



REF

D-0362

набор реагентов
для иммуноферментного
количественного и качественного
определения иммуноглобулинов
класса G к вирусу гепатита А

Вектогеп А-IgG

LOT 200

СОСТАВ:

LOT

✓ 1. Планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВГА	1 шт.		227
✓ 2. Калибровочные образцы, инаktivированные	4 фл.	по 1,5 мл	200
✓ 3. Калибровочный образец, инаktivированный	1 фл.	2,5 мл	200
✓ 4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	200
✓ 5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.	по 28,0 мл	2866
✓ 6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл	959
✓ 7. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	140496
✓ 8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл	10466
✓ 9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1351


Принадлежности:

Пленка для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночка для реагента	2 шт.
Наконечники для пипетки	16 шт.
Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.

Фототрафическое изображение общего вида модифицированного набора реактивов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови (Вектоген А-IgG)»

АО «Вектор-Бест»

«27» ОКТ 2020 г.
ВЕКТОР
БЕСТ

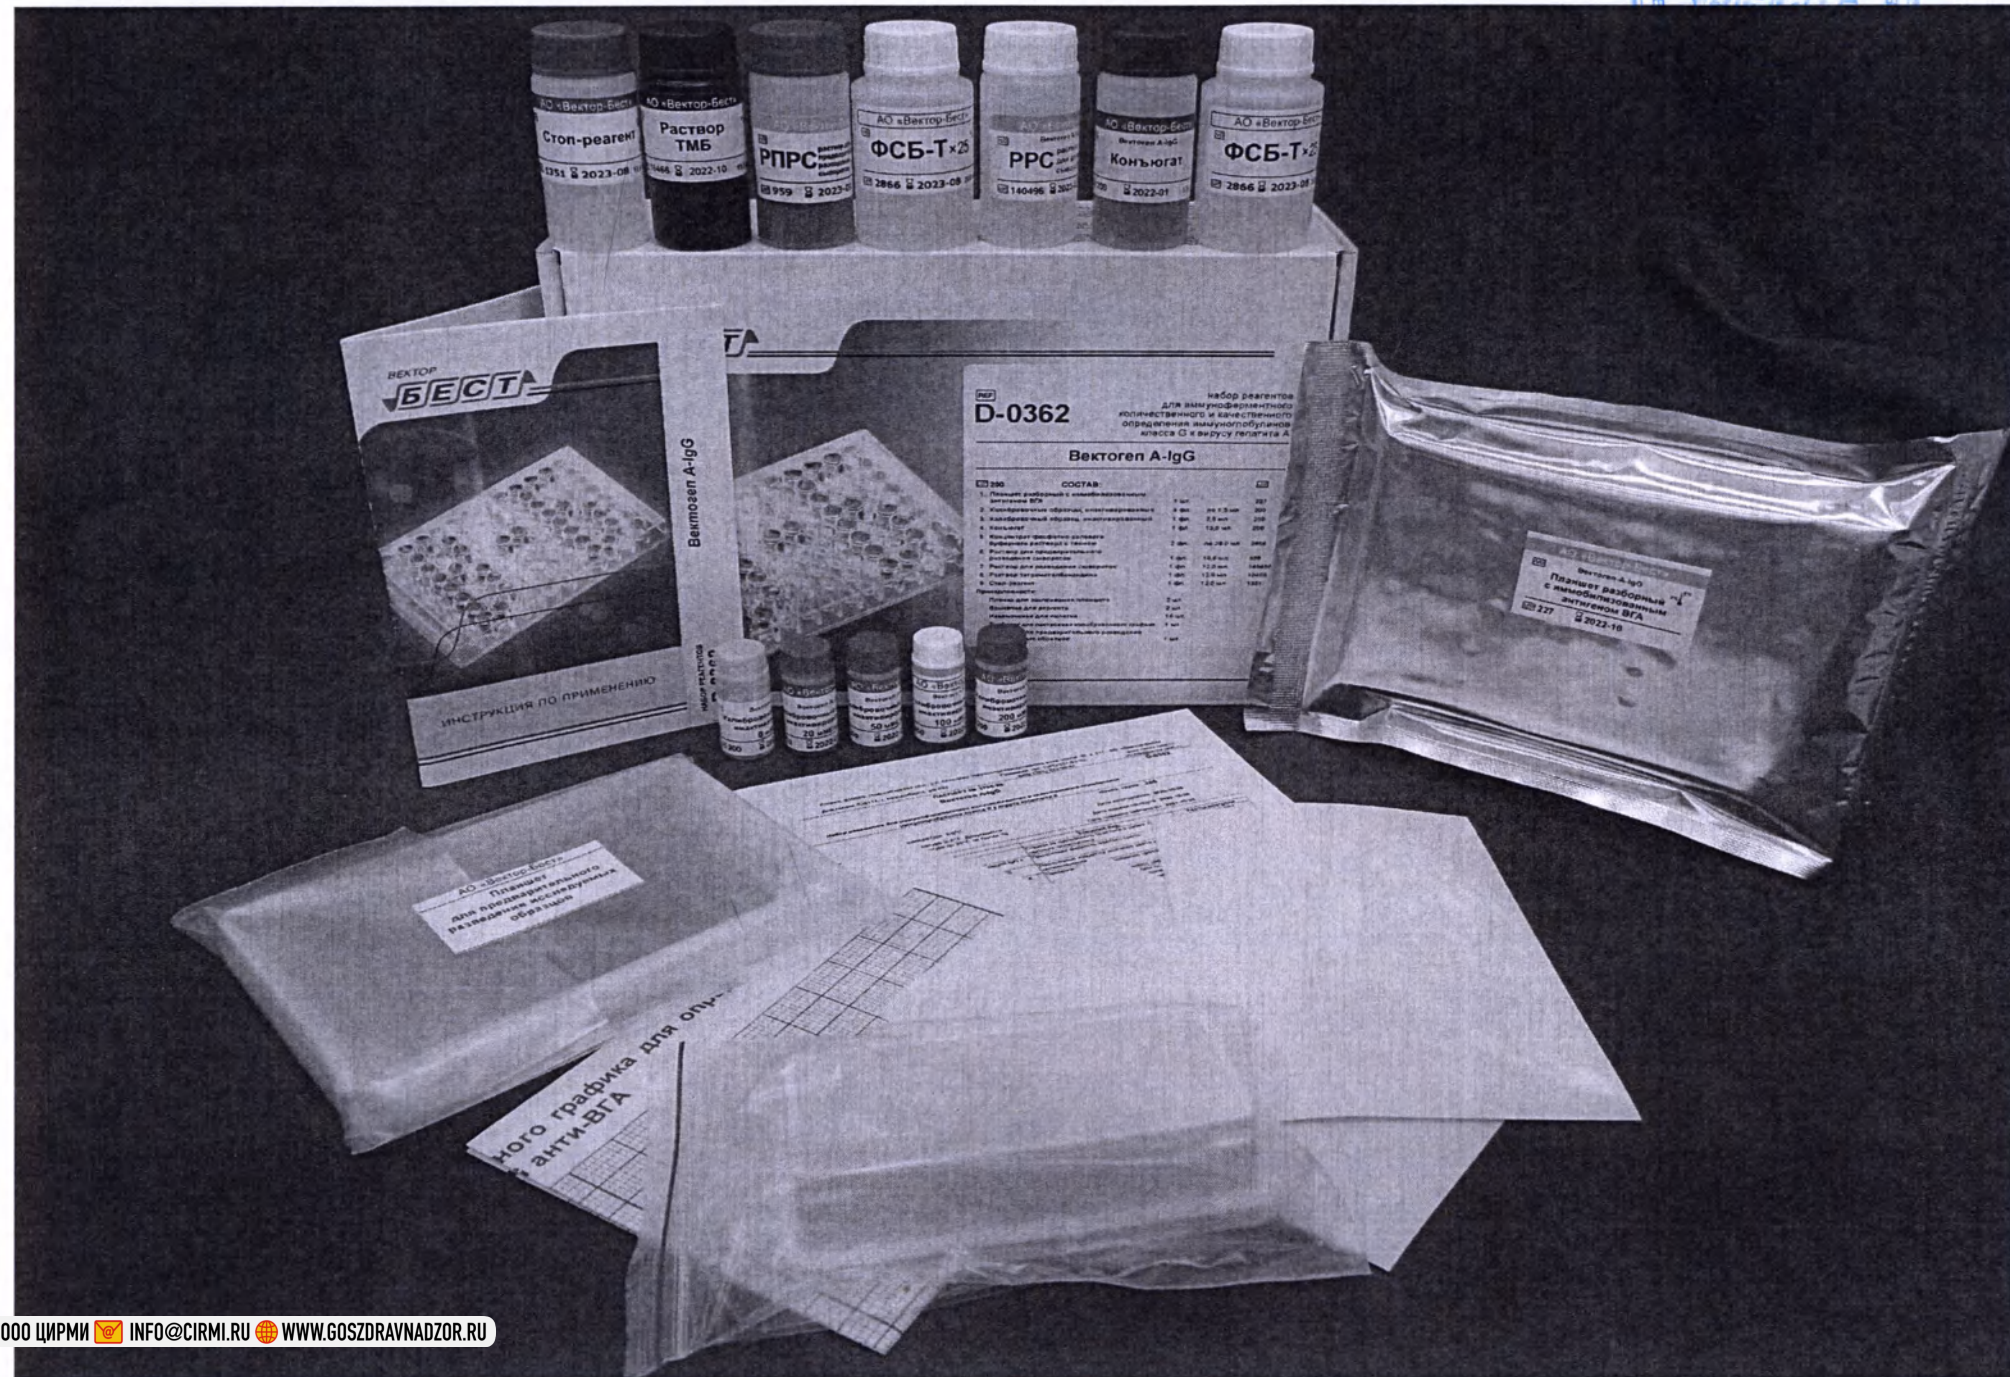

REF **D-0362**

Σ
12x8

LOT

200

ТУ 9398-343-23548172-2012

РУ № ФСР 2012/14011 от 20.03.2017




2020-10-20



2021-10-20

Вектогеп А-IgG

IVD




03622010210020000169

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фототрафическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови (Вектоген А-IgG)» № 1


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

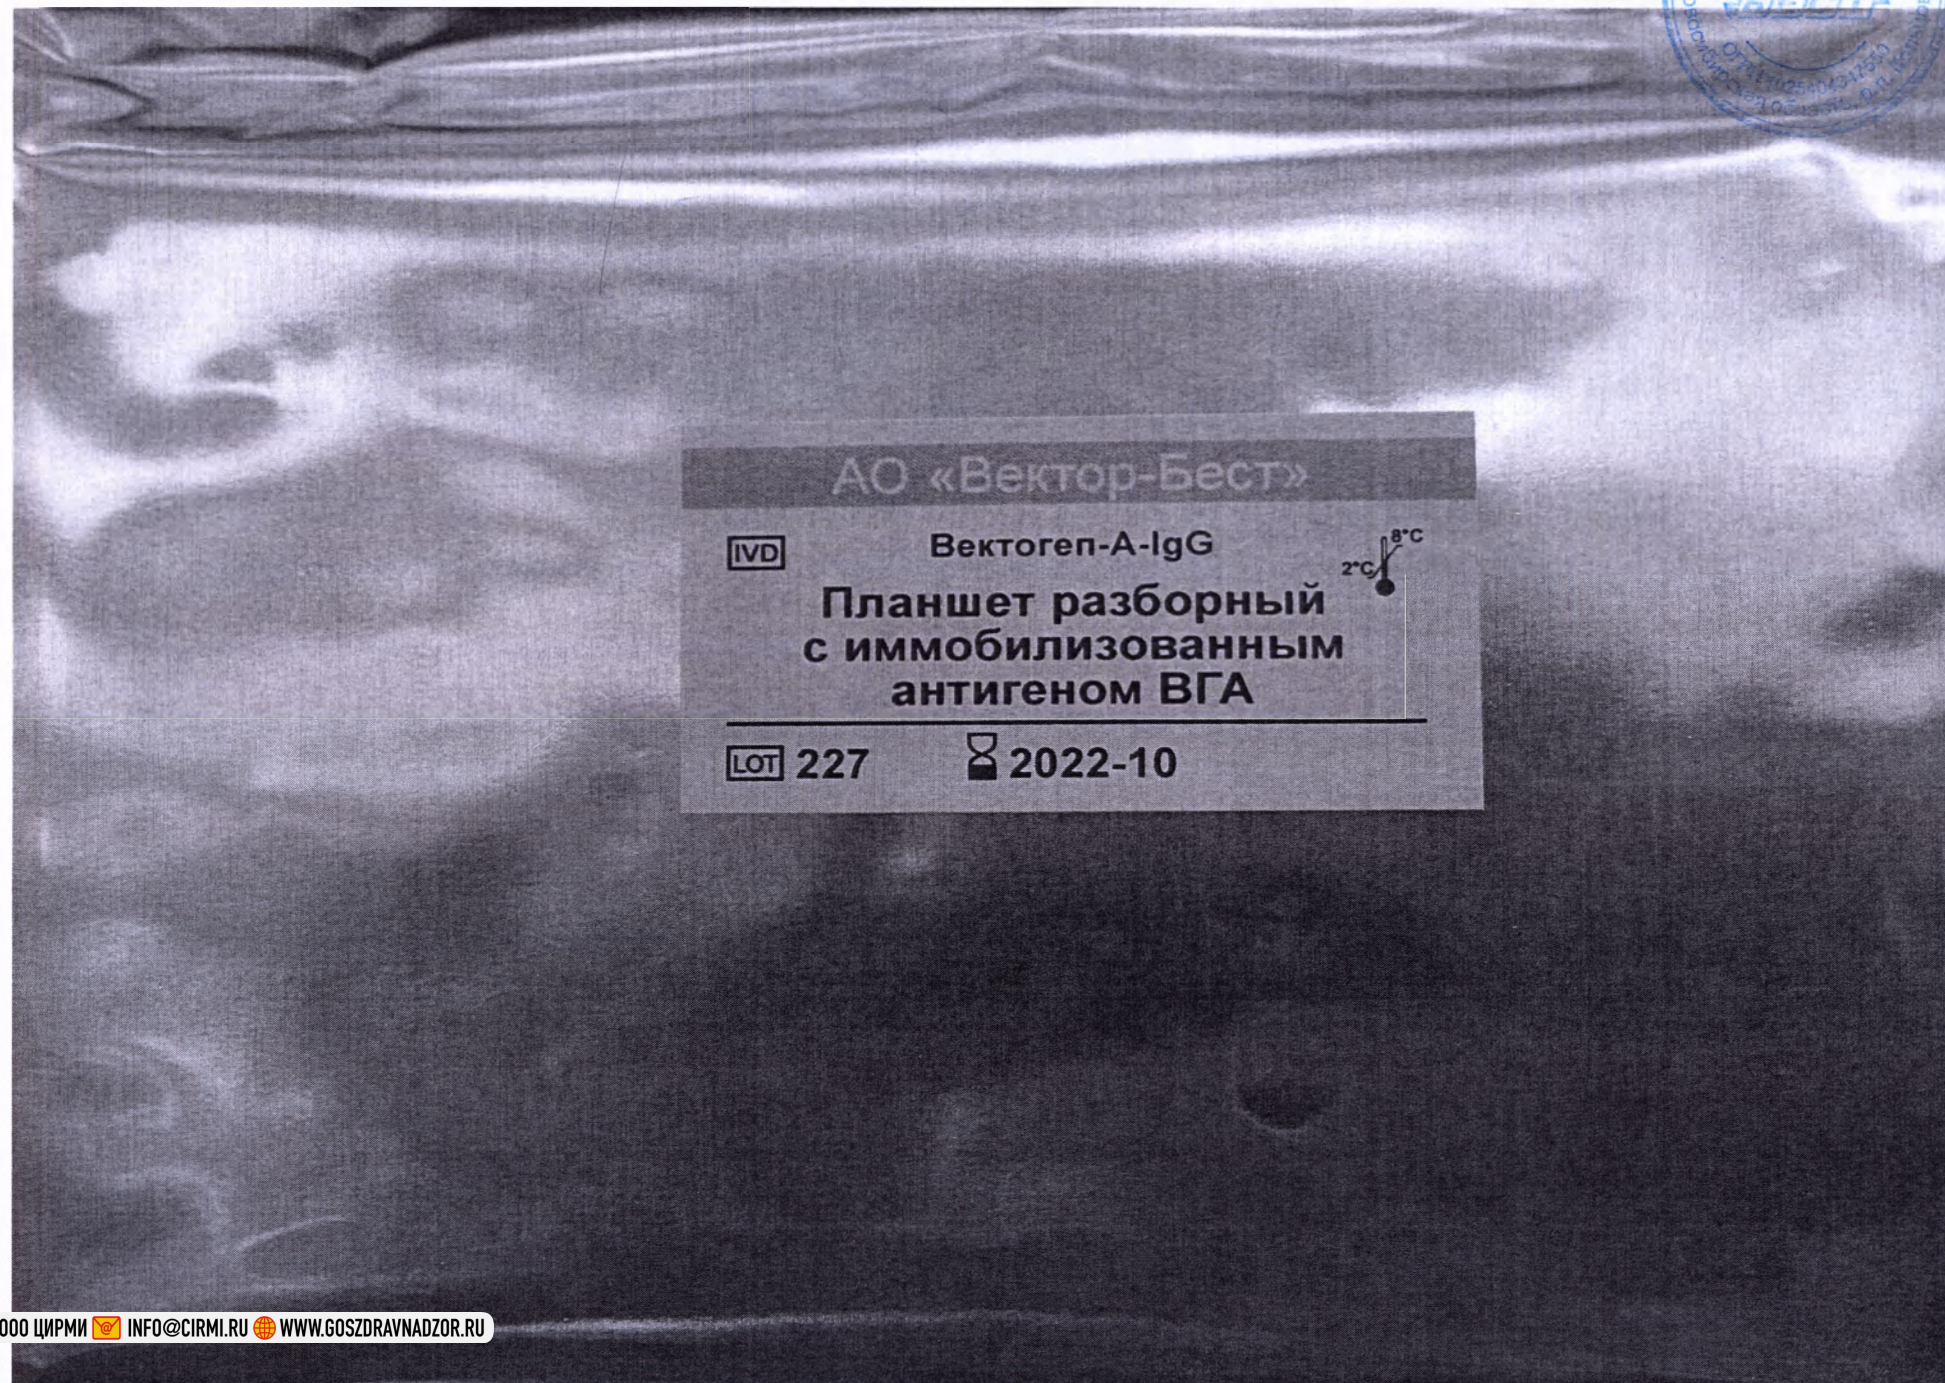

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови (Вектогеп А-IgG)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


« 27 » ОКТ 2020 г.
АО «Вектор-Бест»
ВЕКТОР

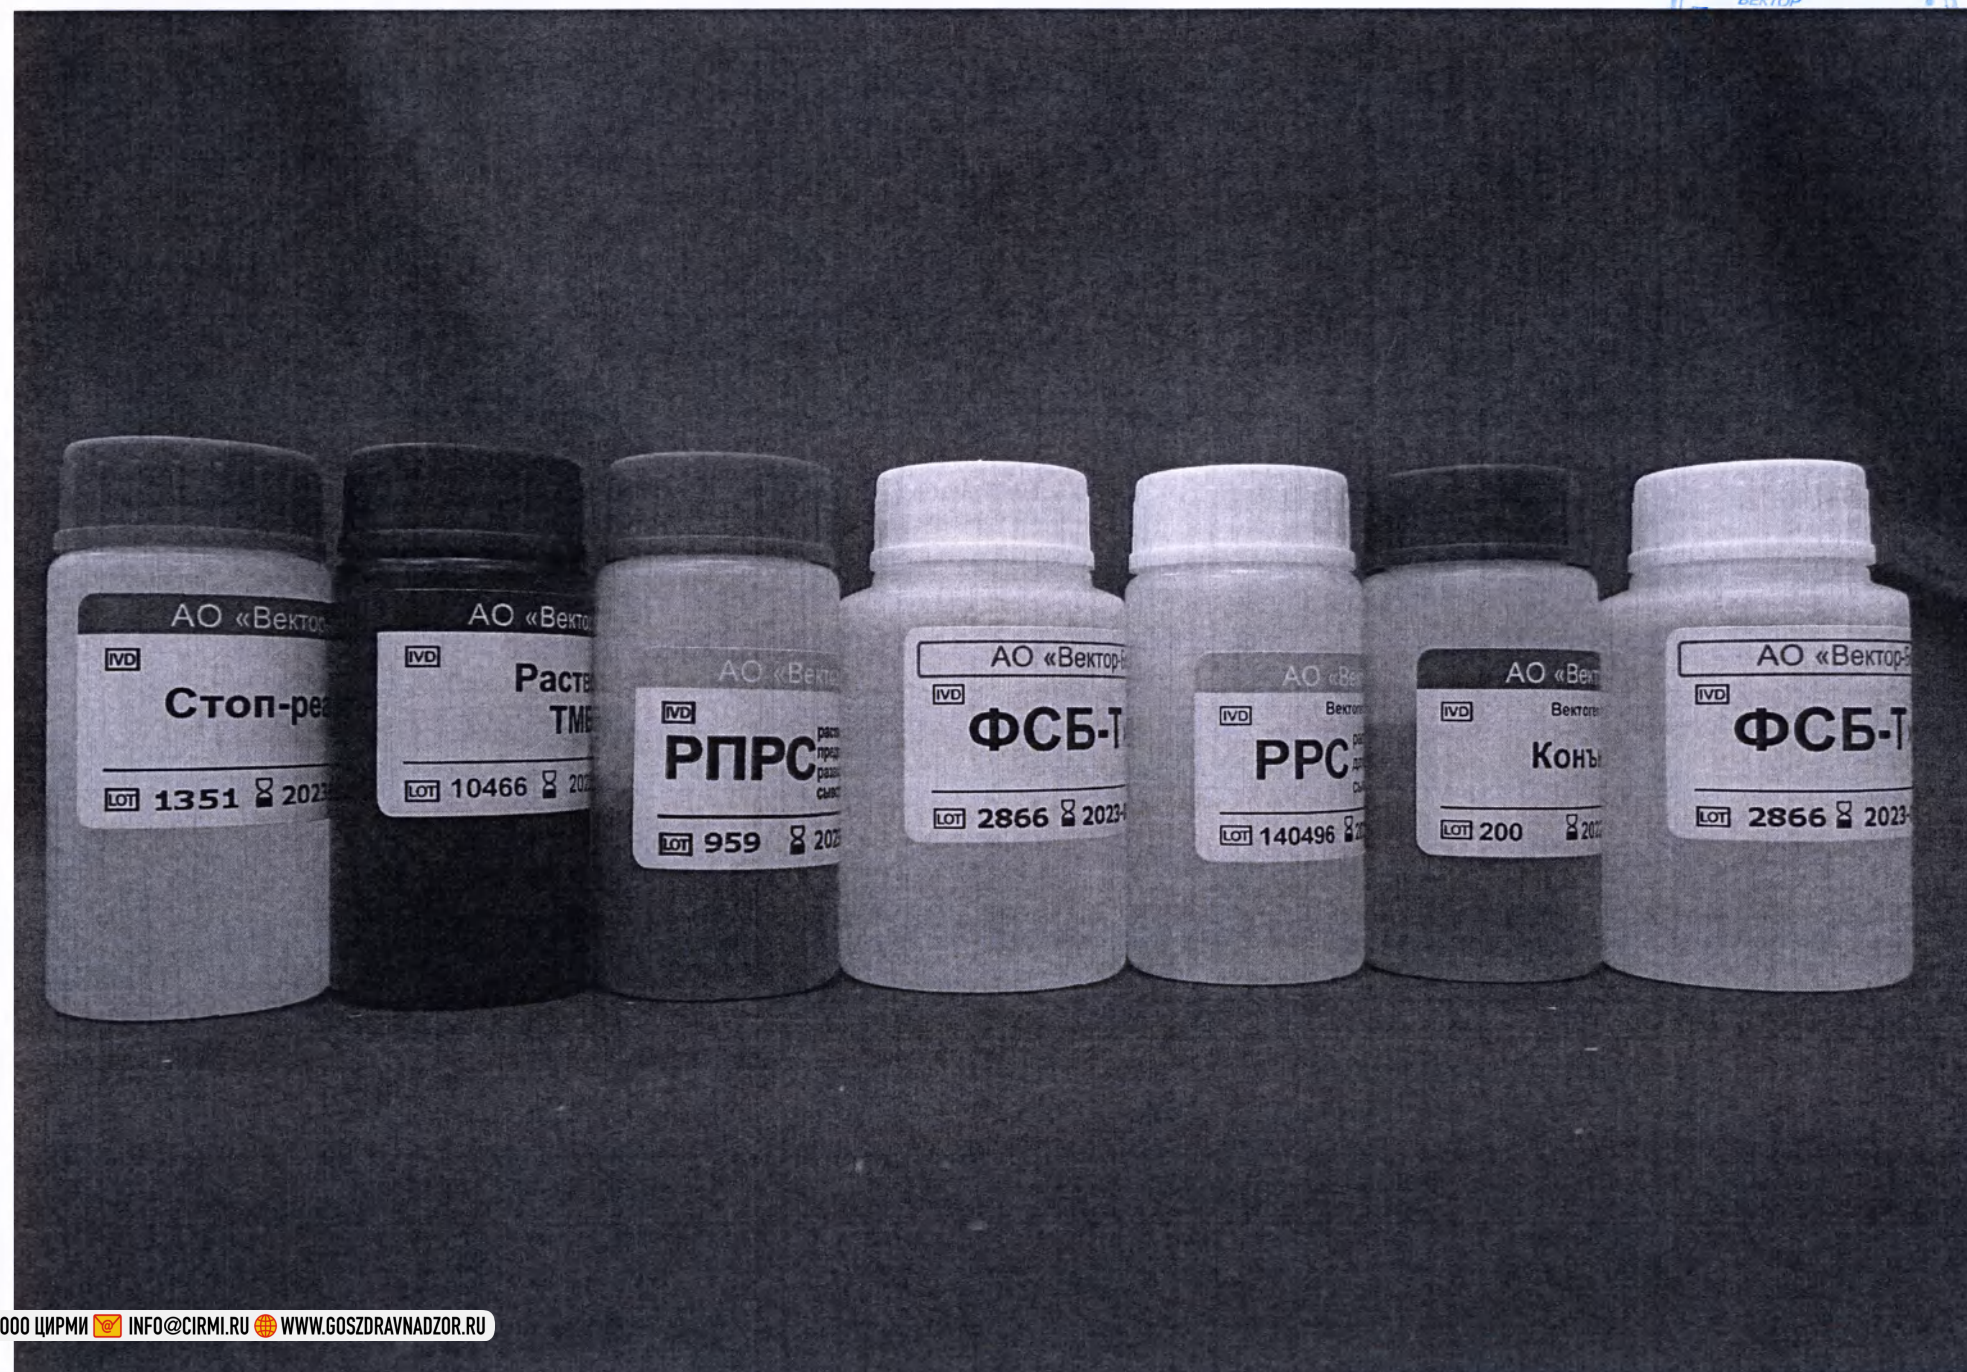

фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови (Вектореп А-IgG)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


27 ОКТ
2020 г.

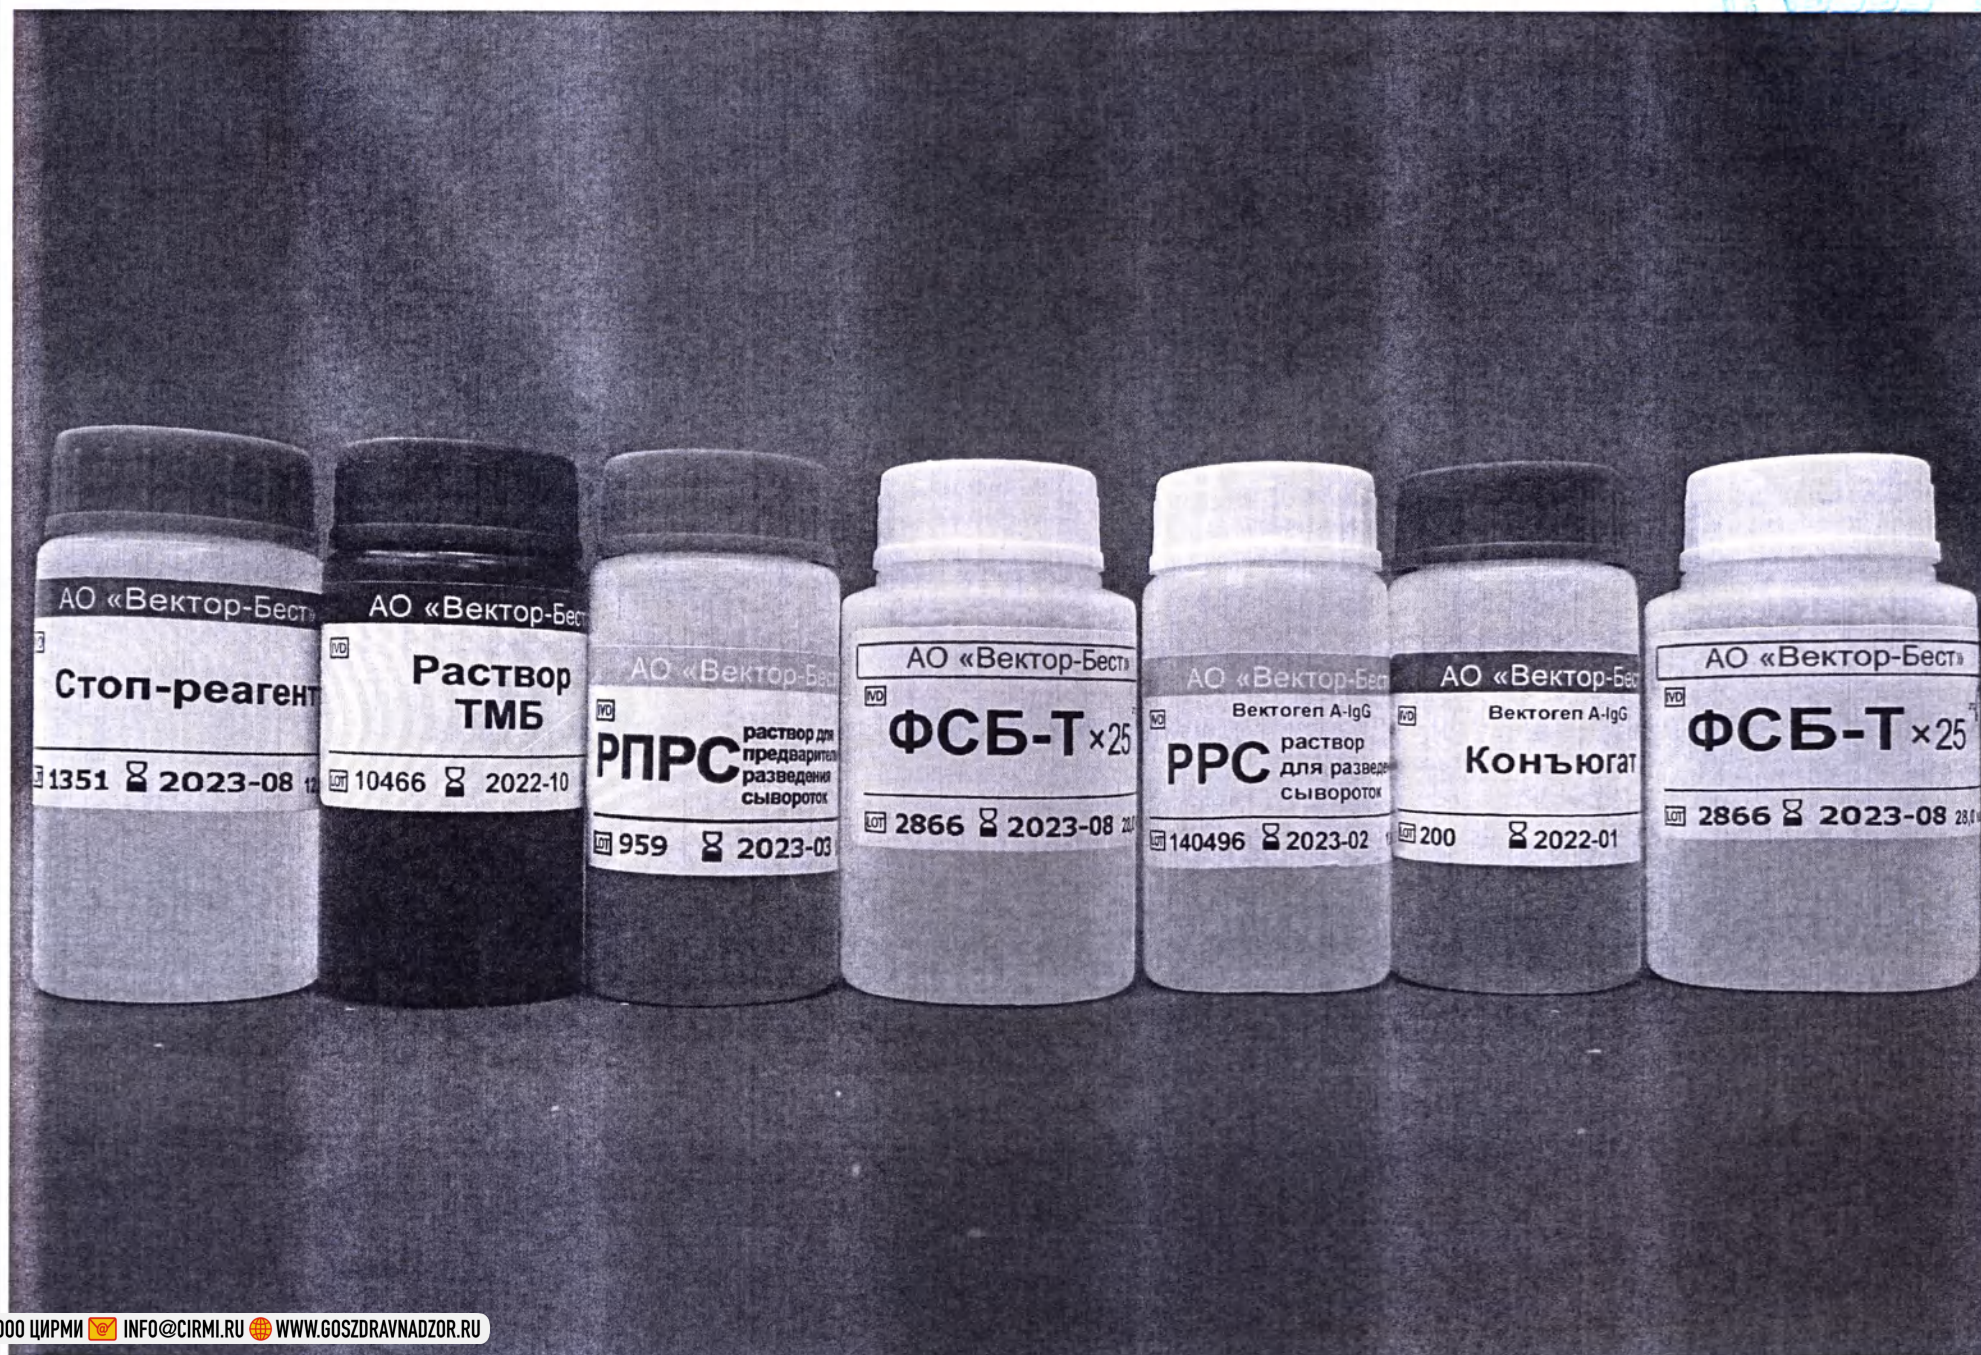

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови (Вектогеп А-IgG)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

« 17 Окт 2020 г. »
БЕКТОР
ВЕКТОР-БЕСТ

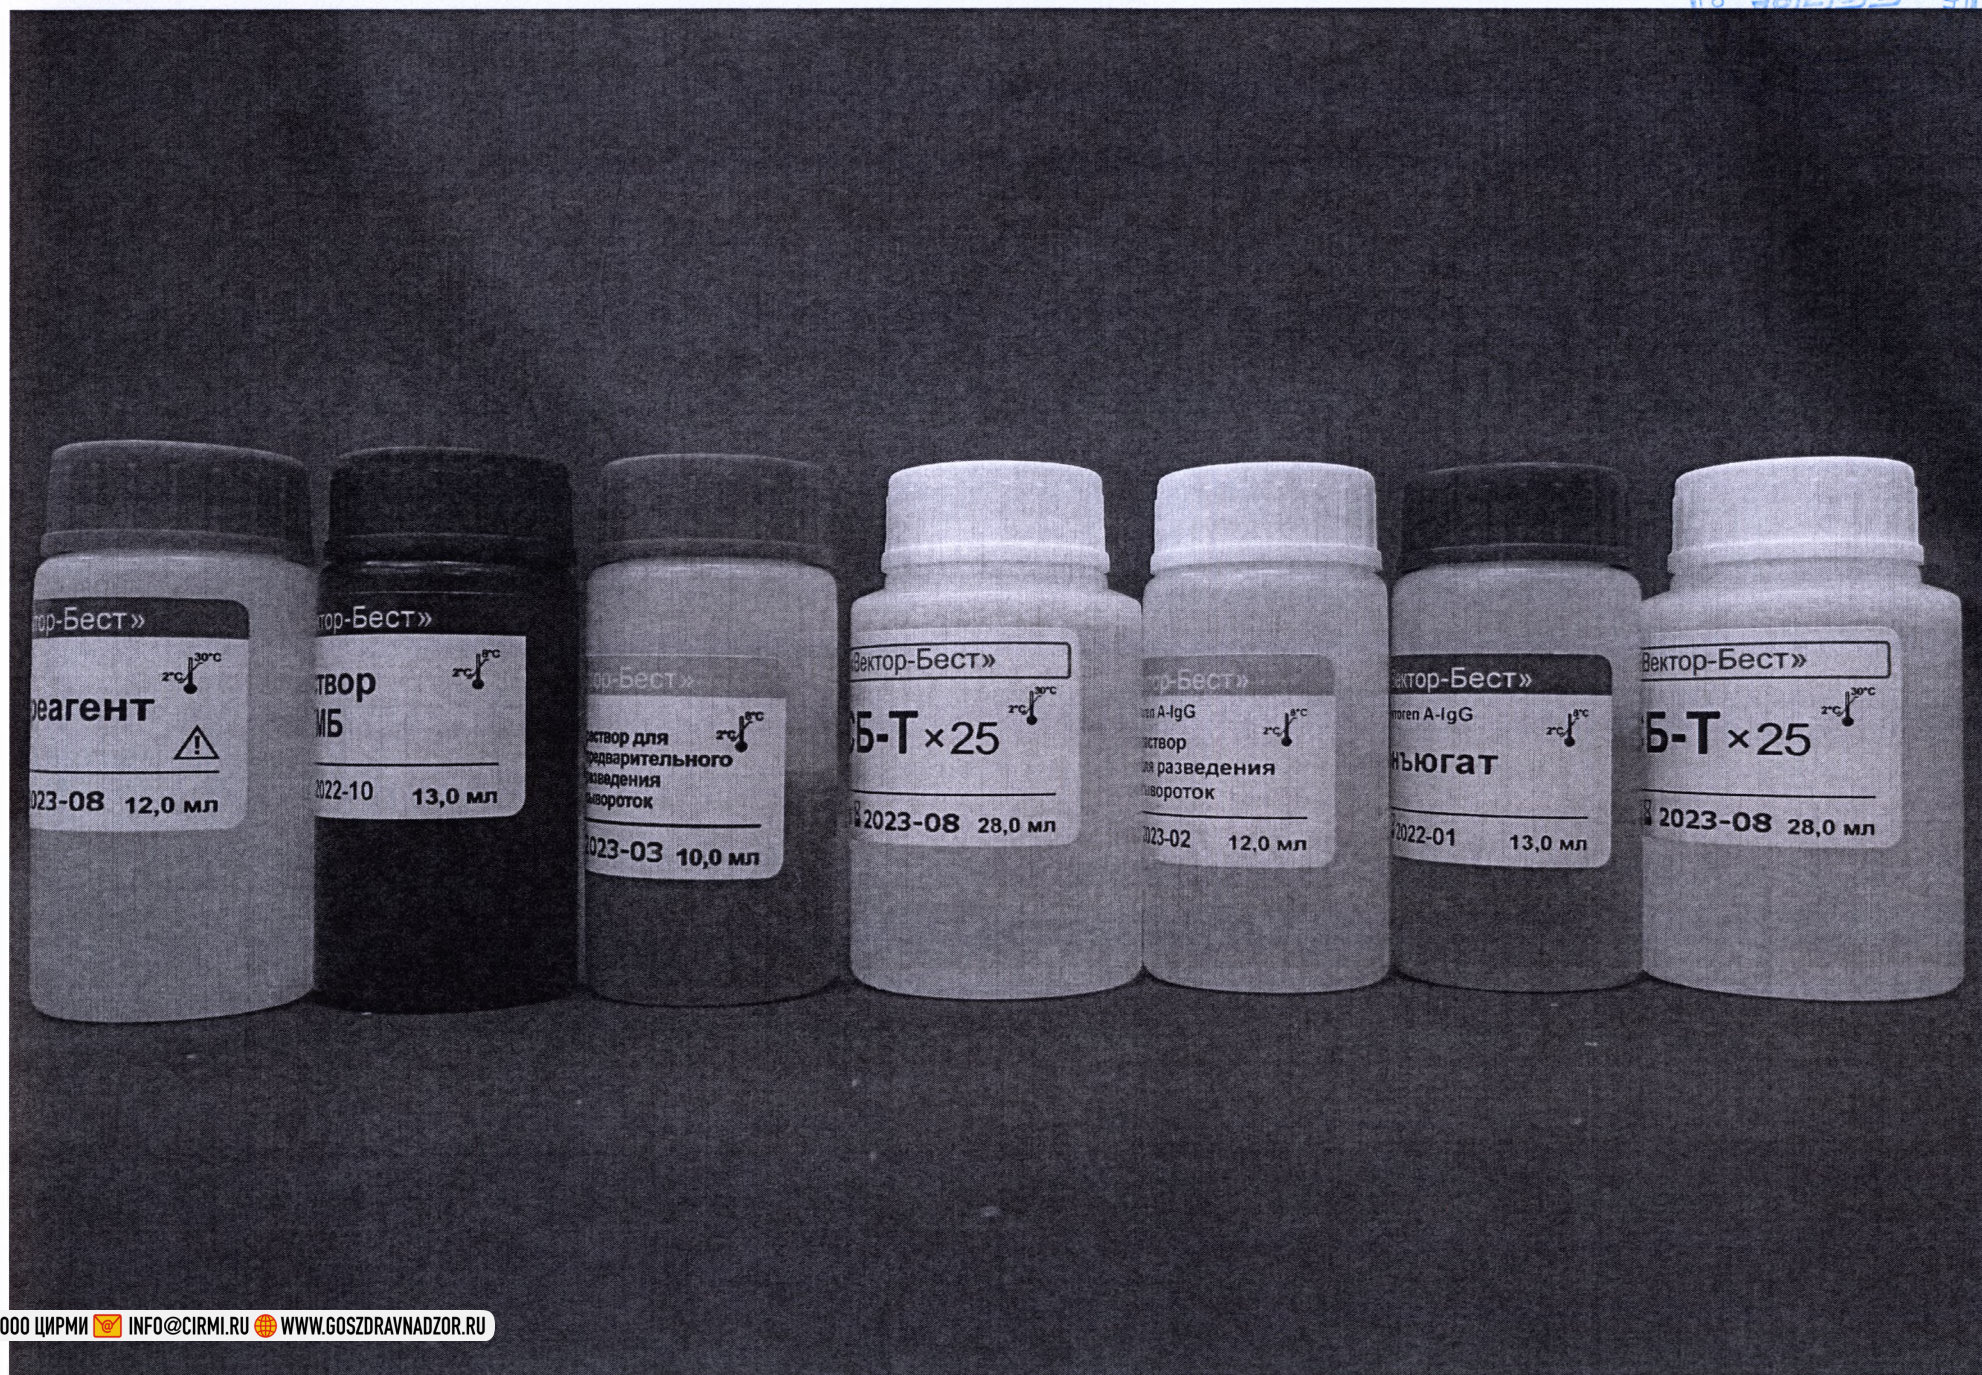

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови (Вектоген А-IgG)» № 5

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови (Вектоген А-IgG)» № 7

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

