


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к *Chlamydia trachomatis* (ХламиБест С. trachomatis-IgG)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2020 г.

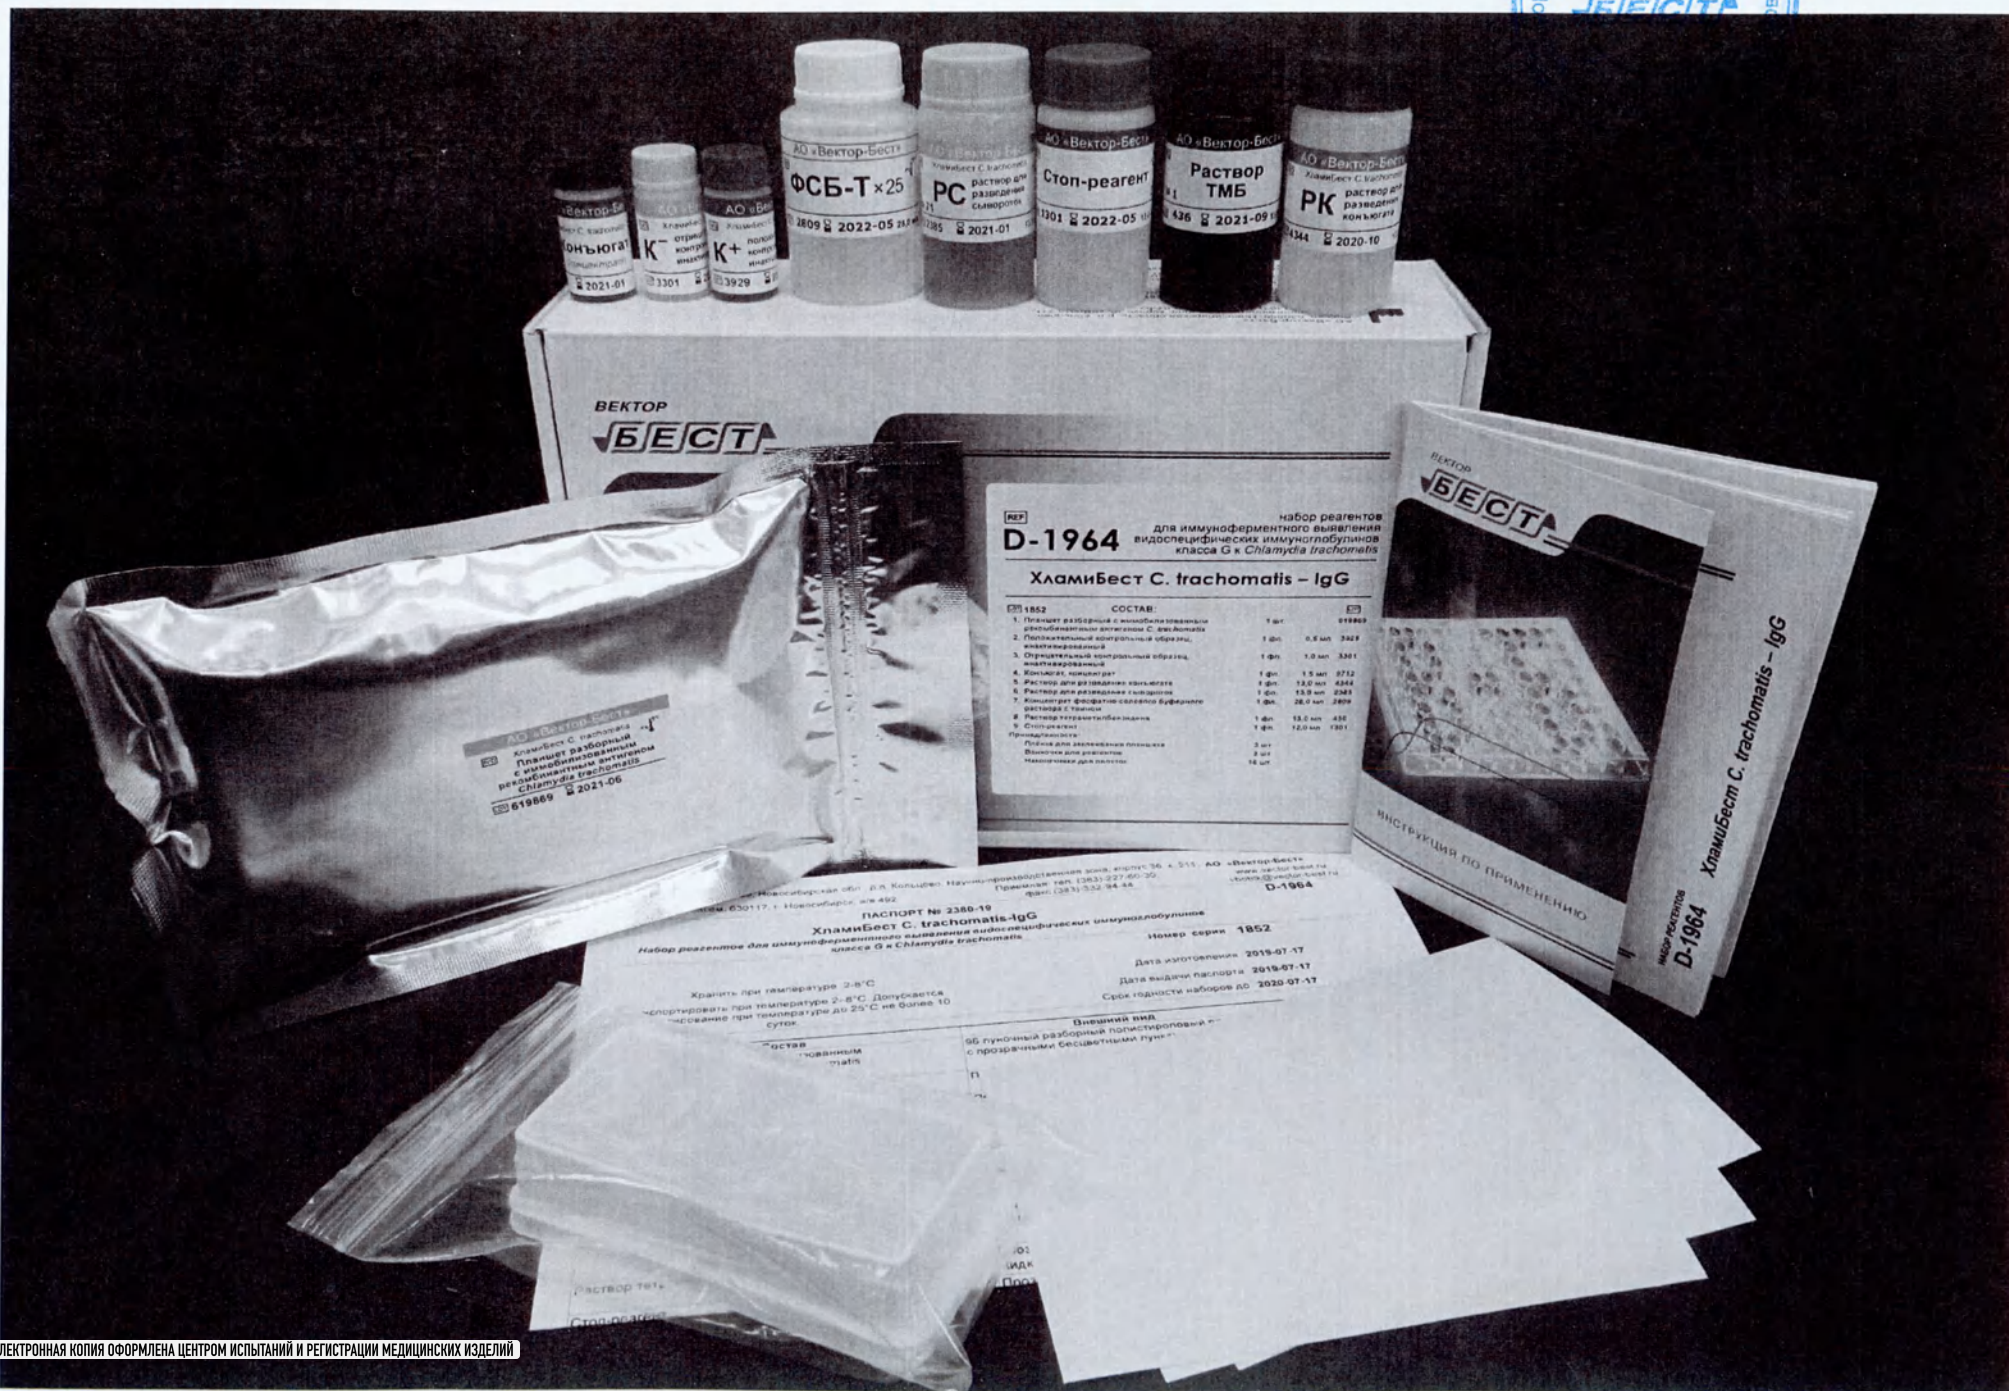

ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-1964

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
видоспецифических иммуноглобулинов
класса G к *Chlamydia trachomatis*

ХламиБест С. trachomatis – IgG

LOT 1852


СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном <i>C. trachomatis</i>	1 шт.	619869
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	0,5 мл 3929
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	1,0 мл 3301
4. Конъюгат, концентрат	1 фл.	1,5 мл 9712
5. Раствор для разведения конъюгата	1 фл.	13,0 мл 4344
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	13,0 мл 2385
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл 2809
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл 436
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл 1301
Принадлежности:		
Плёнка для заклеивания планшета	3 шт.	
Ванночки для реагентов	2 шт.	
Наконечники для пипеток	16 шт.	

ВЕКТОР

БЕСТ

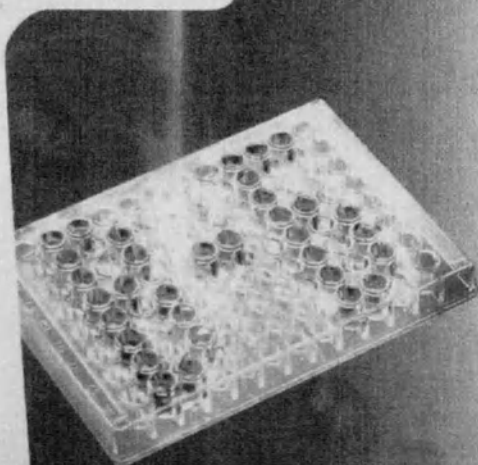

REF **D-1964**

Σ 12×8

LOT **1852**

ТУ 9398-134-23548172-2014

ПУ № РЗН 2014/2202 от 24.03.2017

2019-07-17

2020-07-17

ХламиБест С. trachomatis – IgG

IVD




19641707200185200513


Для профессионального применения


Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к *Chlamydia trachomatis* (ХламиБест С. trachomatis-IgG)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«06 Фев» 2020 г.

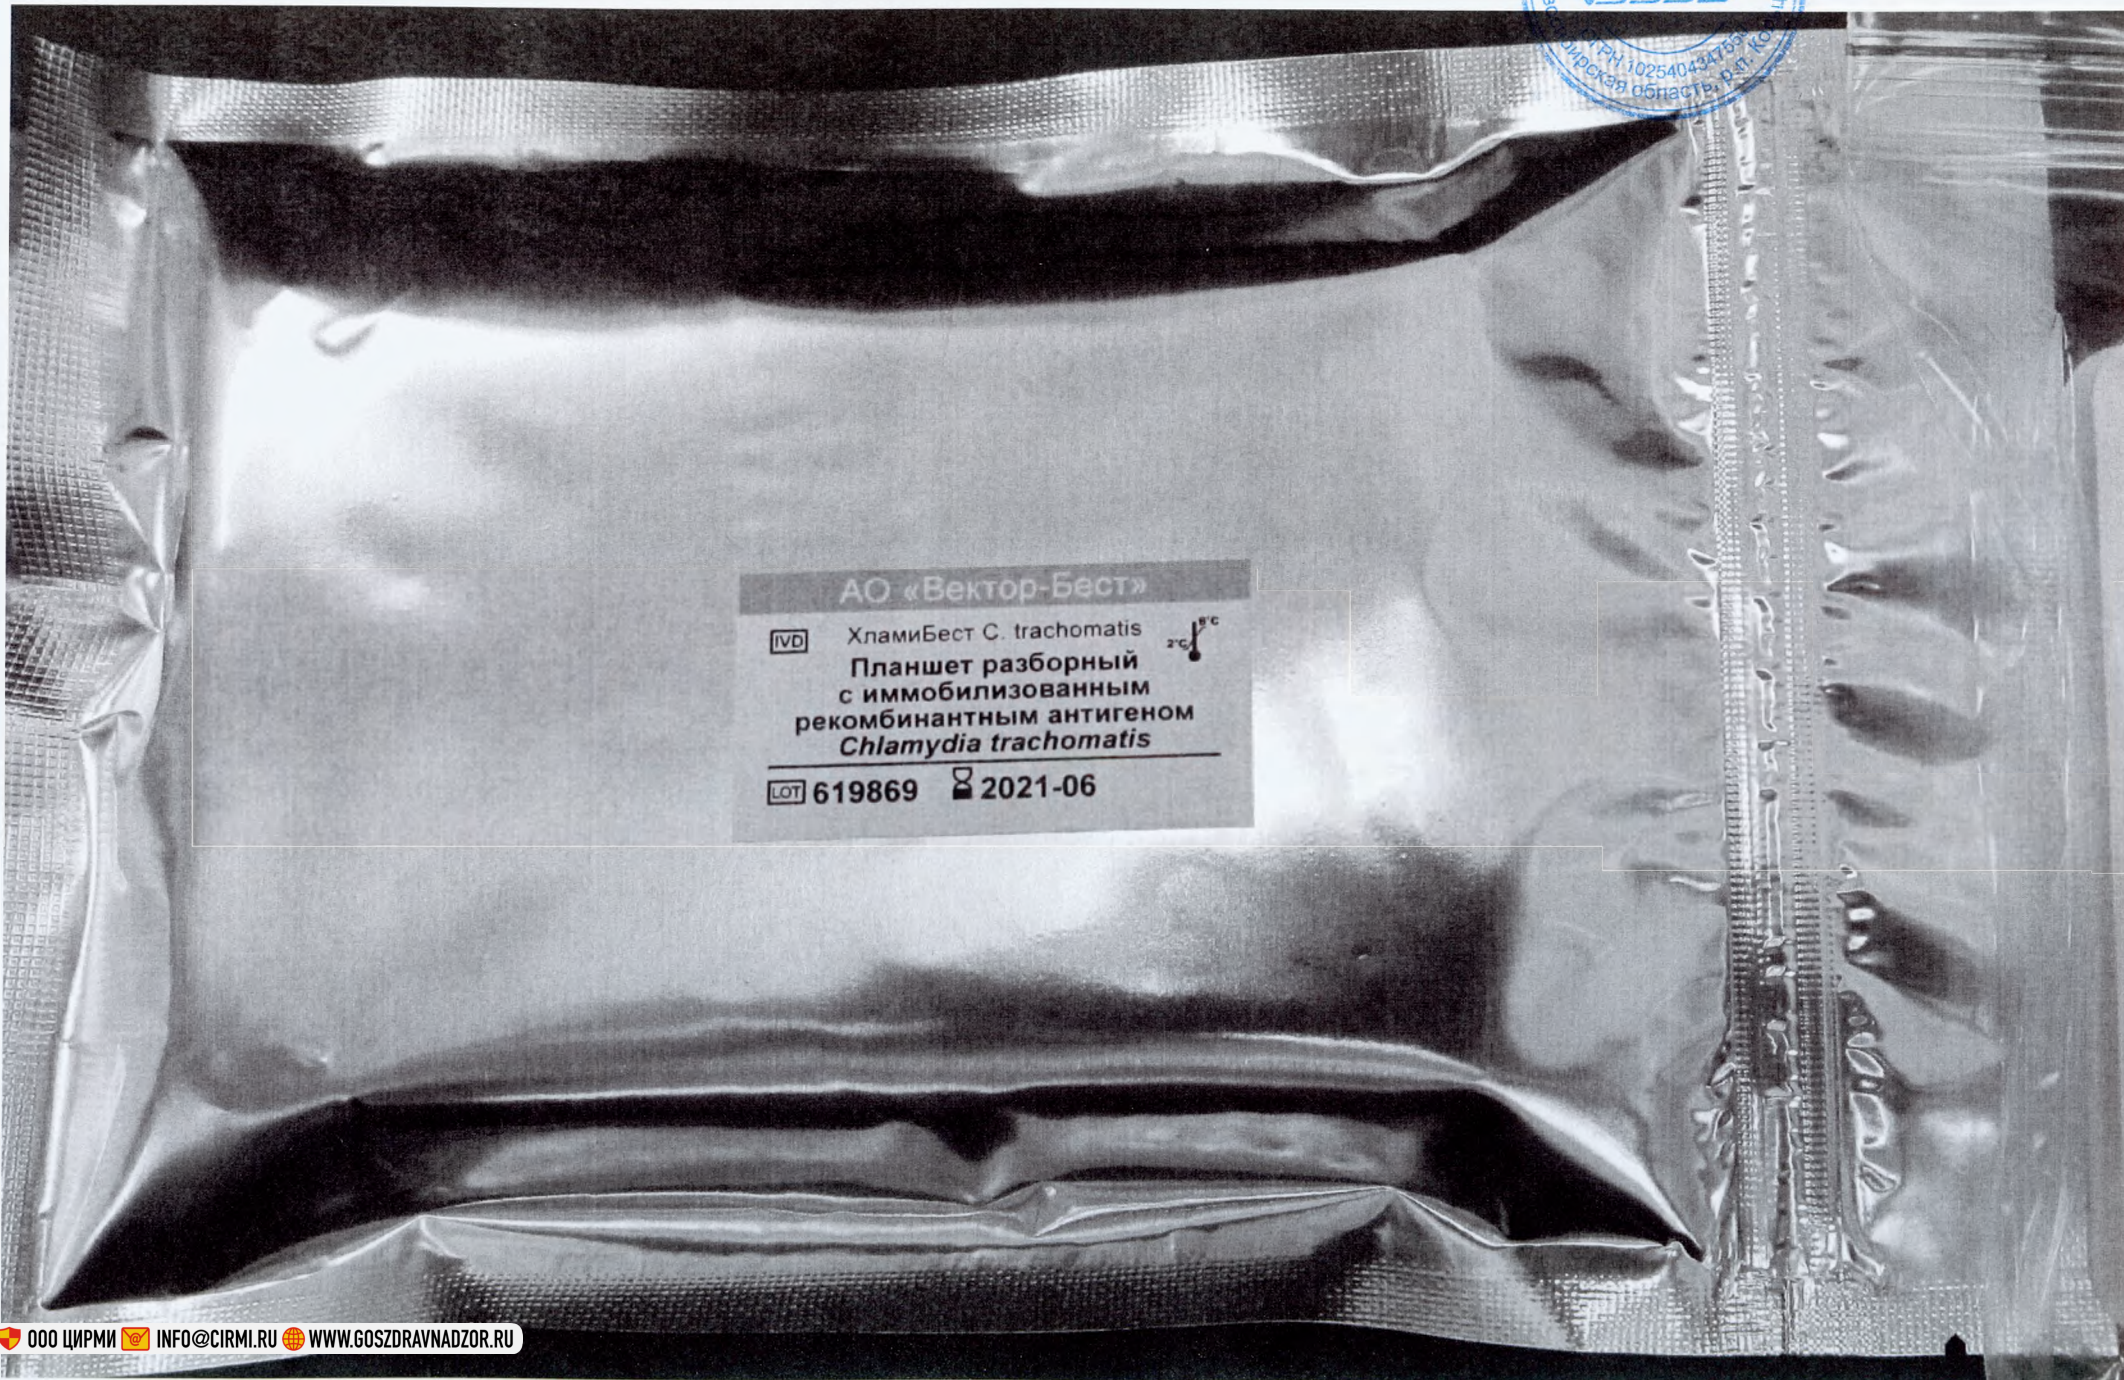

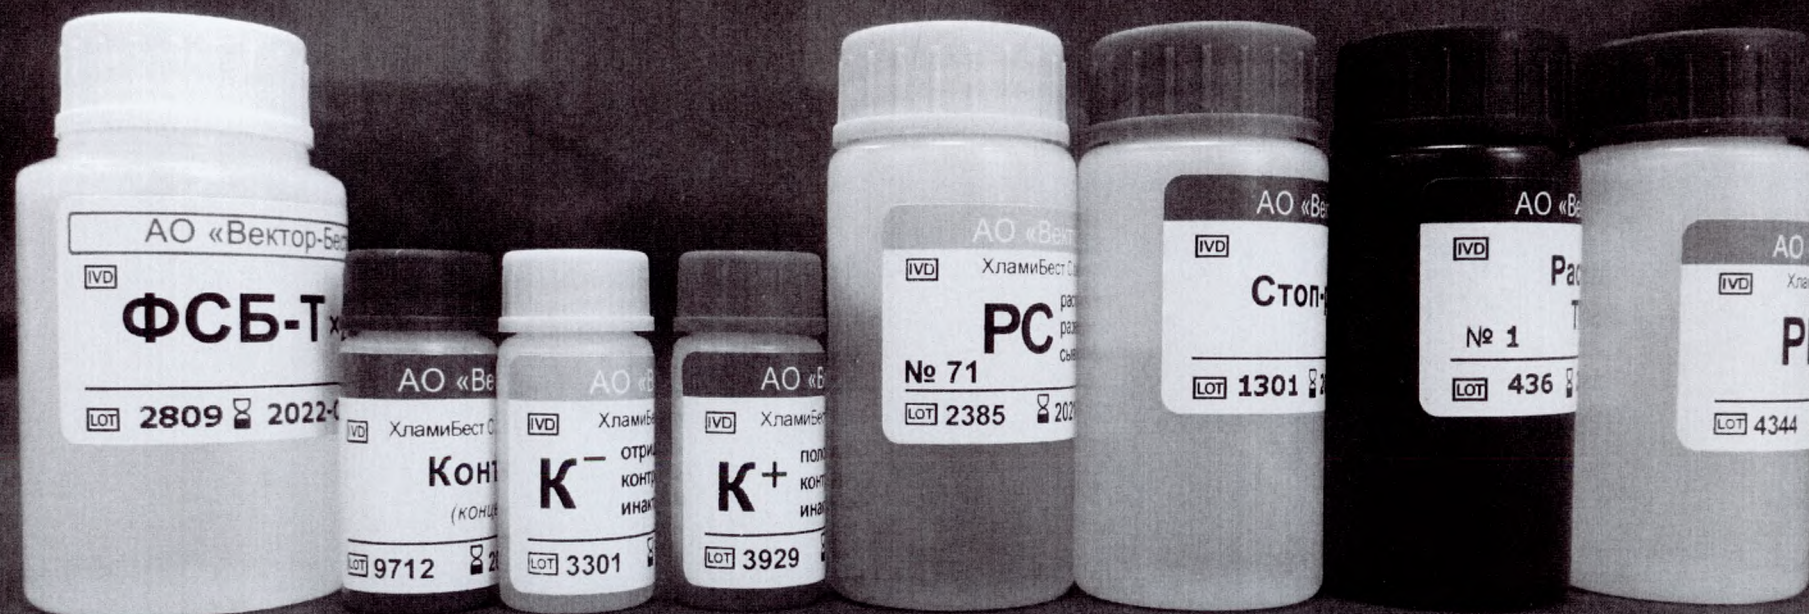

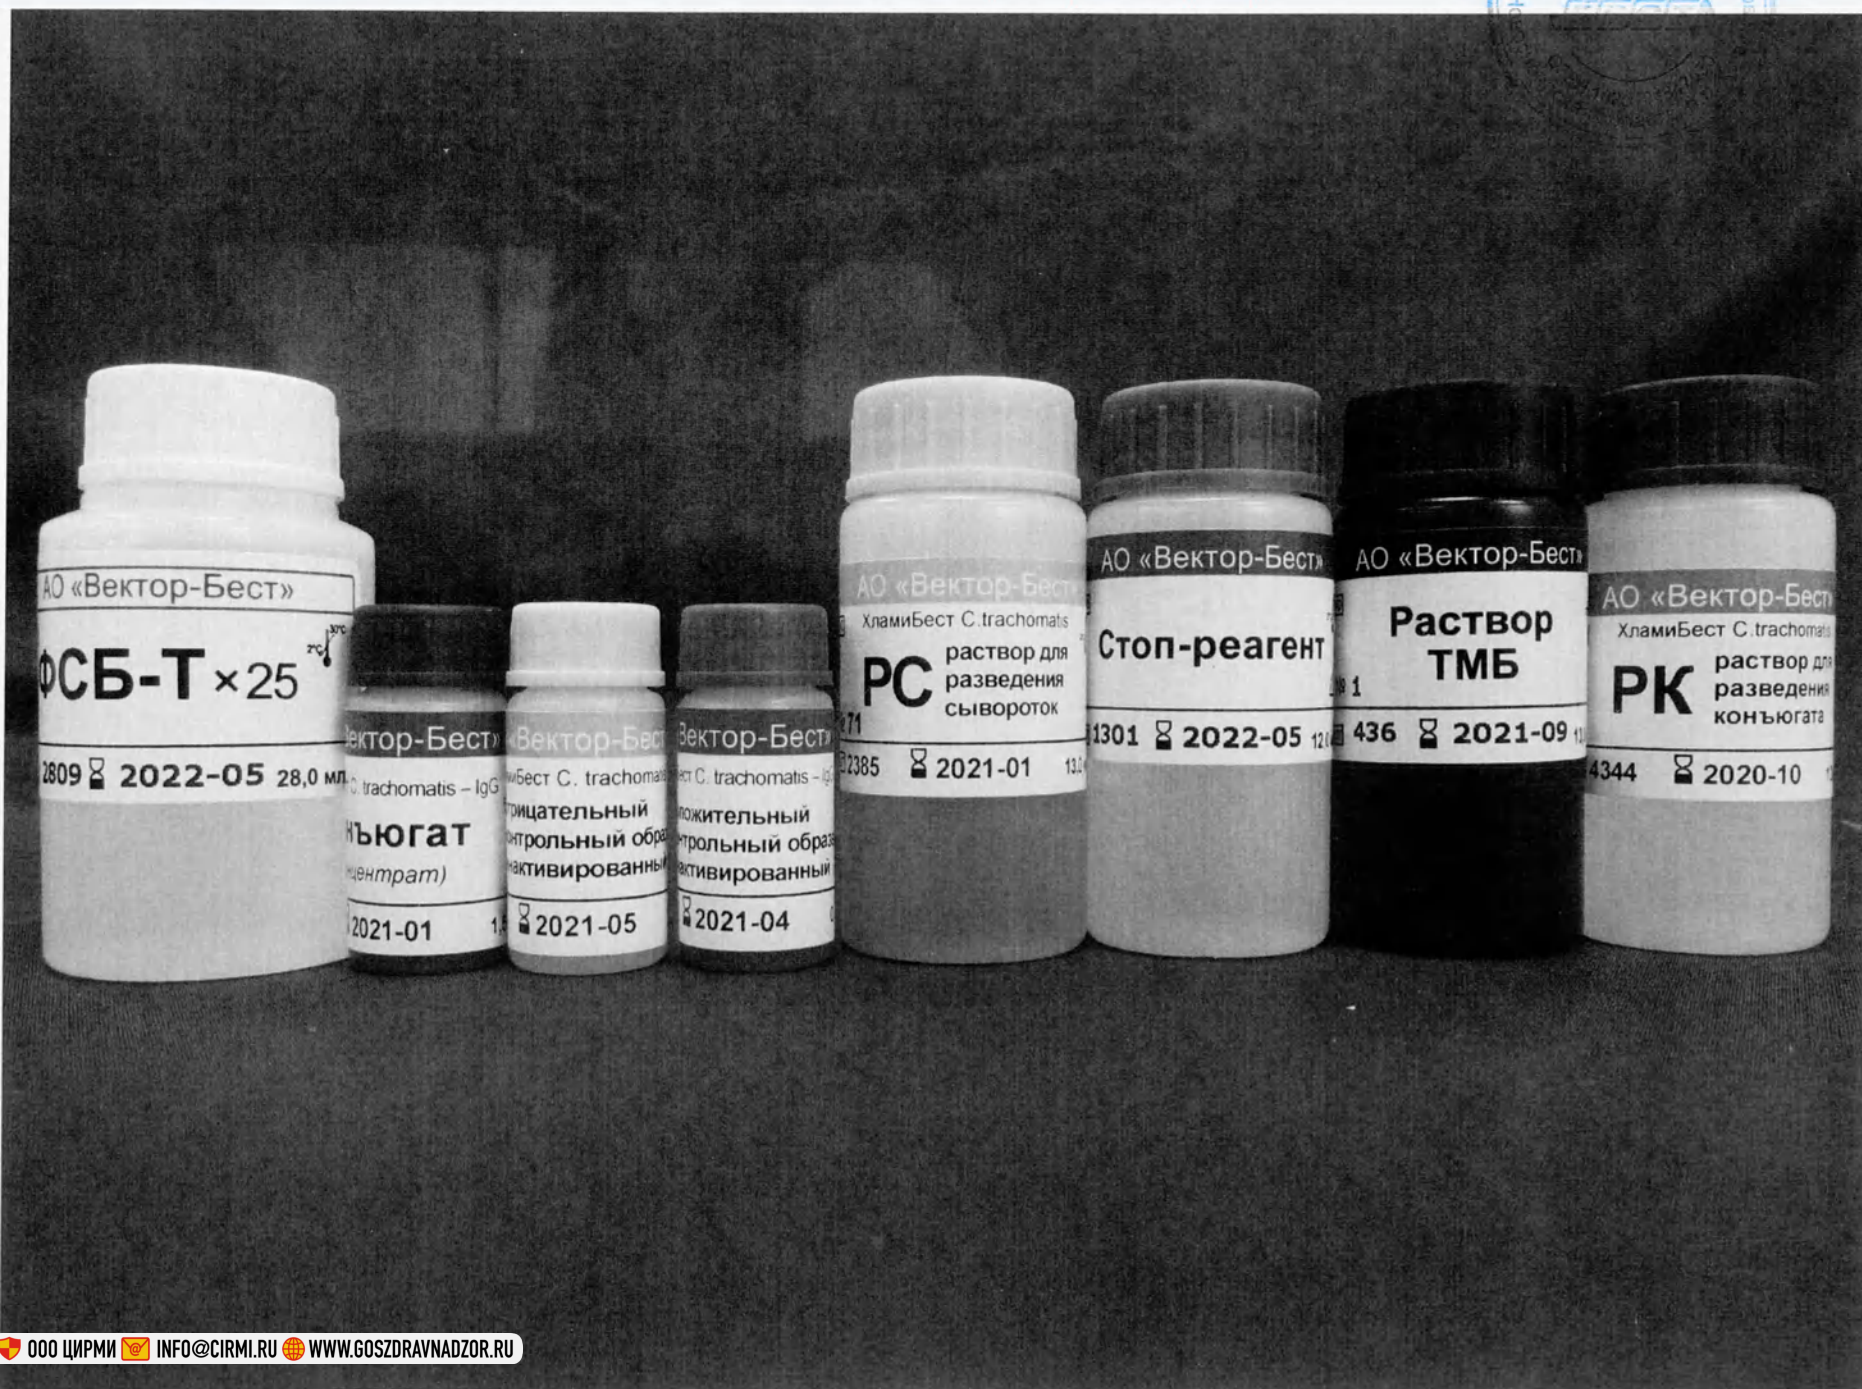

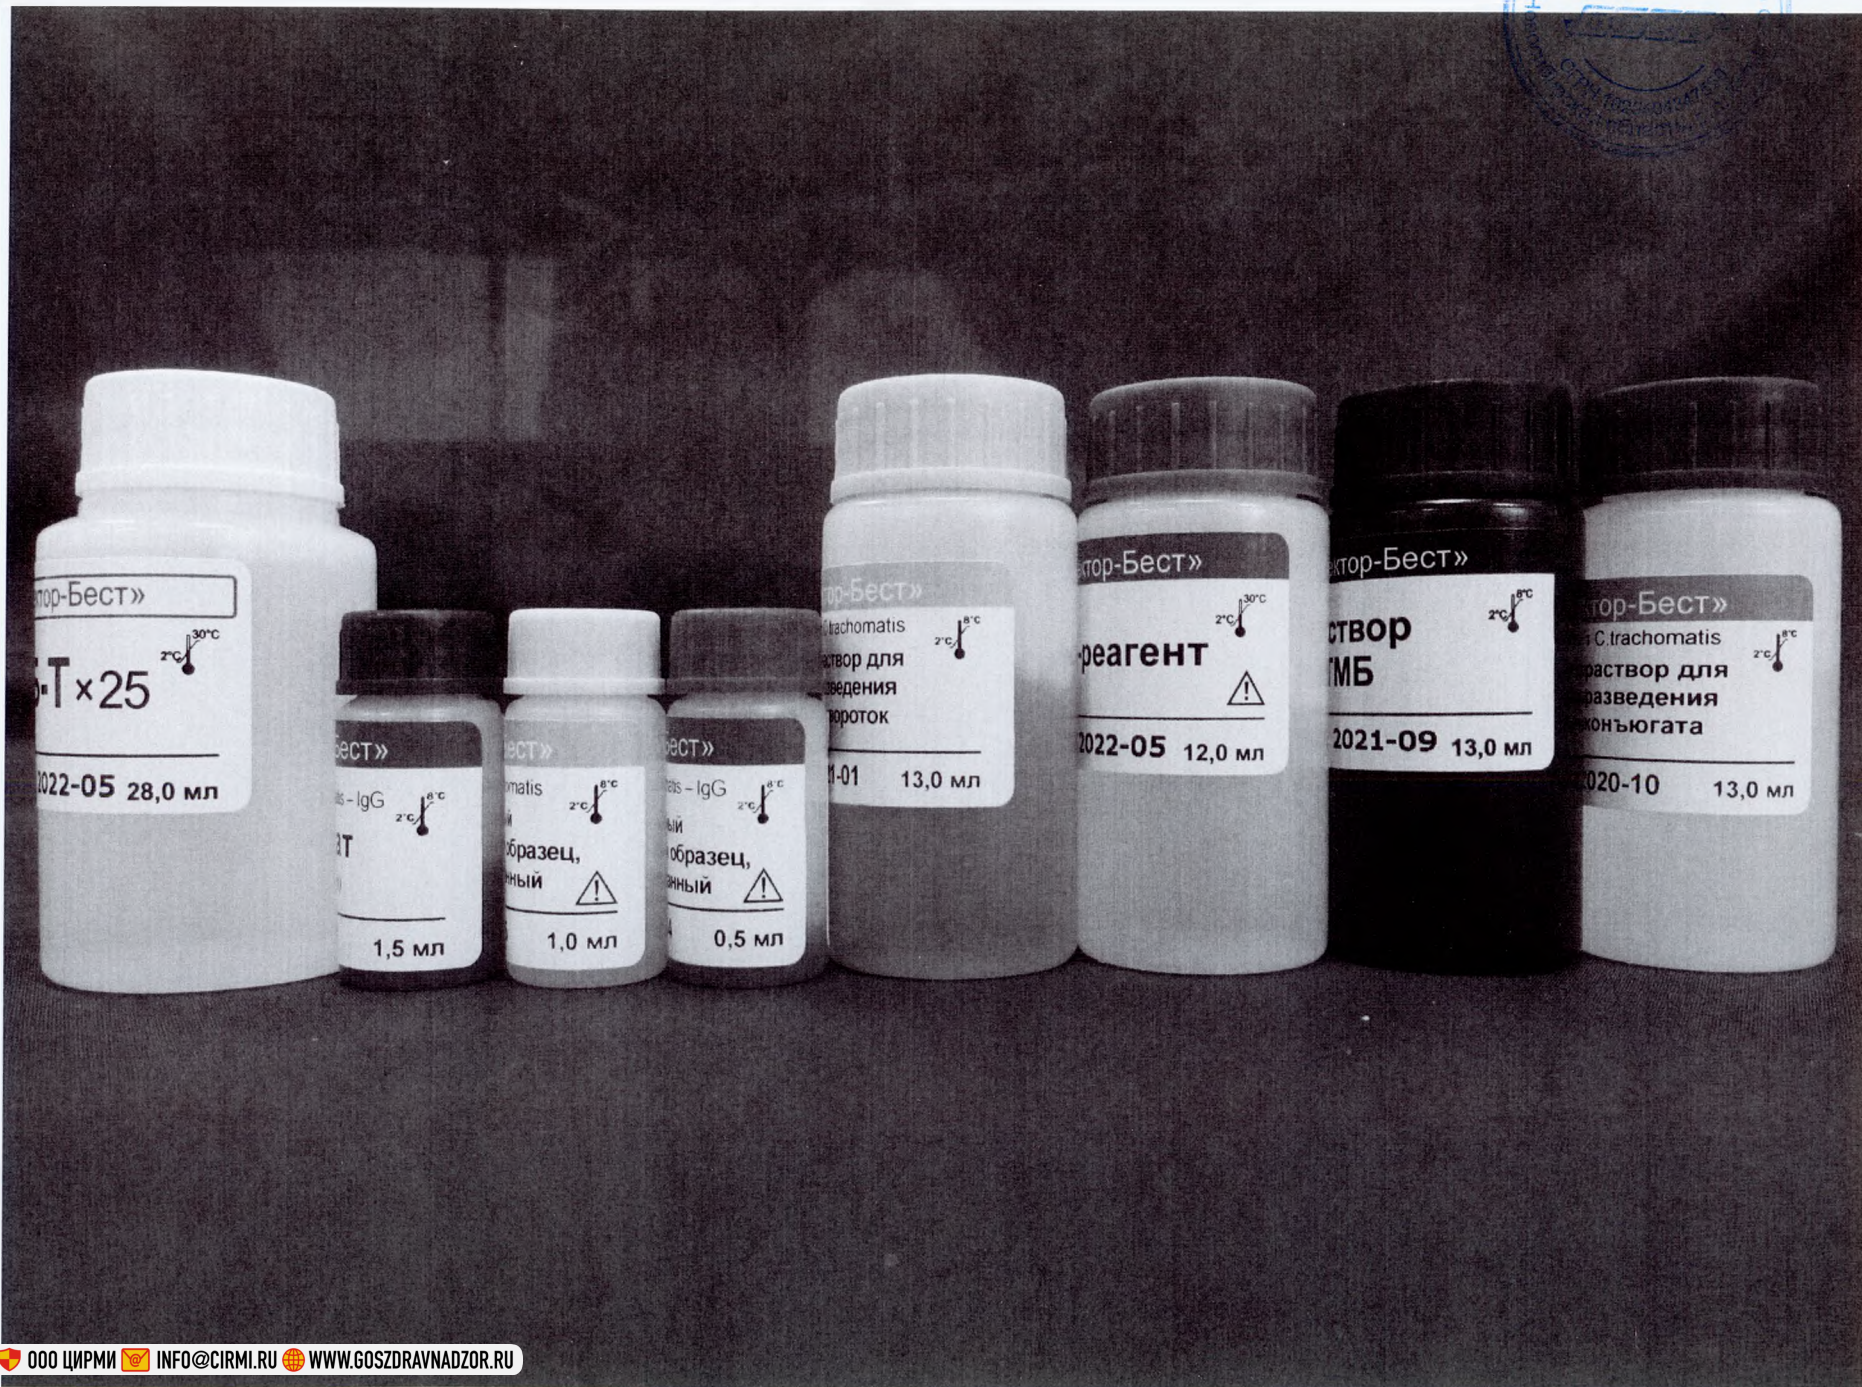

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере
здравоохранения

от 17.02.2020 № 1505

№ п/п	Входящий номер заявления и документов	Дата входящего номера заявления и документов	Номер РУ	Дата РУ	Номер РД, в которое вносятся изменения	Дата РД, в которое вносятся изменения	Наименование медицинского изделия	Уполномоченн ый представитель производителя	Производитель	Страна производителя	Причина внесения изменений
1	9218	12.02.2020	РЗН 2014/2202	24.03.2017	РД- 16340/82685	14.03.2017	Набор реагентов для иммунофермент ного выявления видоспецифичес ких иммуноглобули нов класса G к Chlamydia trachomatis (ХламиБест С. trachomatis-IgG) по ТУ 9398-134- 23548172-2014	—	АО "Вектор- Бест", 630559, Новосибирская обл., р. п. Кольцово, Научно- производственн ая зона, к. 36, ком. 211	Россия	В связи с изменением наименования медицинского изделия, не требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, а именно изменение маркировки и (или) упаковки медицинского изделия

Начальник Управления

Е.М. Астапенко