


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови (Описторх-IgG-ИФА-БЕСТ)»

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.  
28.05.2020 г.

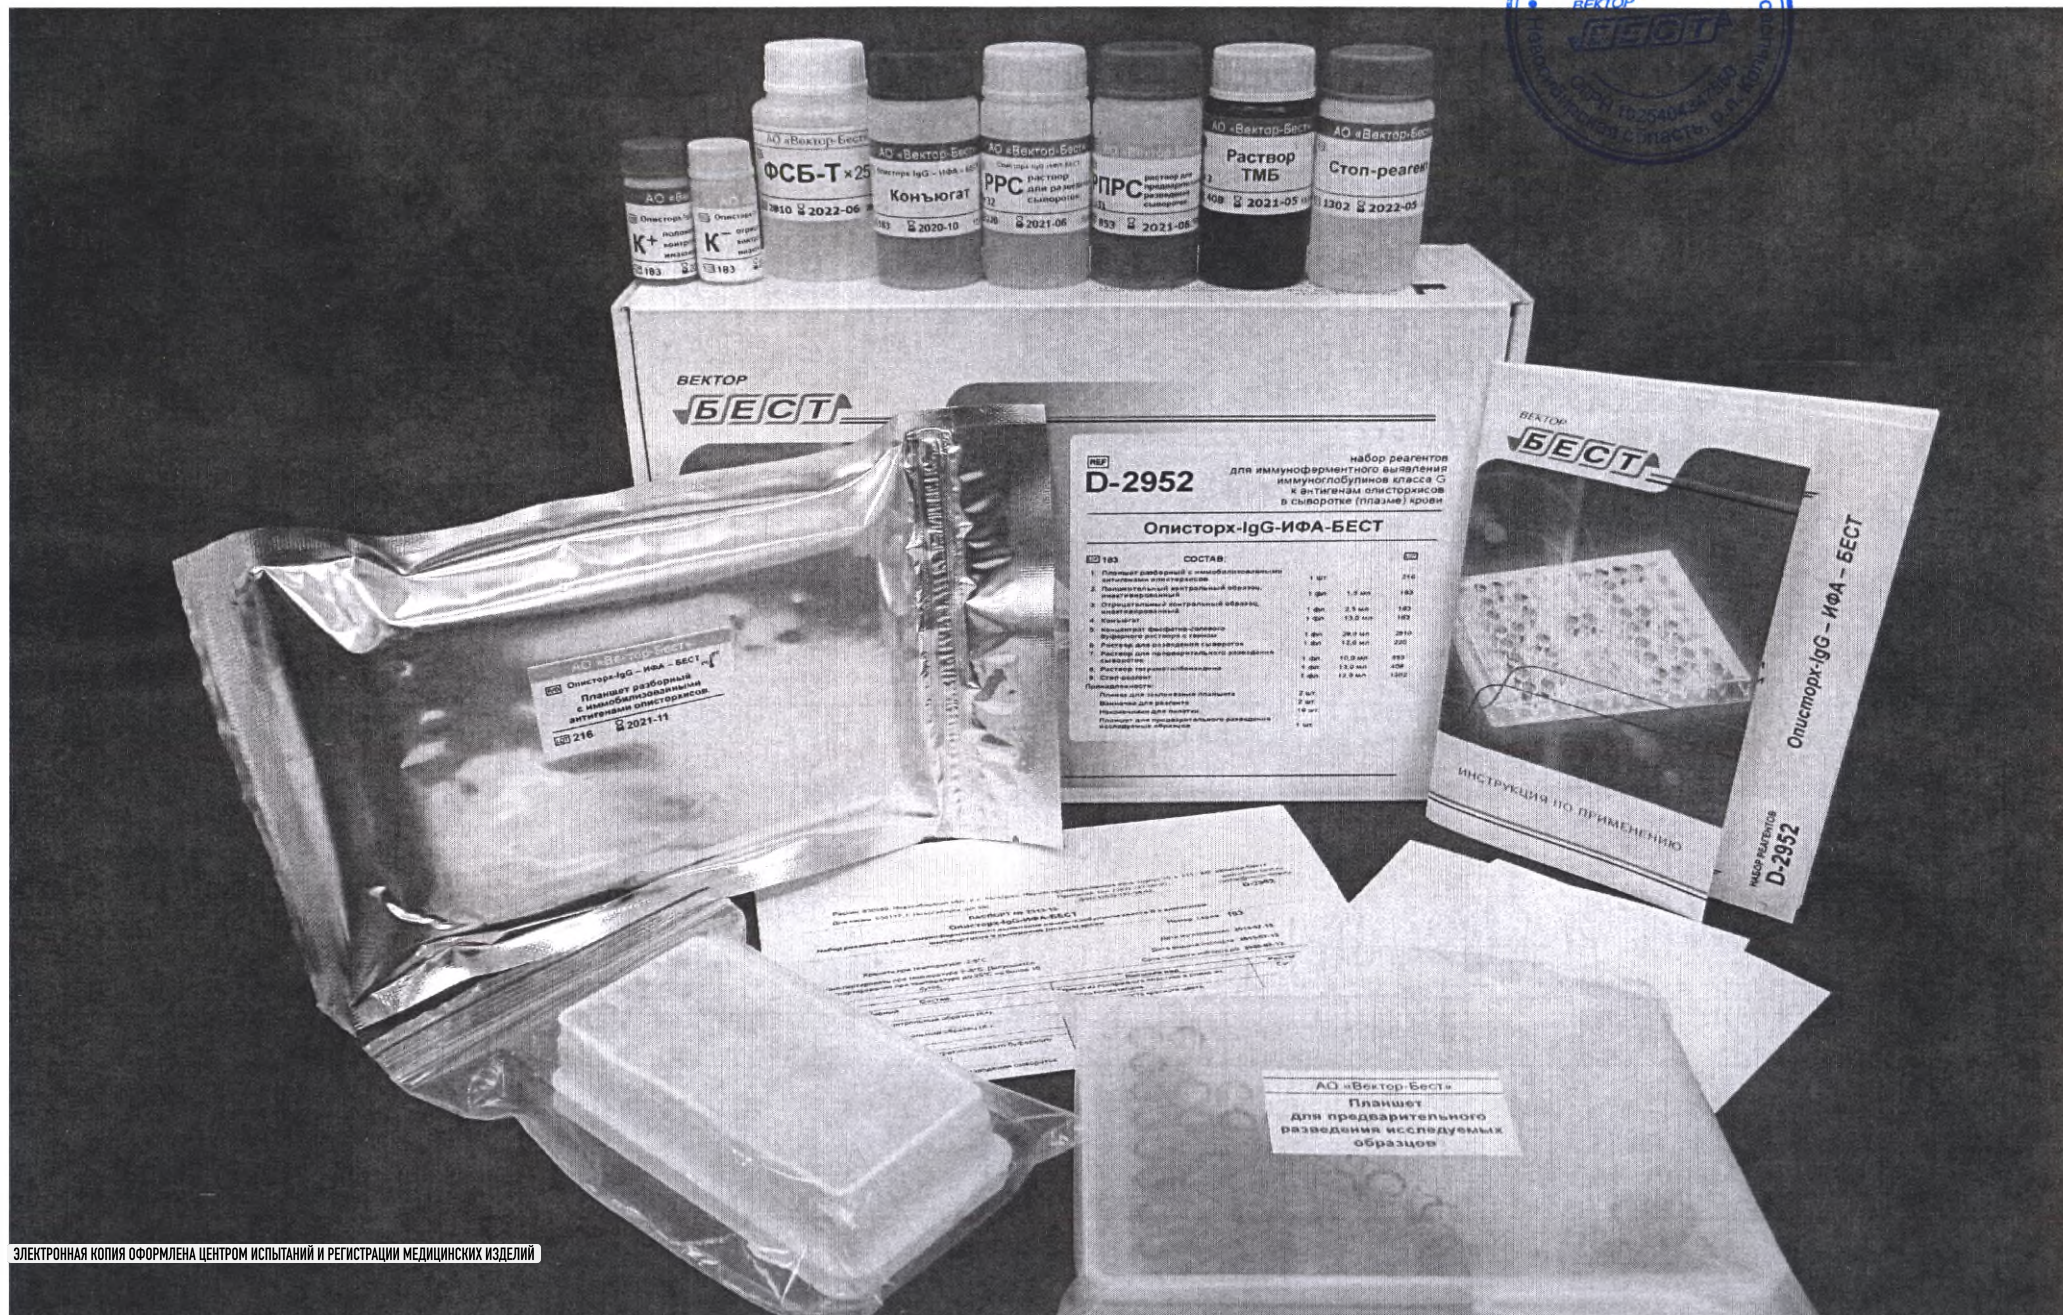

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови (Описторх-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.  
18.05.2020 г.

АО «Вектор-Бест»  
IVD Описторх-IgG – ИФА – БЕСТ<sup>®</sup>  
Планшет разборный  
с иммобилизованными  
антигенами описторхисов  
LOT 216 2021-11


Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»  Хусаинов М.Д.

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» \_\_\_\_\_ Хусаинов М.Д.  
2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови (Описторх-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 3

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»  
Хусаинов М.Д.  
2020 г.

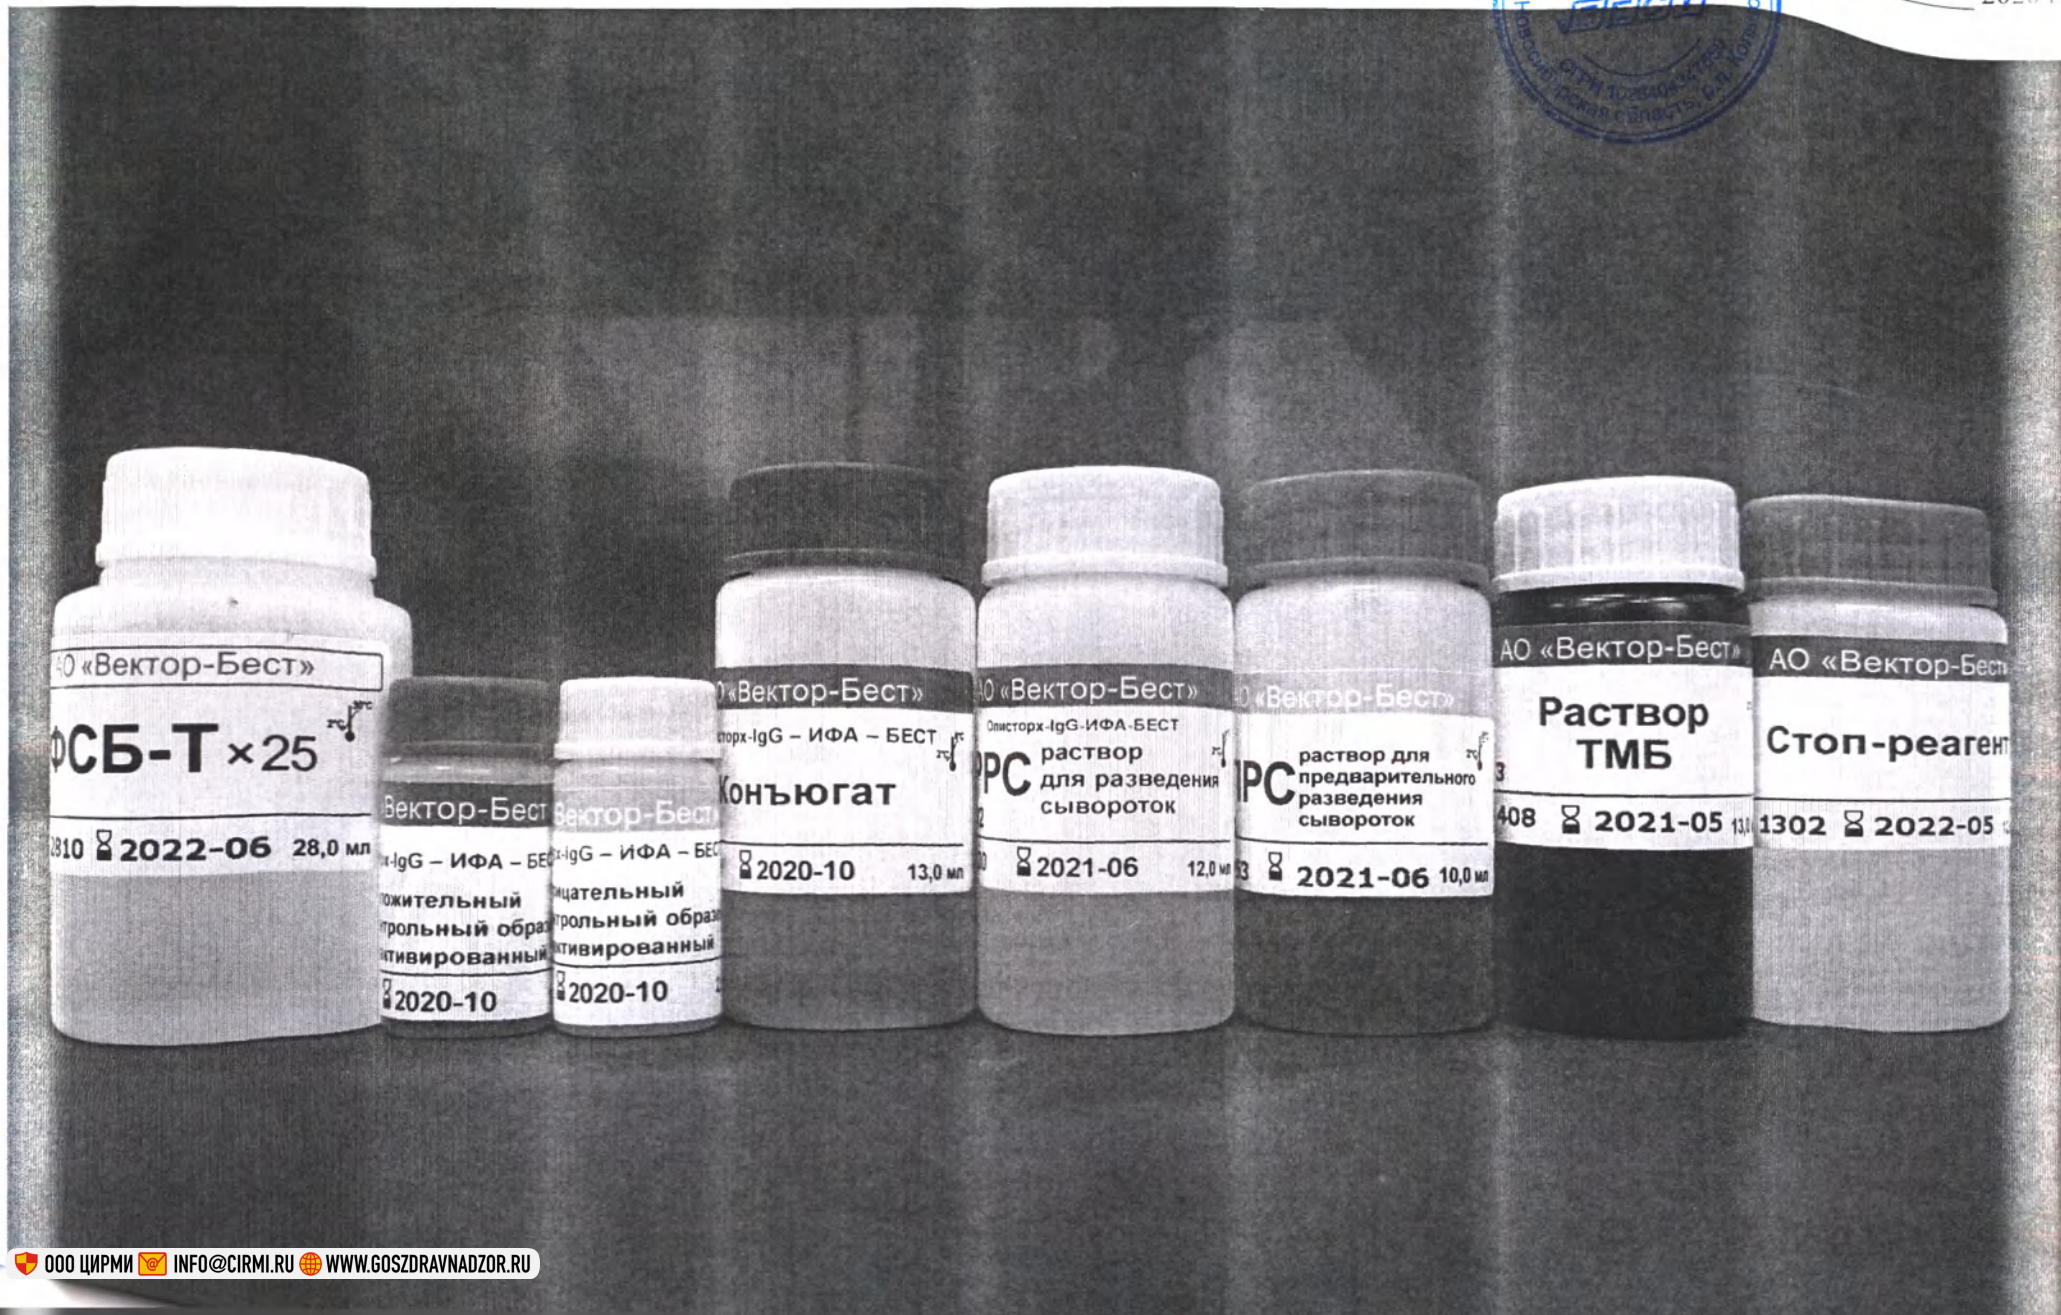

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови (Описторх-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 4

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.  
«28» 05 2020 г.

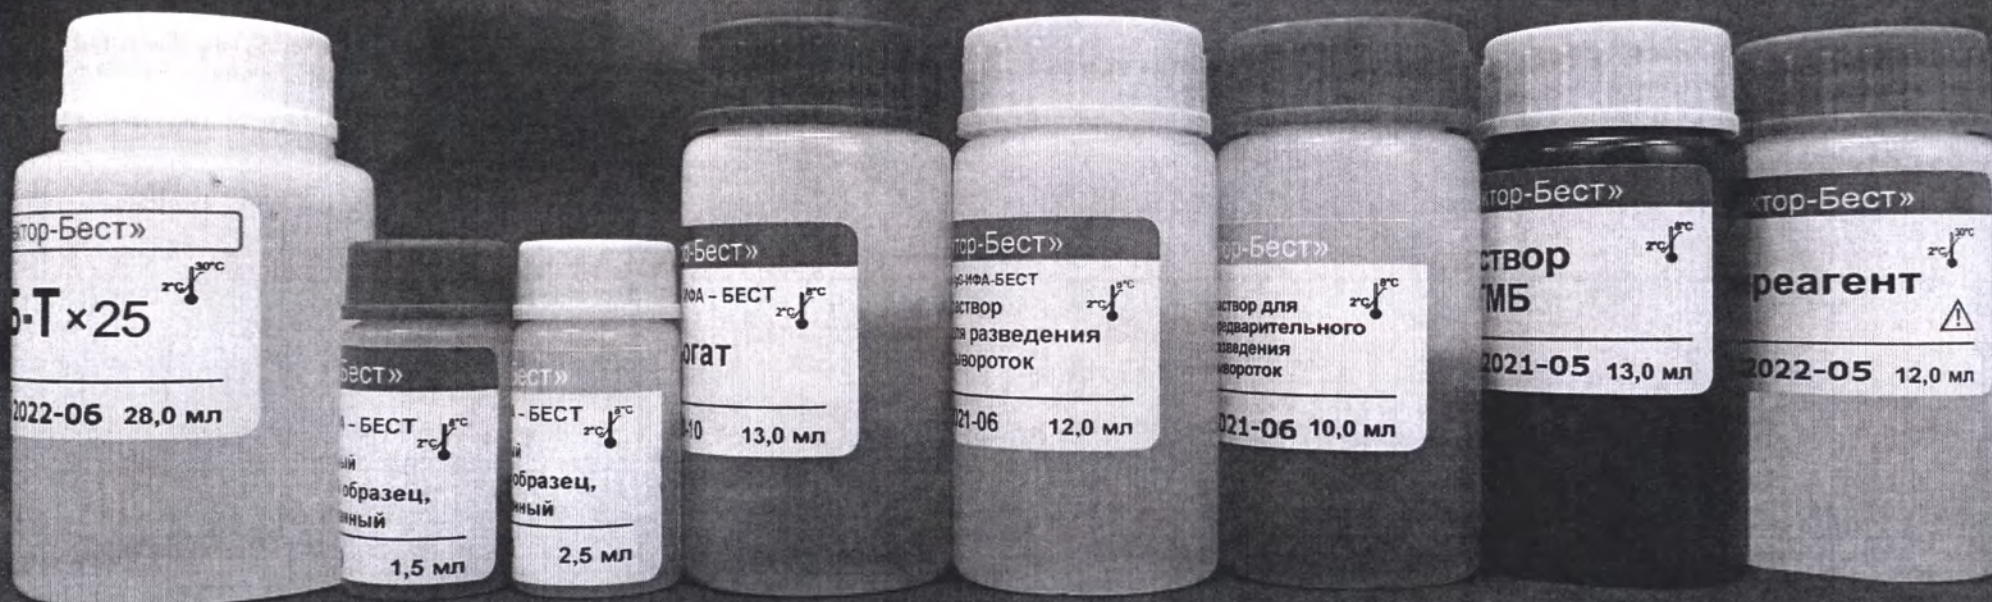


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови (Описторх-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.  
105 2020 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

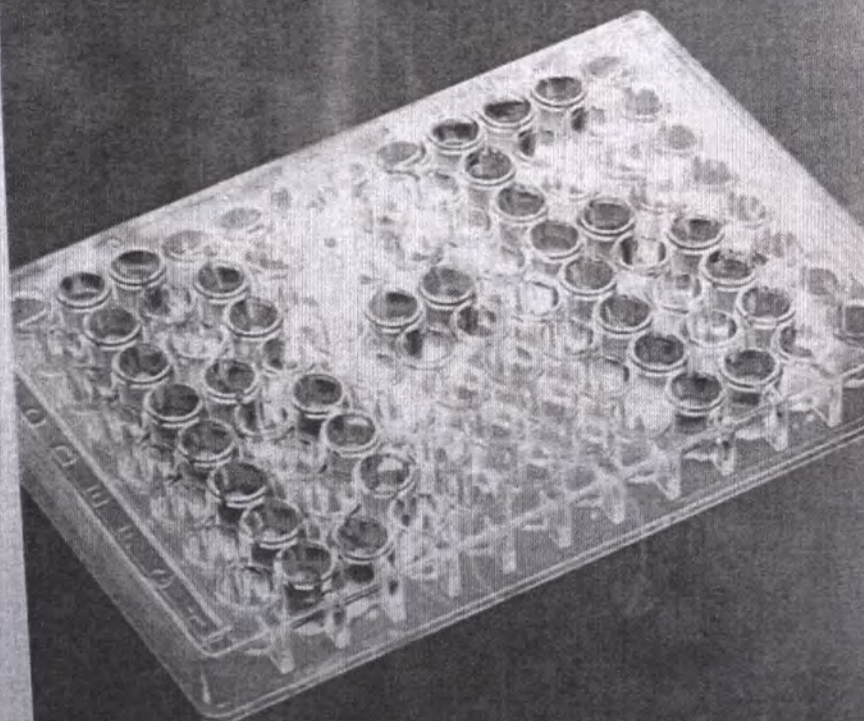

REF

D-2952

набор реагентов  
для иммуноферментного выявления  
иммуноглобулинов класса G  
к антигенам описторхисов  
в сыворотке (плазме) крови

### Описторх-IgG-ИФА-БЕСТ

LOT 183

СОСТАВ:

LOT

|                                                                  |               |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами описторхисов | 1 шт.         | 216  |
| 2. Положительный контрольный образец, инактивированный           | 1 фл. 1,5 мл  | 183  |
| 3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный           | 1 фл. 2,5 мл  | 183  |
| 4. Конъюгат                                                      | 1 фл. 13,0 мл | 183  |
| 5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином      | 1 фл. 28,0 мл | 2810 |
| 6. Раствор для разведения сывороток                              | 1 фл. 12,0 мл | 220  |
| 7. Раствор для предварительного разведения сывороток             | 1 фл. 10,0 мл | 853  |
| 8. Раствор тетраметилбензидина                                   | 1 фл. 13,0 мл | 408  |
| 9. Стоп-реагент                                                  | 1 фл. 12,0 мл | 1302 |

Принадлежности:

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Пленка для заклеивания планшета                              | 2 шт.  |
| Ванночка для реагента                                        | 2 шт.  |
| Наконечники для пипетки                                      | 16 шт. |
| Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов | 1 шт.  |

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови (Описторх-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.  
АО «Вектор-Бест» 05 2020 г.

