


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови (Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2020 г.

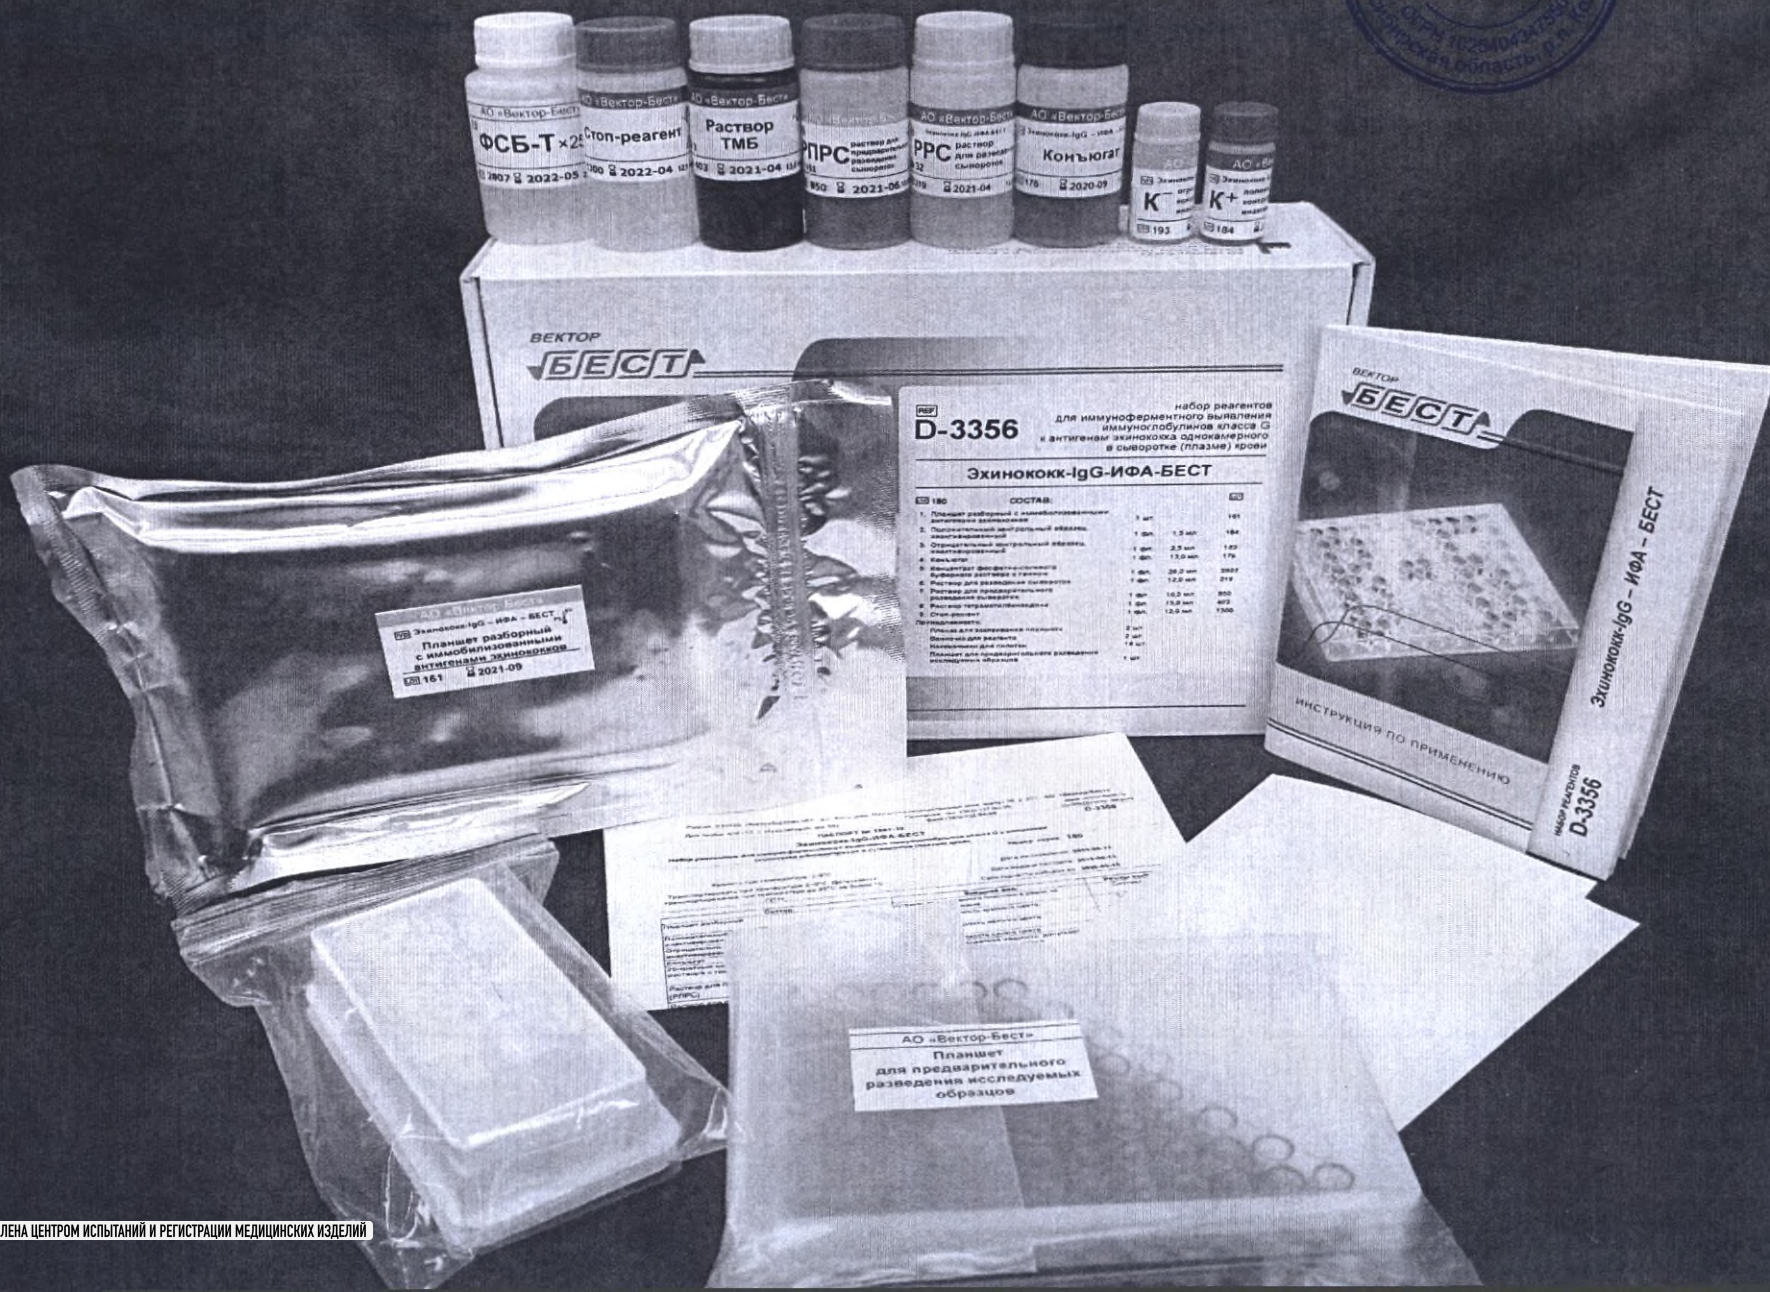


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови (Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.

АО «Вектор-Бест»

2020 г.

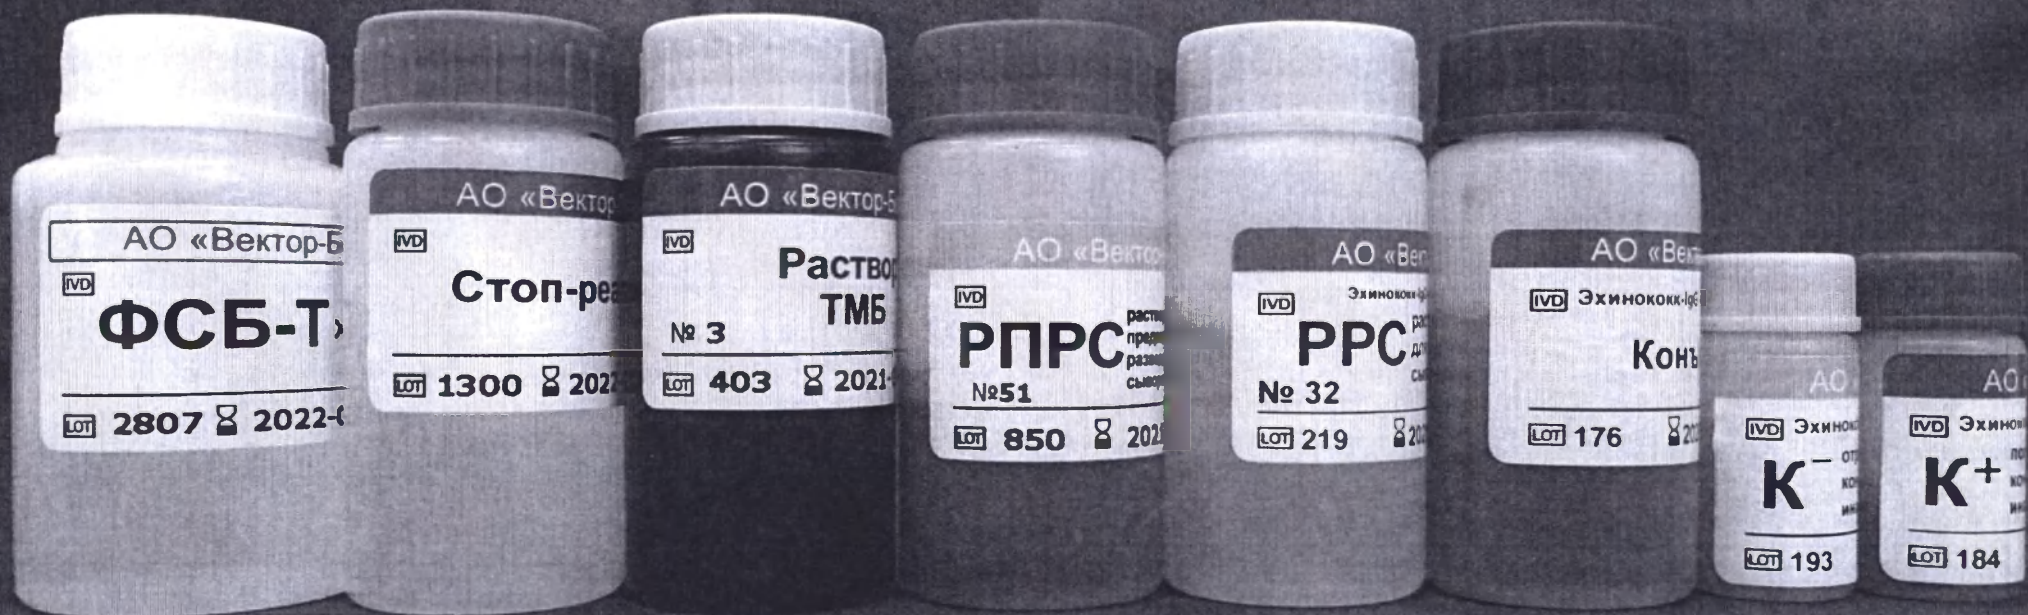


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови (Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.



05 2020

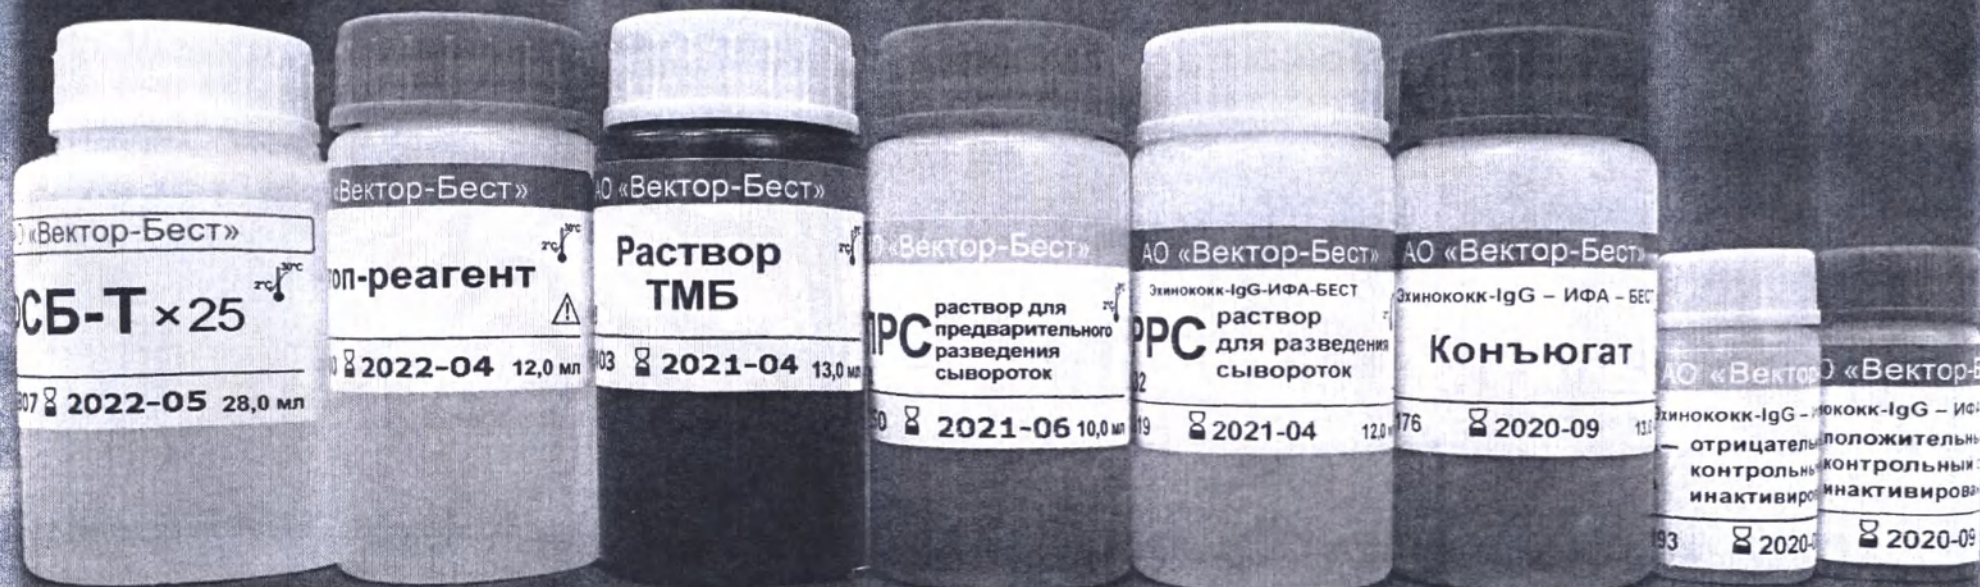


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови (Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2020 г.

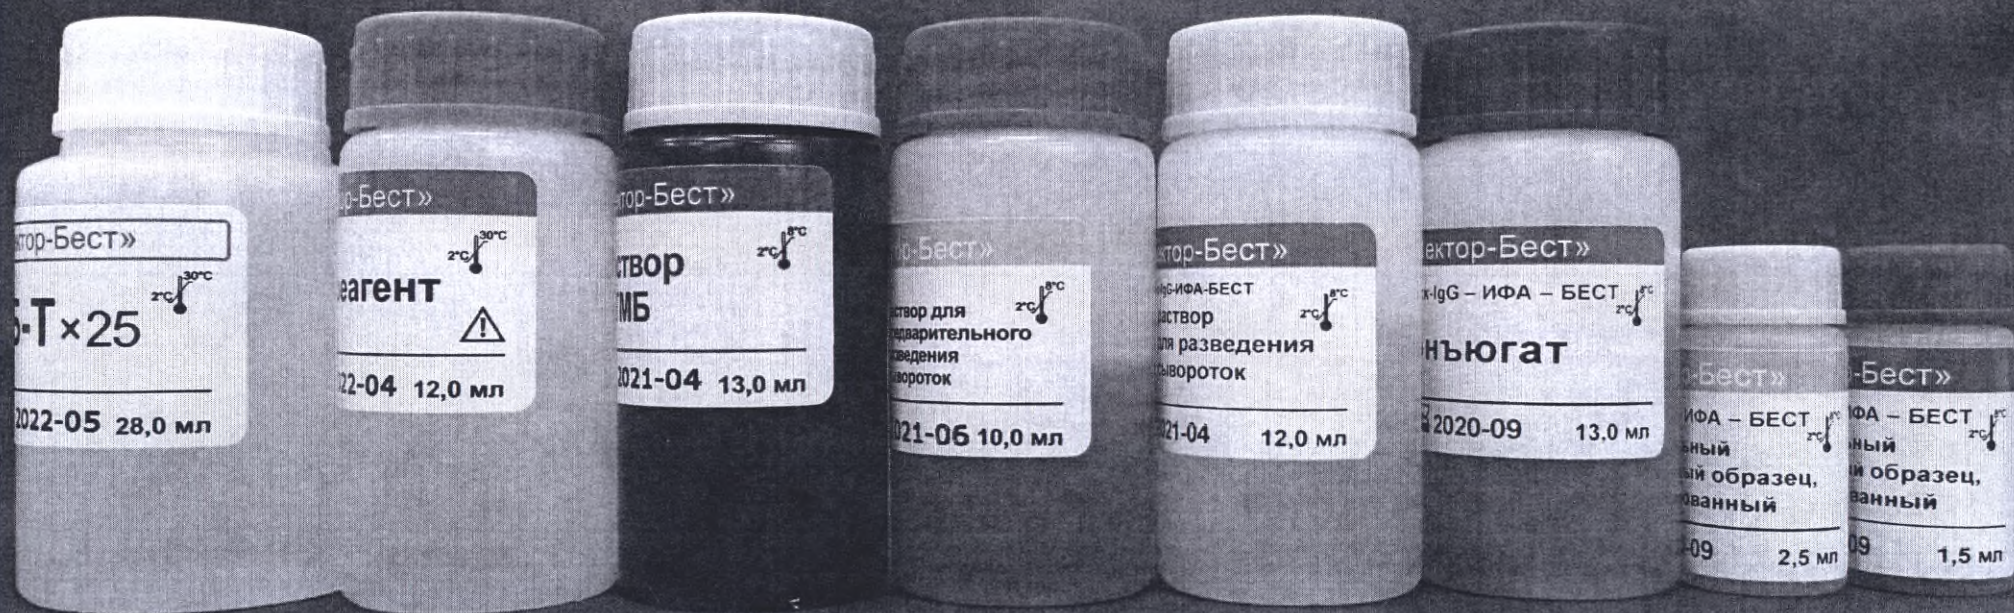

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови (Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
05 2020 г.

АО «Вектор-Бест»
IVD Эхинококк-IgG – ИФА – БЕСТ^{гс}
Планшет разборный
с иммобилизованными
антигенами эхинококков
LOT 161 2021-09


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови (Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
05 2020 г.



БЕКТОР

БЕСТ

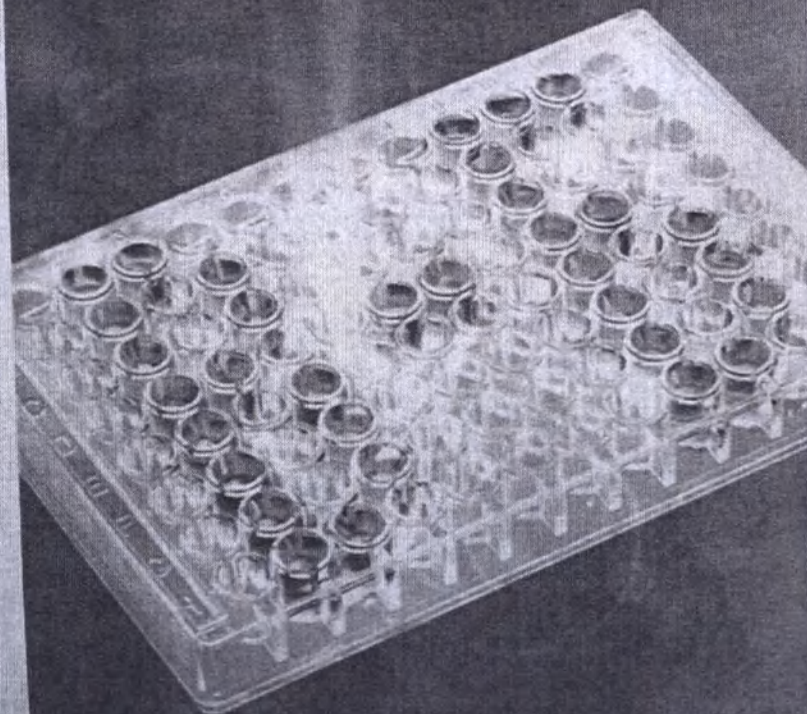

REF

D-3356

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к антигенам эхинококка однокамерного
в сыворотке (плазме) крови

Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ

LOT 180

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами эхинококков	1 шт.	161
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	184
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 2,5 мл	193
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	178
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2807
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	219
7. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	850
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл	403
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1300

Принадлежности:

Пленка для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночка для реагента	2 шт.
Наконечники для пипетки	16 шт.
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови (Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

28 05 2020 г.



БЕКТОР

БЕСТ

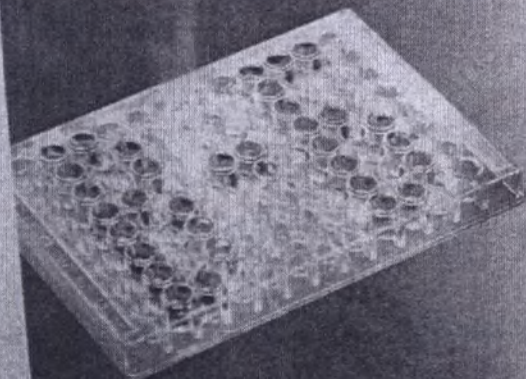

REF **D-3356**

Σ 96

LOT

180

ТУ 9398-393-23548172-2012

ПУ № РЗН 2013/1306 от 23.03.2017



2019-06-11



2020-06-11

Эхинококк-IgG-ИФА-БЕСТ

IVD



33561106200018000835

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют