




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуоферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену НА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-NA-IgG)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2020 г.

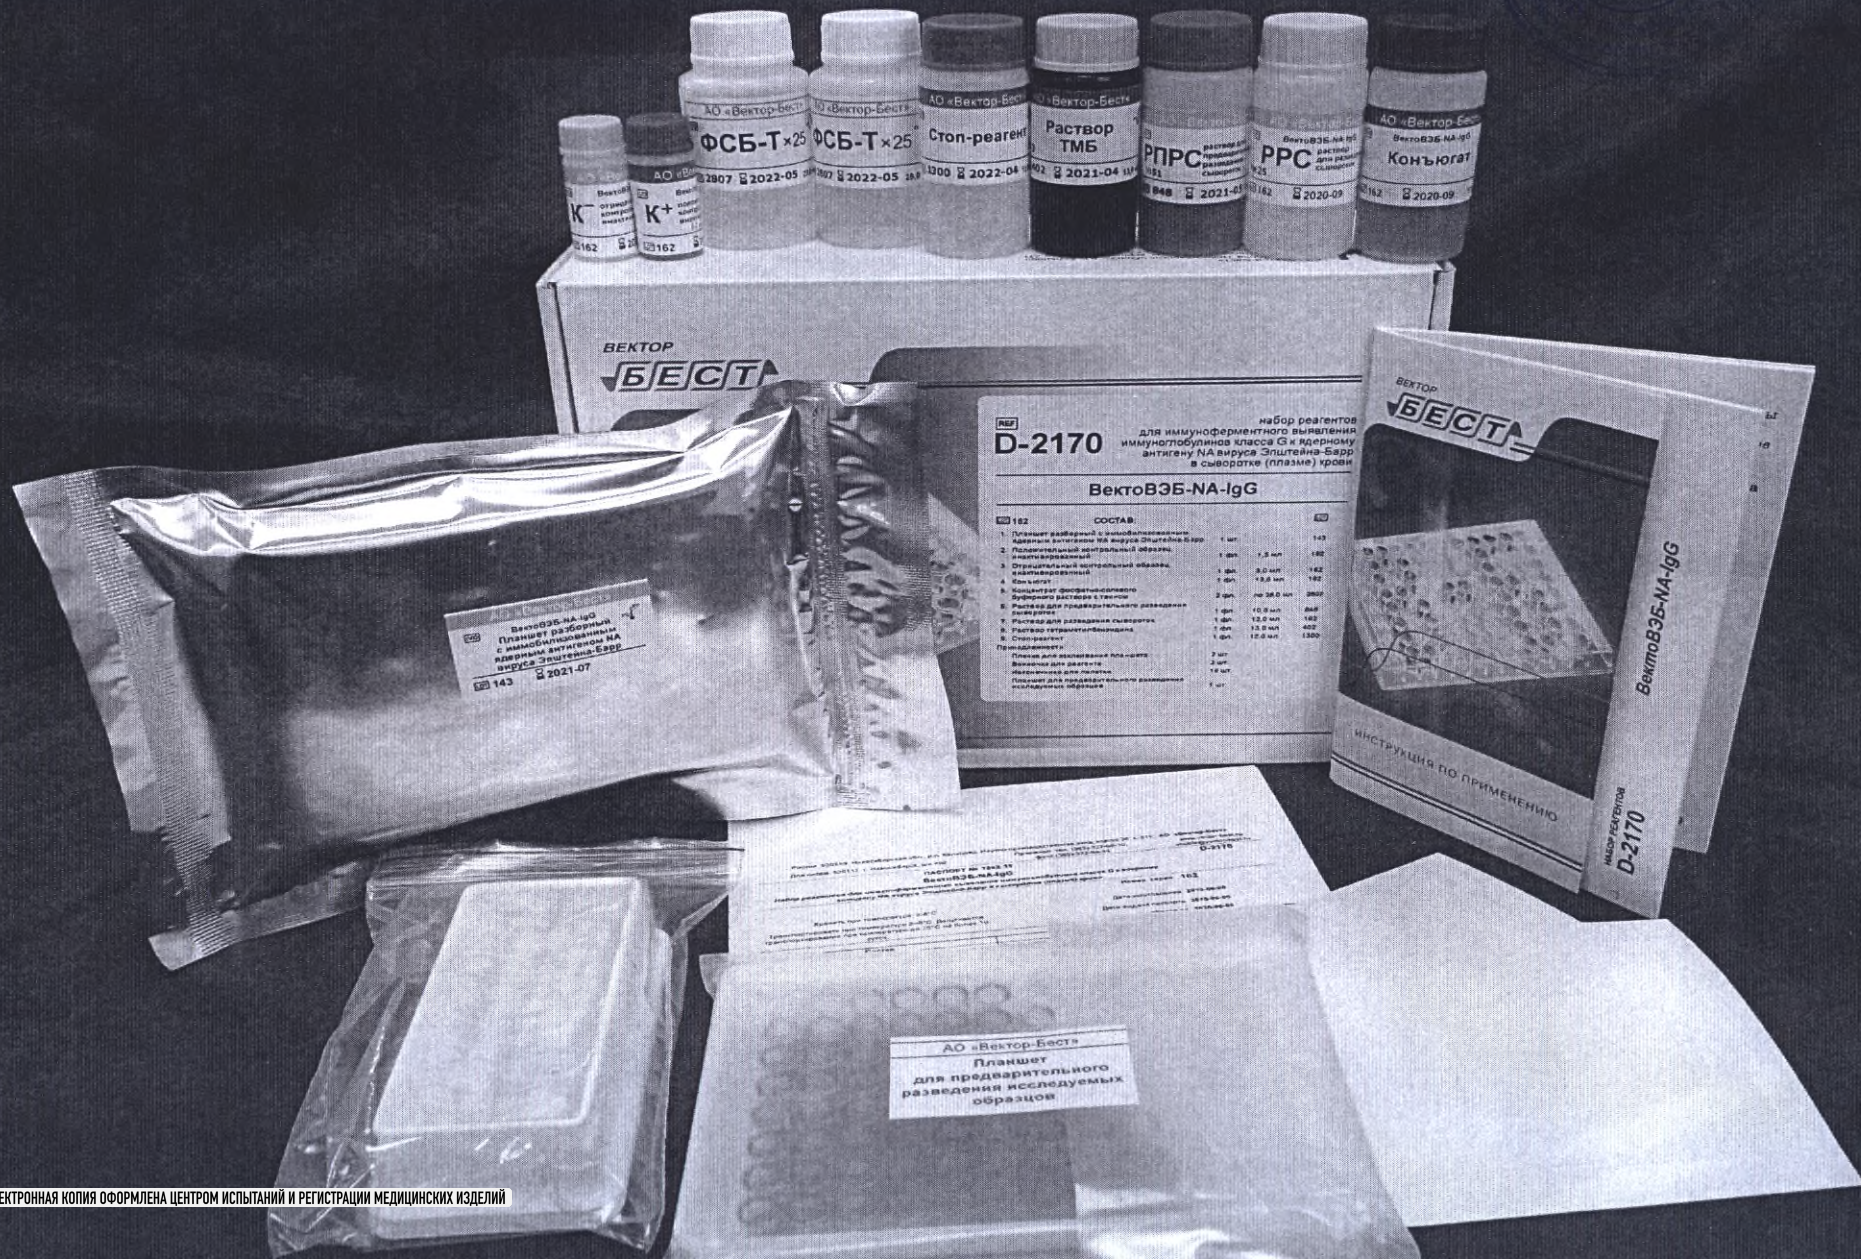


фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-NA-IgG)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
26 МАЙ 2020 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

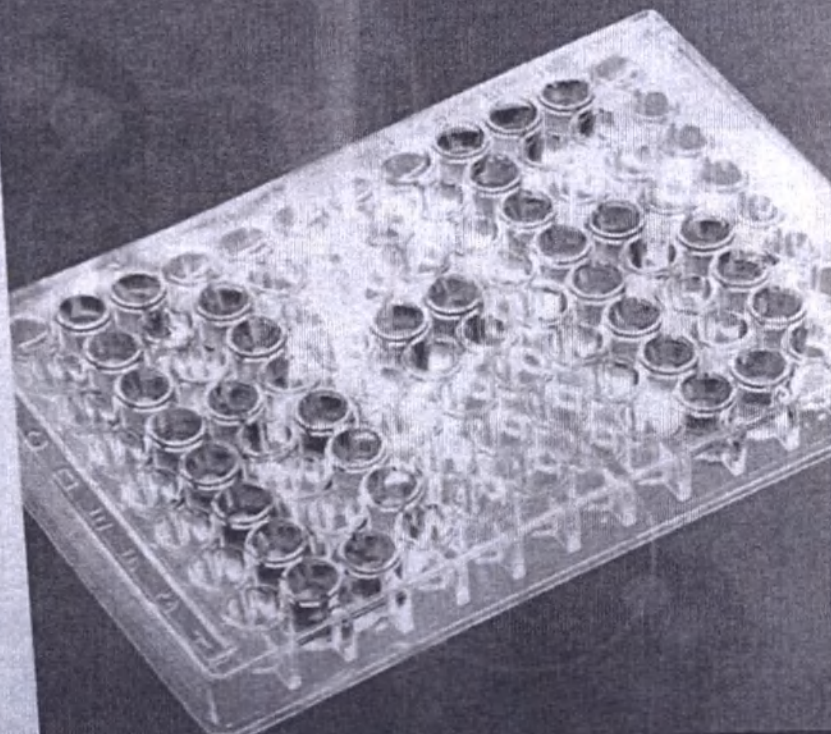

REF

D-2170

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к ядерному
антигену NA вируса Эпштейна-Барр
в сыворотке (плазме) крови

ВектоВЭБ-NA-IgG

LOT 162

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным ядерным антигеном NA вируса Эпштейна-Барр	1 шт.		143
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	1,5 мл	162
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	3,0 мл	162
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	162
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.	по 28,0 мл	2807
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл	848
7. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	162
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл	402
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1300

Принадлежности:


Пленка для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночка для реагента	2 шт.
Наконечники для пипетки	16 шт.
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.

фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену НА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-NA-IgG)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.



2020 г.

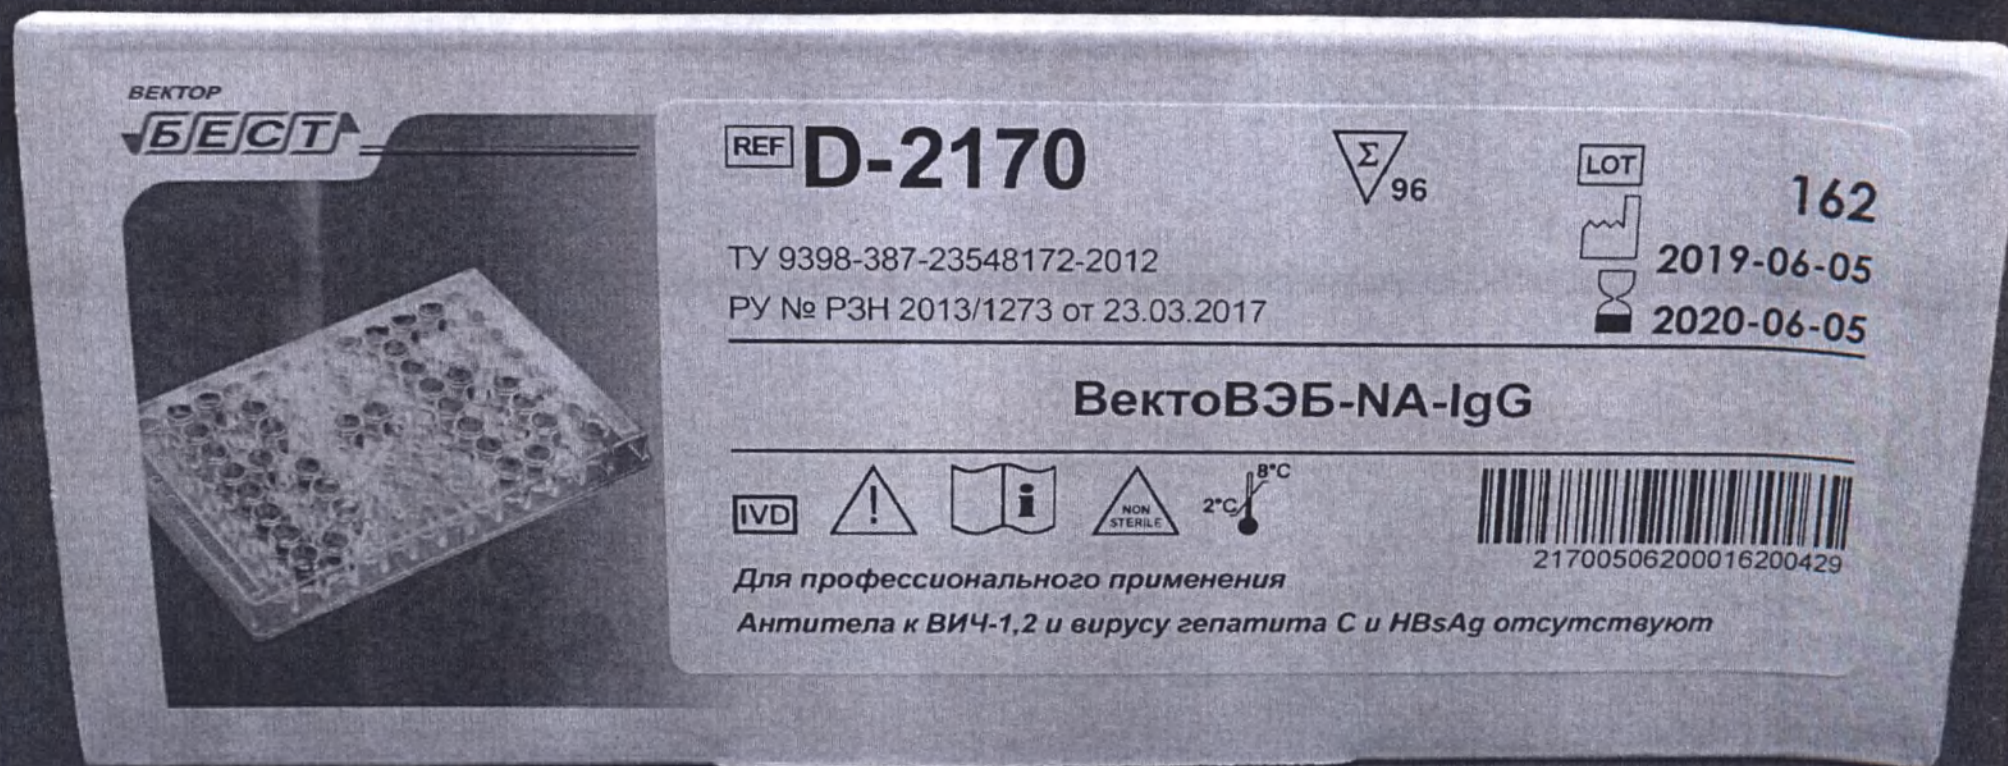

фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену НА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-NA-IgG)» № 1


Генеральный директор  Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «24» МАЙ 2020 г.



АО «Вектор-Бест»
ИВД ВектоВЭБ-NA-IgG
Планшет разборный
с иммобилизованным
ядерным антигеном НА
вируса Эпштейна-Барр
LOT 143 2021-07

фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену НА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-NA-IgG)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
24 МАИ 2020 г.

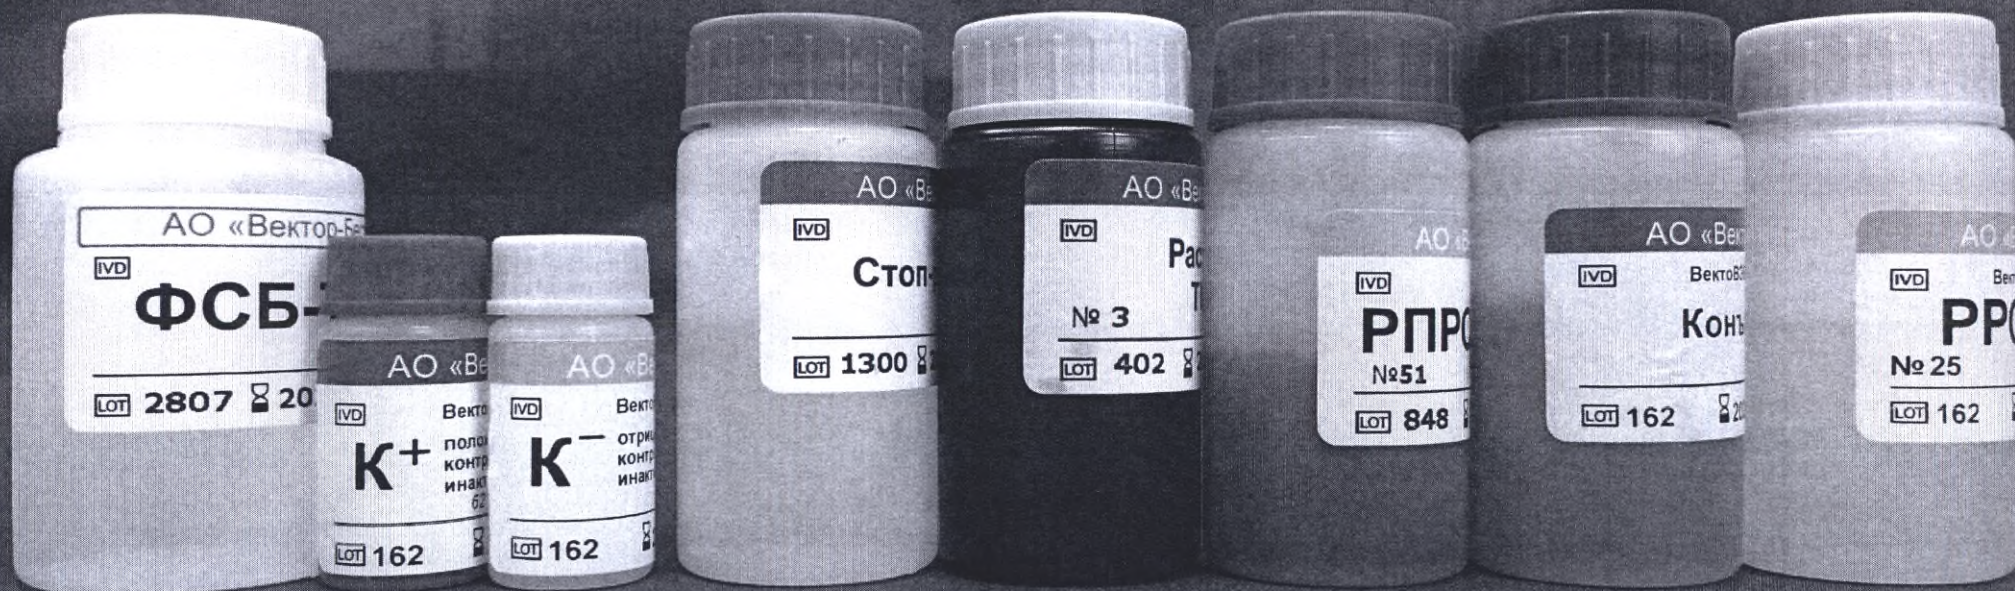

фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену НА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-NA-IgG)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.


2020 г.



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-NA-IgG)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«24 МАЙ» 2020 г.

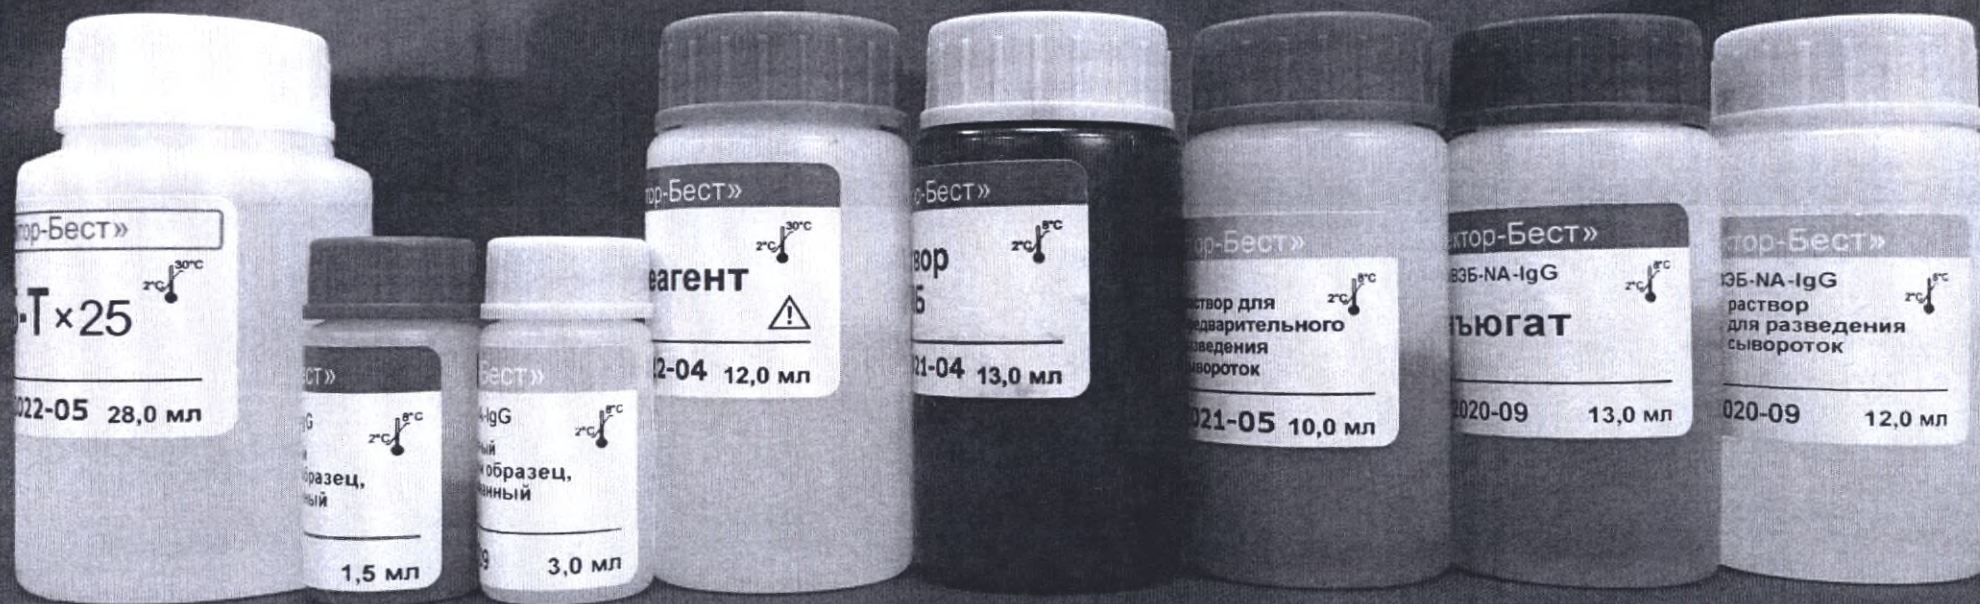

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 7 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

"24" 2020 г. А.В. Масяго

