

Хусаинов М.Д.
«04» 2019 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 1))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

2019 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

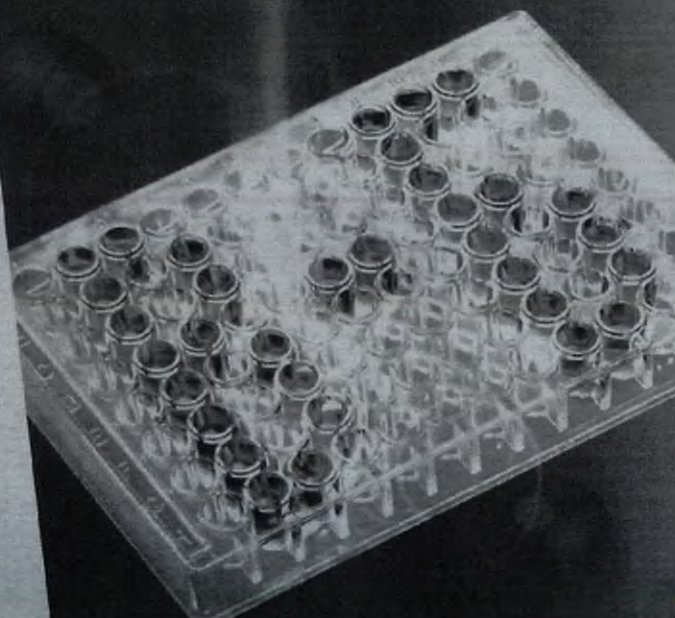

REF

D-0151

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
антител к ВИЧ-1,2
и антигена р24 ВИЧ-1

КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ
(комплект 1)

LOT 2290

СОСТАВ:

LOT

1. Планшеты разборные с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1,2 и антителами к р24 ВИЧ-1	2 шт.	219038
2. Положительный контрольный образец №1, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3976
3. Положительный контрольный образец №2, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3977
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 2,0 мл	3334
5. Конъюгат № 1	1 фл.	9851
6. Конъюгат № 2	1-2 фл.	9604
7. Раствор для предварительного разведения	1 фл. 4,0 мл	1327
8. Раствор для разведения конъюгата № 1	2 фл. по 9,0 мл	4323
9. Раствор для разведения конъюгата № 2	2 фл. по 13,0 мл	4325
10. Концентрат фосфатно-селевого буферного раствора с твином	4 фл. по 28,0 мл	2809
11. Субстратный буферный раствор	2 фл. по 13,0 мл	547
12. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл. 1,5 мл	503
13. Стоп-реагент	1 фл. 21,0 мл	1303
Принадлежности:		
Ванночки для реагентов	4 шт.	
Наконечники для пипетки	32 шт.	
Плёнка для заклеивания планшета	4 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 1))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

2019 г.



БЕКТОР

БЕСТ

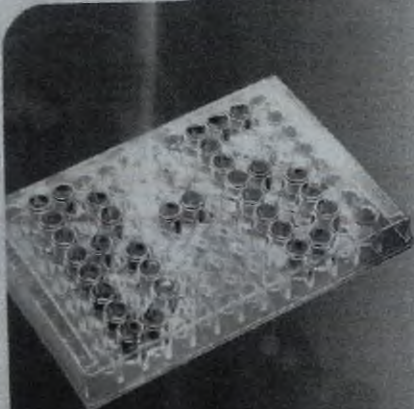

REF **D-0151**

Σ 192

LOT **2290**

ТУ 9398-317-23548172-2011

ПУ № ФСР 2012/13835 от 25.03.2017

2019-07-08

2020-07-08

КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ
(комплект 1)

IVD



01510807200229000367

Для профессионального применения



Антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 1))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2019 г.

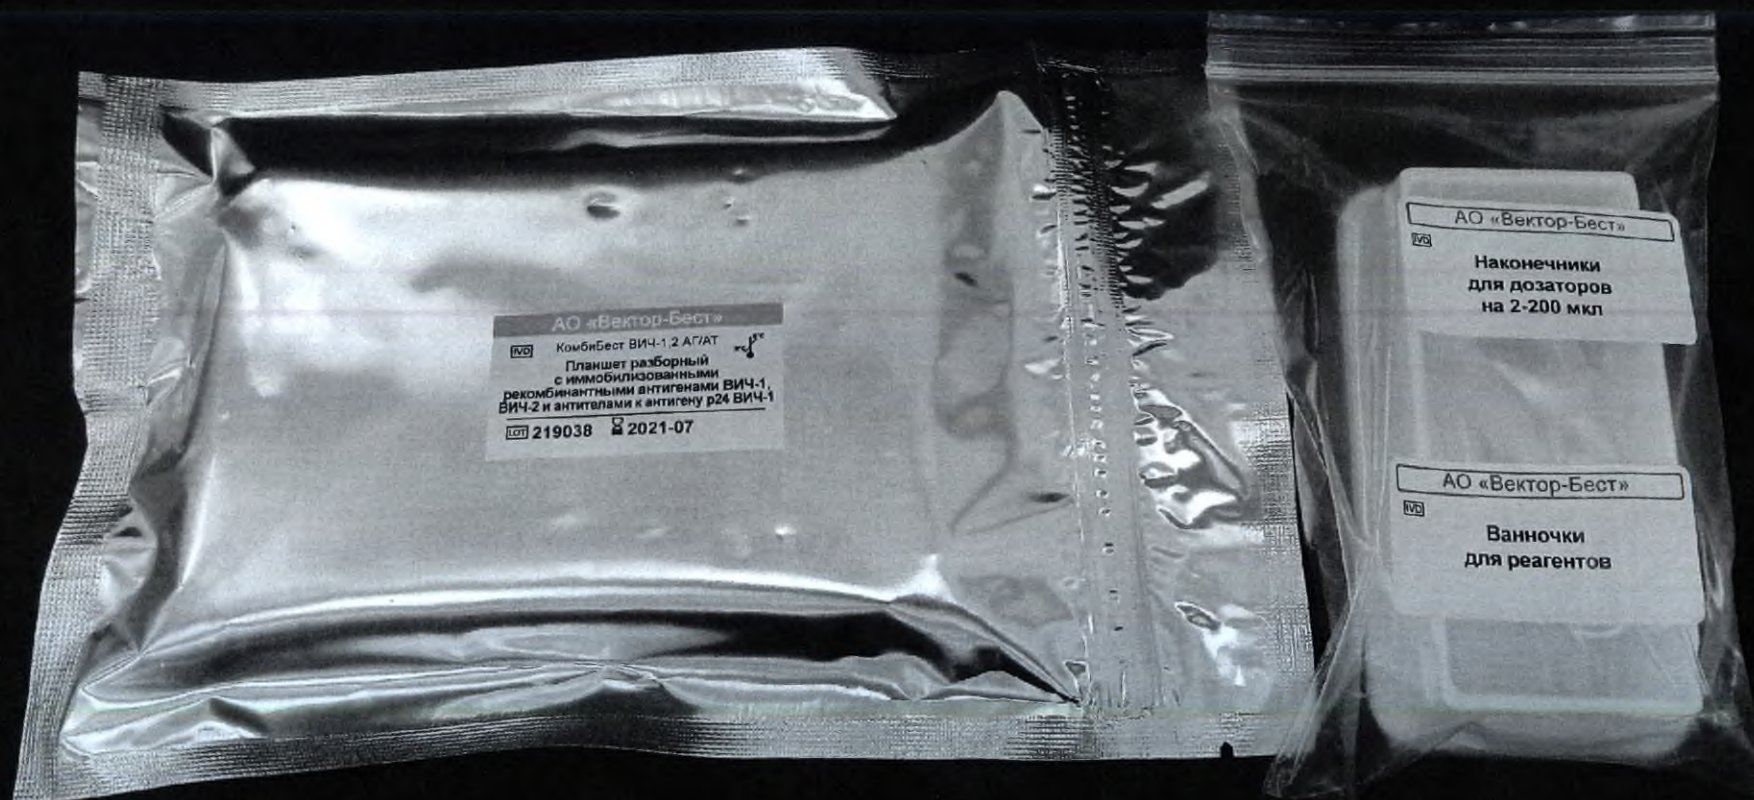

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 1))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2019 г.



2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 1))» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
04 2019 г.






Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 2))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.
2019 г.

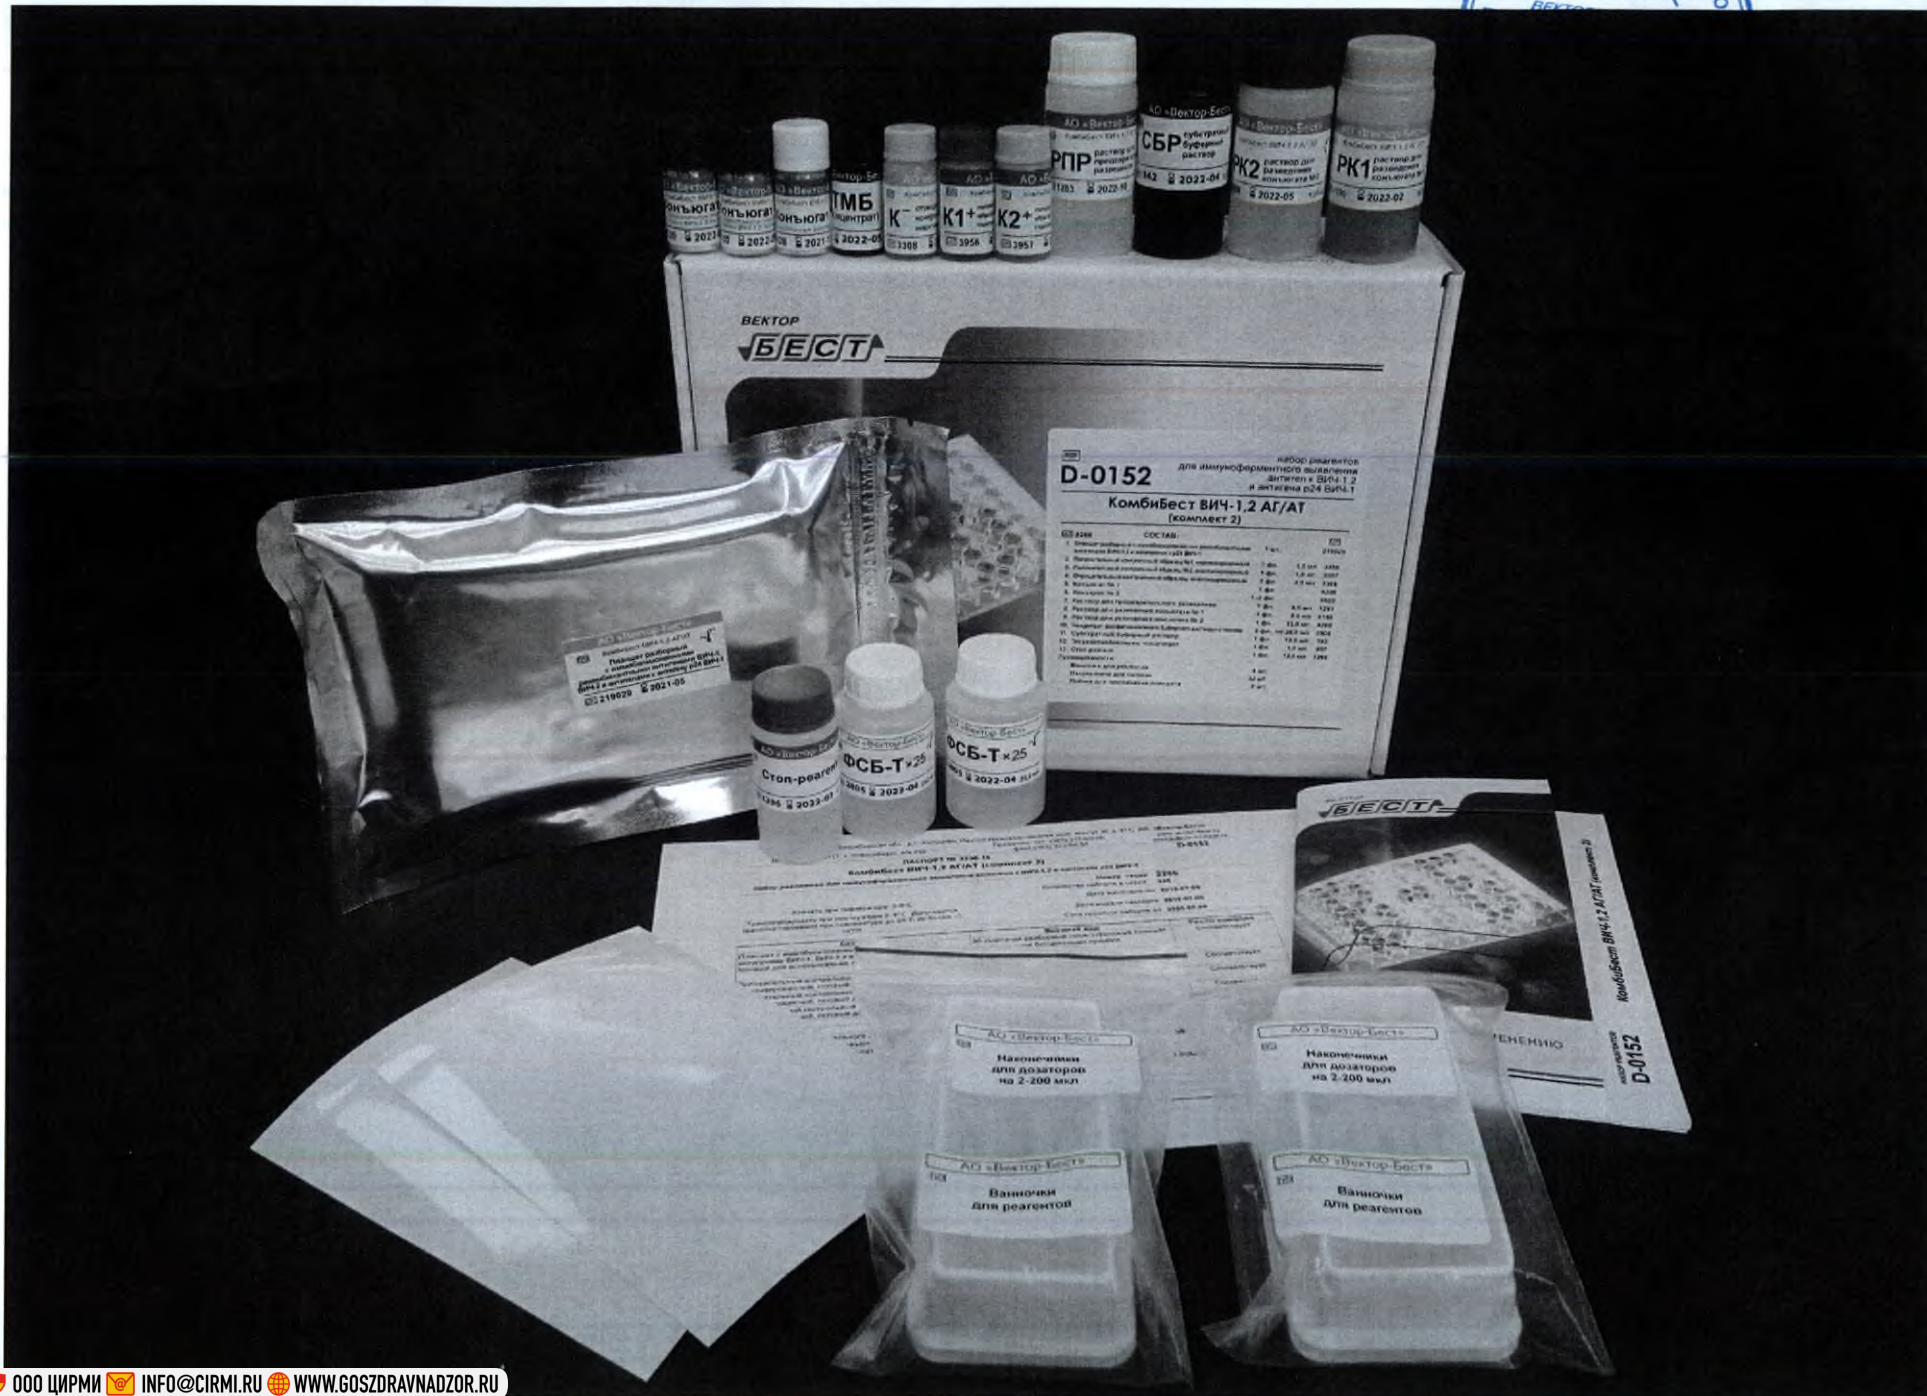



ВЕКТОР

БЕСТ

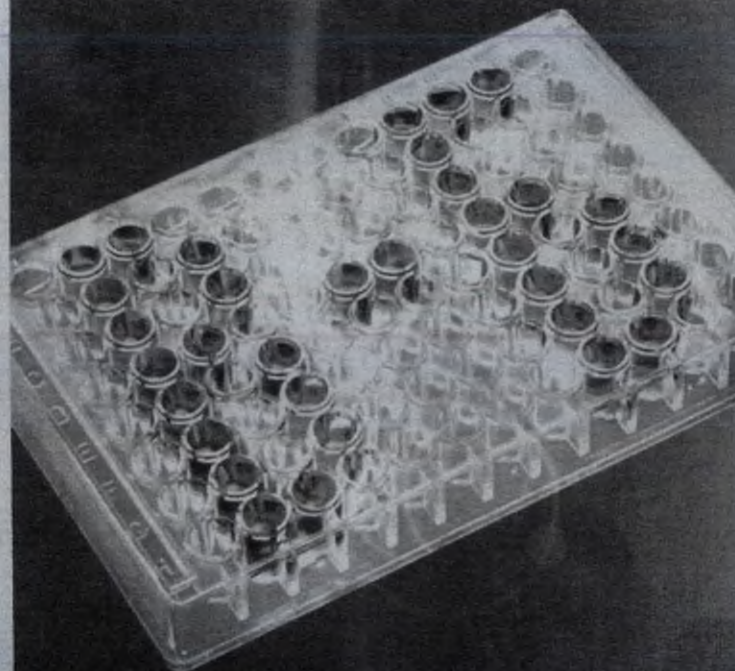

REF

D-0152

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
антител к ВИЧ-1,2
и антигена р24 ВИЧ-1

КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ
(комплект 2)

LOT 2266


СОСТАВ:


LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1,2 и антителами к р24 ВИЧ-1	1 шт.	219029
2. Положительный контрольный образец №1, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3956
3. Положительный контрольный образец №2, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3957
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 2,0 мл	3308
5. Конъюгат № 1	1 фл.	9228
6. Конъюгат № 2	1-2 фл.	9520
7. Раствор для предварительного разведения	1 фл. 4,0 мл	1283
8. Раствор для разведения конъюгата № 1	1 фл. 9,0 мл	4190
9. Раствор для разведения конъюгата № 2	1 фл. 13,0 мл	4288
10. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2805
11. Субстратный буферный раствор	1 фл. 13,0 мл	542
12. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл. 1,5 мл	497
13. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1296
Принадлежности:		
Ванночки для реагентов	4 шт.	
Наконечники для пипеток	32 шт.	
Плёнка для заклеивания планшета	2 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 2))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
104 2019 г.

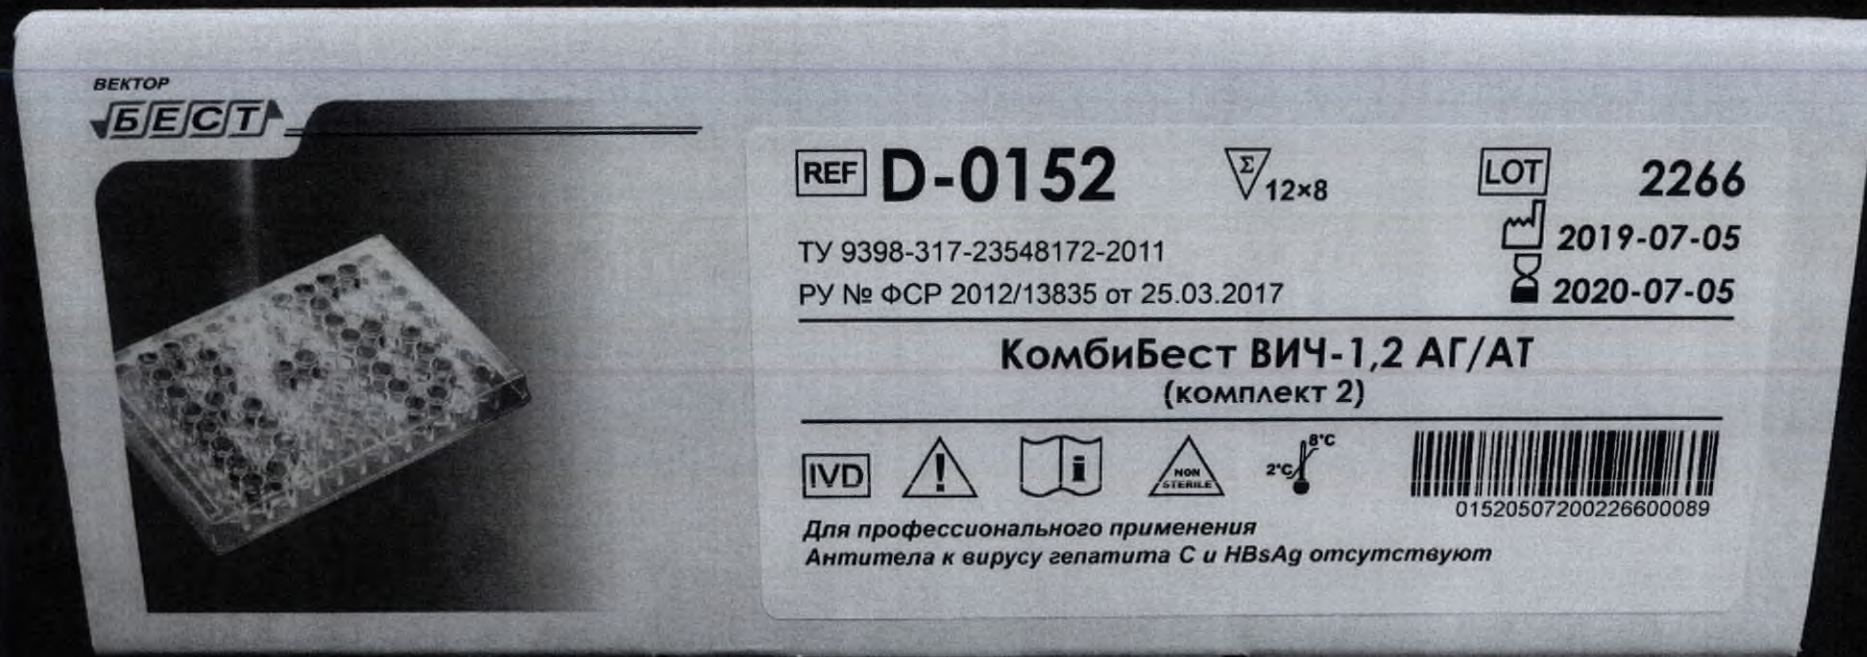

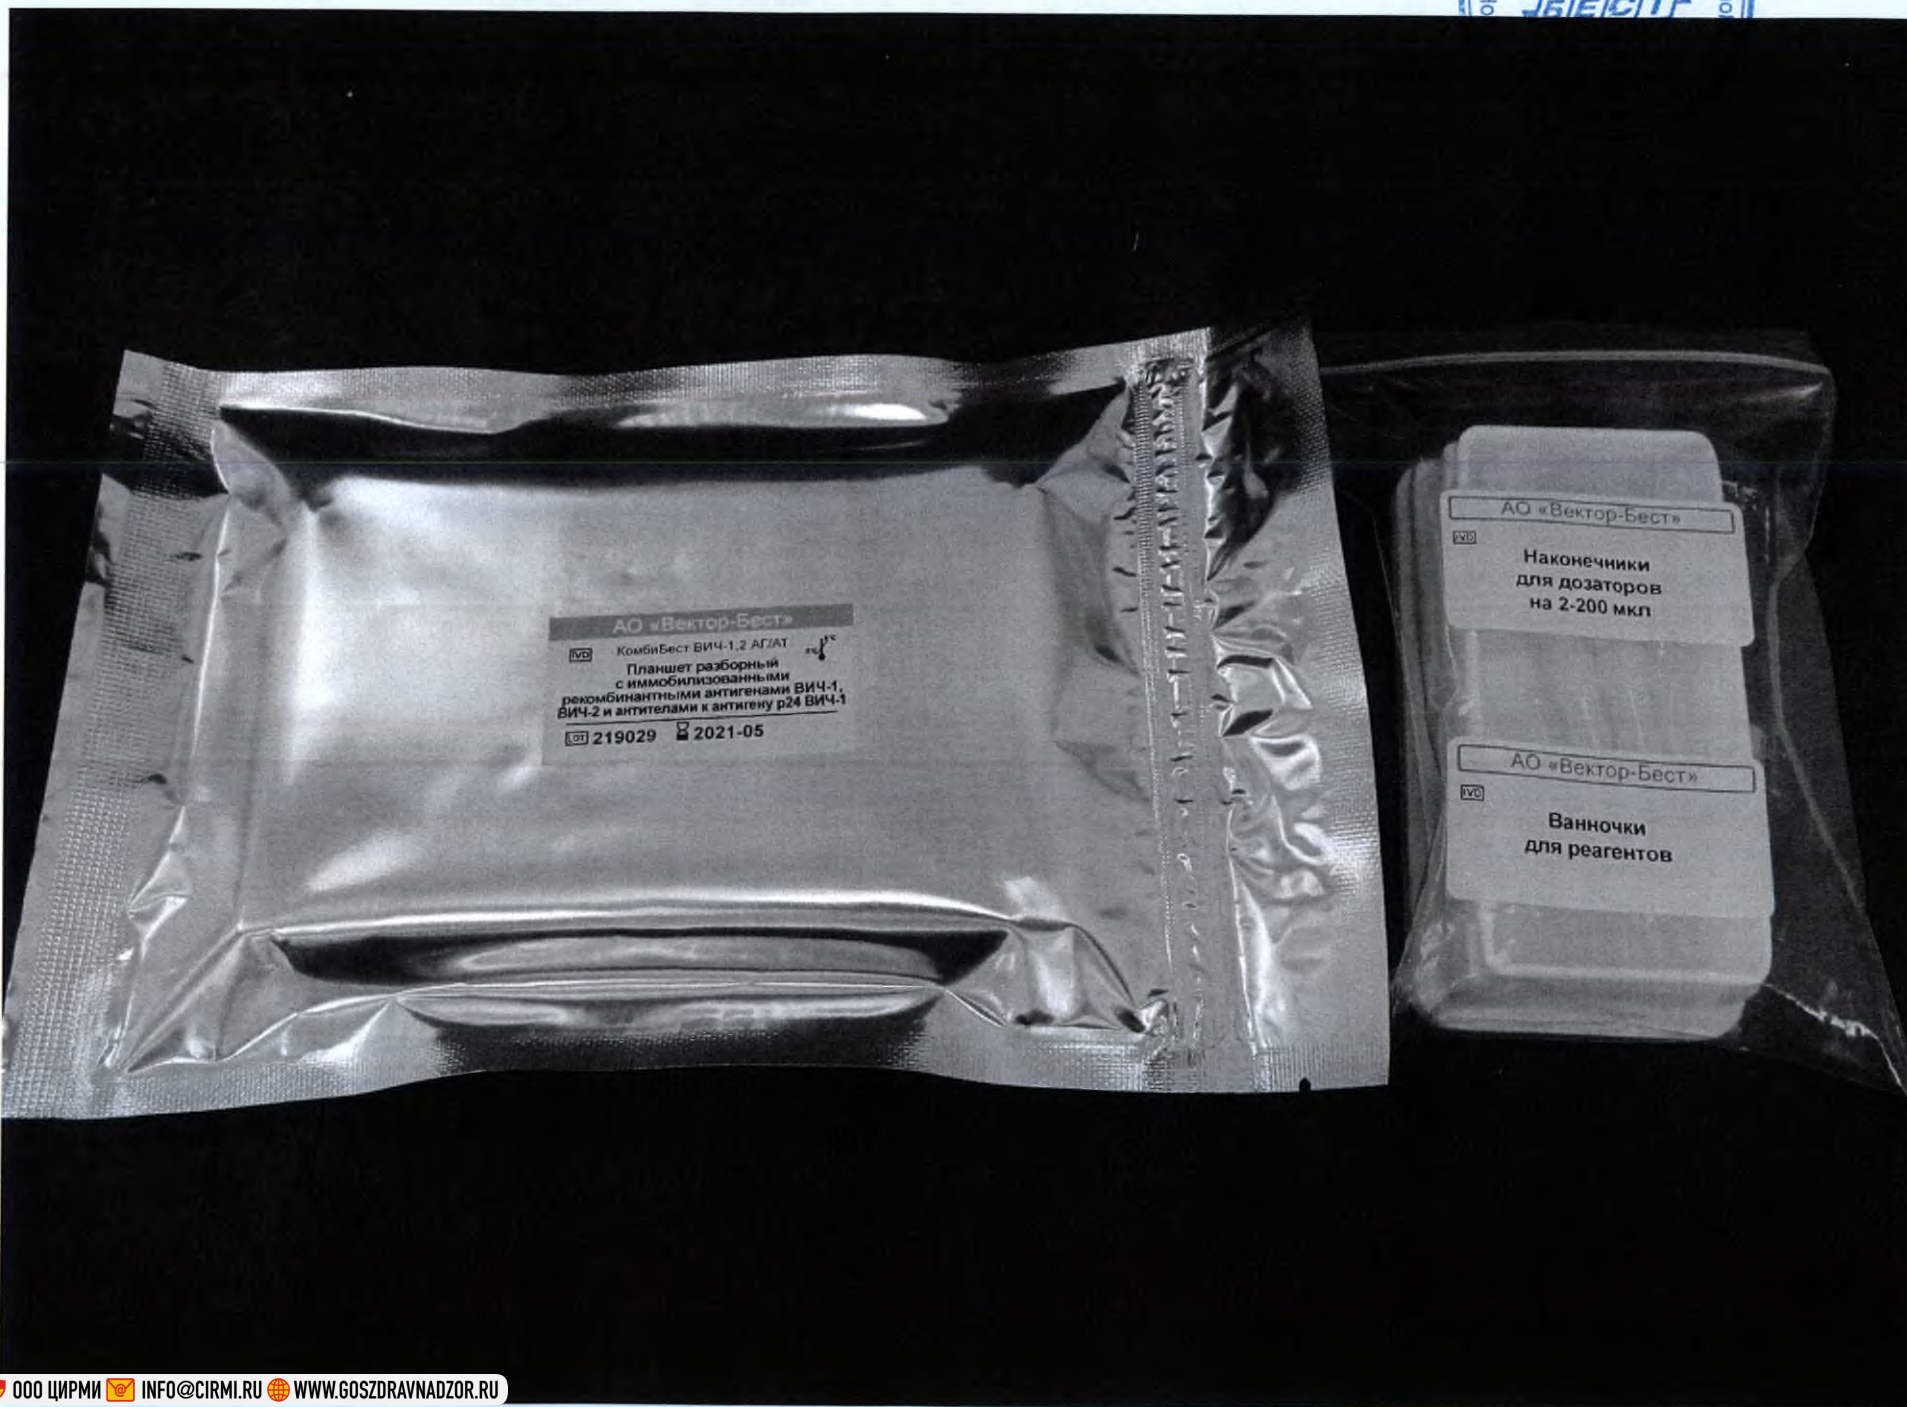


АО «Вектор-Бест»
КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ
Планшет разборный
с иммобилизованными
рекомбинантными антигенами ВИЧ-1,
ВИЧ-2 и антителами к антигену р24 ВИЧ-1
219029 2021-05

АО «Вектор-Бест»
Наконечники
для дозаторов
на 2-200 мкл

АО «Вектор-Бест»
Ванночки
для реагентов

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 2))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
2019 г.

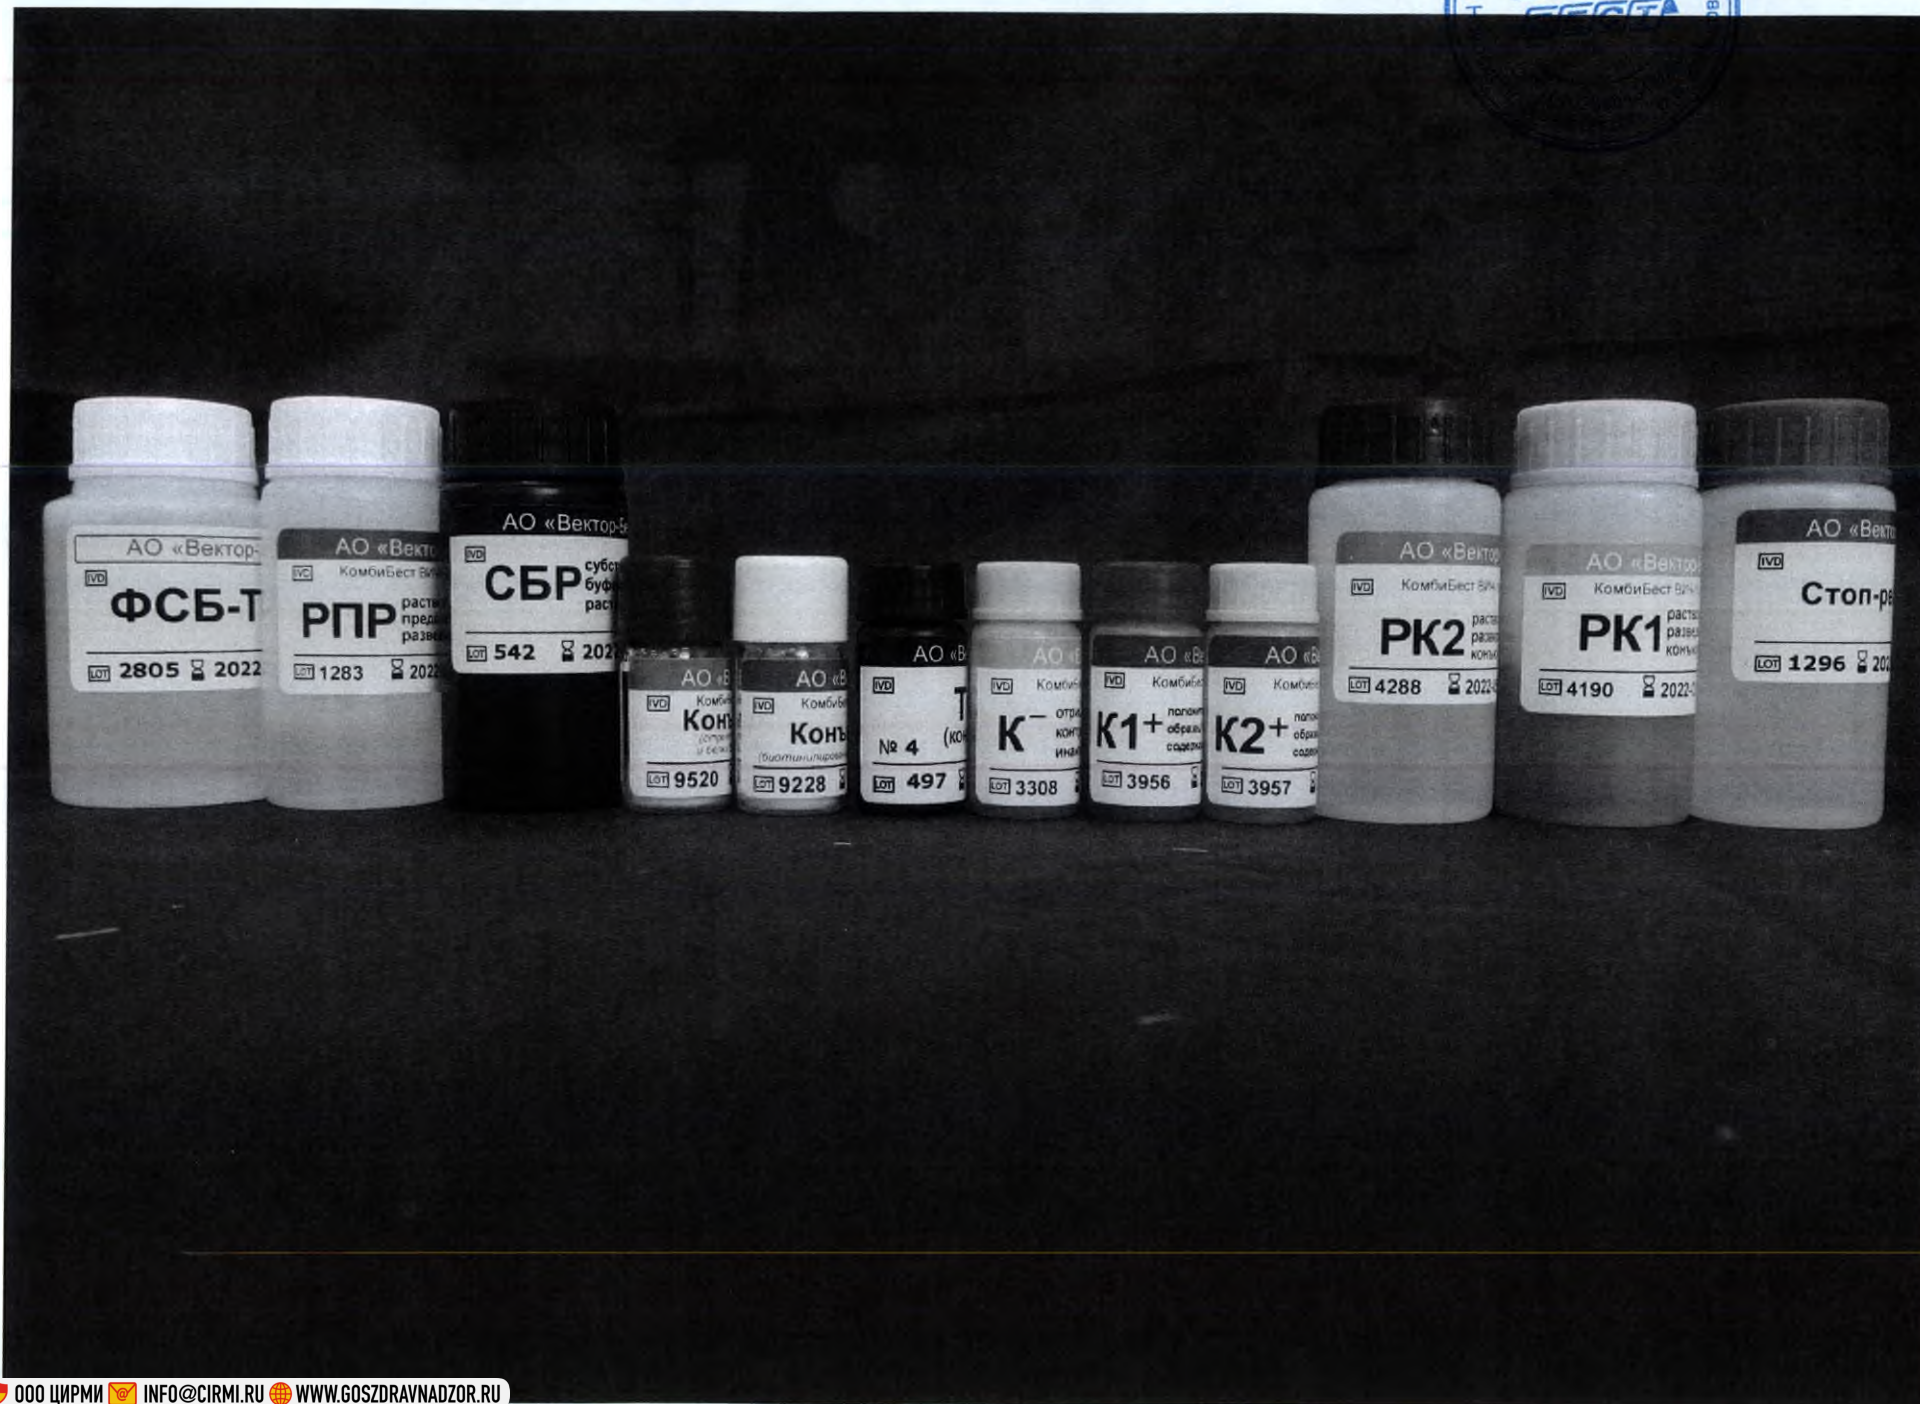

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 2))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
104 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 2))» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
» 104 2019 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 3/авто))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.
2019 г.





ВЕКТОР

БЕСТ

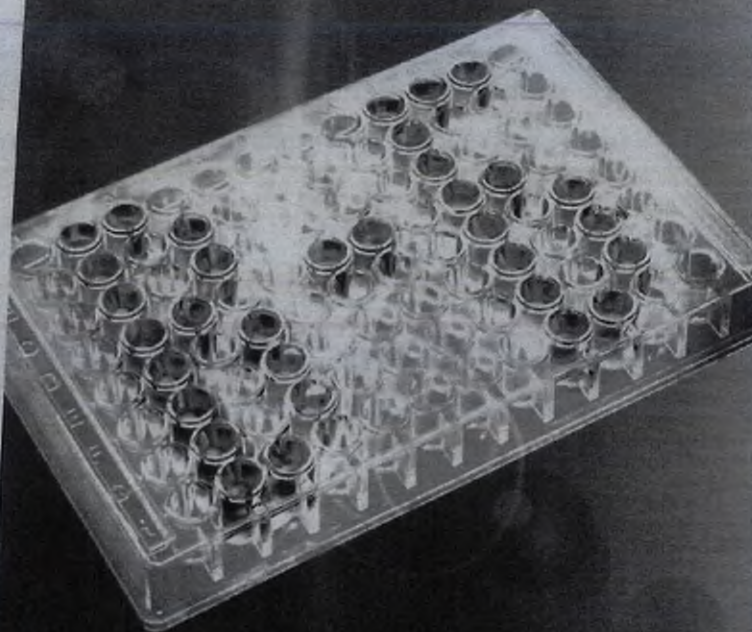

REF

D-0150

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
антител к ВИЧ-1,2
и антигена р24 ВИЧ-1

КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ
(комплект 3/авто)

LOT 2277

СОСТАВ:

LOT

1. Пластины разборные с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1,2 и антителами к р24 ВИЧ-1	2 шт.	219037
2. Положительный контрольный образец №1, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3852
3. Положительный контрольный образец №2, инактивированный	1 фл. 1,0 мл	3957
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 2,0 мл	3321
5. Конъюгат № 1	2 фл.	9372
6. Конъюгат № 2	2-4 фл.	9652
7. Раствор для предварительного разведения	1 фл. 8,0 мл	1340
8. Раствор для разведения конъюгата №1	2 фл. по 13,0 мл	4333
9. Раствор для разведения конъюгата №2	2 фл. по 17,0 мл	4334
10. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	3 фл. по 28,0 мл	2809
11. Субстратный буферный раствор	2 фл. по 20,0 мл	541
12. Тетраметилбензидин, концентрат	2 фл. по 1,5 мл	503
13. Стоп-реагент	2 фл. по 21,0 мл	1303

Принадлежности:

Самолгнущиеся этикетки со штрих-кодами для реагентов 1 комп.


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 3/авто))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«09» 04 2019 г.



БЕКТОР

БЕСТ

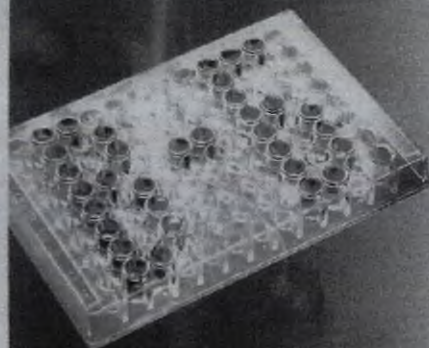

REF **D-0150**

Σ 192

LOT **2277**

TU 9398-317-23548172-2011

ПУ № ФСР 2012/13835 от 25.03.2017

2019-07-04

2020-07-04

КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ
(комплект 3/авто)

IVD



01500407200227700224


Для профессионального применения
Антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 3/авто))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


2019 г.

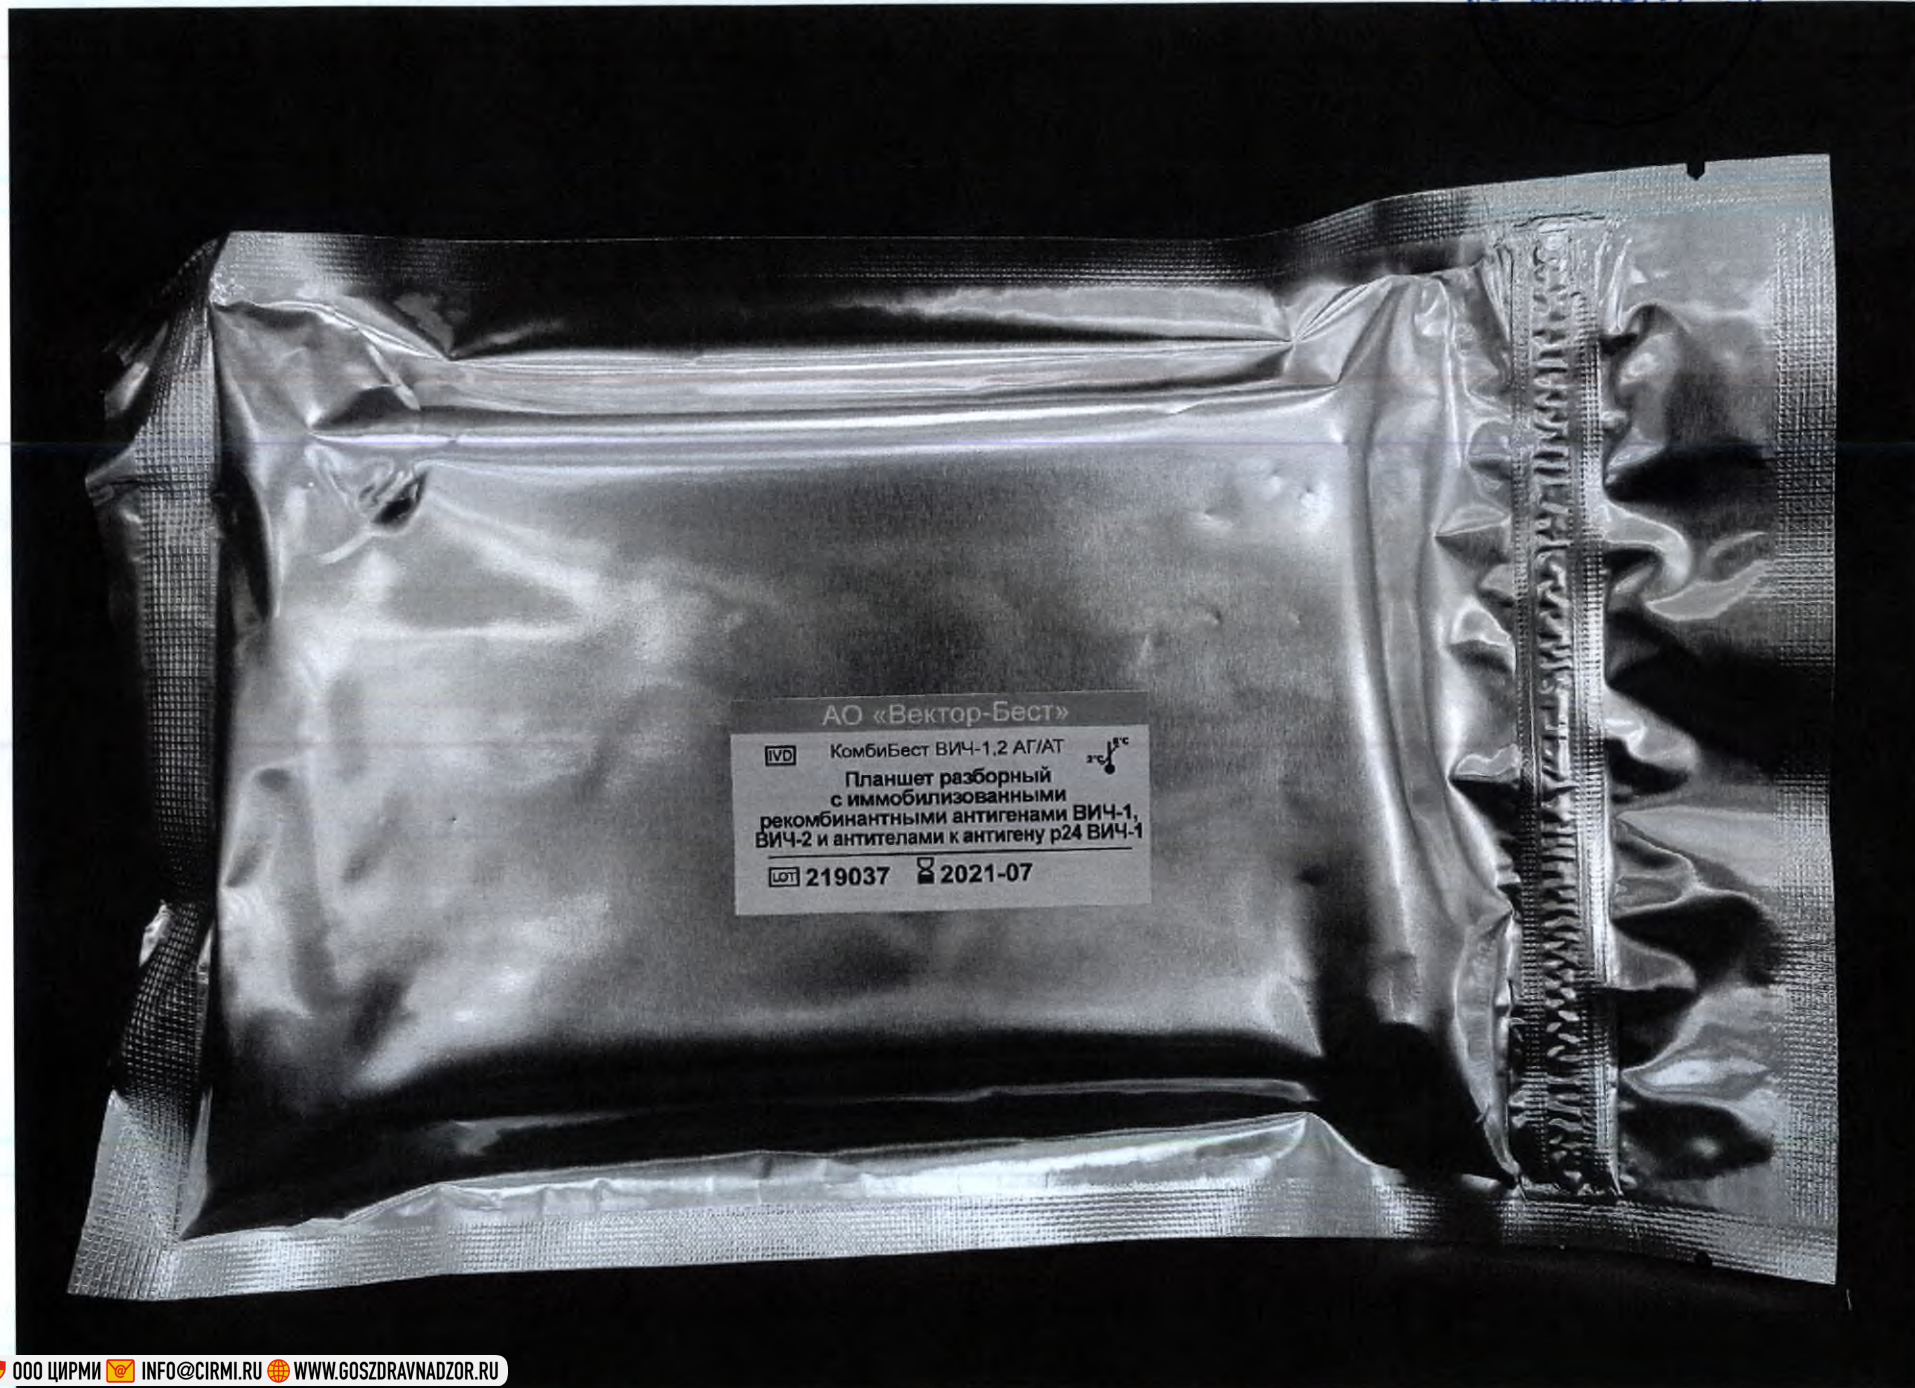

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 3/авто))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
2019 г.

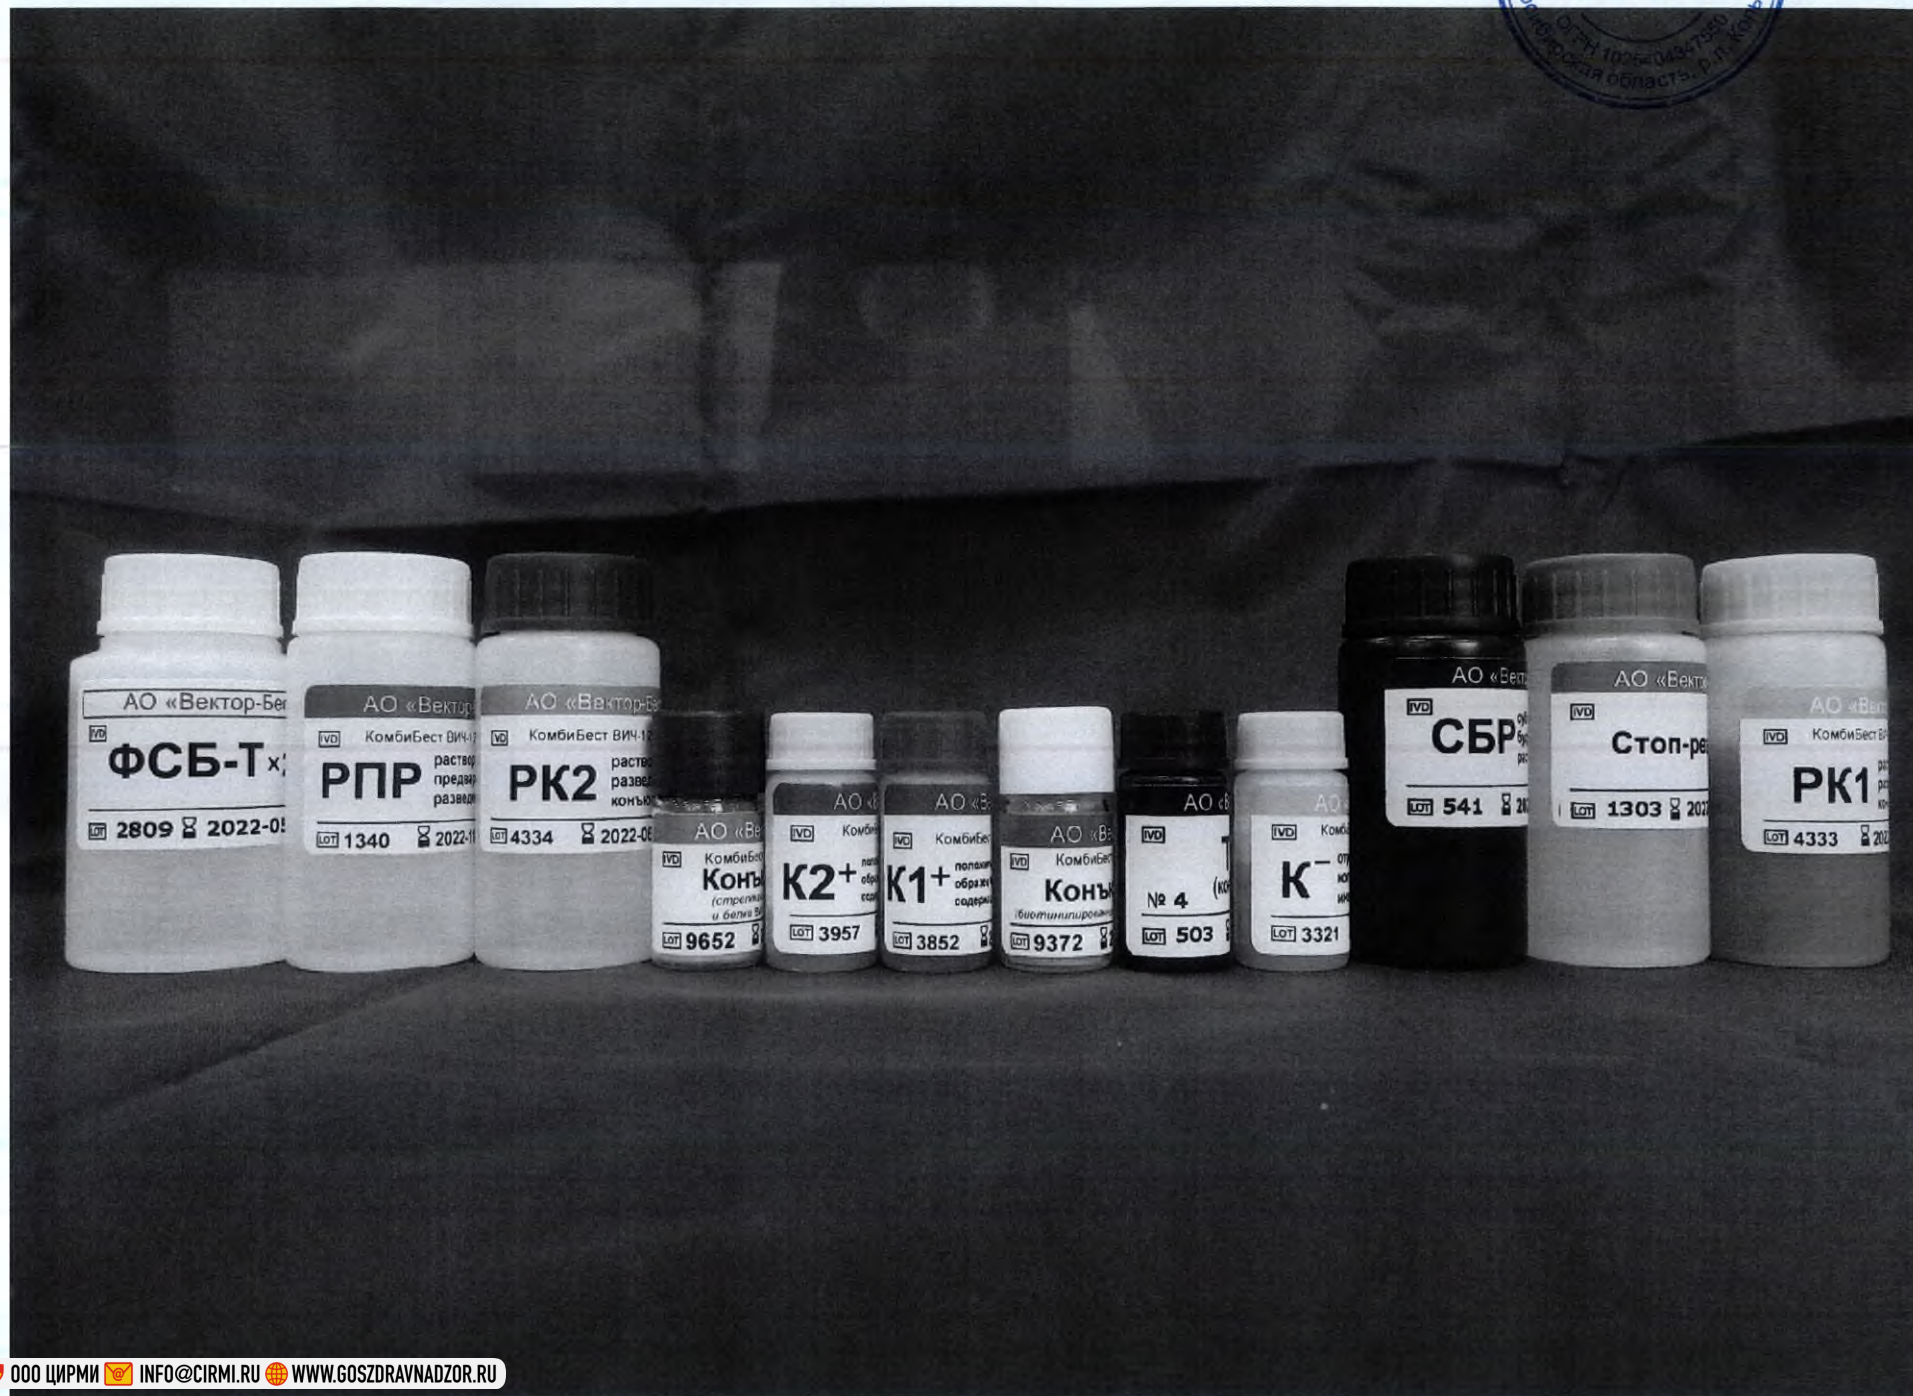

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 (КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 3/авто))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
04 2019 г.

