


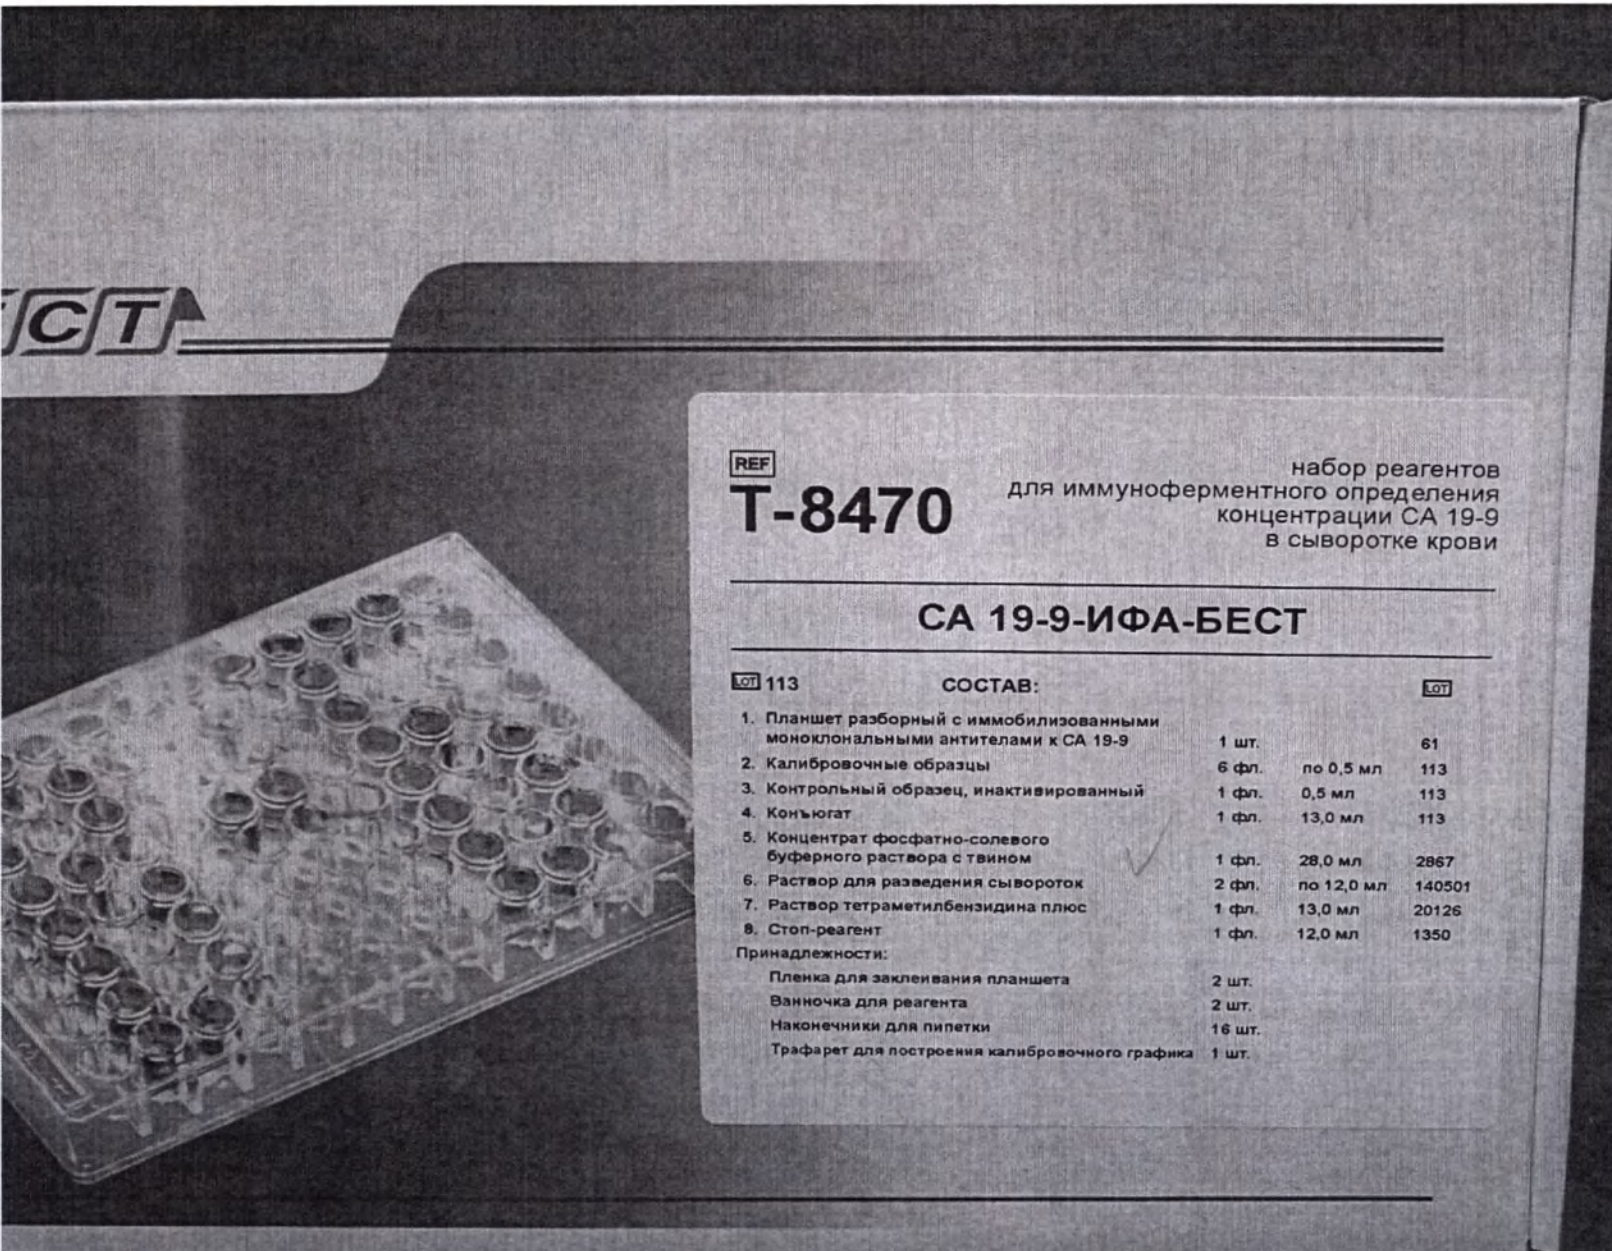

REF

T-8470

набор реагентов
для иммуноферментного определения
концентрации СА 19-9
в сыворотке крови

СА 19-9-ИФА-БЕСТ

LOT 113

СОСТАВ:

LOT


1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к СА 19-9	1 шт.		61
2. Калибровочные образцы	6 фл.	по 0,5 мл	113
3. Контрольный образец, инактивированный	1 фл.	0,5 мл	113
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	113
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл	2867
6. Раствор для разведения сывороток	2 фл.	по 12,0 мл	140501
7. Раствор тетраметилбензидина плюс	1 фл.	13,0 мл	20126
8. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1350
Принадлежности:			
Пленка для заклеивания планшета	2 шт.		
Ванночка для реагента	2 шт.		
Наконечники для пипетки	16 шт.		
Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.		

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови (СА 19-9 – ИФА-БЕСТ)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусанов М.Д.
27.01.2020 г.
ОКР
БЕСТ
НОВ




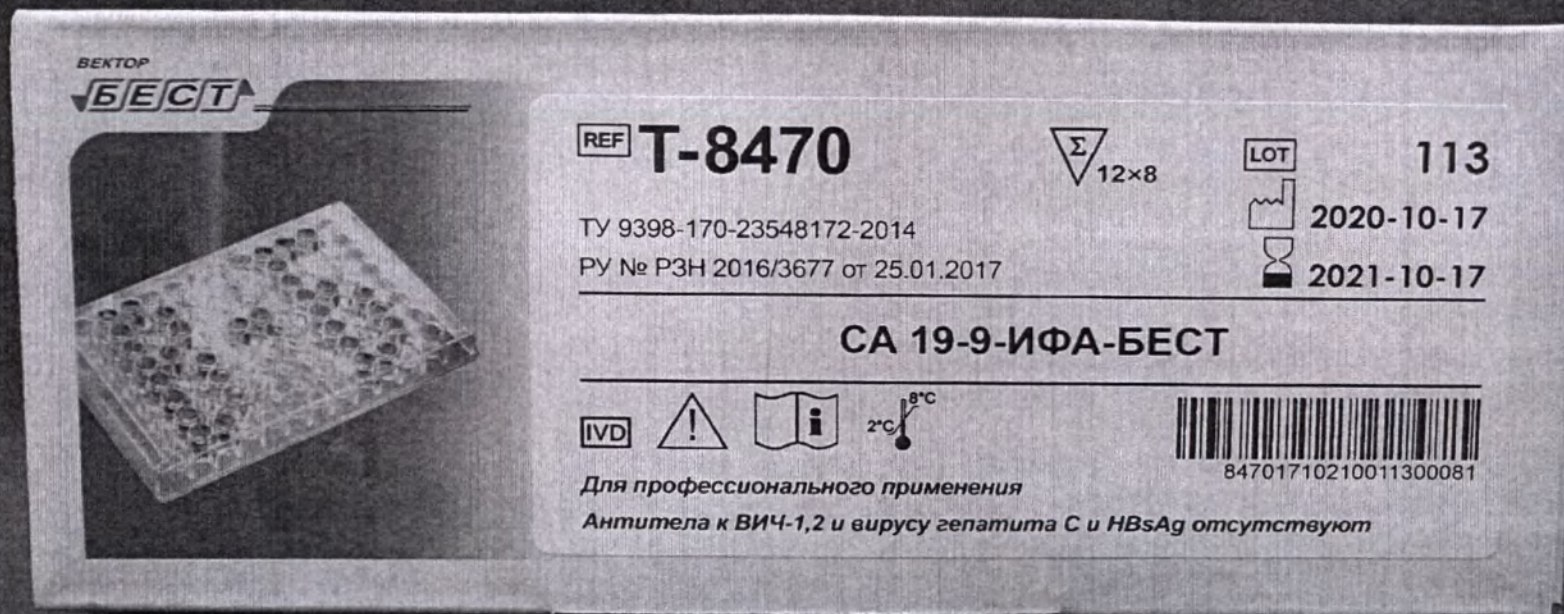


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови (СА 19-9 – ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


2020 г.

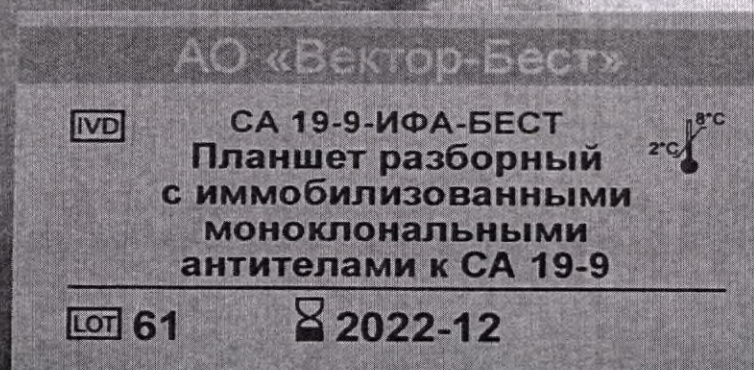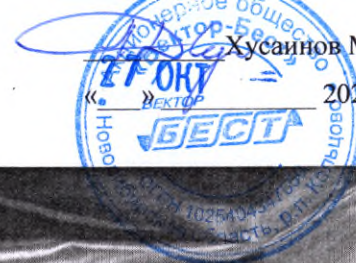

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови (СА 19-9 – ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
27 ОКТ 2020 г.
ВЕКТОР

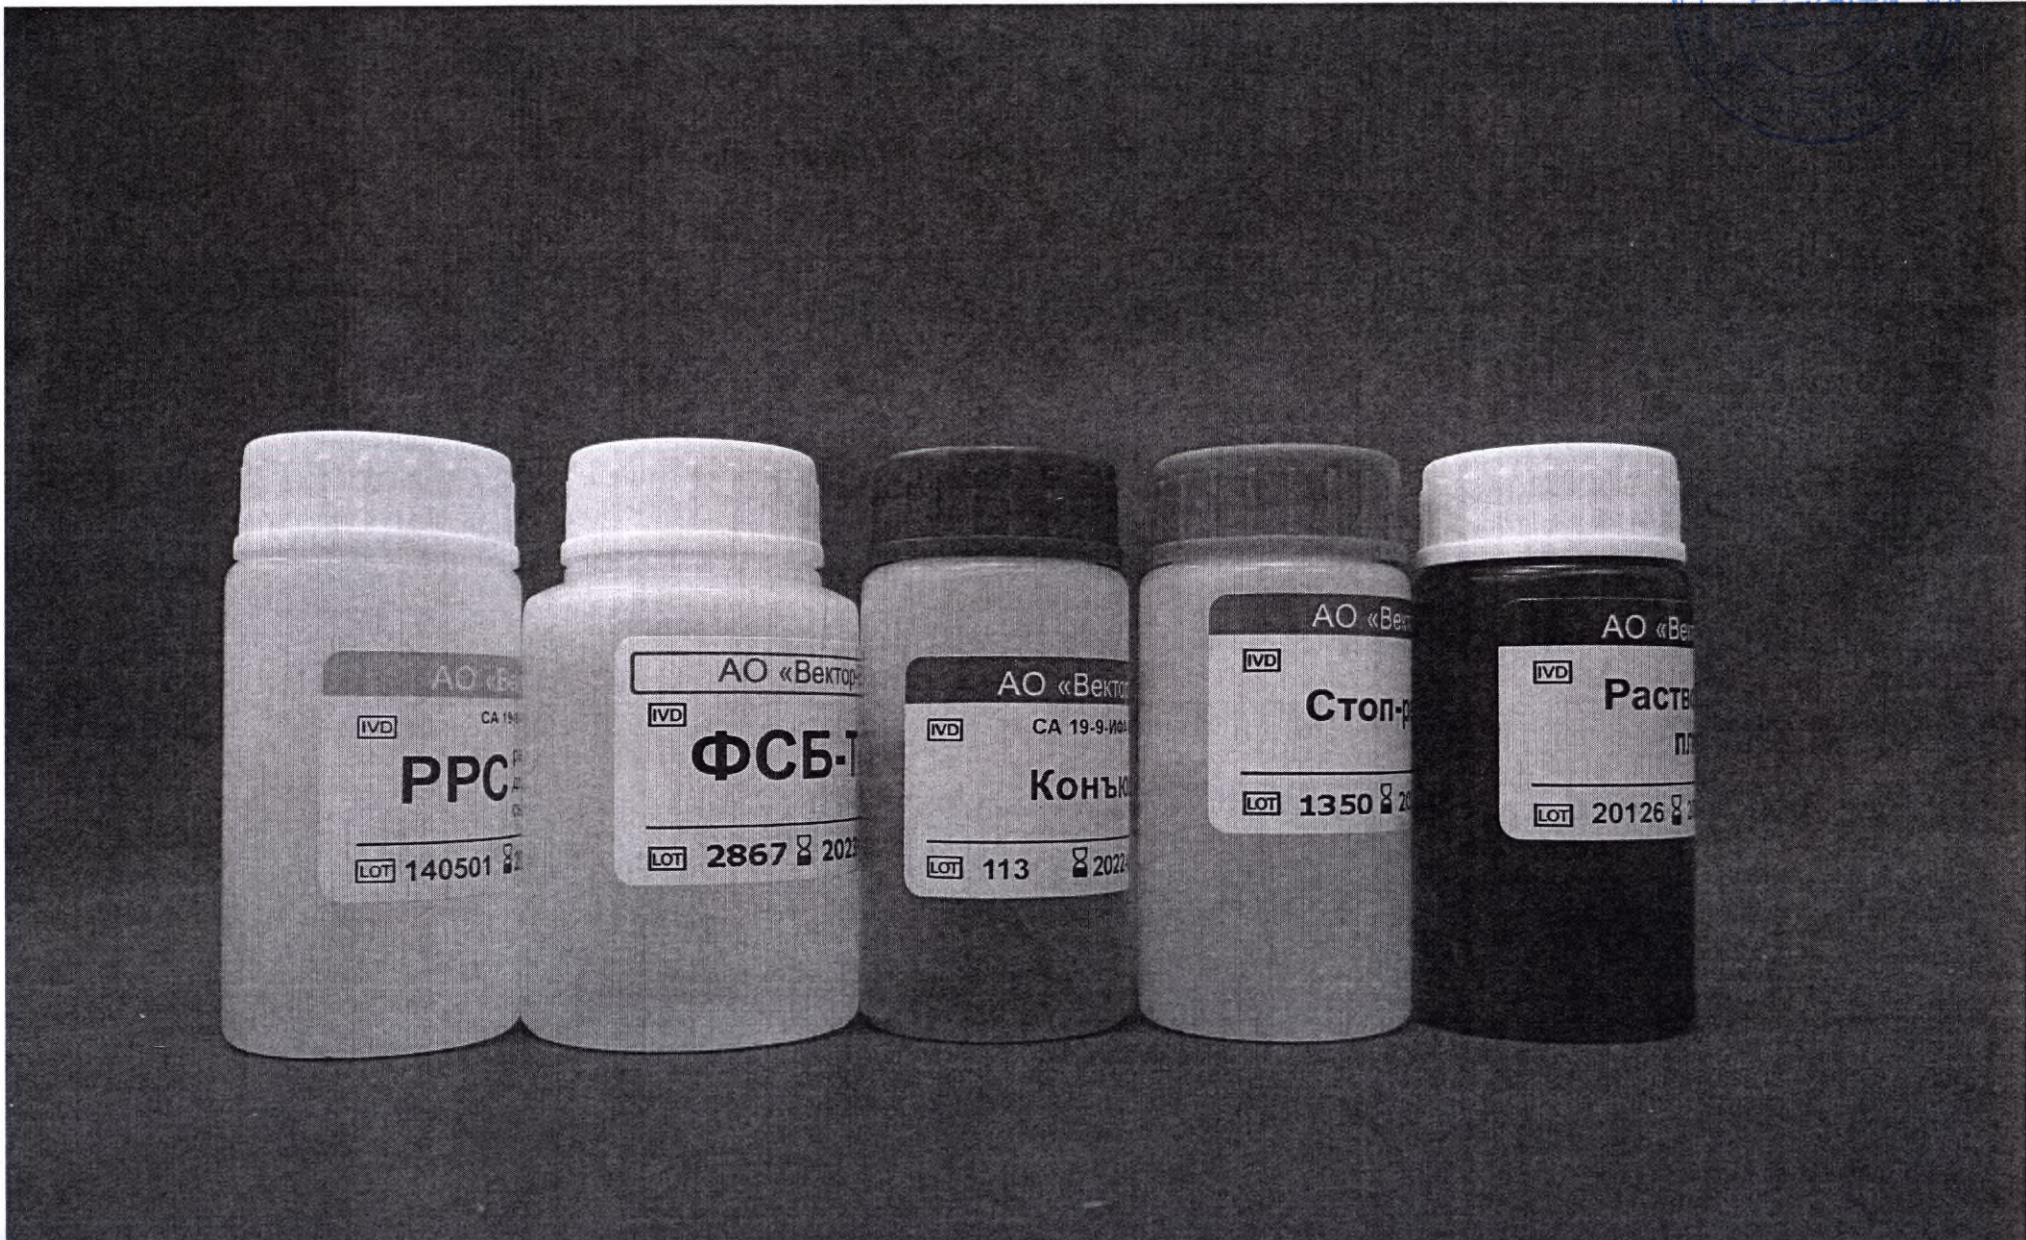

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови (СА 19-9 – ИФА-БЕСТ)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«27» ОКТ 2020 г.
Вектор-Бест





