



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам *Ascaris lumbricoides* в сыворотке (плазме) крови (Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусанов М.Д.
« 05 2020 г.

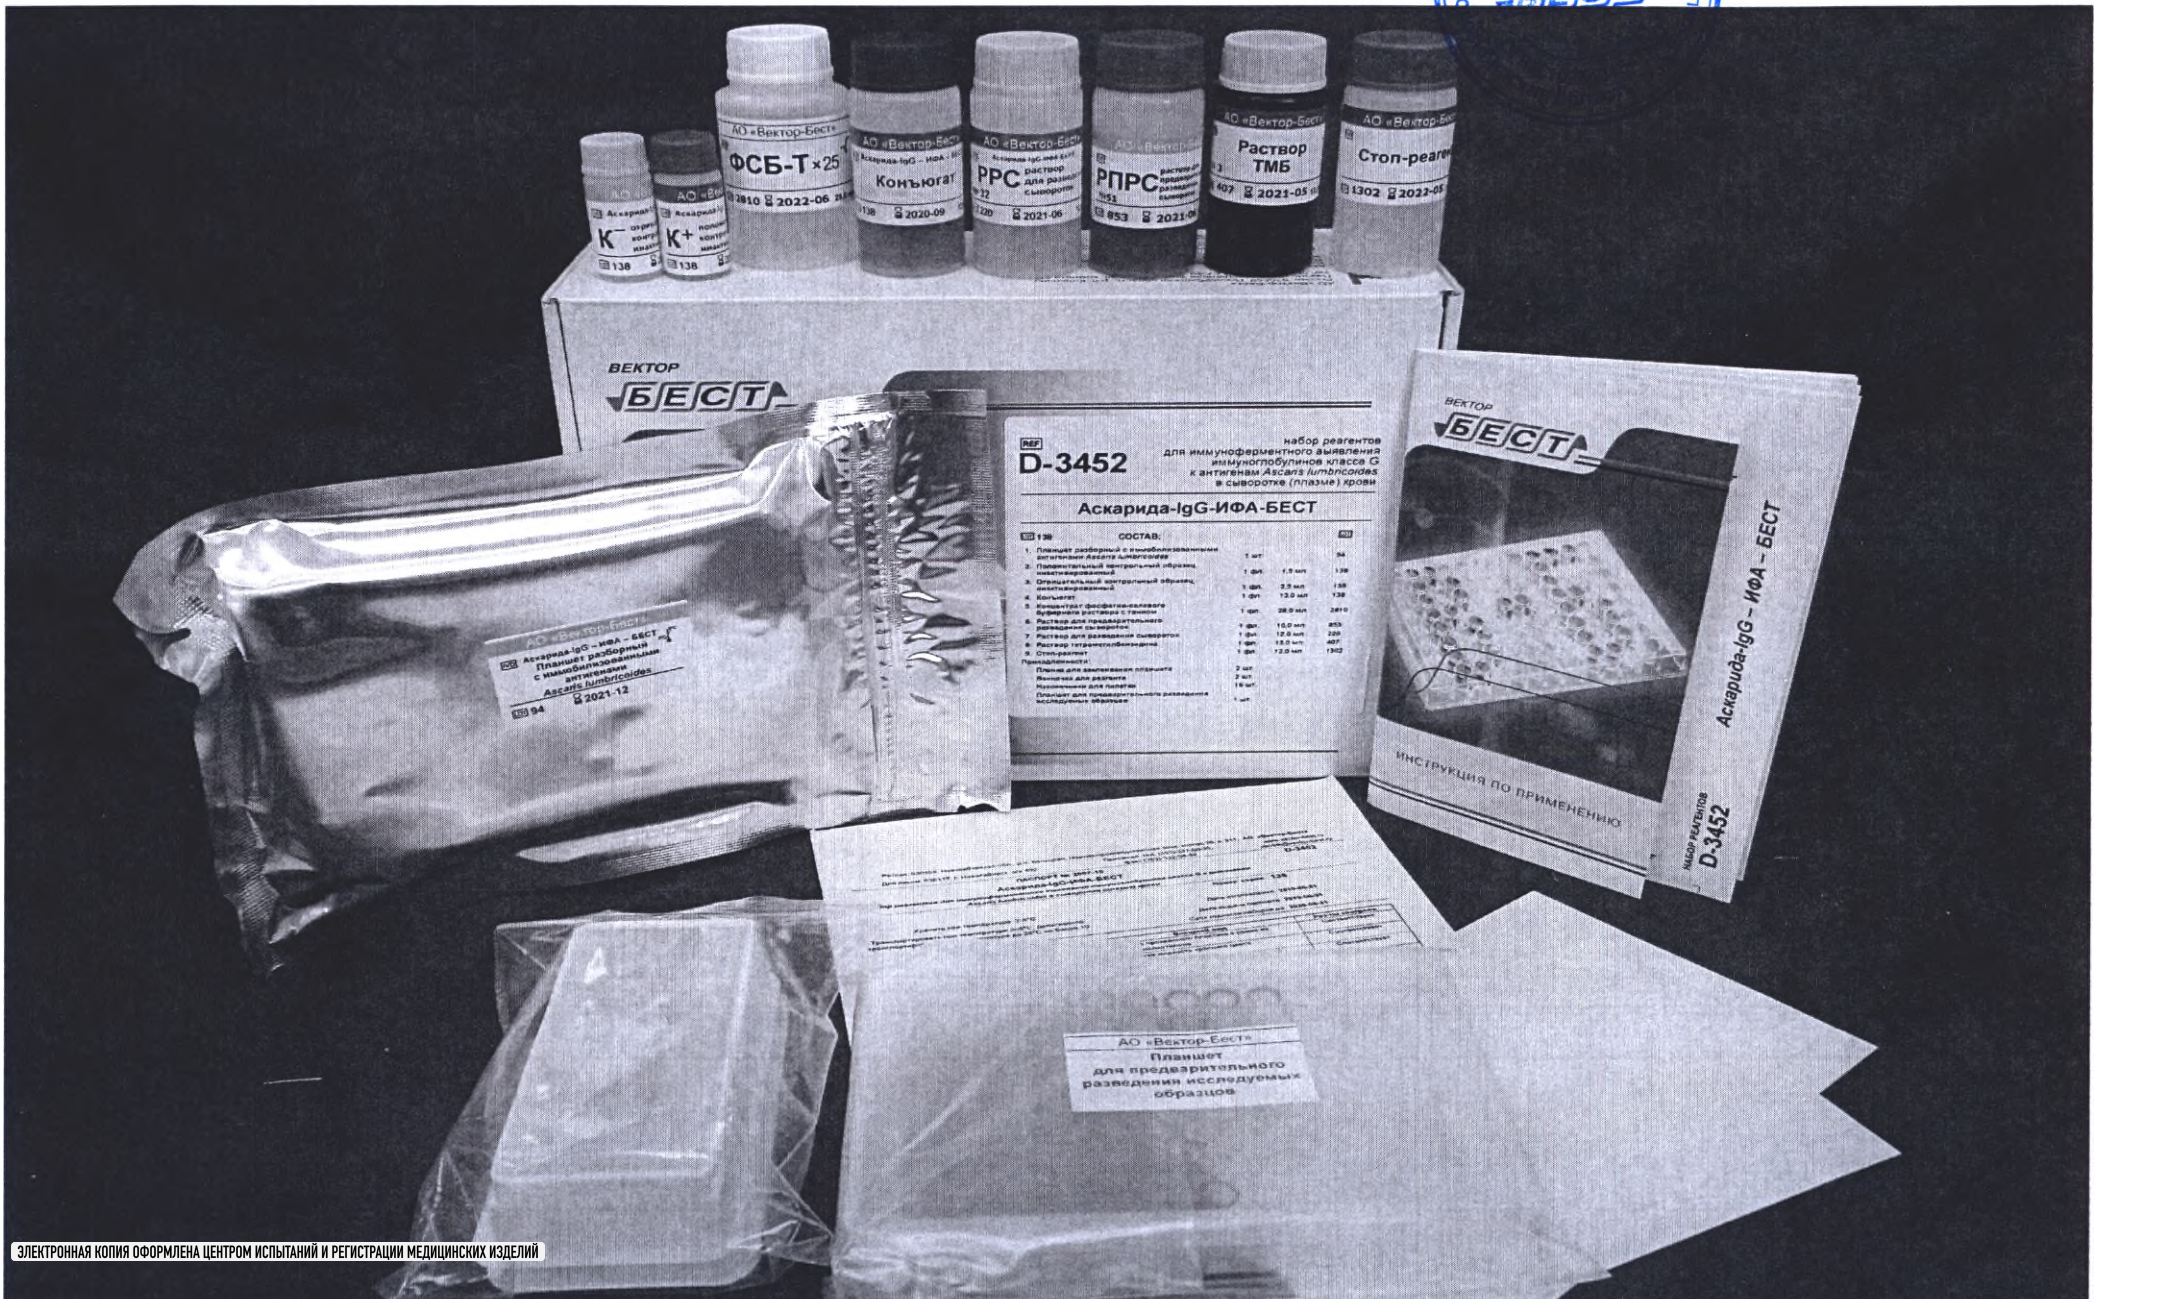


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам *Ascaris lumbricoides* в сыворотке (плазме) крови (Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
18/05 2020 г.

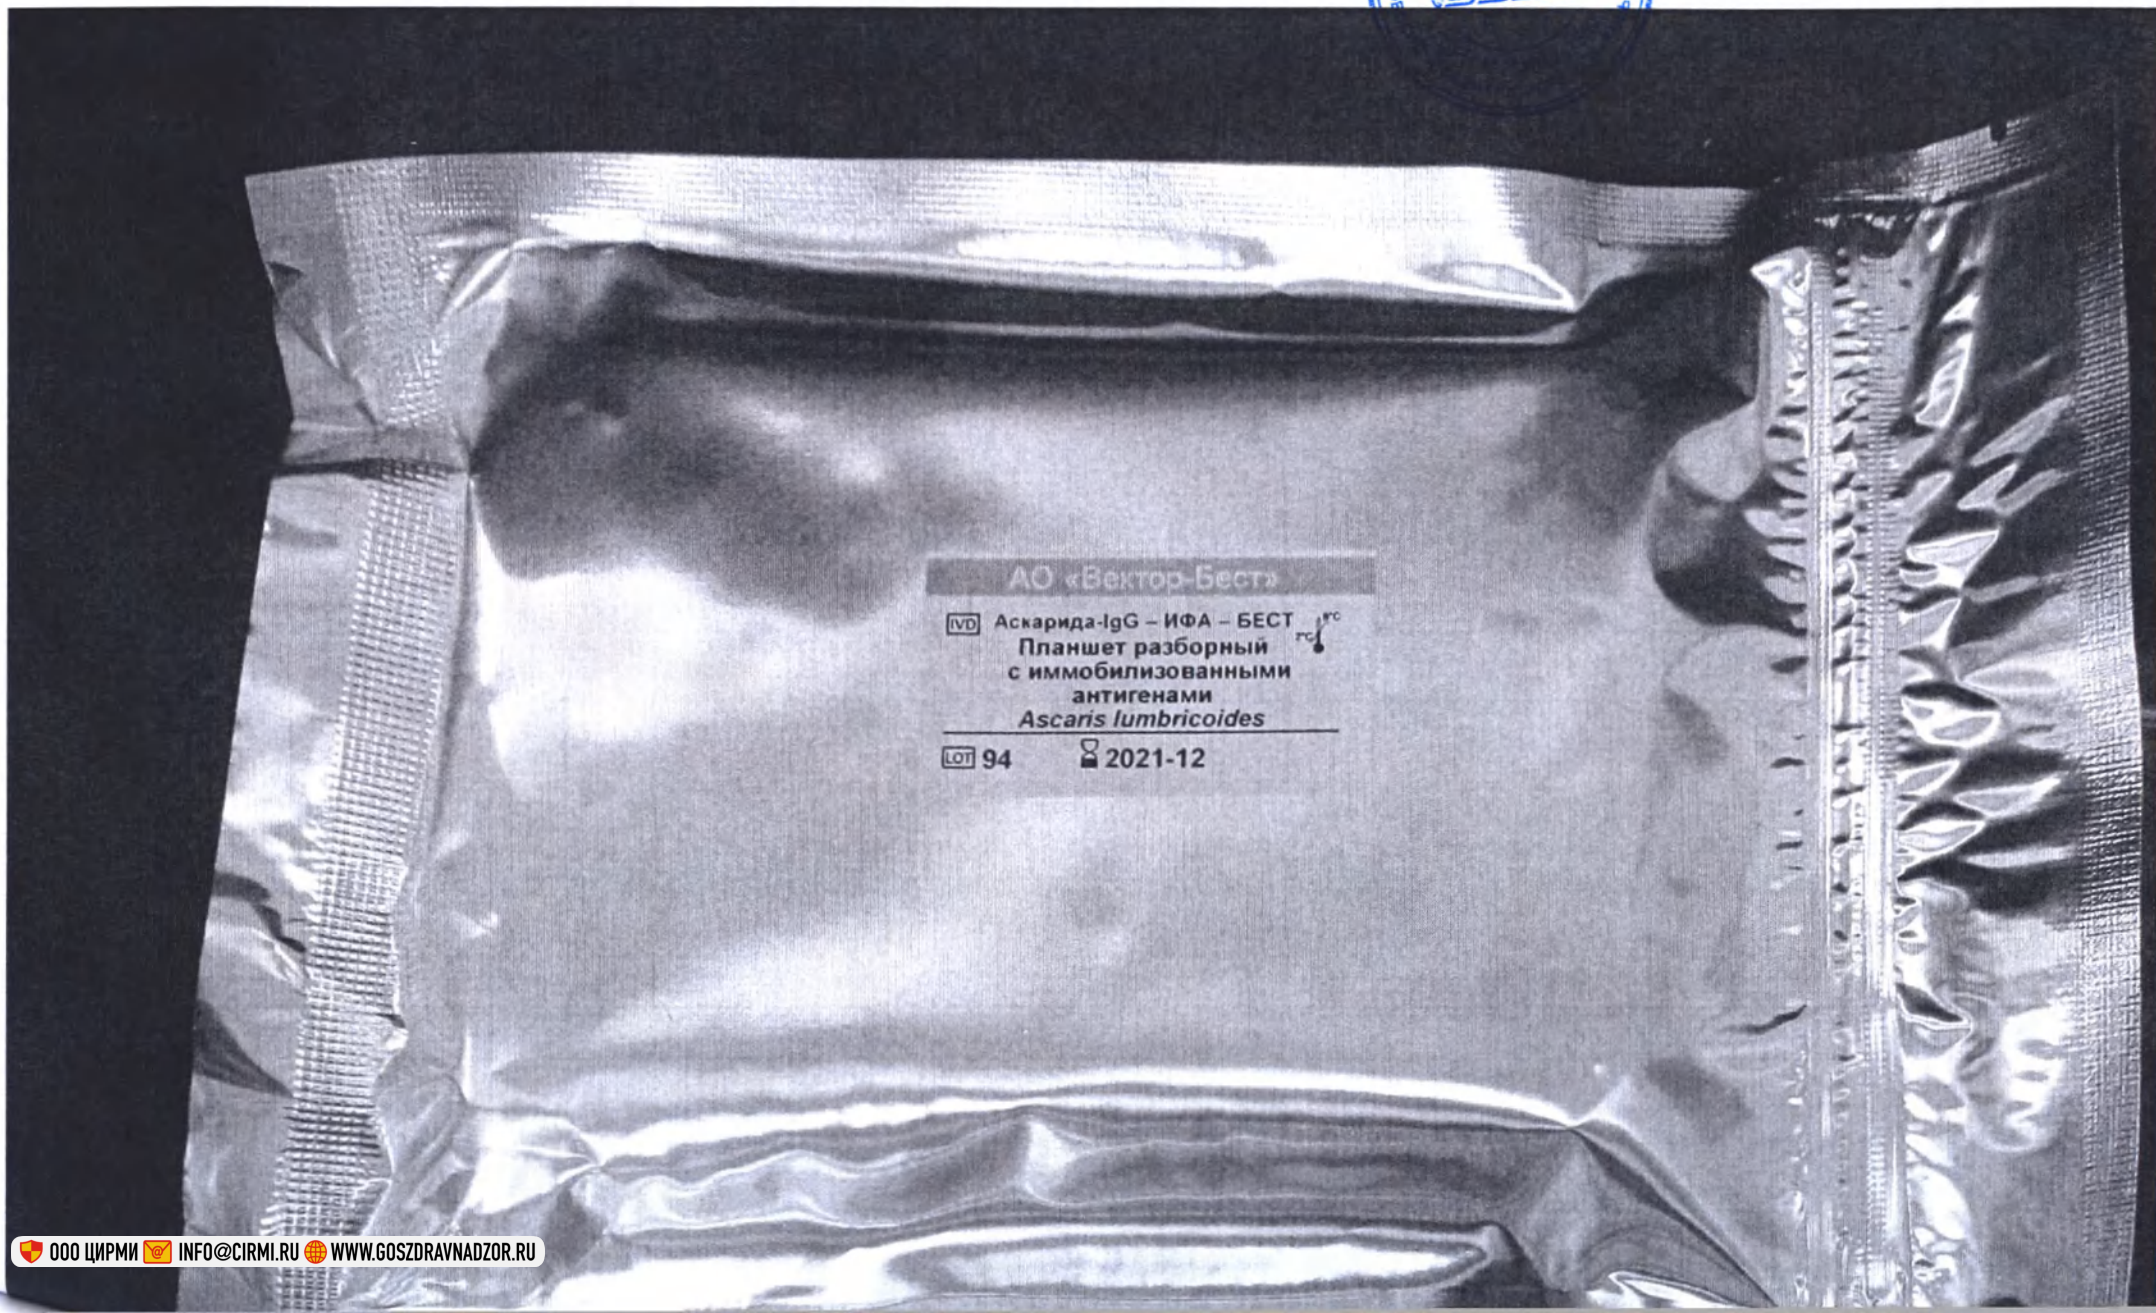



АО «Вектор-Бест»

IVD Аскарида-IgG – ИФА – БЕСТ^{гс}
Планшет разборный
с иммобилизованными
антигенами
Ascaris lumbricoides

LOT 94 2021-12


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам *Ascaris lumbricoides* в сыворотке (плазме) крови (Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
28» 05 2020 г.

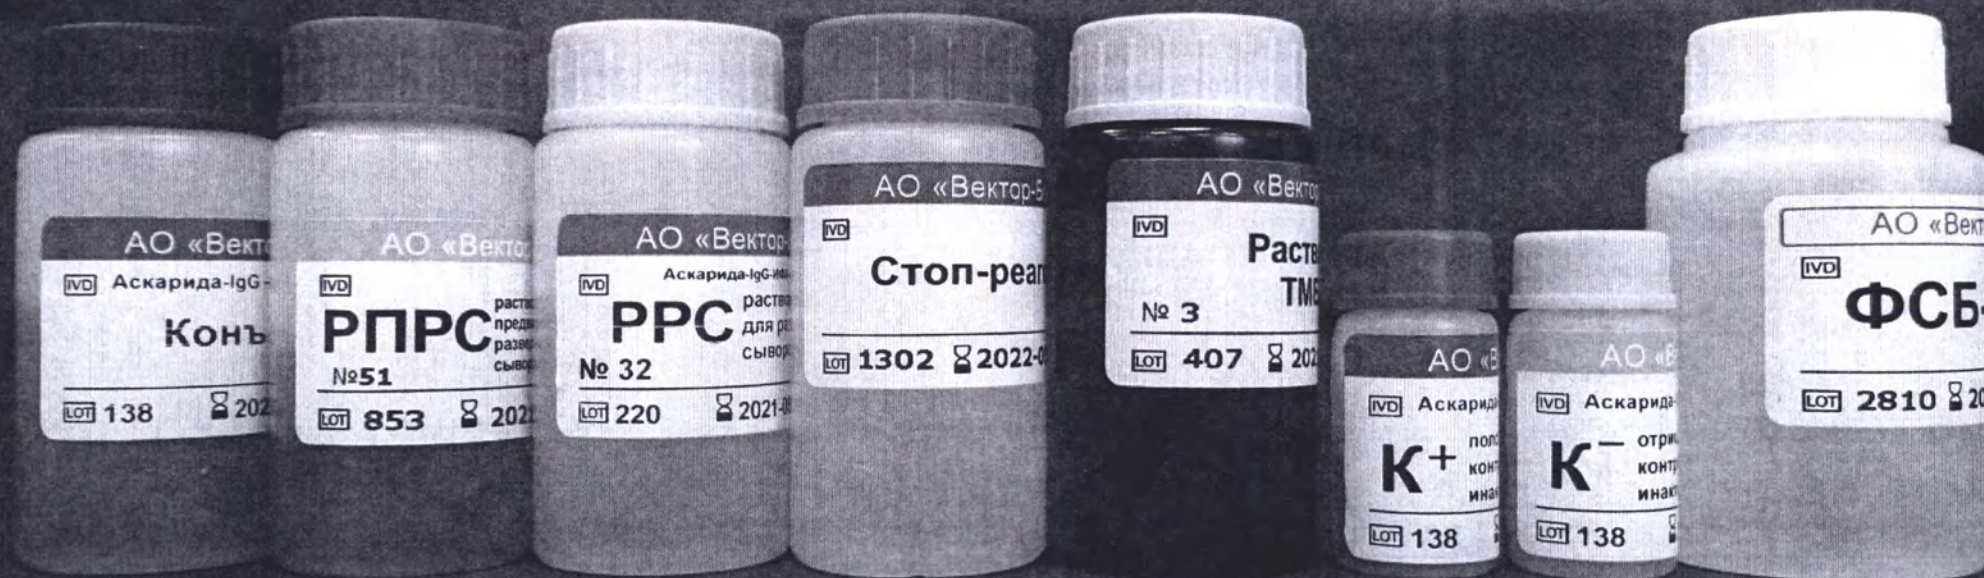

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам *Ascaris lumbricoides* в сыворотке (плазме) крови (Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 3

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» 05 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам *Ascaris lumbricoides* в сыворотке (плазме) крови (Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.




2020 г.





ВЕКТОР

БЕСТ

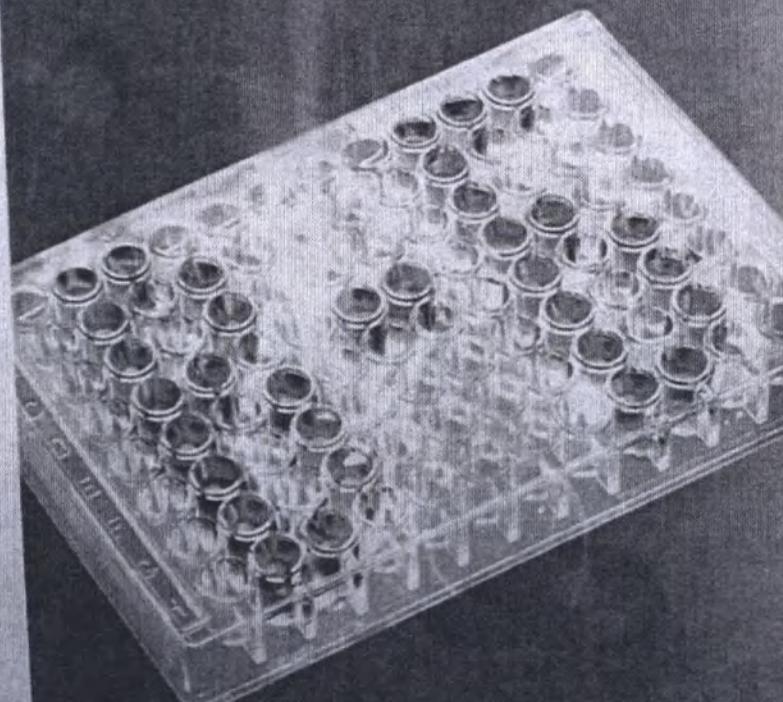

REF

D-3452

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к антигенам *Ascaris lumbricoides*
в сыворотке (плазме) крови

Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ

LOT 138

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами <i>Ascaris lumbricoides</i>	1 шт.		94
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	1,5 мл	138
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	2,5 мл	138
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	138
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл	2810
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл	853
7. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	220
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл	407
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1302

Принадлежности:


Пленка для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночка для реагента	2 шт.
Наконечники для пипетки	16 шт.
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам *Ascaris lumbricoides* в сыворотке (плазме) крови (Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
28.05.2020 г.



БЕСТ

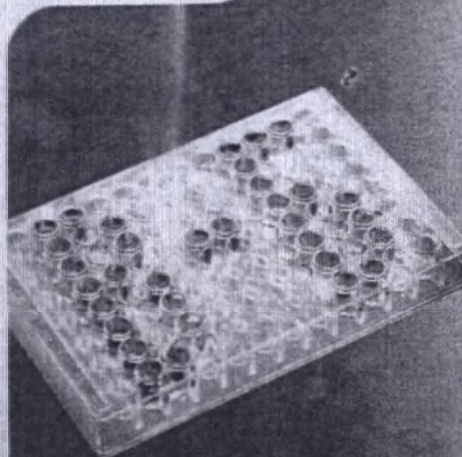

REF **D-3452**

Σ₉₆

LOT

138

ТУ 9398-382-23548172-2012

ПУ № РЗН 2013/449 от 25.03.2017

2019-06-21

2020-06-21

Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ

IVD



34522106200013800700

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют