

Реагент 1	
Реагент 2	
Калибратор	
Технически	
Соответствие	
раствору про	
более	
Чувствитель	
Показатель	
Тест на «лине	
25 - 3800 мкм	
Тест на «откры	
Коэффициент	
более	

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реактивов для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче
Креатинин-Ново-А (биорепант)

на применение набора реактивов для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче
Креатинин-Ново-А (биорепант)

НАЧЕНИЕ
Креатинин-Ново-А (биорепант) — это набор реактивов для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Набор реагентов Кратинин-Ново-А предназначен для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче человека кинестическим методом Яффе с диализом коллоидной пробой и комбинированным методом Яффе с диализом в калликоновских лабораториях, и научно-диагностический практикум.
1.2. Набор выпускается в 6 вариантах комплектации:
– вариант 1 **авто** (100 определений при расходе 0,8 мл реагента 1 на одно определение);
– вариант 2 **авто** (500 определений при расходе 0,8 мл реагента 1 на одно определение);
– вариант 3 **авто** (без калибратора, предназначен для проведения дополнительного определения концентрации креатинина);
– вариант 4 **авто** (калибратор, предназначен для проведения дополнительной калибровки);
– вариант 5 **авто**;
– вариант 6 **авто** (без калибратора, предназначен для проведения дополнительного определения концентрации креатинина).
Количество реагентов в вариантах 3 **авто** и 4 **авто**

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Минимум: Любая область отсечения, граница которой в эллипсе ε и 25 на 1000 жомов и 100 на 1000 жомов.

3.2. Чувствительность отсечения: не более 5% .

3.3. Коэффициент вариации результатов отсечения: не более 5% .

3.4. Нормальные значения концентрации:


- в сыровате: $53-106$ мкмоль/л;
- в сыворотке: $71-115$ мкмоль/л;
- в сыворотке жом: $44-178$ мкмоль/л.

3.5. Рекомендуется в каждой лаборатории.

3.3. Коэффициент вариации
более 5%.

3.4. Нормальные значения концентрации
— в слювороте и моче: 53-106 микомол/л;
мужчины — 71-115 микомол/л;
— в слювороте и моче: 4,4-17,8 микомол/сут.
— 6. Рекомендуется в каждой лаборатории при использо-



Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусанов М.Д.
2017 г.



Инструкция по применению набора реактивов для определения креатинина в сыворотке плазмы крови и моче человека (вариант 3 авто)

Креатинин-Ново-А (Биоактив) (вариант 3 авто)

Набор реактивов для определения креатинина в сыворотке плазмы крови и моче человека (вариант 3 авто)

Хранить при температуре 2-8°C. Срок годности 12 месяцев. Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C на более 48 суток.

ТУ 8289-443-2344173-2013

БЕСТ

НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реактивов предназначен для определения креатинина в сыворотке плазмы крови и моче человека (вариант 3 авто). Набор может быть использован в клинической лаборатории и биохимической лаборатории.

1.2. Набор выпускается в 6 вариантах при расходе 0,8 мл на 1 анализ (100 определений), 1,6 мл на 1 анализ (50 определений), 3,2 мл на 1 анализ (25 определений), 6,4 мл на 1 анализ (12,5 определений), 12,8 мл на 1 анализ (6,25 определений), 25,6 мл на 1 анализ (3,125 определений).

НАПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

2.1. Линейный диапазон определения креатинина в сыворотке плазмы крови и моче человека 0,1-10 мг/дл (0,8-8 ммоль/л).

2.2. Предел чувствительности 0,05 мг/дл (0,4 ммоль/л).

2.3. Коэффициент вариации не более 5%.

2.4. Продолжительность анализа 10 минут.

2.5. Реактивы в наборе предназначены для определения креатинина в сыворотке плазмы крови и моче человека (вариант 3 авто).

Генеральный директор
АО «Вектор-Бей»
Хусанов М.Д.
2017 г.



КРЕАТИНИН-НОВО-А (реактивы) (латинский алфавит)
Kreatinin-Nowo-A (reagents) (Latin alphabet)
ТУ 6389-04-01-2013

Жидкость при проведении теста должна быть прозрачной, без осадка и помутнения. Транспортировать в герметичной упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ
Креатинин-Ново-А (реактивы)

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Набор реактивов Креатинин-Ново-А (реактивы) предназначен для определения концентрации креатинина в сыворотке плазмы крови и мочи. Набор может быть использован в лабораториях, оснащенных автоматическими и биохимическими анализаторами.


1.2. Набор выпускается в 6 вариантах при расходе 0,8 мл реактива 1 на одно определение:
— вариант 2 **авто** (без калибратора, предназначен для проведения дополнительной определения концентрации креатинина);
— вариант 4 **авто** (калibrator, предназначен для проведения дополнительной определения концентрации креатинина);
— вариант 5 **авто** (без калибратора, предназначен для проведения дополнительной определения концентрации креатинина);
— вариант 6 **авто** (без калибратора, предназначен для проведения дополнительной определения концентрации креатинина).

Количество реактивов в вариантах 3 **авто** и 4 **авто** (калibrator).

ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Ламинированный картонный флакон.
1.2. Фасовка: 10 флаконов по 10 мл.
1.3. Срок годности: 12 месяцев со дня выпуска.
1.4. Нормальный диапазон: 0,1-10 мг/дл.
1.5. Рабочий диапазон: 0,1-10 мг/дл.

КАРТА
Содержимое
Вариант
Полная
ТД - 3800

Тест на креатинин
Дополнительно
определяется
серия. Значение

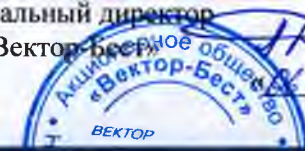

набор реагентов
для определения концентрации
креатинина кинетическим методом
Яффе с диализом в оплывающей
пробой и комплассации в сыворотке
плазмы крови и моче

Креатинин-Ново-А (биореагент)
(вариант 5 авто, Сапфир 400-24)

Состав: Реагент 1 (4+40 мл)
Реагент 2 (2+20 мл)
Калибратор (2+3 мл)
ТУ 0288.042.236-0173-2013
г. Москва 2014

