


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов
 класса А к Chlamydia trachomatis (ХламиБест C. trachomatis-IgA) по ТУ 9398-091-23548172-2014»

Генеральный директор
 АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2022 г.

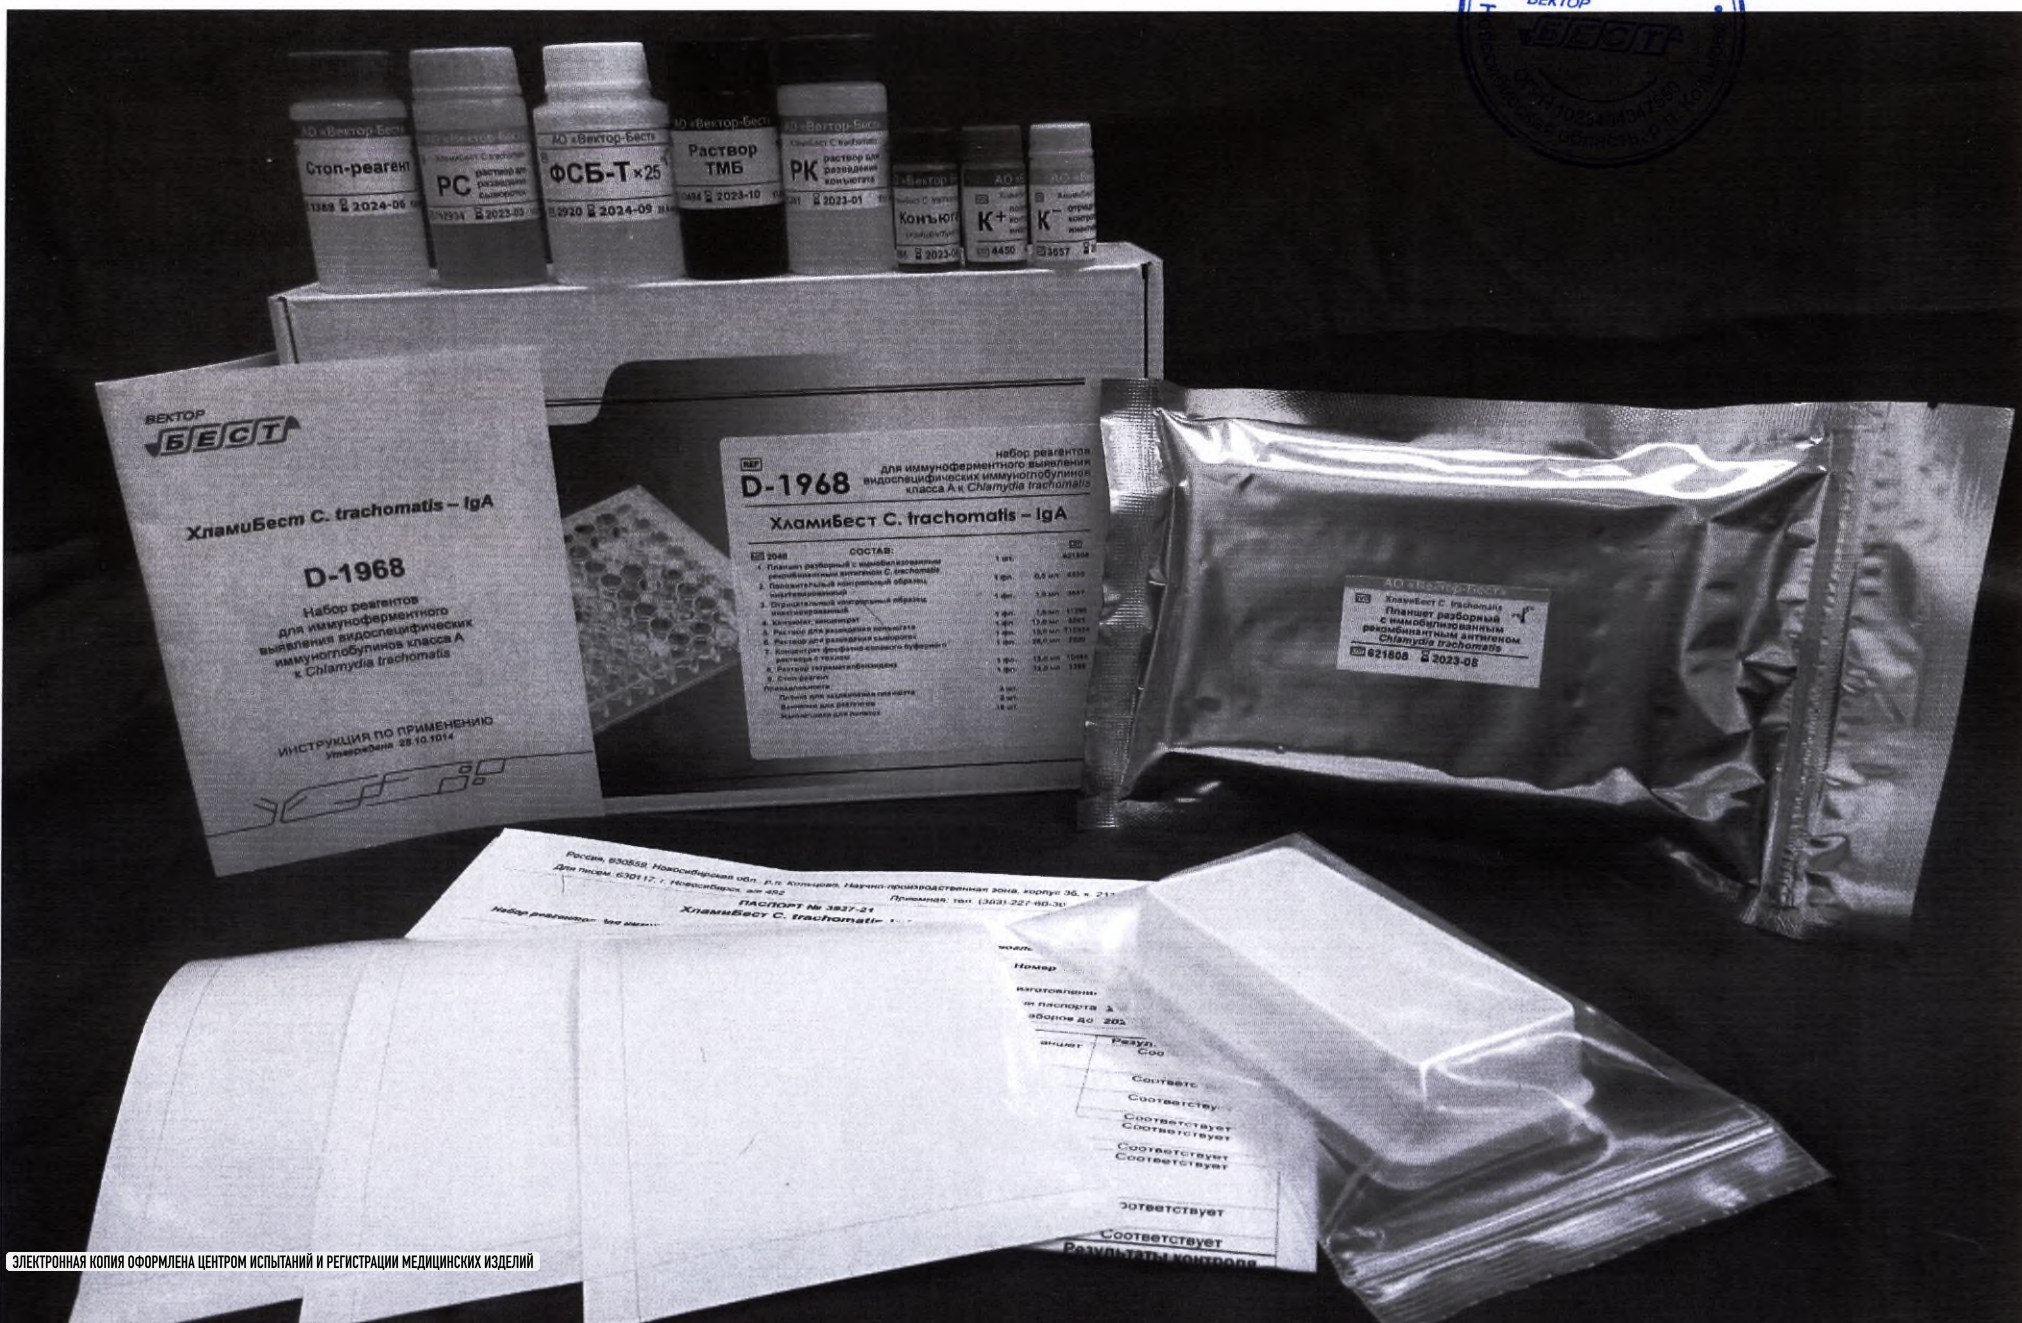

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к *Chlamydia trachomatis* (ХламиБест С. trachomatis-IgA) по ТУ

9398-091-23548172-2014» №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

2022 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

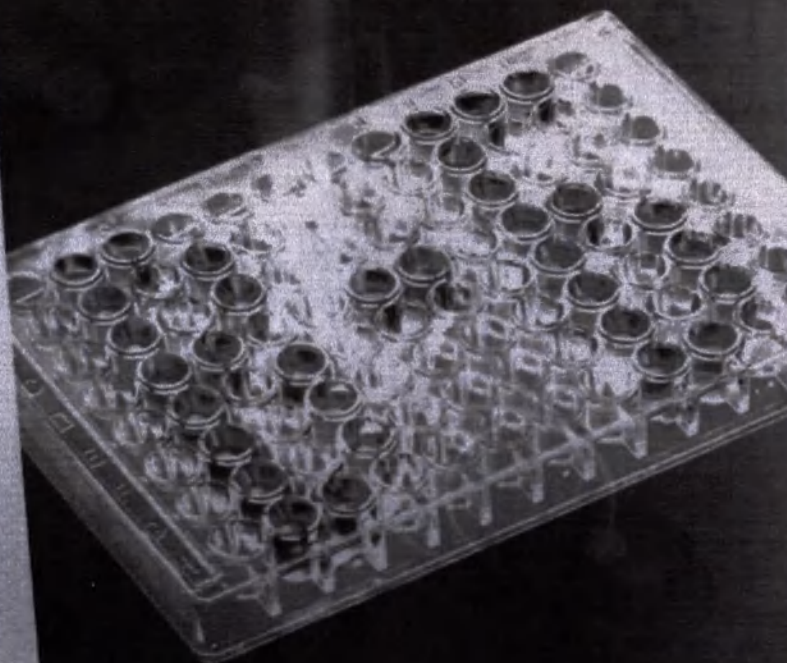

REF

D-1968

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
видоспецифических иммуноглобулинов
класса А к *Chlamydia trachomatis*

ХламиБест С. trachomatis – IgA

LOT 2048

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном <i>C. trachomatis</i>	1 шт.	621808
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	0,5 мл 4450
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	1,0 мл 3657
4. Конъюгат, концентрат	1 фл.	1,5 мл 11295
5. Раствор для разведения конъюгата	1 фл.	13,0 мл 5241
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	13,0 мл 712934
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл 2920
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл 10494
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл 1388
Принадлежности:		
Плётка для заклеивания планшета	3 шт.	
Ванночки для реагентов	2 шт.	
Наконечники для пипеток	16 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis (ХламиБест С. trachomatis-IgA) по ТУ 9398-091-23548172-2014» №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

И.И. Дуванов М.Д.
«21» 10 2022 г.



REF **D-1968**

Σ 12x8

LOT

2048

ТУ 9398-091-23548172-2014

ПУ № РЗН 2014/2186 от 29.03.2017



2021-10-21



2022-10-21

ХламиБест С. trachomatis - IgA

IVD



19682110220204800051


Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических
иммуноглобулинов класса А к *Chlamydia trachomatis* (ХламиБест С. trachomatis-IgA) по ТУ
9398-091-23548172-2014» №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



«21» 103 2022 г.

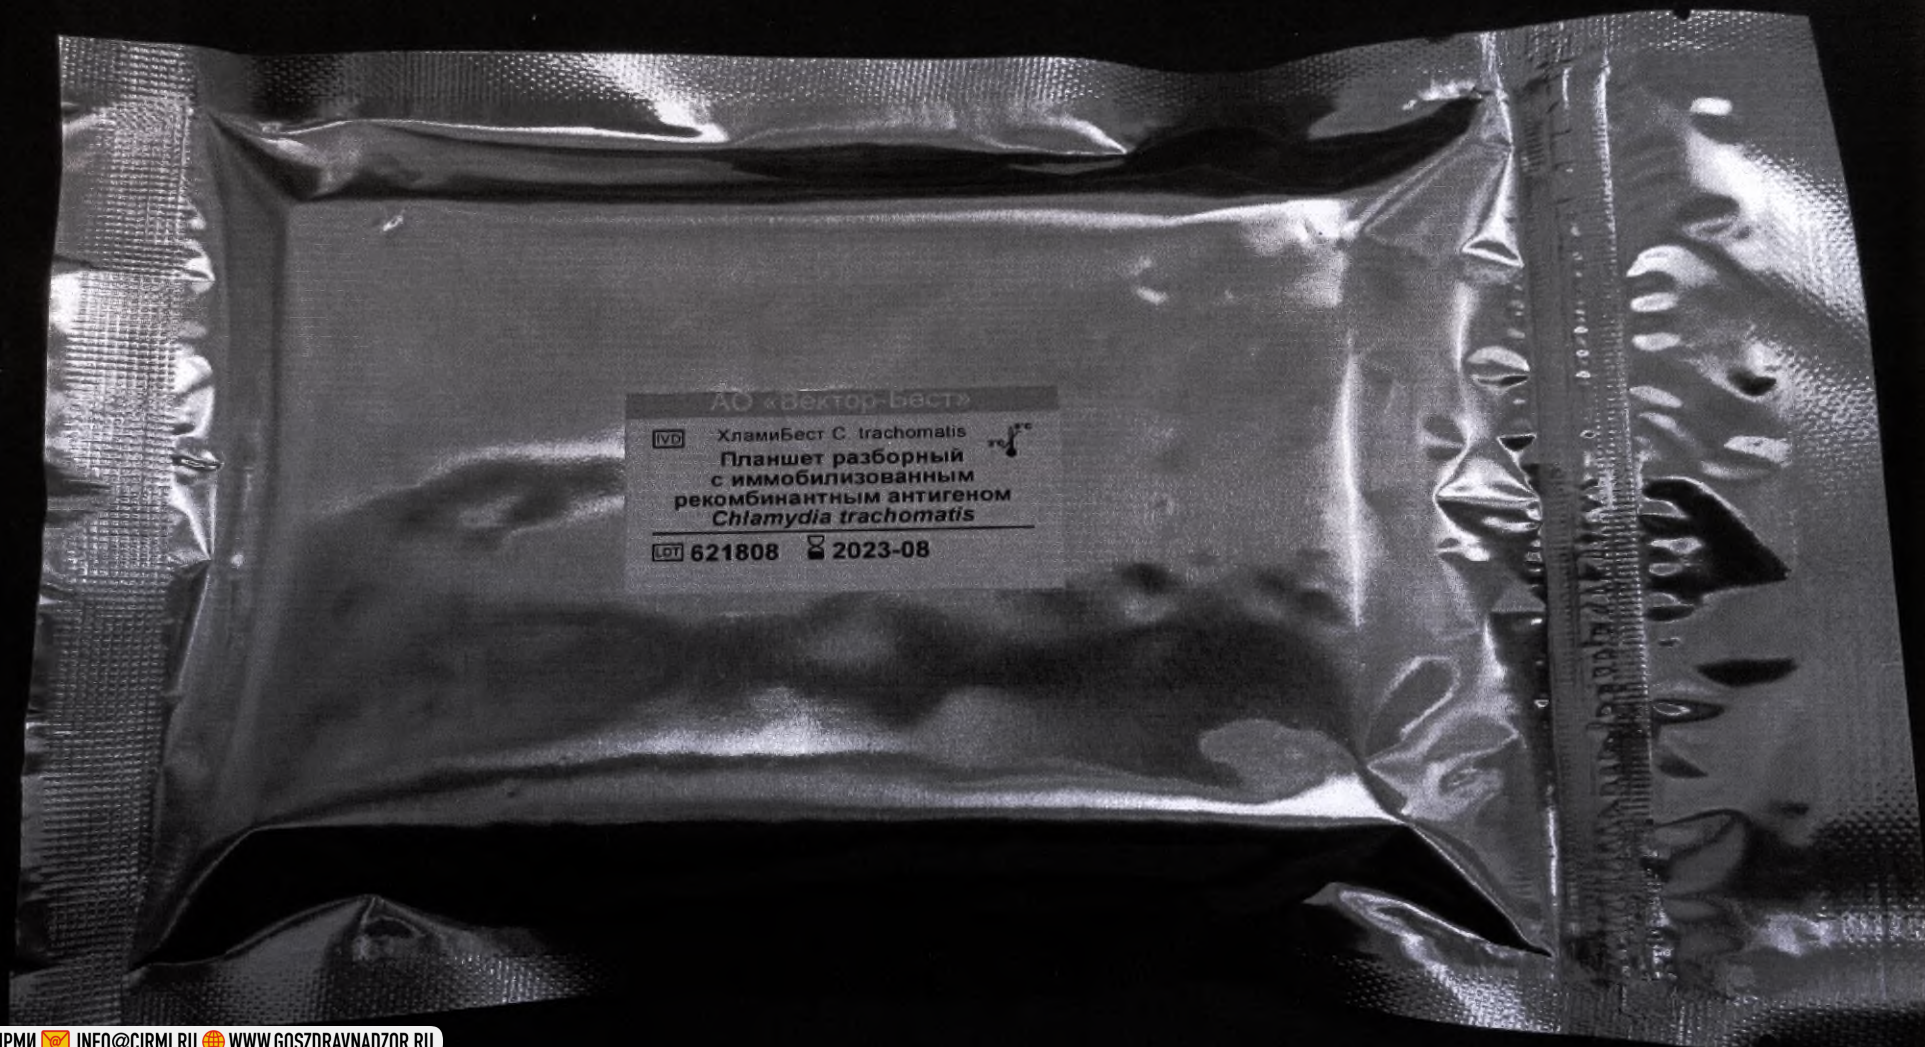


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических
иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis (ХламиБест С. trachomatis-IgA) по ТУ
9398-091-23548172-2014» №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2022 г.

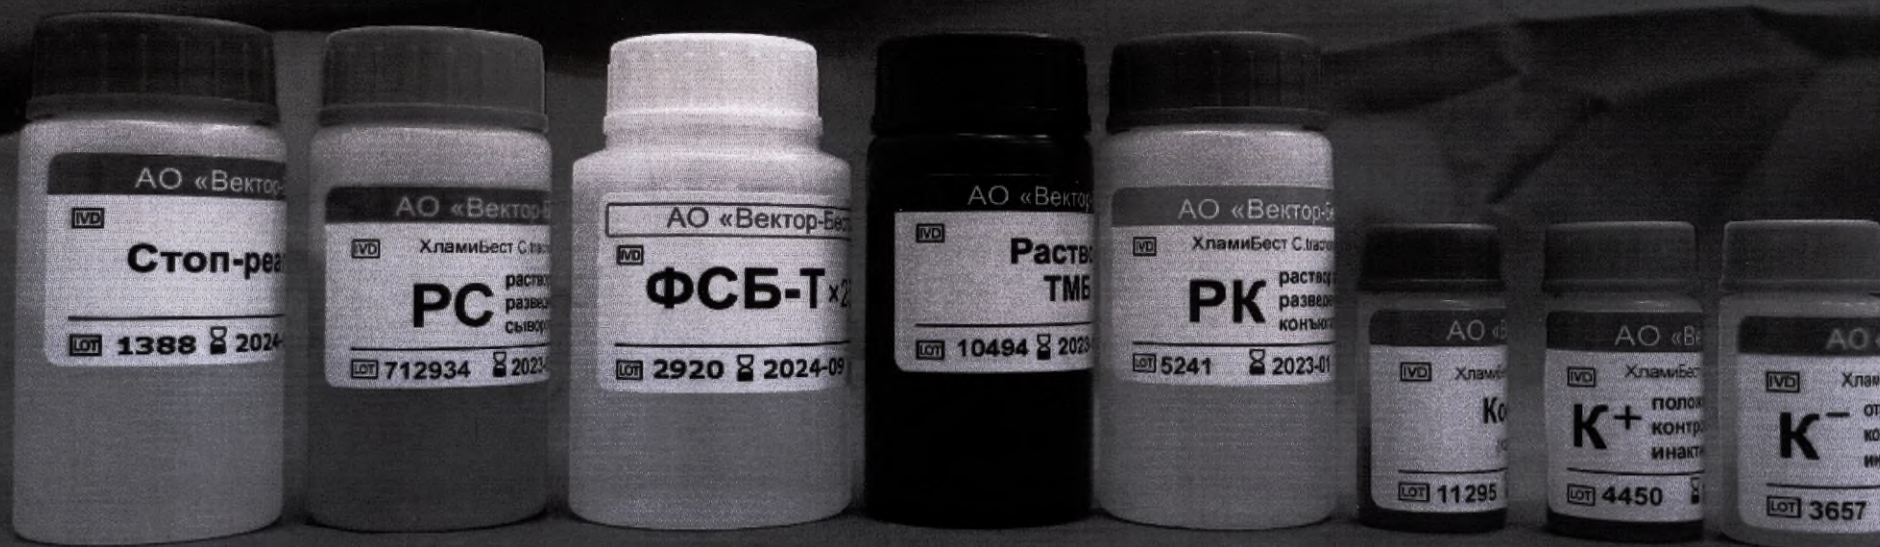

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis (ХламиБест С. trachomatis-IgA) по ТУ 9398-091-23548172-2014» №3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

2022 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических
иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis (ХламиБест С. trachomatis-IgA) по ТУ
9398-091-23548172-2014» №4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
21» 103 2022 г.

