


I, PHILLIP JONES, of the Town of Windsor, Berkshire, Notary Public
duly admitted and sworn, practising in the said Town,

DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST:

That I have no reason to doubt the authenticity of the document
hereunto annexed namely Declaration, dated 14th December 2016 and
signed for and on behalf of Johnson & Johnson Consumer Services
EAME Limited by Dr G M Carpenter, Head of Global Regulatory Affairs,
Growth Initiatives and Strategic Advisor.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto set my hand and
affixed my Seal of Office, in the Town of Windsor aforesaid, this day
Thursday, 15th December 2016.



MR PHILLIP JONES


Notary Public
Charsley Harrison LLP
Windsor House
Victoria Street
Windsor
Berkshire
SL4 1EN

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Phillip H Jones
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at a / en	London
6. the le / el día	19 December 2016
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-123131
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre 	10. Signature Signature Firma A. Hodges 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk



CONSUMER SERVICES EAME LIMITED

FOUNDATION PARK • ROXBOROUGH WAY
MAIDENHEAD • BERKSHIRE SL6 3UG
Telephone: (01628) 822222 Facsimile: (01628) 821222

14th December 2016

To Whom it may concern,

I certify that the attached “Instruction for Use, Visine®”, has been issued by Anthony Gore, Regulatory Affairs CE REP Manager, for Johnson & Johnson Consumer Services EAME Ltd.

Yours faithfully,

Dr G M Carpenter

Head of Global Regulatory Affairs, Growth Initiatives and Strategic Advisor
Johnson & Johnson Consumer Services EAME Limited

Anthony
Gore

Digitally signed by Anthony Gore
DN: c=US, o=JNJ, ou=Subscribers,
cn=Anthony Gore,
0.9.2342.19200300.100.1.1=6200426
5
Reason: I attest to the accuracy and
integrity of this document.
Date: 2016.12.14 10:03:19 Z

УТВЕРЖДАЮ/APPROVE

« Джонсон & Джонсон Сантэ Ботэ Франс С.А.С.,
Франция.»/ «Johnson & Johnson Sante Beaute France
S.A.S.»

(Организация/Organization)

Route de Retortat, 51120 Sezanne, France

(Адрес/Address)

(Должность/Occupation)

(Имя Фамилия/Name Surname)

(Дата «ДД.ММ.ГГГГ»/Date «DD.MM.YYYY»)

М.П./Stamp

(подпись/signature)

INSTRUCTION FOR USE

Moisturizing agent for ophthalmology Visine®

1.	Designation of the medical device	2
1.1.	Medical Device Name	2
1.2.	Intended Use	2
1.3.	Indications for Use	2
1.4.	Contraindications	2
1.5.	Possible Adverse Effects of Medical Device Use	2
1.6.	Operating environment	2
2.	Data for Medical Device Development and Manufacturing	2
2.1.	Name	2
2.2.	Address of the legal manufacturer	2
2.3.	Addresses and names of the manufacturing sites	2
3.	Medical Device Classification	3
4.	Principles of Operation of the Medical Device	3
5.	Method of Use	3
6.	Technical description	4
6.1.	General view of the Medical Device and packaging	4
6.2.	Device Contents and Configuration	5
6.3.	Possible Combinations with Other Equipment	5
6.4.	Materials of the components in contact with the human body	6
7.	Basic Parameters and Performance Data of Medical Device	6
8.	Labeling	9
9.	Packaging	14
10.	Transportation and Storage Conditions	14
11.	Shelf Life	14
12.	Safety Requirements	15
13.	Environment Protection	15
13.1.	Environment protection requirements	15
13.2.	Medical Device Recycling or Disposal	15
14.	Methods and Means of Disinfection and Pre-cleaning	15
15.	Warranty	16
16.	Complaints	16

1. Designation of the medical device

1.1. *Medical Device Name*

Moisturizing agent for ophthalmology Visine®

1.2. *Intended Use*

It is used to prevent and reduce the symptoms of irritation with dryness and eye fatigue

1.3. *Indications for Use*

Moisturizing agent for ophthalmology Visine® is indicated for lubrication for the relief and prevention of tired, strained and irritated eyes that may indicate the initial onset of dry eye due to environmental factors, such as computer use, reading, driving and contact lens wear.

1.4. *Contraindications*

Do not take this product if you are allergic to any of the ingredients. If you experience discomfort or irritation, stop using the product.

1.5. *Possible Adverse Effects of Medical Device Use*

In the presence of chronic diseases of eyes, consult with the expert!

1.6 *Operating environment*

The medical product can be used by the patient independently at home or medical personnel in MPI. It is intended for individual application.

Used at:

Temperature	10–25 °C
Pressure	86.0–106.7 kPa
Relative Humidity	55-75%

2. Data for Medical Device Development and Manufacturing

2.1. *Name*

Johnson & Johnson Sante Beaute France S.A.S.

2.2. *Address of the legal manufacturer*

Route de Retortat, 51120 Sezanne, France

2.3. *Addresses and names of the manufacturing sites*

1. Farmigea S.p.A., Via Giovan Battista Oliva, 6/8, 56121, Pisa, Italy
2. Johnson & Johnson Sante Beaute France S.A.S., Route de Retortat, 51120 Sezanne, France

3. Medical Device Classification

Class depending on the potential risk of the use of the medical device	2a
The duration of use	Device intended for continuous use for less than 30 days (short term use)
Invasiveness	Invasive device
Sterility	Sterile device
Application area	Ophthalmology

4. Principles of Operation of the Medical Device

Clinical studies have demonstrated that concentrating for an extended period can result in up to a 66% reduction in blink rate and ocular fatigue. Tired eye symptoms are due to the sufferer experiencing a mild and transient form of the clinically diagnosed condition of dry eye. This condition is associated with insufficient lubrication of the eye surface caused by deficiencies in the tears or low tears production.

Dry eye is caused when the delicate tear film that covers the surface of the eye does not provide sufficient lubrication and moisture. This results in the characteristic dry, gritty, burning and sometimes painful symptoms experienced by sufferers. The tear film consists of layers, each performing a unique function. An important element is the mucus component, which lubricates and protects your eye.

Different people suffer from dry eye to different degrees ranging from feelings of mild occasional tired eye to more severe daily discomfort. The treatment goal for dry eye is to restore and stabilize the tear film, relieving symptoms.

The range of Visine liquid eye gel drops contains a natural ingredient (TS-Polysaccharide) which is extracted from the seeds of the tree *Tamarindus indica*. The resulting purified gum extract closely resembles the mucus component present in the normal healthy tear film that covers the eye's surface. The mucus component in the tears forms a layer to protect and lubricate the eye.

The products in this Visine range are formulated as liquid drops to combine with the natural mucus in the tear film, to provide lost moisture and protection for immediate refreshment and comfort.

5. Method of Use

For device variant:

Visine® Pure tears

Multi-use bottles


Before first use, check cap seal is intact. Tilt head backwards and gently squeeze 1-2 drops into each eye and blink 3 or 4 times after application to distribute the product over the eye. Replace cap securely. Use 3 - 4 times per day.



Visine® Pure tear, 1 day

Re-sealable vials:

Tear one vial from the strip and replace remaining vials in the foil pouch. Twist the vial to open. Tilt head backwards and gently squeeze 1-2 drops into each eye and blink 3 or 4 times after application to distribute the product over the eye. When using Visine Pure Tears, 1 day there is no need to remove contact lenses before application. Invert vial cap and securely place back on the vial. Once opened each vial can be used for up to 12 hours.



6. Technical description

The 0.5% TSP formulations are presented in a multi-dose 10ml volume preserved with benzalkonium chloride.

The solutions are sterilized by a steam sterilization process or by sterile filtration (0.2um) prior to aseptic fill of polyethylene bottles or vials sterilized by gamma-irradiation.

The bottle used for immediate packaging is a standard design used in high volumes for commercial eye drops. It consists of three parts: bottle, dropper and screw-cap equipped with tamper-evident.

The single-use vials are heat-sealed within polyethylene-aluminium-polyester coupled sachets.

6.1. General view of the Medical Device and packaging

Visine Pure Tears





Visine Pure Tears, 1 day



6.2. Device Contents and Configuration

Device variants:

- 1) Visine® Pure tears : a bottle with solution, instruction for use
- 2) Visine® Pure tears, 1 day : heat-sealed vials, instruction for use

6.3. Possible Combinations with Other Equipment

Can not be integrated with other products

6.4. Materials of the components in contact with the human body

Composition of the solution

Principal ingredients	Supplier
TS Polysaccharide	- Opocrin S.p.A., Italy - INDENA S.p.A., Italy
Other ingredients	
Mannitol	- Brenntag, USA - Carlo Erba, Italy
Benzalkonium chloride*	- Eigenmann & Veronelli*, Italy
Dibasic sodium phosphate dodecahydrate	- Giusto Faravelli, Italy - Carlo Erba, Italy
Monobasic sodium phosphate monohydrate	- Giusto Faravelli, Italy
Water for injections	- Farmigear S.p.A, Italy

*for Visine® Pure tears presentation only

Packaging materials

Visine Pure Tears	
Bottle	PTLE Riblene FL20, Polimeri Europa
Dropper	PTLE Riblene FL20, Polimeri Europa
Screw-cap	HDPE Eraclene MP 90, Polimeri Europa Colorant: Prisma PE Azzurro 53712, Frilvam
Visine Pure Tears, 1 day	
Vials	PTLE PURELL 1840H, Basell

7. Basic Parameters and Performance Data of Medical Device

Manufacturing formula


Component	Visine Pure Tears g/ml	Visine Pure Tears, 1 day g/ml
TS Polysaccharide (1)	0.5	0.5
Mannitol	2	2
Monobasic sodium phosphate monohydrate	1.84	1.84
Dibasic sodium phosphate dodecahydrate	1.909	1.909
Benzalkonium chloride	0.01	N/A
Water for injections as required up to	100	100

Parameters	Visine Pure Tears	Visine Pure Tears, 1 day
Coloure	Clear, colourless or slightly opalescent solution	
pH	6.0 – 7.5	
Extractable volume	≥ 10 ml	
TS polysaccharide titre	90 – 110% nominal concentration	90 – 110% nominal concentration
Viscosity	10 – 55 cP·s	10 – 55 cP·s

Benzalconium chloride assay	90 – 115% nominal concentration	N/A
Extractable volume	≥ 10 ml	≥ 0.5 ml
Sterility	Sterile	Sterile


Visine Pure Tears

Dropper

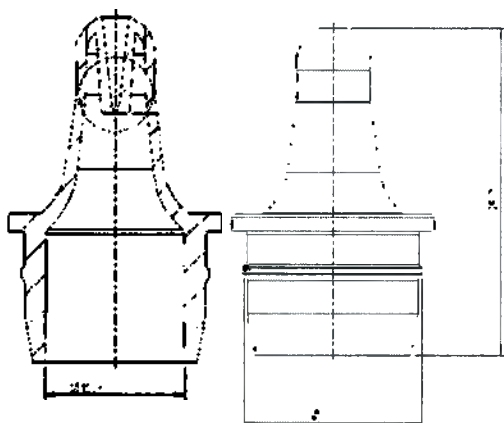


<i>Parameters</i>	<i>Requirements</i>	
Appearance	outer and inner surfaces	clean and smooth
	hole	open
Shape and size	overall height	25.2 ± 0.1 mm
	dropper diameter in contact with the bottle	10.3 – 13.7 mm
	weight	0.80 ± 0.05 g

Bottle

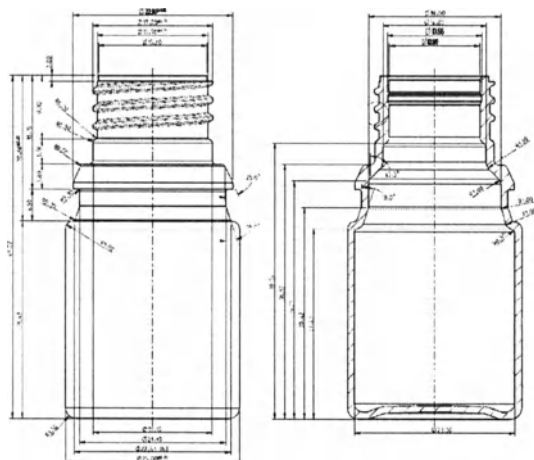

<i>Parameters</i>	<i>Requirements</i>	
Appearance	outer and inner surfaces	clean and smooth
	thread	without damage
	body	
	spout	
Shape and size	overall height	49.00 ± 0.35 mm
	O.D.	25.00 ± 0.20 mm
	inner diameter in contact with the dropper	12.95 ± 0.10 mm
	O.D. of the neck of the bottle	17.20 ± 0.15 mm
	weight	3.80 ± 0.10 g


Screw-cap

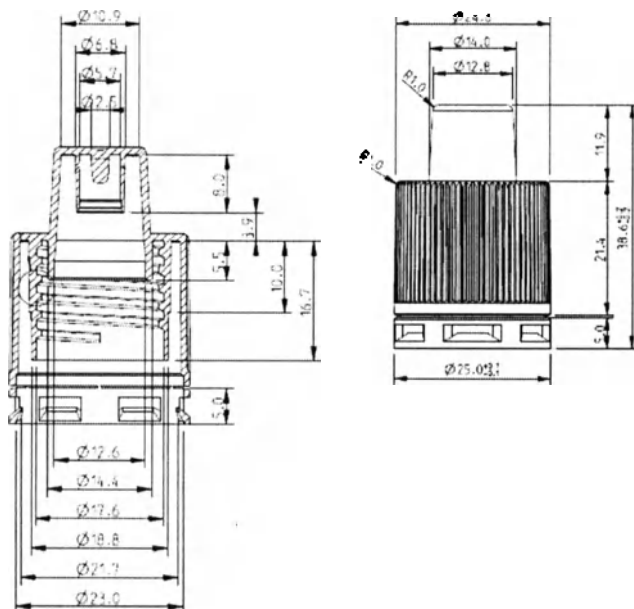

<i>Parameters</i>	<i>Requirements</i>	
Appearance	outer and inner surfaces	clean and smooth
Shape and size	overall height	38.6 ± 0.2 mm
	O.D.	25.0 ± 0.1 mm
	the inner diameter of the thread	17.6 ± 0.25 mm
	weight	3.75 ± 0.10 g

Visine Pure Tears, 1 day

Heat-sealed vials

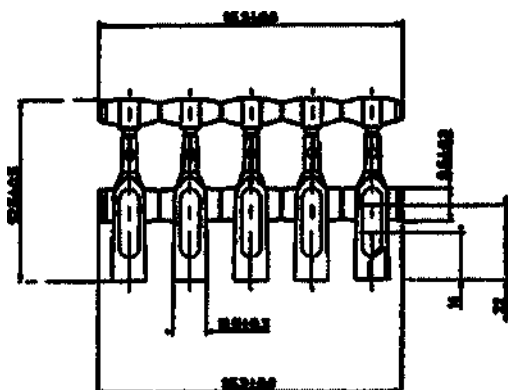

Parameters	Requirements	
Appearance	outer and inner surfaces	clean and smooth
Shape and size	overall height	$52.8 \pm 0.5 \text{ mm}$
	width	$95.3 \pm 0.6 \text{ mm}$
	max diameter	$10.5 \pm 0.3 \text{ mm}$
	min diameter	$7.0 \pm 0.3 \text{ mm}$
	wall thickness	$0.63 \pm 0.03 \text{ mm}$
	weight	$4.50 \pm 0.50 \text{ g}$

8. Labeling

Visine Pure Tears

The marking is applied directly on the label of the primary packaging - the bottle and secondary packaging - cardboard box.

The marking contains the following information:

on the label:

- the name of medical device;
- logotipy of the owner of the registration certificate;
- volume of the vial;
- lot number;
- manufacturing date;
- shelf life;
- name, country, address of the manufacturer and place of manufacturing;
- name, country, organization address, receiving consumer complaints;
- name, country, address of the distributor;
- liquid gel drops;
- sterility designation.

cardboard packaging:

- the name of medical device;
- packaging kit;
- volume of the vial;
- intended use;
- indications;
- instructions for use;
- storage conditions;
- composition of the medical device;
- date of opening ;

- keep away from direct sunlight;
- upper temp limit 25°C;
- discard remaining product 30 days after opening;
- do not use beyond expiry date ;
- logotipy of the owner of the registration certificate;
- name, country, address of the manufacturer and place of manufacturing;
- name, country, organization address, receiving consumer complaints;
- lot number;
- manufacturing date;
- shelf life;
- secondary barcode ;
- main barcode ;
- number and date of issuance of the registration certificate;
- liquid gel drops;
- symbols.

Visine Pure Tears, 1 day

The marking is applied directly on the label of the primary packaging - single-dose containers and secondary packaging - cardboard box.

The marking contains the following information:

on the label:

- the name of medical device;
- logotipy of the owner of the registration certificate;
- volume of the single-dose containers;
- lot number;
- manufacturing date;
- shelf life;
- liquid gel drops;
- sterility designation.

cardboard packaging:

- the name of medical device;
- packaging kit;
- volume of the vial;
- intended use;
- indications;
- instructions for use;
- storage conditions;
- composition of the medical device;
- date of opening ;
- keep away from direct sunlight;
- upper temp limit 25°C;
- discard remaining product 30 days after opening;
- do not use beyond expiry date ;
- logotipy of the owner of the registration certificate;
- name, country, address of the manufacturer and place of manufacturing;
- name, country, organization address, receiving consumer complaints;
- name, country, address of the distributor;
- lot number;
- manufacturing date;
- shelf life;
- secondary barcode ;
- main barcode ;

- number and date of issuance of the registration certificate;
- liquid gel drops;
- symbols.

Symbol	Value
Хранить в недоступном для детей месте	Keep out of the reach of children
СТЕРИЛЬНО	Sterility
	Mark of conformity for mandatory certification

Label project (primary packaging):

Visine Pure Tears



Visine Pure Tears, 1 day

Визин[®]

ЧИСТАЯ СЛЕЗА (на 3 день)

для снятия раздражения при сухости и усталости глаз
капли 5 закрывающихся
пластиковых ампул по 0,5 мл

Серия №:

Дата изг.:

Годен до:

Для более подробной информации прочтите инструкцию!

Импортер:
ООО «Джонсон & Джонсон», 121614,
Россия, г. Москва, ул. Крылатская,
д. 17, корп. 2
Держатель регистрационного
удостоверения: Джонсон энд
Джонсон Санта Ботта Франс С.А.С.,
Рут де Репорта, 51120 Сокзевен,
Франция
Произведено:
ФАРМИДЖЕА С.п.А., Виа Джован
Баттиста Оливия, 6/6, 56121,
г. Пиза, Италия

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2009/05110 от 28.12.2011.

СТЕРИЛЬНО

Label photo (transporting packaging):

Visine Pure Tears



+



Photo transport packaging:

Visine Pure Tears



Visine Pure Tears, 1 day



9. Packaging

Visine Pure Tears

The multi-dose primary packaging consists of a bottle, a dropper and a blue double chamber screw-cap equipped with tamper-evident closure. The bottles are labeled with labels containing identification and batch-specific details prior to packaging within an outer carton.

Dimensions of labels: length - 60 mm $\pm$ 1 mm, width - 22 mm $\pm$ 1 mm.

Dimensions carton packaging: length - 34 mm $\pm$ 2 mm, width - 32.5 mm $\pm$ 2 mm, height - 73 mm $\pm$ 4 mm.

Dimensions of transport packaging: length - 360mm $\pm$ 5 mm, width - 245 mm $\pm$ 5 mm, height - 310 mm $\pm$ 5 mm.

Visine Pure Tears, 1 day

Nature of container materials (immediate packaging); qualitative composition

The single dose product is supplied as 0.5ml heat-sealed vials on a multi-unit sprue with perforations for separation of individual vials, sealed within polyethylene-aluminium-polyester sachets. The cardboard box includes 10 doses of the product.

Dimensions of labels: length - 60 mm $\pm$ 3 mm, width - 22 mm $\pm$ 1 mm.

Dimensions of carton packaging: length - 80.5 mm $\pm$ 4 mm, width - 20.5 mm $\pm$ 1 mm, height - 126.5 mm $\pm$ 6 mm.

Dimensions of transport packaging: length - 445mm $\pm$ 5 mm, width - 290 mm $\pm$ 5 mm, height - 270 mm $\pm$ 5 mm.

Identification and batch-specific details are printed on the vials and on the foil pouch.

All components except the cap consist of inert low density, colorless polyethylene. The cap is high density polyethylene, colored blue. All components are supplied sterilized by gamma irradiation.

10. Transportation and Storage Conditions

Transportation any kinds of covered vehicles.

Transportation and store at:

Temperature	10–25 °C
Pressure	86.0–106.7 kPa
Relative Humidity	55-75%

11. Shelf Life

Stability studies to date support a shelf-life of 24 months stored at 25°C.

In-use stability testing shows that Visine Tired Eyes can be used for 30 days after first opening of the container.

Single-dose containers can be used for up to 12 hours after opening and may be stored out of the foil pouch for 2 months.

12. Safety Requirements

Visine Pure Tears

General Precautions

- Do not take this product if you are allergic to any of the ingredients. If you experience discomfort or irritation, stop using the product.
- Do not use at the same time as any drug or product that is applied to the eye as it may modify its effect.
- Not recommended for use whilst wearing contact lenses.
- Avoid touching the tip of the container and try not to allow the tip to come into contact with the surface of your eye.
- Do not wash the tip of the container with cleaning agents.
- Do not use if the container is damaged or if the tamper seal is broken.
- Once opened, throw away any unused product after 30 days.
- Do not swallow.
- Do not use after the expiry date.
- Keep out of reach and sight of children.

Visine Pure Tears, 1 day

General Precautions

- Do not take this product if you are allergic to any of the ingredients. If you experience discomfort or irritation, stop using the product.
- If the eye is infected or red, inflamed or painful please see a doctor, ophthalmologist or eye care professional.
- Do not use at the same time as any drug or product that is applied to the eye as it may modify its effect.
- Avoid touching the tip of the vial and do not allow the tip to come into contact with the surface of your eye.
- Do not wash the tip of the vial with cleaning agents.
- Do not use if the vial is damaged or if there is any evidence that the vial cap has been removed.
- Once opened, throw away any unused product after 12 hours.
- Do not swallow.
- Do not use after the expiry date.
- Keep out of reach and sight of children.

13. Environment Protection

13.1. Environment protection requirements

Products in the life cycle does not affect the environment.

13.2. Medical Device Recycling or Disposal

Products after use should be disposed of according to local regulations. Provided for disposal of the medical device with the household waste.

14. Methods and Means of Disinfection and Pre-cleaning

Not applicable

15. Warranty

The expiration date of a product corresponds to the term of preservation of sterility and makes 2 years from the date of production, specified on packing of a product. The producer guarantees compliance of the declared characteristics, sterility preservation term, a guarantee of safety of integrity of packing at the correct transportation, operation and storage of a product.

16. Complaints

Johnson and Johnson LLC, Krylatskaya str., 17, building 2, 121614, Moscow, Russian Federation.

я, ФИЛЛИП ДЖОНС, г. Виндзор, Беркшир, нотариус, должным образом
допущенный к практике и приведенный к присяге, практикующий в вышеуказанном
городе,

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ И СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ:

что у меня нет каких-либо оснований подвергать сомнению подлинность
прилагаемого документа «Декларация» от 14 декабря 2016 года, подписанного от
имени и по поручению компании «Джонсон & Джонсон Консьюмер Сервисез И-Эй-
Эм-И Лимитед» д-ром Г. М. Карпентером, руководителем международного отдела
нормативно-правового регулирования, программ развития и стратегическим
консультантом.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО я скрепляю настоящий
документ своей подписью и должностной печатью в вышеуказанном г. Виндзоре,
сегодня, в четверг, 15 декабря 2016 года.

<подписано>

Г-Н ФИЛЛИП ДЖОНС

Нотариус

Партнёрство с ограниченной ответственностью Чарсли Харрисон

Виндзор Хаус

Виктория Стрит

Виндзор

Беркшир

SL4 1EN

Прошито тесьмой и скреплено печатью нотариуса:

<Круглая рельефная печать нотариуса:
ФИЛЛИП ХОВАРД ДЖОНС; НОТАРИУС; АНГЛИЯ>

АПОСТИЛЬ (Гагская Конвенция от 5 октября 1961 г.)	
1. Страна: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	
Настоящий официальный документ	
2. Подписан	Филлипом Х. Джонсом
3. Выступающим в качестве	нотариуса
4. Скреплен печатью/штампом	вышеуказанного нотариуса
Удостоверено:	
5. В г. Лондоне	6. 19 декабря 2016 года
7. Государственным секретарём Её Величества по иностранным делам и по делам Содружества	
8. За № АРО-123131	
9. Печать/штамп: <Круглая гербовая печать: Министерство иностранных дел и по делам Содружества, Лондон>	10. Подпись: А. Ходжиз <подписано>

Настоящий Апостиль не предназначен для использования в Соединенном Королевстве и подтверждает лишь подлинность подписи, печати или штампа на прилагаемом официальном документе Соединенного Королевства. Он не подтверждает подлинность самого документа. Апостили, прилагаемые к документам, которые были ксерокопированы и заверены в Соединенном Королевстве, подтверждают подпись официального должностного лица, осуществлявшего исключительно процедуру заверения. Апостиль никоим образом не подтверждает ни подлинность подписи на оригинале, ни содержание самого оригинала. Если настоящий документ предполагается использовать в стране, которая не является членом Гагской Конвенции от 5 октября 1961 г., он должен быть представлен в консульский отдел дипломатического представительства данной страны.

Действительность данного апостиля можно проверить на сайте www.verifyapostille.service.gov.uk

Джонсон & Джонсон
КОНСЬЮМЕР СЕРВИСЕЗ И-ЭЙ-ЭМ-И ЛИМИТЕД

ФАУНДЕЙШН ПАРК • РОКСБОРО УЭЙ
МЕЙДЕНХЕД • БЕРКШИР SL6 3UG
Телефон: (01628) 822222 Факс: (01628) 821222

14 декабря 2016 г.

Всем заинтересованным лицам:

Я удостоверяю, что прилагаемый документ «Инструкция по применению медицинского изделия Визин®» был выдан Энтони Гором, Руководителем Представительства в ЕС по вопросам нормативно-правового регулирования, для компании «Джонсон & Джонсон Консьюмер Сервисез И-Эй-Эм-И Лтд.»

С уважением,

<подписано>

Д-р Г. М. Карпентер

Руководитель международного отдела нормативно-правового регулирования,
руководитель программ развития и стратегический консультант
«Джонсон & Джонсон Консьюмер Сервисез И-Эй-Эм-И Лимитед»
(Johnson & Johnson Consumer Services EAME Limited)

ФАУНДЕЙШН ПАРК • РОКСБОРО УЭЙ • МЕЙДЕНХЕД • БЕРКШИР SL6 3UG • ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В АНГЛИИ •
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 603028 • ТОРГОВЫЙ ЗНАК

/электронная подпись: Энтони Гор (Anthony Gore)

Подписано в электронном виде Энтони Гором (Anthony Gore)

ДН: си=ЮС, о=ДжиЭнДжи, ою=Подписчики,

сизн=Энтони Гор (Anthony Gore),

0.9.2342.19200300.100.1.1=6200426

5

Довод: Я свидетельствую о достоверности и
целостности данного документа.

Дата: 2016.12.14 10:03:19 Зи/

УТВЕРЖДАЮ

«Джонсон & Джонсон Сантэ Ботэ Франс С.А.С.,
Франция»

Организация

Рут де Реторта, 51120 Сезанн, Франция

Адрес

Должность

Имя Фамилия

Дата «ДД.ММ.ГГГГ»

подпись

Место печати

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство увлажняющее офтальмологическое Визин®

1. Назначение медицинского изделия	2
1.1. Наименование медицинского изделия.....	2
1.2. Предусмотренное применение	2
1.3. Показания к применению.....	2
1.4. Противопоказания	2
1.5. Возможные нежелательные действия при использовании медицинского изделия ..	2
1.6. Условия эксплуатации.....	2
2. Данные для производства и развития медицинских изделий	2
2.1. Название.....	2
2.2. Адрес официального производителя	2
2.3. Адреса и названия участков производства.....	2
3. Классификация медицинского изделия	3
4. Принцип работы медицинского изделия	3
5. Метод использования	3
6. Техническое описание	4
6.1. Общий вид медицинского изделия и упаковки	4
6.2. Комплект поставки и состав изделия.....	5
6.3. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями	5
6.4. Материалы изделия, имеющие контакт с организмом человека	5
7. Основные параметры и характеристики медицинского изделия	6
8. Маркировка.....	9
9. Упаковка.....	15
10. Условия хранения и транспортировки	16
11. Срок годности	16
12. Требования безопасности	16
13. Защита окружающей среды	17
13.1. Требования к защите окружающей среды	17
13.2. Утилизация или уничтожение медицинских изделий	17
14. Способы и средства дезинфекции и предварительной очистки	17
15. Гарантия	17
16. Претензии.....	17

1. Назначение медицинского изделия

1.1. Наименование медицинского изделия

Средство увлажняющее офтальмологическое Визин®.

1.2. Предусмотренное применение

Используется для профилактики и уменьшения симптомов раздражения, сопровождающихся сухостью и утомляемостью глаза.

1.3. Показания к применению

Средство увлажняющее офтальмологическое Визин® предназначено для смазывания с целью облегчения и профилактики симптомов усталого, напряженного и раздраженного глаза, которые могут указывать на первоначальные признаки возникновения синдрома сухого глаза из-за неблагоприятного воздействия окружающей среды (работа за компьютером, чтение, управление транспортным средством, использование контактных линз).

1.4. Противопоказания

Не применяйте капли при аллергии на любой из компонентов. При проявлении дискомфорта и раздражения прекратите применение изделия

1.5. Возможные нежелательные действия при использовании медицинского изделия

При наличии хронических заболеваний глаз обязательно проконсультируйтесь со специалистом!

1.6 Условия эксплуатации

Медицинское изделие может самостоятельно использоваться пациентом на дому, а также медицинским персоналом Лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Продукт предназначен для индивидуального применения.

Условия применения

Температура	10–25 °C
Давление	86,0–106,7 кПа
Относительная влажность воздуха	55–75 %

2. Данные для производства и развития медицинских изделий

2.1. Название

«Джонсон & Джонсон Сантэ Ботэ Франс С.А.С.».

2.2. Адрес официального производителя

Рут де Реторта, 51120 Сезанн, Франция.

2.3. Адреса и названия участков производства

1. «Фармиджеа С.п.А.», Виа Джован Баттиста Олива, 6/8, 56121, г. Пиза, Италия.

2. «Джонсон & Джонсон Сантэ Ботэ Франс С.А.С.», Рут де Реторта, 51120 Сезанн, Франция.

3. Классификация медицинского изделия

Класс в зависимости от потенциального риска использования медицинского изделия	2а
Длительность применения	Изделие предназначено для длительного использования в течение не более 30 дней (короткий срок использования)
Инвазивность	Инвазивное изделие
Стерильность	Стерильное изделие
Сфера применения	Офтальмология

4. Принцип работы медицинского изделия

Клинические исследования показали, что продолжительное использование медицинского изделия может привести к снижению частоты моргания и утомляемости глаза на 66 %. Симптомы усталости глаз возникают из-за того, что пациент переносит клинически выявленное состояние сухого глаза в легкой и преходящей форме. Это состояние связано с неэффективным смазыванием поверхности глаза, вызванным дефицитом объема слезной жидкости или пониженным слезоотделением.

Синдром сухого глаза развивается, когда тонкая слезная пленка, покрывающая поверхность глаза, не обеспечивает глаз достаточным количеством смазки и увлажнения. Это приводит к сухости, ощущению «песка в глазу», жжению и, иногда, к болезненным ощущениям, возникающим у пациентов. Слезная пленка состоит из слоев, каждый из которых выполняет свою особенную функцию. Одним из важных компонентов является слизь, которая смазывает и защищает ваш глаз.

Степень выраженности сухости глаз у разных людей разная: от ощущения легкого преходящего утомления глаз до более ярко выраженного ежедневного дискомфорта. Целью лечения сухого глаза является восстановление и укрепление слезной пленки, облегчение симптомов.

В состав Визина в форме гелеобразных глазных капель, входит натуральный компонент TS-полисахарид (TSP), который выделяют из семян индийского финика. Очищенная вязкая масса очень похожа на слизь, которая присутствует в обычной слезной пленке, покрывающей поверхность глаза. Компонент слизи в слезной жидкости образует слой, защищающий и смазывающий глаз.

Изделия линейки Визин разработаны в форме жидких капель, которые соединяются с натуральной слизью в слезной пленке с целью восстановления, увлажнения, защиты для быстрого выздоровления и комфорта.


5. Метод использования

Варианты исполнения:

Визин® Чистая слеза

Флаконы для многократного применения.


Перед первым применением проверьте целостность предохранительного колпачка. Отклоните голову назад, и аккуратно закапайте 1-2 капли в каждый глаз, затем моргните 3-4 раза для равномерного распределения капель по поверхности глаза. Плотно закрутите колпачок. Рекомендуется применение капель 3-4 раза в день.

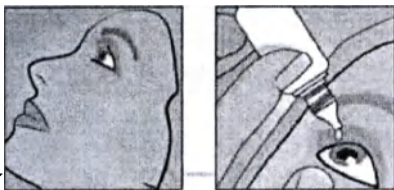

Визин® Чистая слеза на 1 день

Ампулы с возможностью повторной герметизации.

Оторвите одну ампулу от пластинки, а оставшиеся ампулы положите обратно в пакет из фольги. Откройте ампулу, отвернув колпачок. Отклоните голову назад аккуратно закапайте 1-2 капли в каждый глаз, затем моргните 3-4 раза для равномерного распределения капель в глазу. При применении Визин® Чистая слеза на 1 день нет необходимости снимать контактные линзы перед использованием. Переверните колпачок ампулы и плотно наденьте его снова на ампулу. Вскрытую ампулу можно использовать в течение не более 12 часов.

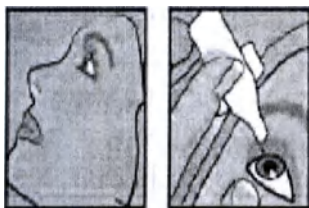

6. Техническое описание

Раствор 0,5 %-го TSP полисахарида находится во флаконе для многократного применения объемом 10 мл, при этом в качестве консерванта используется бензалкония хлорид.

Растворы стерилизованы методом паровой стерилизации или методом стерилизующей фильтрации (0,2 мкм) перед асептическим розливом во флаконы или ампулы из полиэтилена, стерилизованные с помощью гамма-облучения.

Флакон, используемый для первичной упаковки, выполнен в стандартном исполнении для больших объемов в производстве глазных капель. Он состоит из трех частей: флакона, капельницы - дозатора и откручивающегося колпачка с контролем случайного вскрытия.

Флаконы для однократного использования термически запаяны внутри сдвоенных полиэтилен-алюминий-полистирольных саше.

6.1. Общий вид медицинского изделия и упаковки

Визин® Чистая слеза





Визин® Чистая слеза на 1 день



6.2. Комплект поставки и состав изделия

Варианты исполнения:

- 1) Визин® Чистая слеза: флакон с раствором, инструкция по применению.
- 2) Визин® Чистая слеза (на 1 день): термозапаянные ампулы, инструкция по применению.

6.3. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями

Не интерггрируется

6.4. Материалы изделия, имеющие контакт с организмом человека

Состав раствора

Основные ингредиенты	Поставщик
TS-полисахарид	«Опокрин С.п.А.», Италия «ИНДЕНА С.п.А.», Италия
Вспомогательные ингредиенты	
Маннитол	«Бреннтаг», США «Карло Эрба», Италия

Бензалконий хлорид*	«Айгенманн и Веронелли»*, Италия
Натрия фосфат двухосновной додекагидрат	«Джусто Фарелли, Италия» «Карло Эрба», Италия
Натрия фосфат одноосновной моногидрат	«Джусто Фарелли», Италия
Вода для инъекций	«Фармиджеа С.п.А.», Италия

*только для формы выпуска Визин® Чистая слеза

Материалы первичной упаковки


<i>Визин® Чистая слеза</i>	
Флакон	Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) Riblene FL20, «Полимери Европа», Италия
Капельница - дозатор	ПЭНП Riblene FL20, «Полимери Европа», Италия
Откручивающийся колпачок	Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) Eraclene MP 90, «Полимери Европа», Италия Краситель: «Фрилвам», Италия
<i>Визин® Чистая слеза на 1 день</i>	
Ампулы	ПЭНП PURELL 1840H, «Базелл», Италия

7. Основные параметры и характеристики медицинского изделия

Производственная рецептура


<i>Компонент</i>	<i>Визин® Чистая слеза, г/мл</i>	<i>Визин® Чистая слеза на 1 день, г/мл</i>
TS-полисахарид (1)	0,5	0,5
Маннитол	2	2
Натрия фосфат одноосновной моногидрат	1,84	1,84
Натрия фосфат двухосновной додекагидрат	1,909	1,909
Бензалкония хлорид	0,01	Не применимо
Вода для инъекций согласно требованиям, максимально	100	100

<i>Параметры</i>	<i>Визин® Чистая слеза</i>	<i>Визин® Чистая слеза на 1 день</i>
Цвет	Прозрачный, бесцветный или слегка блестящий раствор	
значение pH	6,0–7,5	
Извлекаемый объем	≥ 10 мл	
Титр по TS-полисахариду	90–110 % номинальной концентрации	90–110 % номинальной концентрации
Вязкость	10–55 сП·с	10–55 сП·с
Количественное определение бензалкония хлорида	90–115 % номинальной концентрации	Нет данных
Извлекаемый объем	≥ 10 мл	≥ 0,5 мл
Стерильность	Стерильный	Стерильный

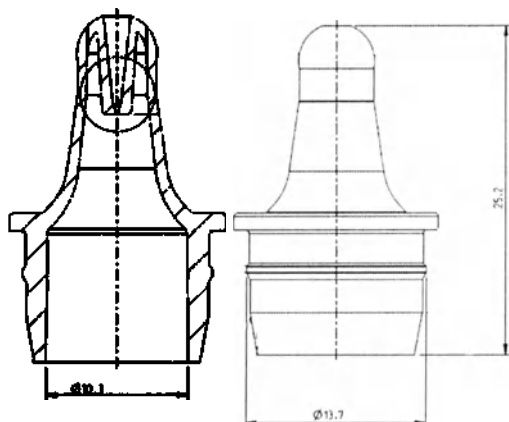


Параметры		Требования
Описание	внешняя и внутренняя поверхность	чистая и гладкая
	отверстие	открыто
Форма и размер	общая высота	25,2 мм $\pm 0,1$ мм
	диаметр капельницы - дозатора, примыкающей к флакону	10,3–13,7 мм
	масса	0,80 г $\pm 0,05$ г

Флакон

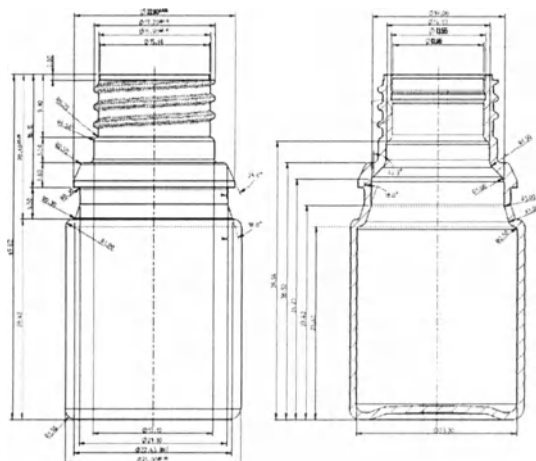


Параметры	Требования	
Описание	внешняя и внутренняя поверхность	чистая и гладкая
	резьба корпус носик	без повреждений
Форма и размер	общая высота	49,00 мм $\pm 0,35$ мм
	внешний диаметр	25,00 мм $\pm 0,20$ мм
	внутренний диаметр, примыкающий к капельнице - дозатору	12,95 мм $\pm 0,10$ мм
	внешний диаметр горлышка флакона	17,20 мм $\pm 0,15$ мм
	масса	3,80 г $\pm 0,10$ г

Откручивающийся колпачок

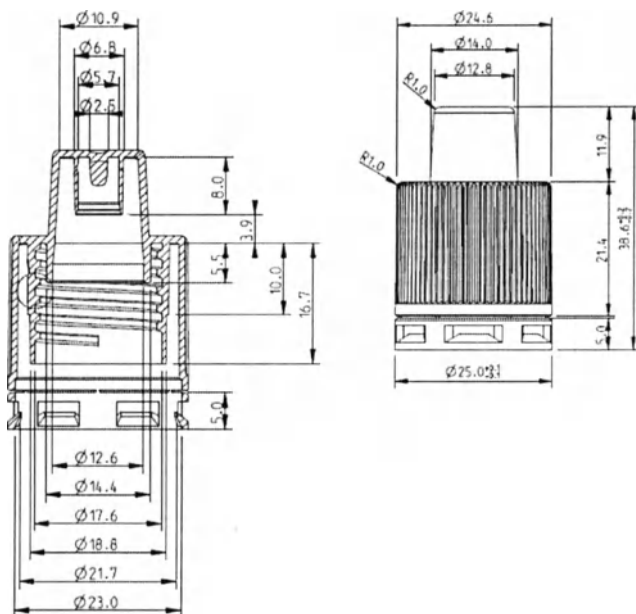

Параметры	Требования	
Описание	внешняя и внутренняя поверхность	чистая и гладкая
Форма и размер	общая высота	38,6 мм $\pm 0,2$ мм
	внешний диаметр	25,0 мм $\pm 0,1$ мм
	внутренний диаметр резьбы	17,60 мм $\pm 0,25$ мм
	масса	3,75 г $\pm 0,10$ г

Термозапаянные ампулы

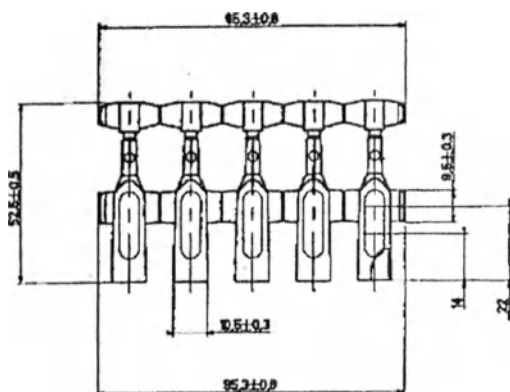

Параметры	Требования	
Описание	внешняя и внутренняя поверхность	чистая и гладкая
Форма и размер	общая высота	52,8 мм ±0,5 мм
	ширина	95,3 мм ±0,6 мм
	максимальный диаметр	10,5 мм ±0,3 мм
	минимальный диаметр	7,0 мм ±0,3 мм
	толщина стенки	0,63 мм ±0,03 мм
	масса	4,50 г ±0,50 г

8. Маркировка

Визин® Чистая слеза

Маркировка наносится непосредственно на этикетку первичной упаковки – флакона и вторичную упаковку – картонную коробку.

Маркировка на этикетке флакона содержит следующую информацию:

- наименование медицинского изделия;
- логотип держателя регистрационного удостоверения;
- объем флакона;
- номер серии (партии);
- дата производства;
- срок годности;
- название, страна, адрес производителя и место производства;
- название, страна, адрес организации, принимающей претензии клиентов;
- название, страна, адрес дистрибьютора;
- жидкие гель-капли;
- указание о стерильности.

Маркировка на картонной коробке:

- наименование медицинского изделия;
- фасовка;
- объем флакона;
- целевое назначение;
- показания к применению;
- указания по применению;
- условия хранения;
- состав медицинского изделия;
- дата вскрытия флакона;

- «беречь от прямых солнечных лучей»;
- «хранить при температуре не выше 25 °С»;
- «не использовать изделие по истечении 30 дней после вскрытия»;
- «не использовать по истечении срока годности»;
- логотип держателя регистрационного удостоверения;
- название, страна, адрес производителя и место производства;
- название, страна, адрес организации, принимающей претензии клиентов;
- номер серии (партии);
- дата производства;
- срок годности;
- вторичный штрих-код;
- основной штрих-код;
- номер и дата выпуска регистрационного удостоверения;
- капли в виде жидкого геля;
- символы.

Визин® Чистая слеза на 1 день

Маркировка наносится непосредственно на этикетку первичной упаковки – ампул для однократного применения и вторичную упаковку – картонную коробку.

Маркировка содержит следующую информацию:

Упаковка изделия

- наименование медицинского изделия;
- логотип держателя регистрационного удостоверения;
- объем ампул для однократного использования;
- номер серии (партии);
- дата производства;
- срок годности;
- Жидкие гель-капли ;
- указание о стерильности.

Маркировка на картонной коробке:

- наименование медицинского изделия;
- фасовка;
- объем флакона;
- целевое назначение;
- показания к применению;
- указания по применению;
- условия хранения;
- состав медицинского изделия;
- дата вскрытия ампулы;
- «беречь от прямых солнечных лучей»;
- «хранить при температуре не выше 25°С»;
- «не использовать изделие по истечении 12 часов после открытия»;
- не использовать по истечении срока годности;
- логотип владельца регистрационного удостоверения;
- название, страна, адрес производителя и место производства;
- название, страна, адрес организации, принимающей претензии клиентов;
- название, страна, адрес дистрибьютора;
- номер серии (партии);
- дата производства;
- срок годности;
- вторичный штрих-код;
- основной штрих-код;
- номер и дата выпуска регистрационного удостоверения;

- Жидкие гель-капли;
- символы.

Символ	Значение
Хранить в недоступном для детей месте	Хранить в недоступном для детей месте
СТЕРИЛЬНО	Стерильность
	Знак обязательного соответствия в области сертификации

Проект этикетки (первичная упаковка):



Визин® Чистая слеза на 1 день

Визин®

ЧИСТАЯ СЛЕЗА (на 1 день)

для снятия раздражения
при сухости и усталости глаз
капли 5 закрывающихся
пластиковых выпул по 0,5 мл

Серия №:

Дата изг.:

Годеи до:

Для более подробной
информации прочтите
инструкцию!

Импортер:
ООО «Джонсон & Джонсон», 121614,
Россия, г. Москва, ул. Крылатская,
д.17, корп. 2

Держатель регистрационного
удостоверения Джонсон энд
Джонсон Сантэ Ботэ Франс С.А.С.,
Рут де Ратоота, 51120 Сезанн,
Франция

Произведено:
ФАРМИДЖЕА С.п.А., Виа Джован
Баттиста Олива, 6/8, 56121,
г. Пиза, Италия


Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2009/05110 от 28.12.2011.

СТЕРИЛЬНО


2404475/03

Фото этикетки (транспортная упаковка):

Визин® Чистая слеза

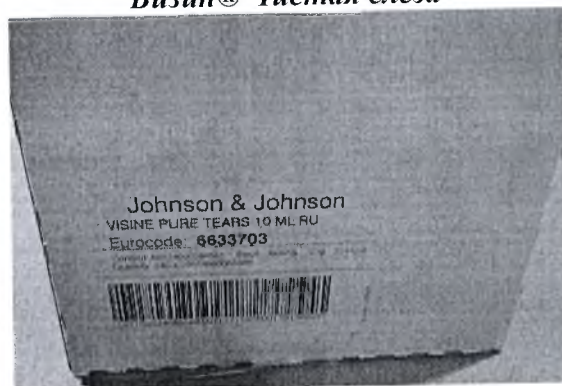

Визин® Чистая слеза на 1 день

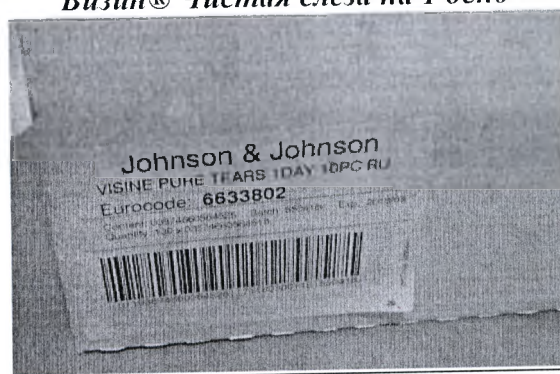

Средство увлажняющее офтальмологическое.

Состав:
TS-полисахарид 0,5%, маннитол, натрия дигидрофосфата моногидрат, натрия гидрофосфата дodeкагидрат, бензалкония хлорид, очищенная вода.

Хранить при температуре не выше 25° C.

Беречь от воздействия прямого солнечного света.

Вскрытый флакон хранить не более 30 дней.

Не использовать по истечении срока годности.

Дата вскрытия флакона/...../.....

С инструкцией обращаться.
Импортер: ООО «Данвис» и «Данвис», 125460, Россия, Москва, ул. Крылатская, д. 17 эт. 2, Державский инновационный промышленный парк «Данвис» и «Данвис» Восток Валле Франс S.A.S., Route de l'Ancêtre, 51120 Soissons, France
Дистрибутор: ООО «Фармоз», Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 17, 190000, Санкт-Петербург, Россия
FARMOS J.S.P.A. - Via Garibaldi Battaglia Oliveto, 6/8, 54121, Pistoia, Italy
ФАБРИКА СЛАЗА, Сан-Джованни-Баттиста Оливето, 6/8, 54121, Пистоя, Италия
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/06118 от 26.12.2011.

Способ применения:

- Перед закапыванием рекомендуется вымыть руки.
- Отклоните голову назад и аккуратно закапайте по 1-2 капли в каждый глаз.
- Для равномерного распределения капель по поверхности глаза рекомендуется поморгать 3-4 раза после закапывания.
- При закапывании, пока жидкость еще не распространилась равномерно по поверхности глаза, может возникнуть кратковременное ощущение нечеткости зрения. Это нормально и должно исчезнуть после моргания.
- Плотно закройте кулачком после закапывания.
- Рекомендуется применение капель 3-4 раза в день.

Хранить в недоступном для детей месте

Перед применением прочтите инструкцию!

Визин®
ЧИСТАЯ СЛЕЗА

РЕКОМЕНДОВАНО ОФТАЛЬМОЛОГАМИ™

для снятия раздражения при сухости и усталости глаз

Капли 10 мл

СТЕРИЛЬНО


Визин® — зарегистрированная торговая марка.

Визин® Чистая слеза на 1 день



Фото транспортной упаковки:

Визин® Чистая слеза

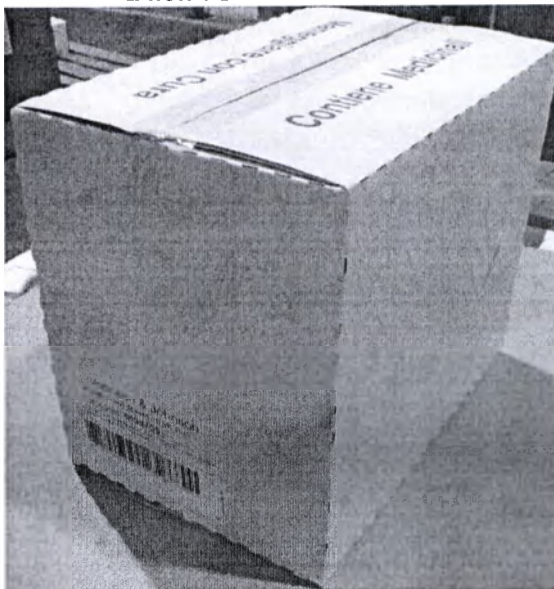

Визин® Чистая слеза на 1 день



9. Упаковка

Визин® Чистая слеза

Первичная упаковка изделия для многократного применения включает в себя флакон, капельницу - дозатор и голубой двухкамерный откручивающийся колпачок с контролем случайного вскрытия. Флаконы промаркированы этикетками, где обозначены характеристики серии изделия до упаковки в картонную коробку.

Размеры этикеток: длина – 60 мм $\pm$ 1 мм; ширина – 22 мм $\pm$ 1 мм.

Размеры картонной упаковки: длина – 34 мм $\pm$ 2 мм; ширина – 32,5 мм $\pm$ 2 мм; высота – 3 мм $\pm$ 4 мм.

Размеры транспортной упаковки: длина – 360 мм $\pm$ 5 мм; ширина – 245 мм $\pm$ 5 мм; высота – 310 мм $\pm$ 5 мм.

Визин® Чистая слеза на 1 день

Натуральные материалы ампулы (первичная упаковка); качественный состав.

Изделие для однократного применения поставляется в виде 0,5 мл термосваренных ампул, расположенных в литниках для нескольких ампул с перфорацией для отделения каждой ампулы, и приваренных внутри полиэтилен-алюминий-полистироловых саше. В картонной коробке содержатся 10 доз изделия.

Размеры этикеток: длина – 60 мм $\pm$ 3 мм; ширина – 22 мм $\pm$ 1 мм.

Размеры картонной упаковки: длина – 80,5 ± 4 мм; ширина – 20,5 мм ± 1 мм; высота – 126,5 мм ± 6 мм.

Размеры транспортной упаковки: длина – 445 мм ± 5 мм; ширина – 290 мм ± 5 мм; высота – 270 мм ± 5 мм.

Обозначение и характеристики серии изделия напечатаны на ампулах и на саше из фольги.

Все компоненты, кроме колпачка, изготовлены из химически инертного, с низкой плотностью, бесцветного полиэтилена. Колпачок изготовлен из полиэтилена с высокой плотностью, окрашенного в голубой цвет. Все компоненты подвергались стерилизации гамма-облучением.

10. Условия хранения и транспортировки

Допускается транспортировка любым видом крытого транспортного средства

Условия транспортировки и хранения

Температура	10–25 °C
Давление	86,0–106,7 кПа
Относительная влажность воздуха	55–75 %

11. Срок годности

Согласно исследованию по стабильности, срок годности изделия составляет 24 месяца при температуре хранения 25 °C.

Исследования срока годности после вскрытия упаковки указывают на то, что Визин Чистая слеза можно использовать в течение 30 дней после вскрытия флакона.

Ампулы для однократного применения можно использовать в течение 12 часов после вскрытия и могут храниться в упаковке из фольги в течение 2 месяцев.

12. Требования безопасности

Визин® Чистая слеза

Общие меры предосторожности

- Не применяйте капли при аллергии на любой из компонентов. При проявлении дискомфорта и раздражения прекратите применение изделия
- Не используйте изделие одновременно с другими препаратами или офтальмологическими средствами, так как это может изменить их действие
- Рекомендуется снять контактные линзы перед применением препарата
- Не дотрагивайтесь до кончика флакона и старайтесь не допускать его контакта с поверхностью глаза
- Не промывайте кончик флакона моющими средствами.
- Не используйте флакон, если его герметичность нарушена
- Если изделие было вскрыто, выбросите его по истечении 30 дней.
- Не глотайте изделие.
- Не используйте после окончания срока годности.
- Храните в местах, недоступных для детей.

Визин® Чистая слеза на 1 день

Общие меры предосторожности

- Не применяйте капли при аллергии на любой из компонентов. При проявлении дискомфорта и раздражения прекратите применение изделия. При наличии инфекции, покраснения, воспаления и боли в глазах обратитесь к врачу-офтальмологу.
- Не используйте изделие одновременно с другими препаратами или офтальмологическими средствами, так как это может изменить их действие. Не

дотрагивайтесь до кончика ампулы и старайтесь не допускать ее контакта с поверхностью глаза

- Не промывайте кончик ампулы моющими средствами.
- Не используйте ампулу, если она повреждена или ее герметичность нарушена
- Если изделие было вскрыто, выбросите неиспользованное изделие по истечении 12 часов.
- Не глотайте изделие.
- Не используйте после окончания срока годности.
- Храните в местах, недоступных для детей.

13. Защита окружающей среды

13.1. Требования к защите окружающей среды

Разработка, производство и утилизация изделия не наносит вред окружающей среде

13.2. Утилизация или уничтожение медицинских изделий

После использования изделие должно быть утилизировано согласно местным инструкциям и законодательствам. Утилизируйте медицинское изделие как обычный бытовой отход.

14. Способы и средства дезинфекции и предварительной очистки

Не применимо


15. Гарантия

Дата истечения срока годности изделия соответствует сроку сохранения стерильности и составляет 2 года от даты изготовления изделия, указанной на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение заявленных характеристик изделия, срока сохранения стерильности, гарантии безопасности и целостности упаковки при правильной транспортировке, эксплуатации и хранении изделия.

16. Претензии

ООО «Джонсон и Джонсон», 121614, Москва, Российская Федерация, ул. Крылатская, д. 17., корп. 2

Перевела Кострикова Вера Сергеевна




Российская Федерация, город Москва, двадцать седьмое декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я, Атрахимович Татьяна Павловна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Костриковой Верой Сергеевной, в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 2-5-8529

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Нотариус

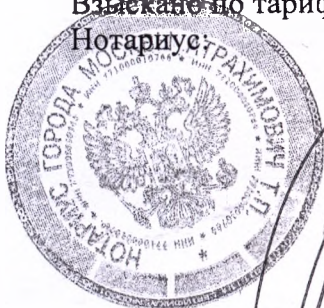

Всего прощито,
прокумеровано и скреплено
печатью 33

листов.

Нотариус

ko

Город Москва

Двадцать седьмого декабря две тысячи шестнадцатого года

Я, Атрахимович Татьяна Павловна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за N

Взыскано по тарифу

Нотариус



8-5-8530
440



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 42

листов.

Нотариус