


Дисковый блок eximia NBS



Мониторы LCD - 2 шт



Передвижная тележка для основного блока с шафром
трансформатором

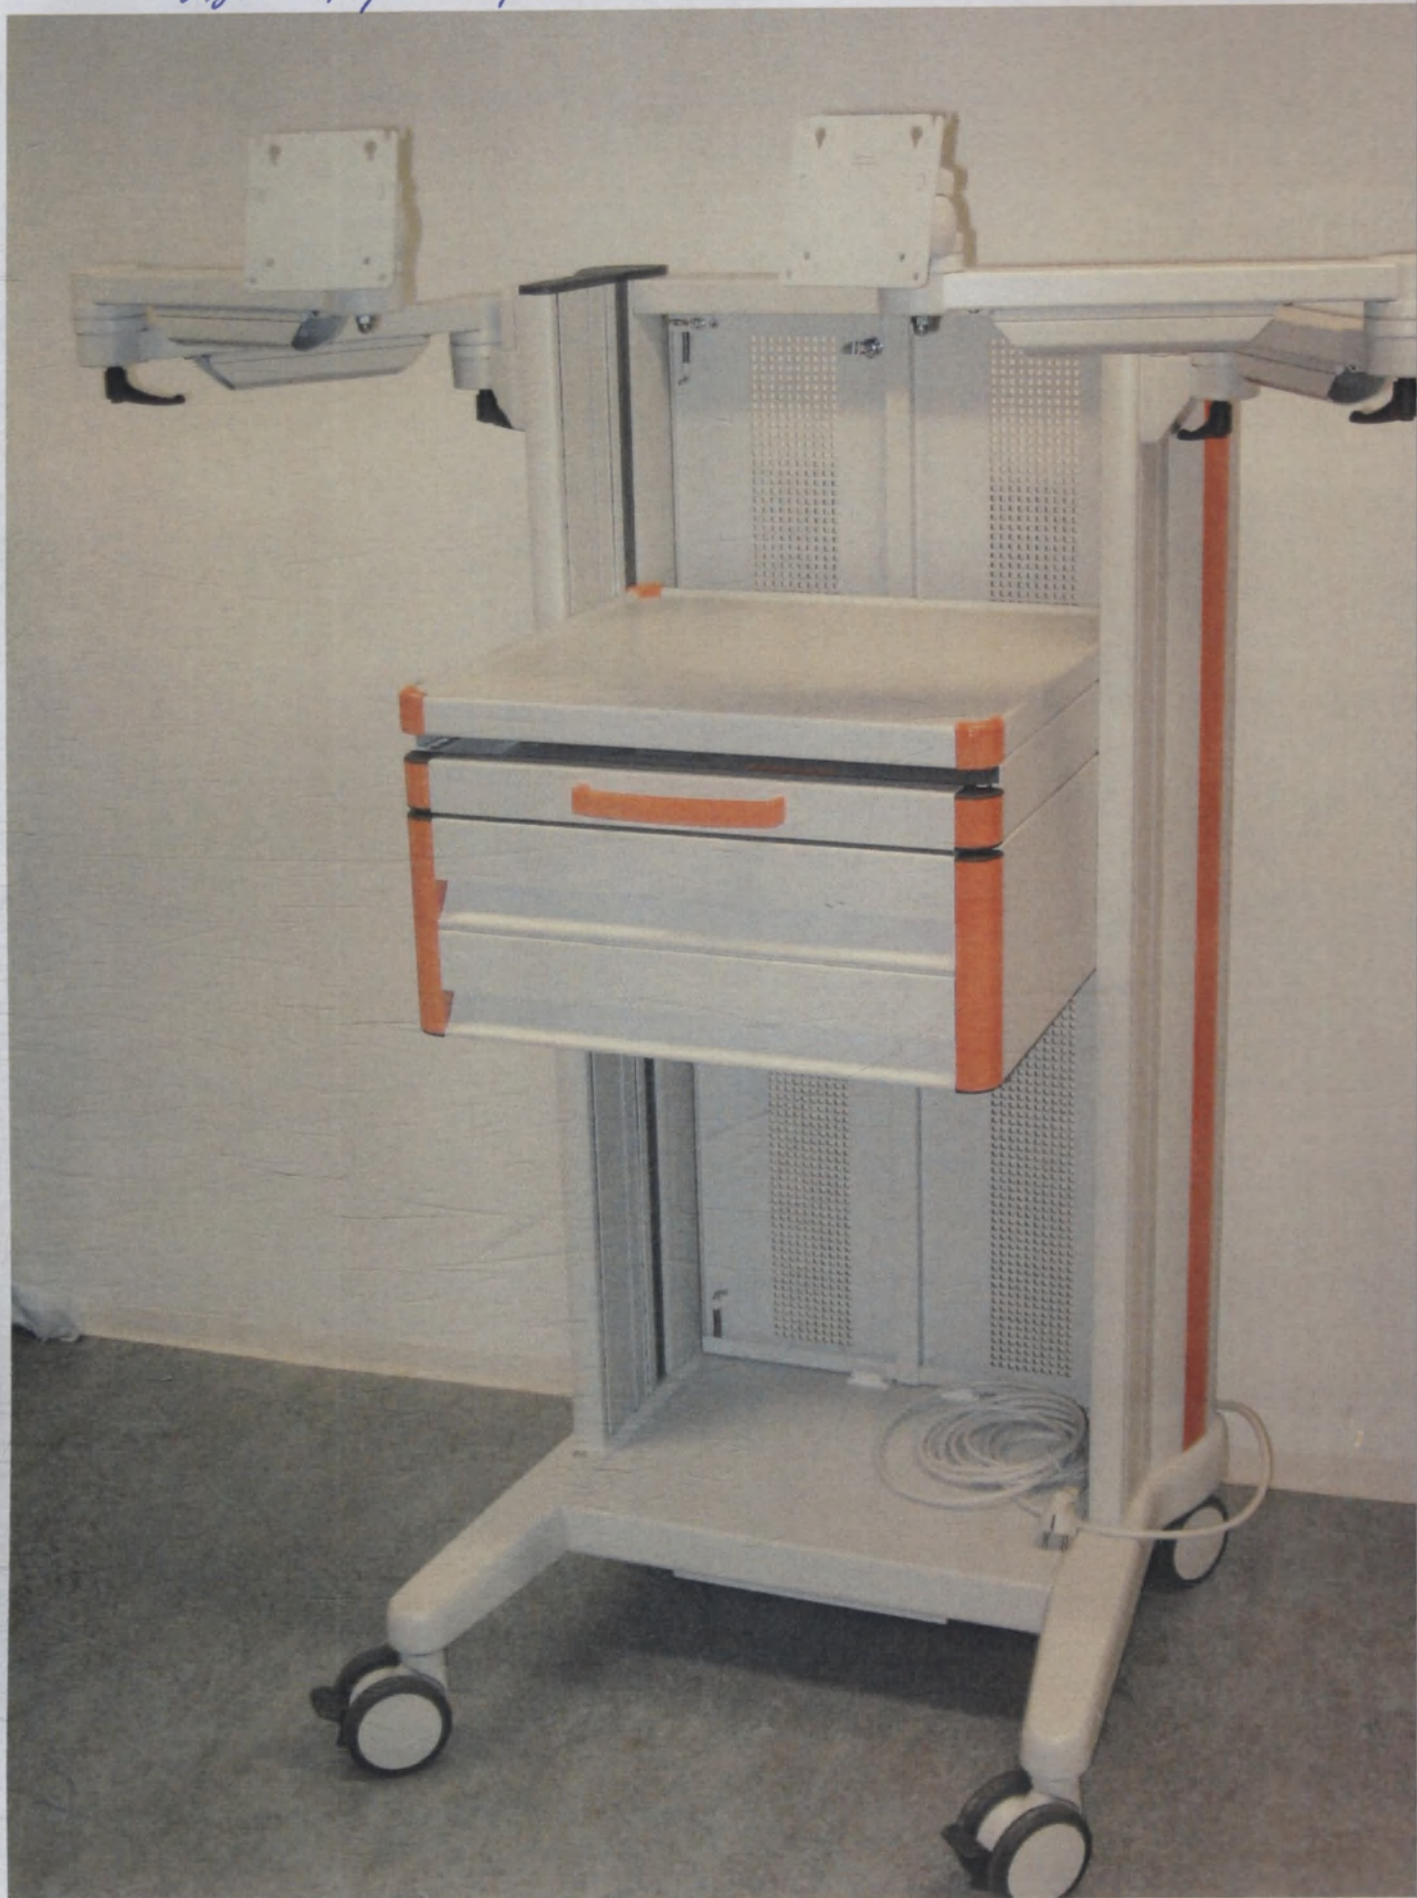

Кресло массажное



LCD монитор



Система трансформаторной магнитной стимуляции



Индуктор магнитной стимуляции фронтальной Зимингильса




Индуктор электромагнитного поля для измерения




Усилитель ЭМР сигналов



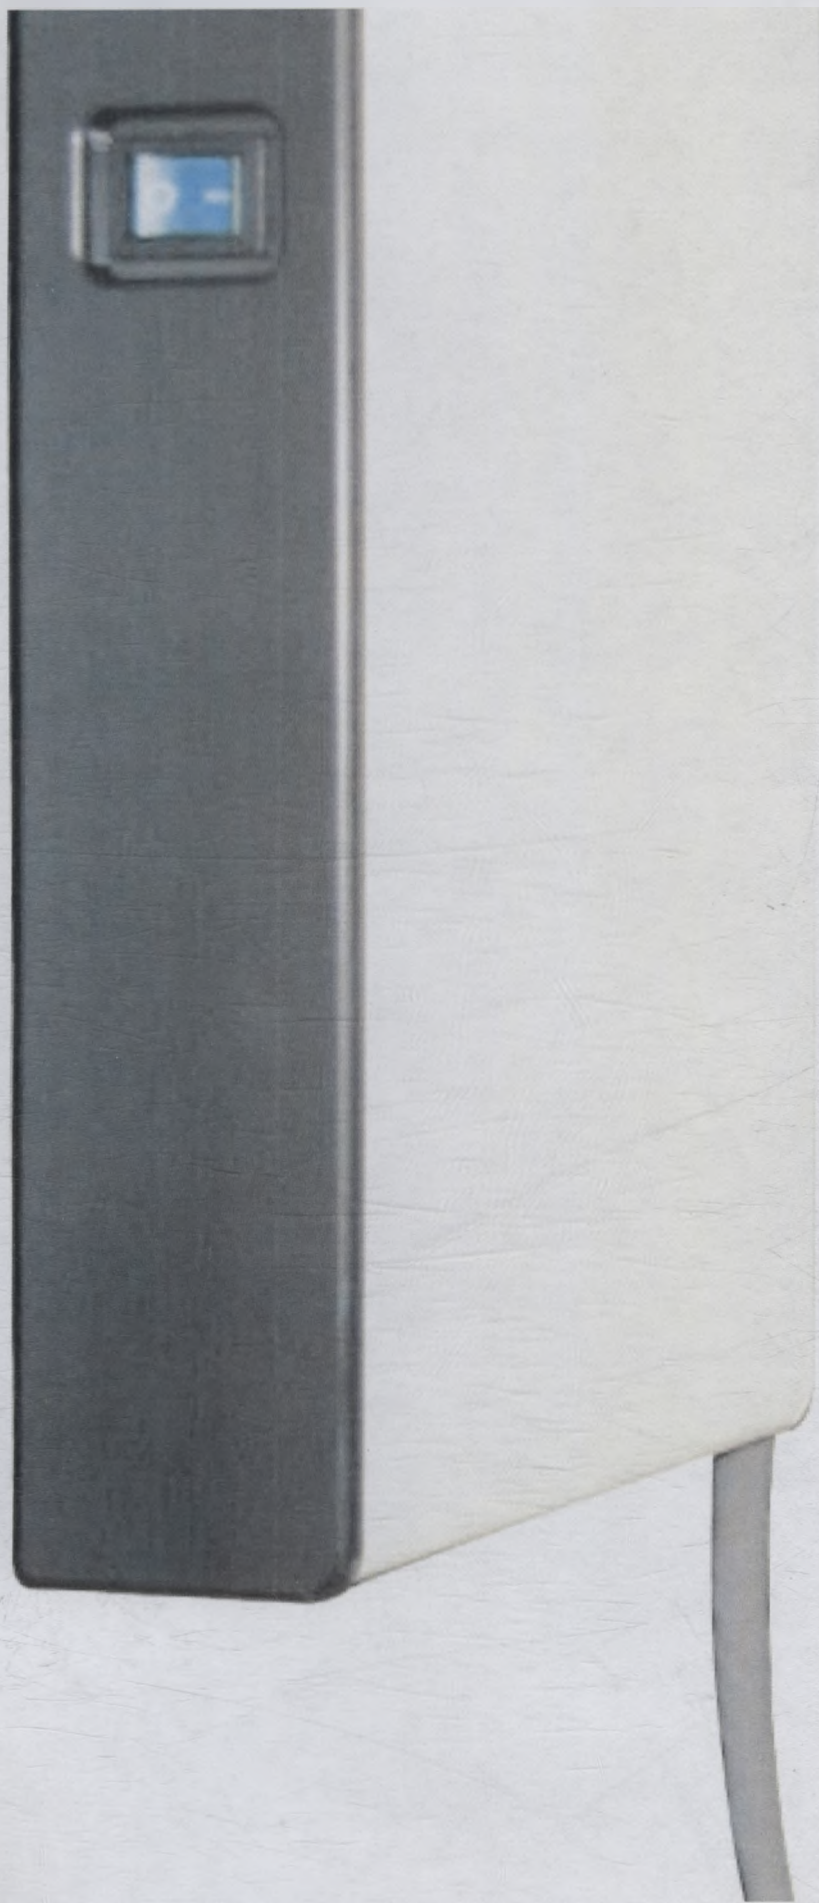


следить позиционирование индуктора

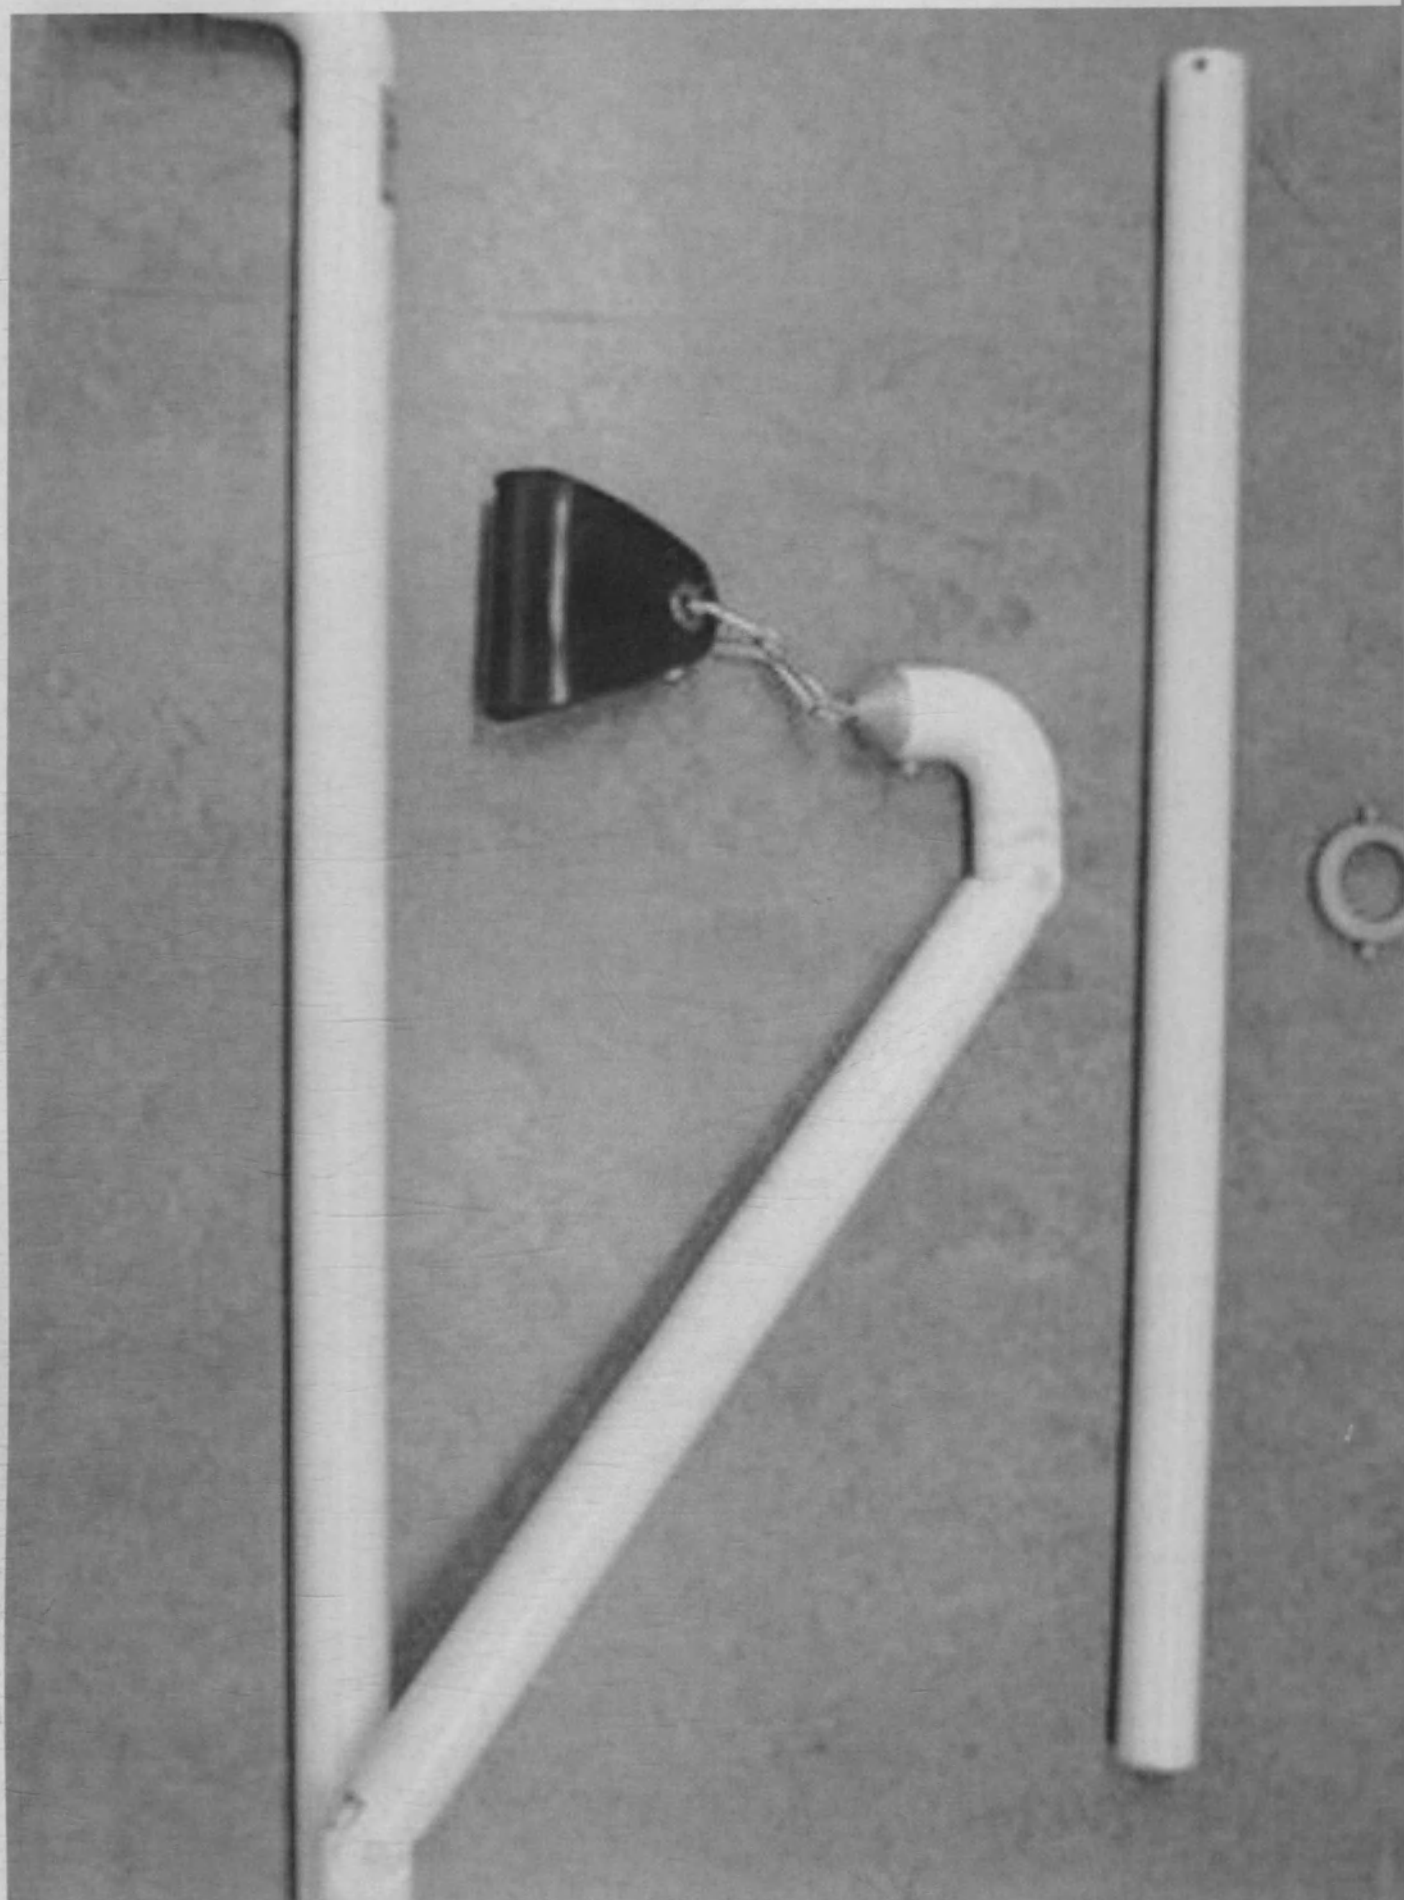


Детектор лучевых излучений



Визуальная головная сессия по контролю зрения

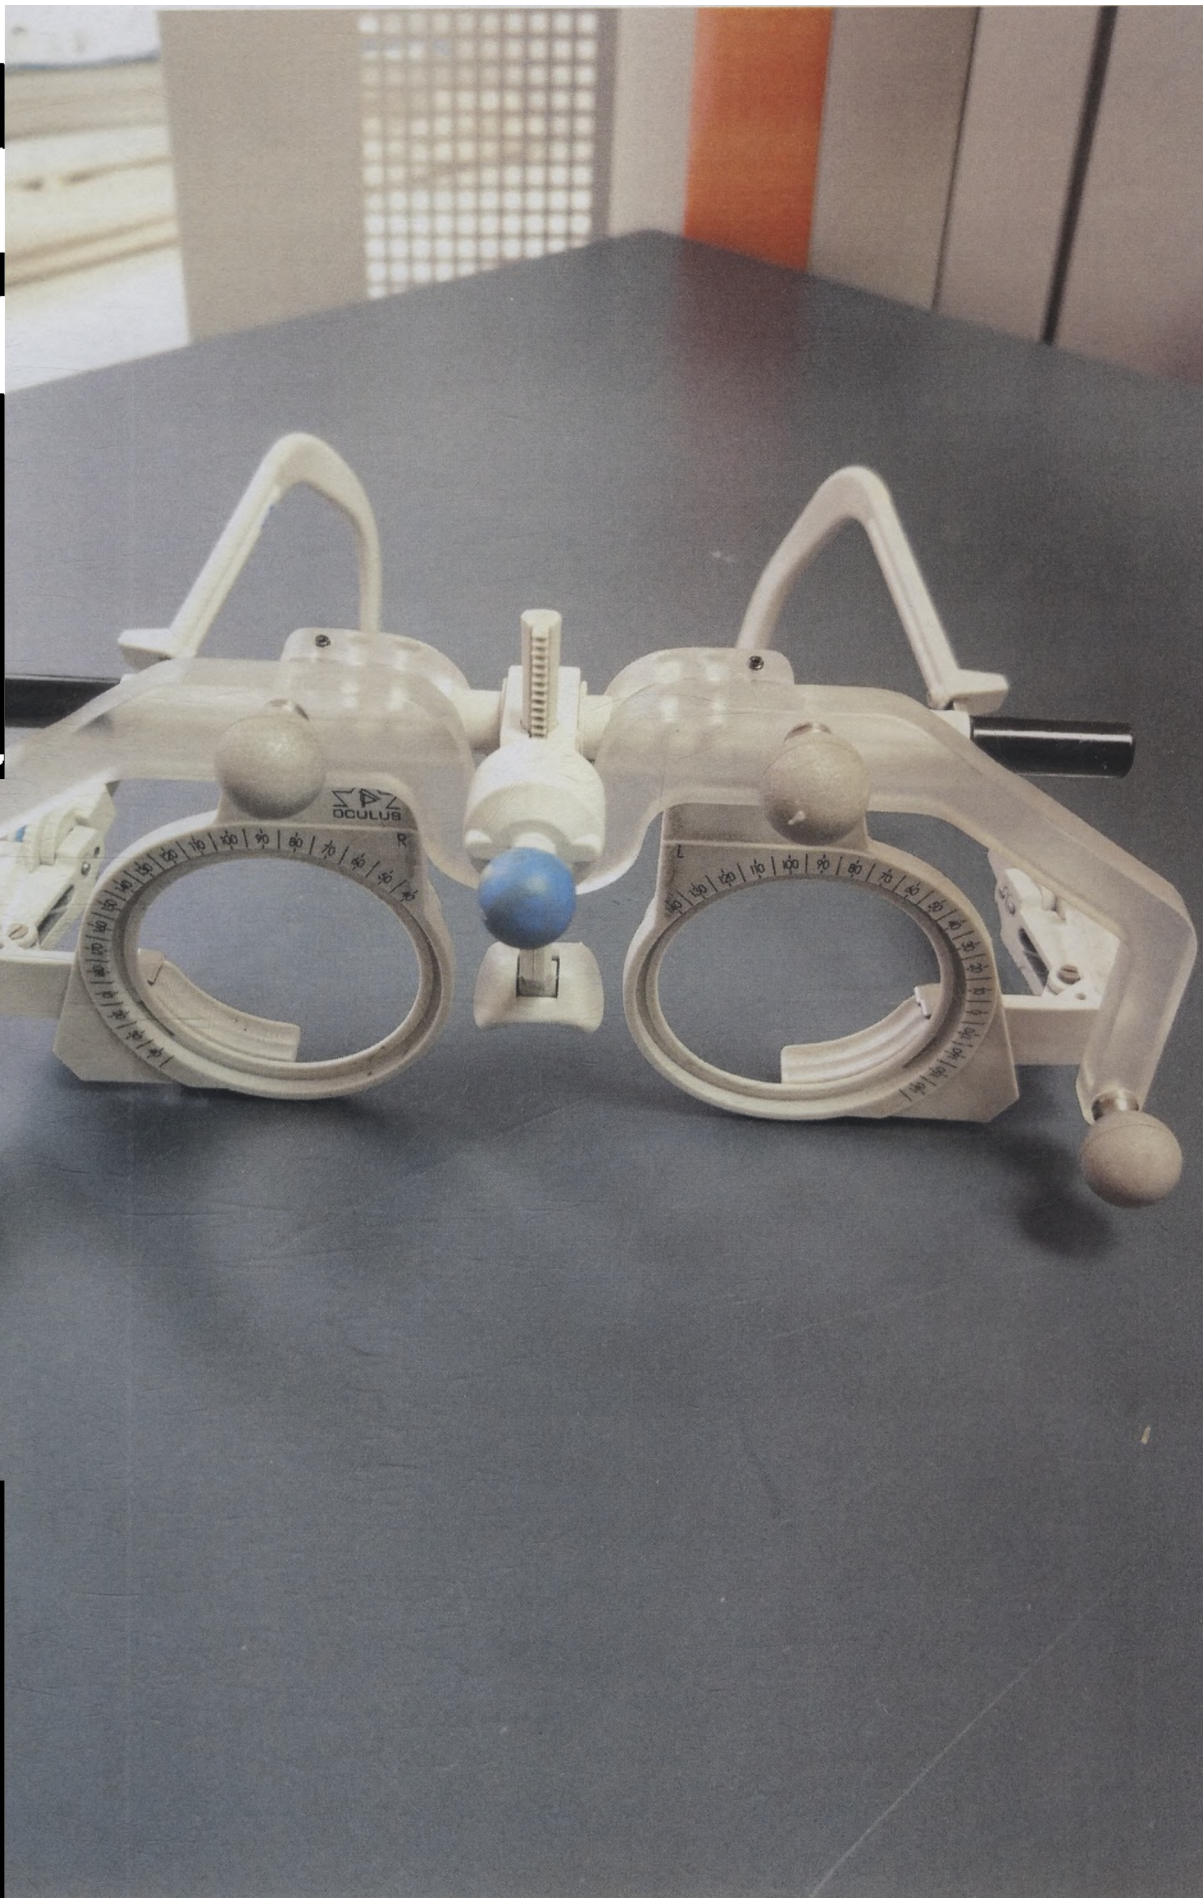

Стандартное садовое устройство для
посадки с пикирующей (для

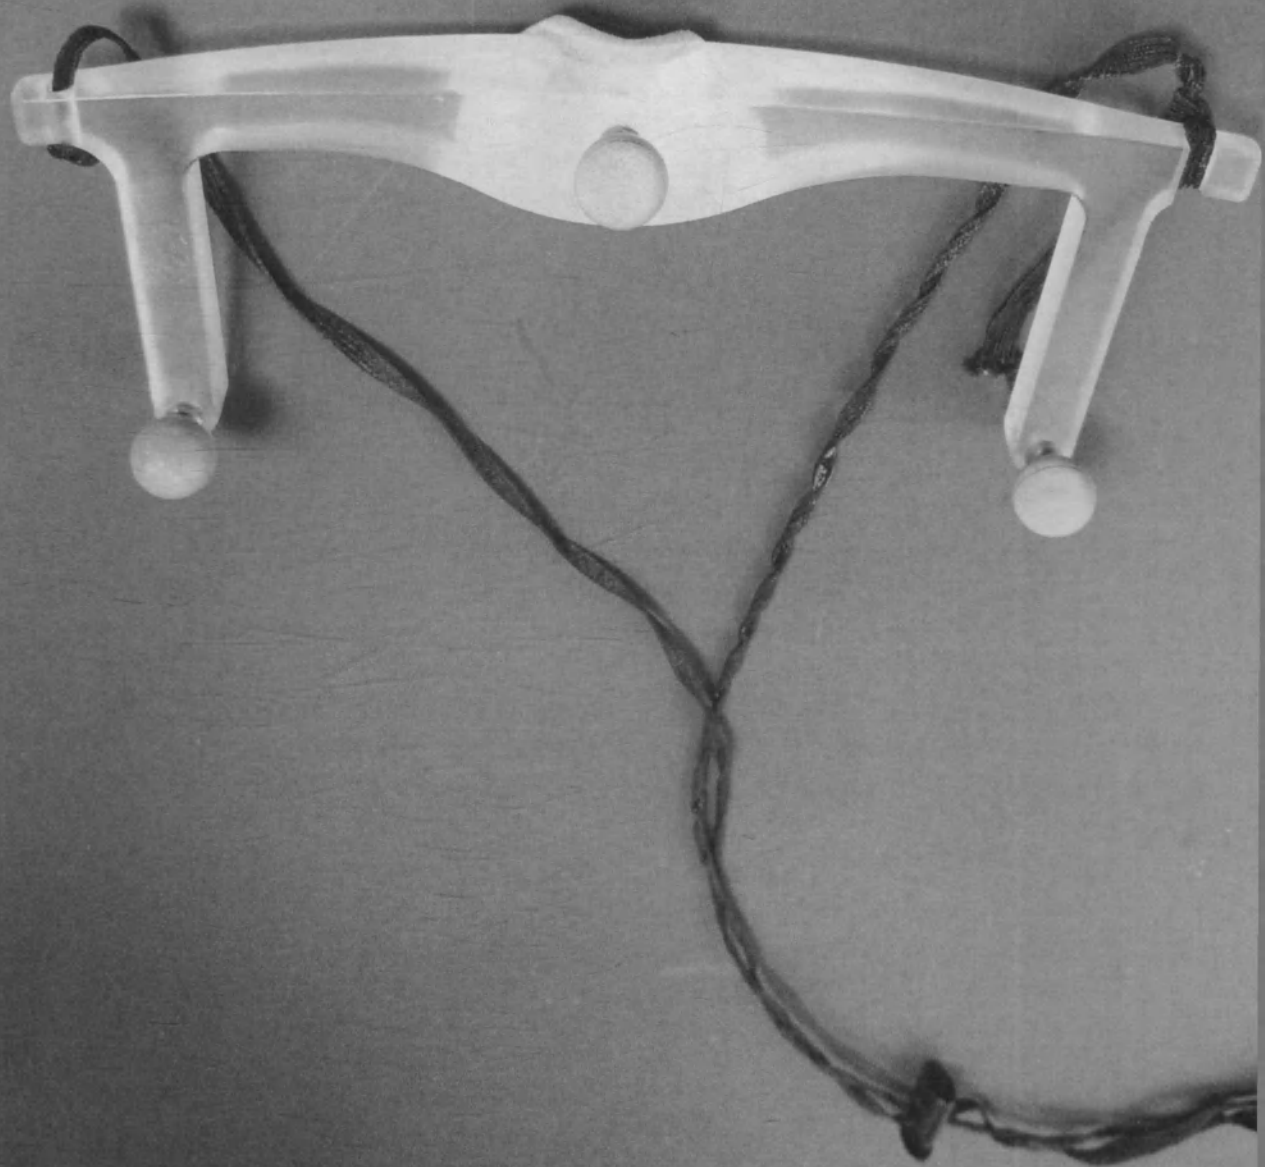

Циркуль nero для разметки маркером отливов о о о о



Пожарный реис для установки системы позиционера



Источник питания системы позиционирования



USB конвертор для системы позиционирования




Диагностический блок eximia NBS



Мониторы LCD - 2 шт



Передвижная тележка для основного блока с шафром
трансформатором

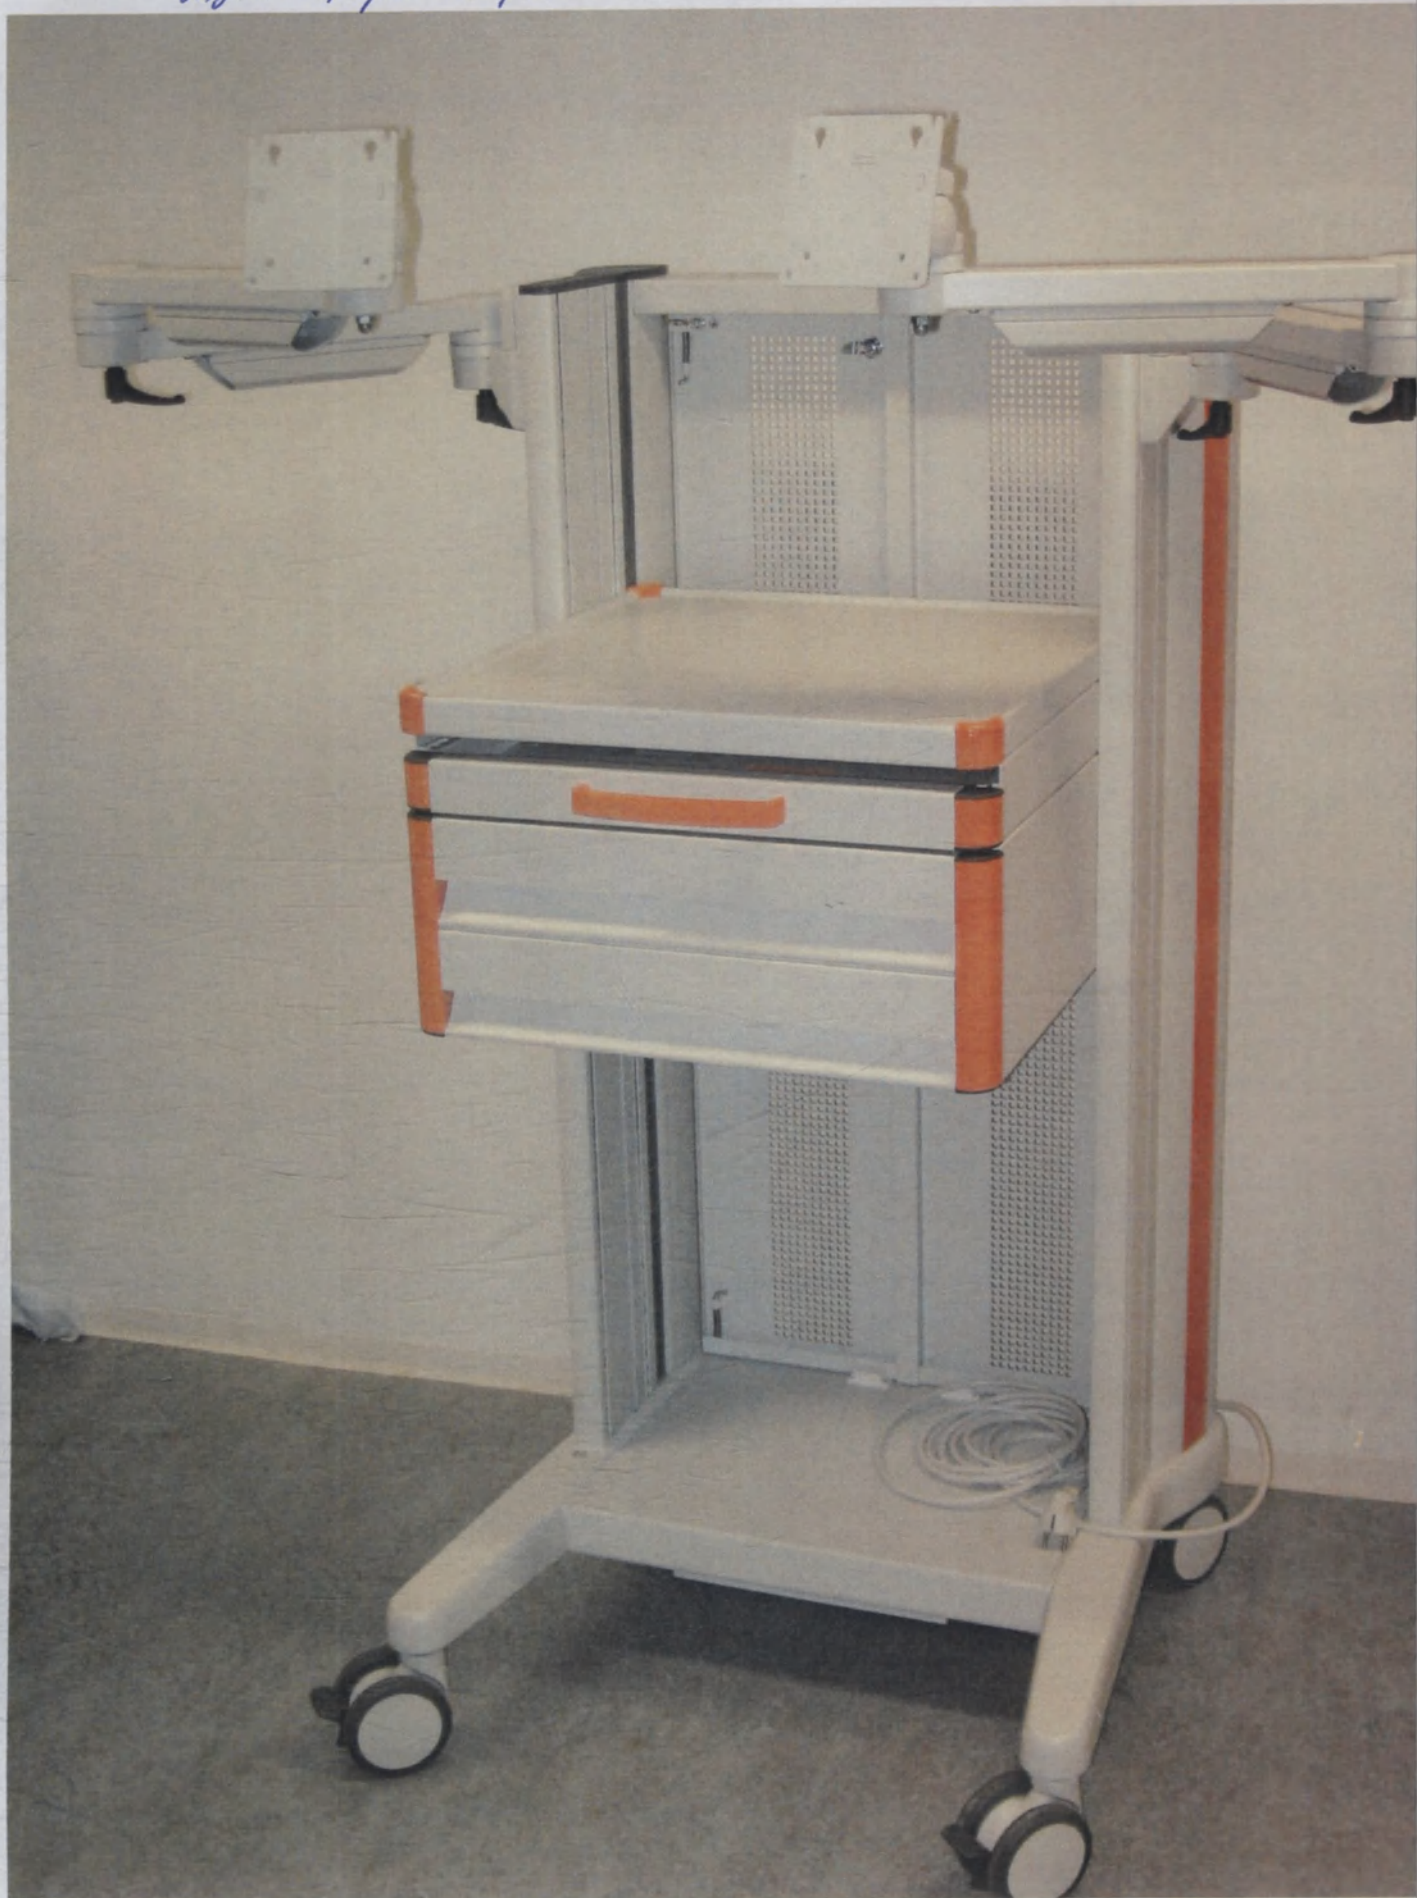

Кресло массажное



LCD монитор




у
Измерить ЭЭГ модуль



Средняя 551 модуль




Цифровый трансформатор

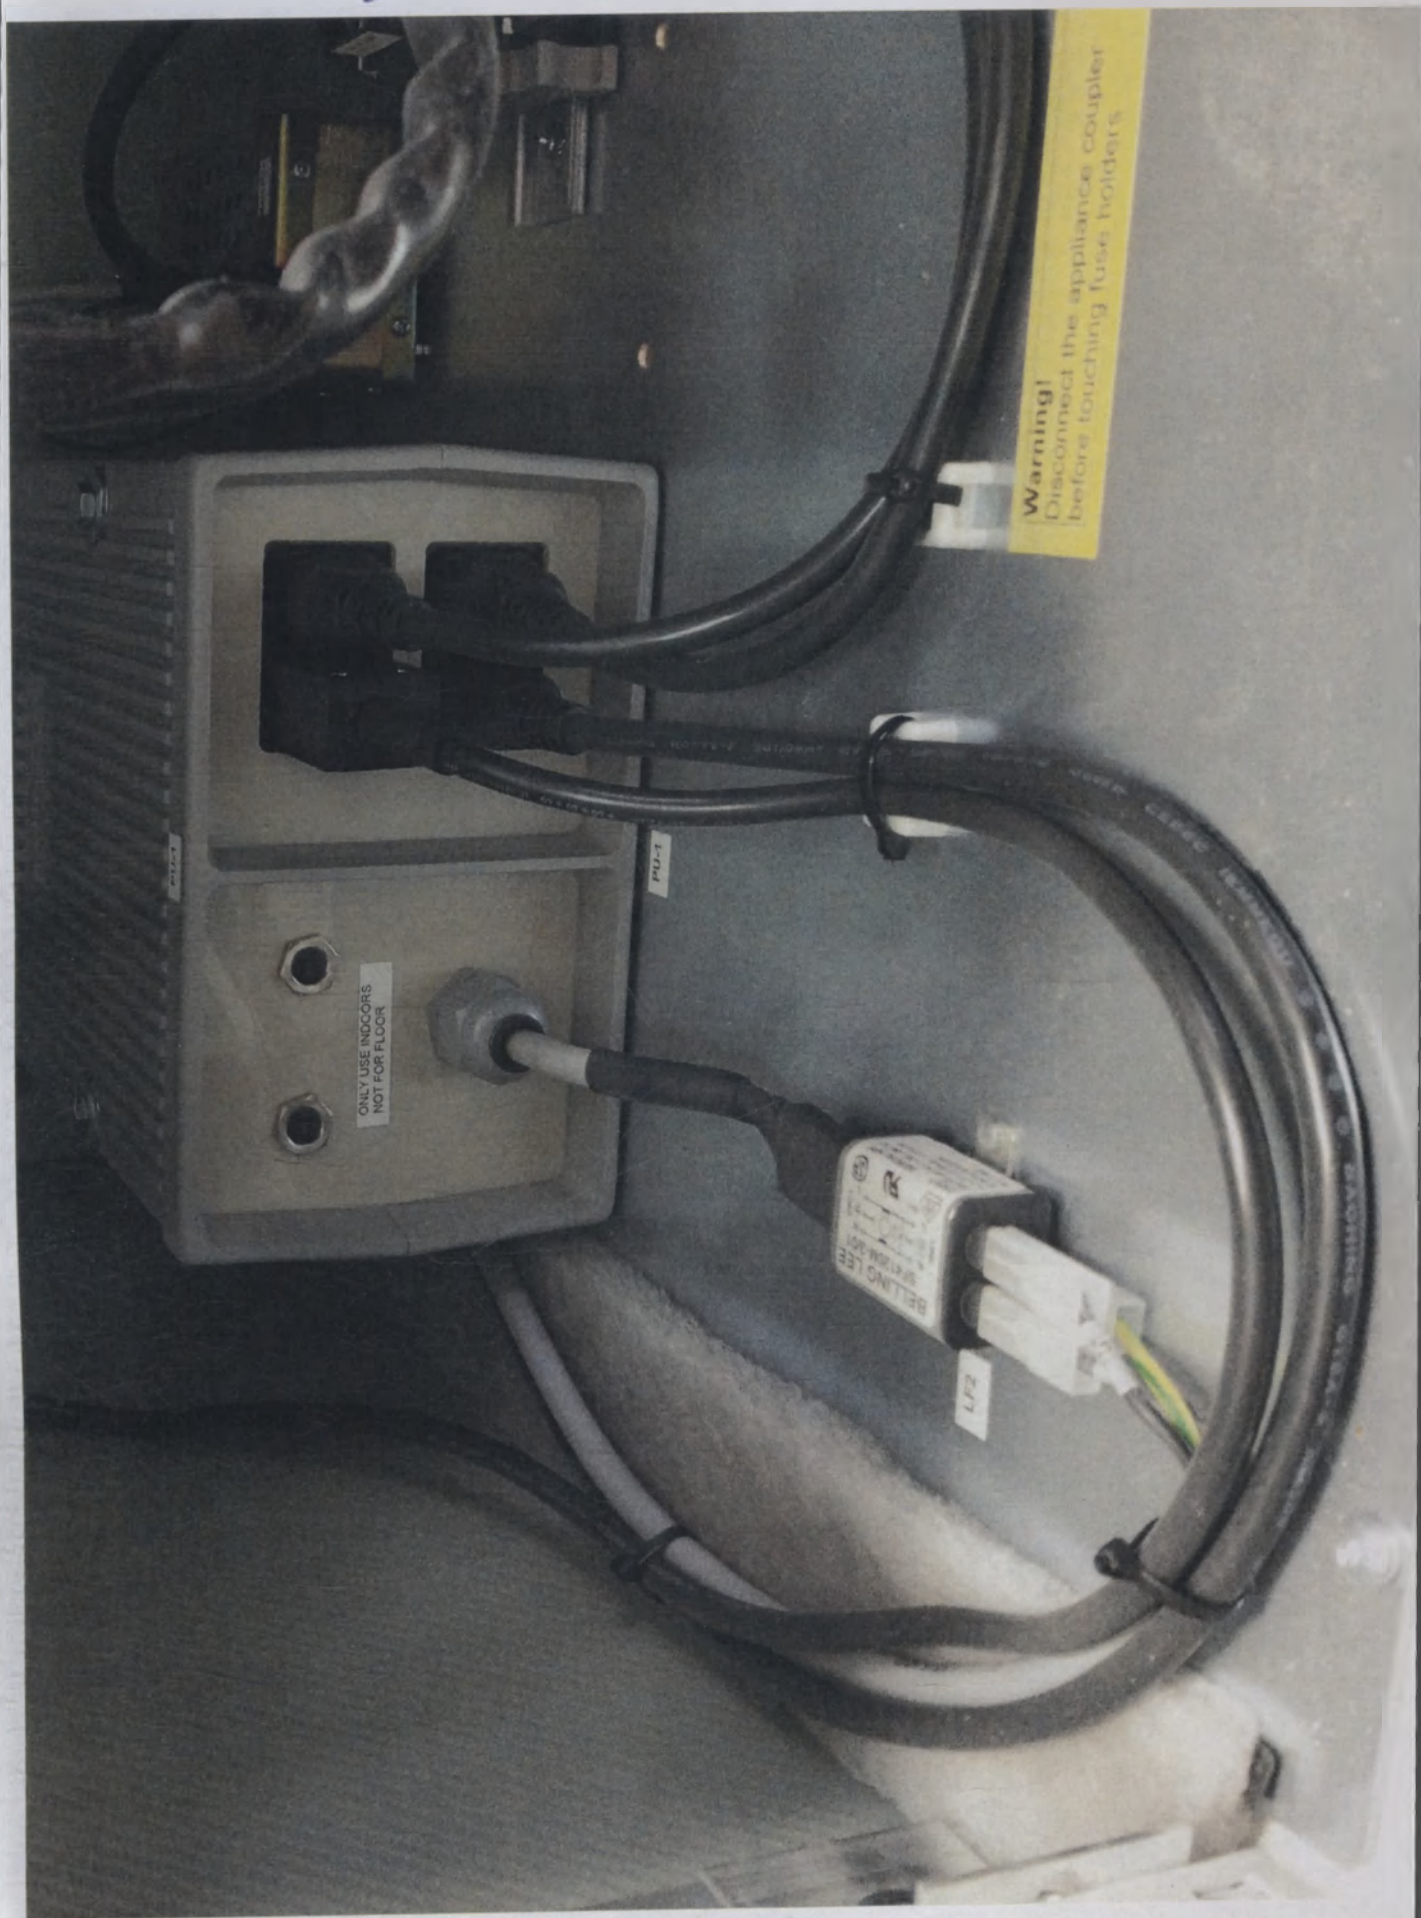



Кнопка переключателя



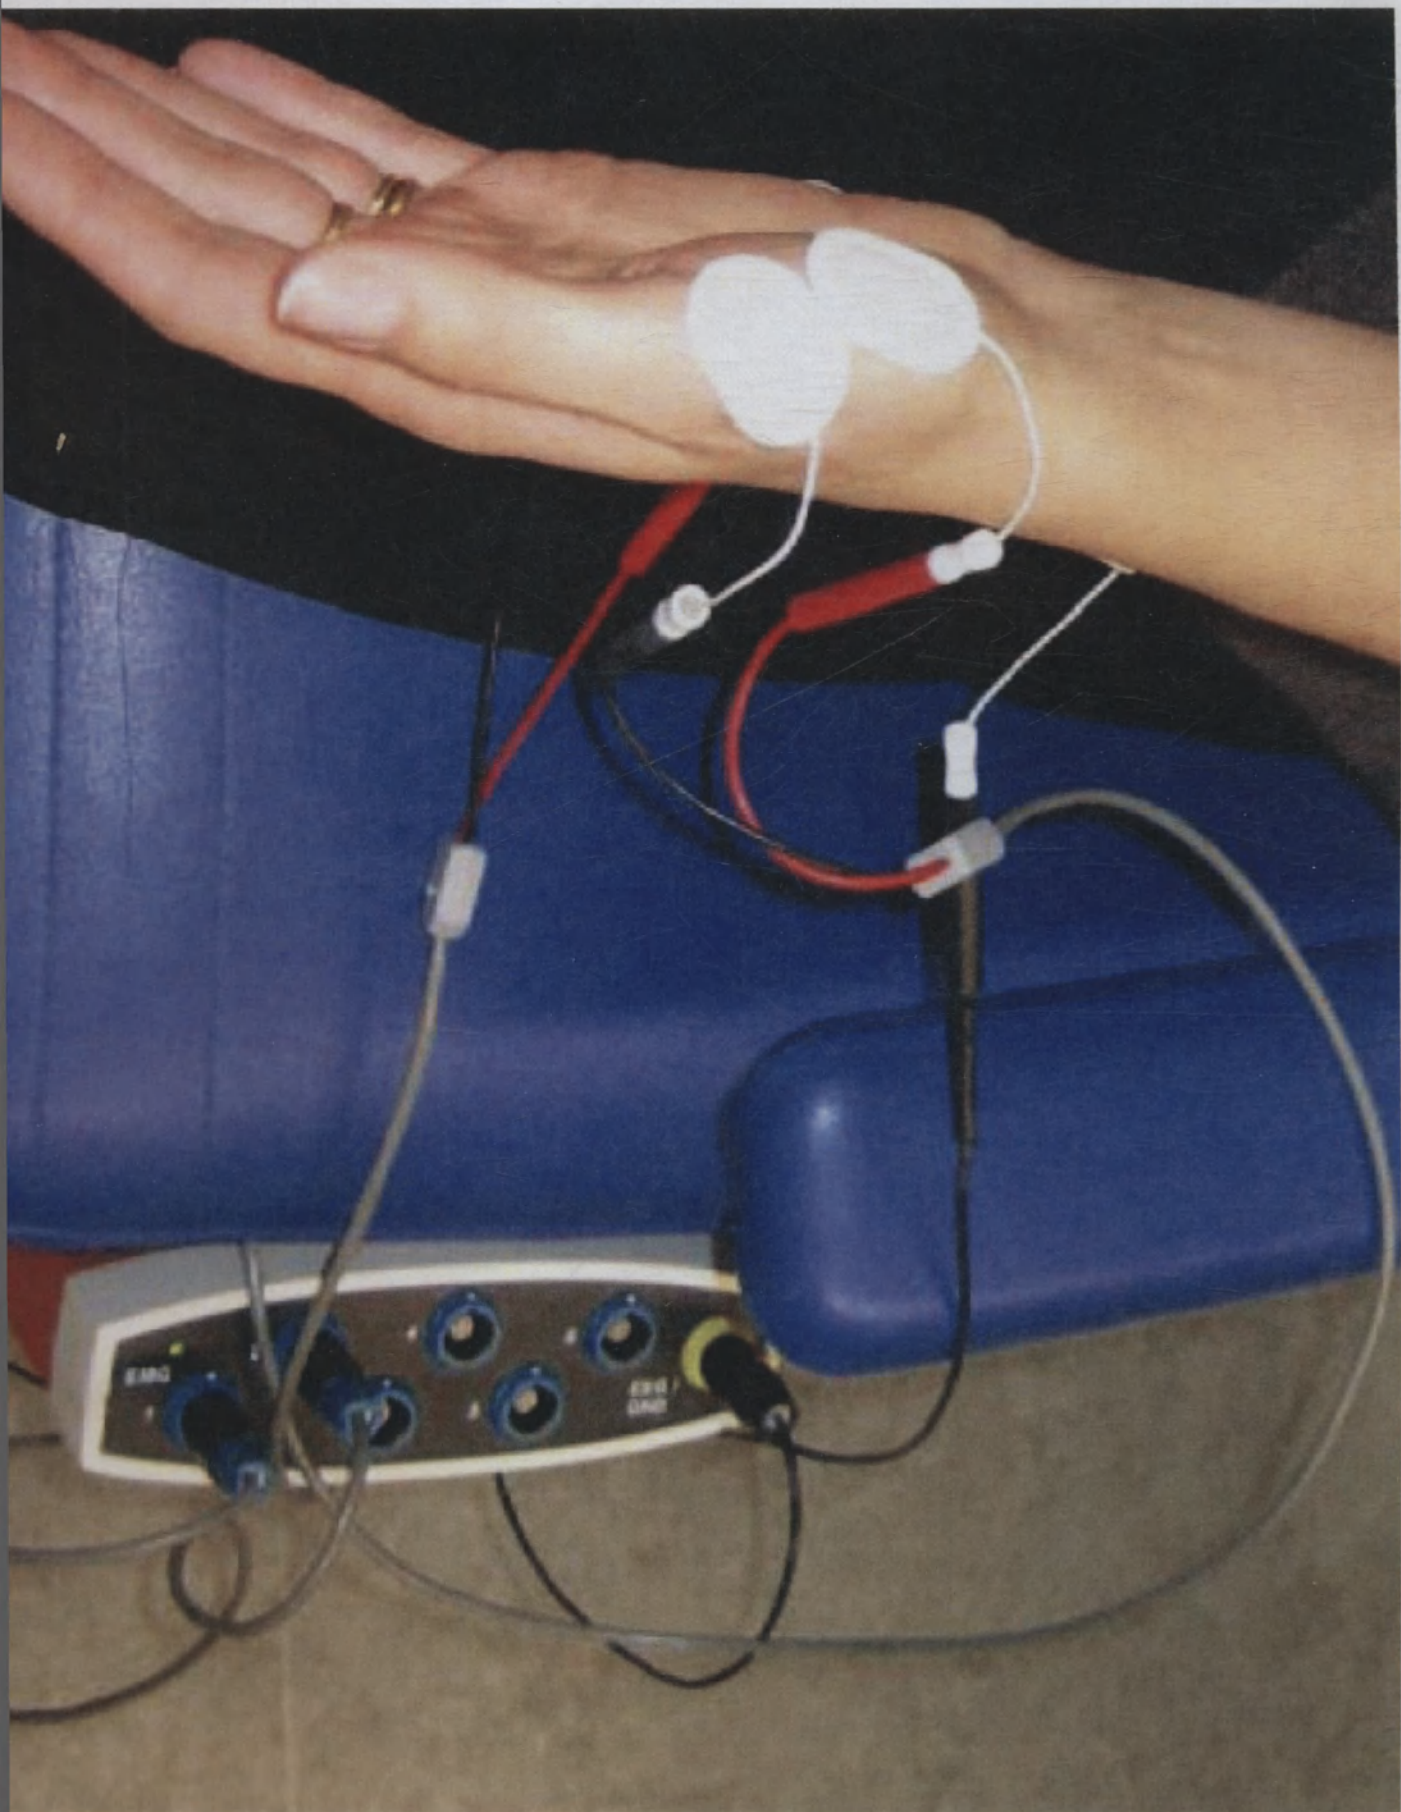

Набор ЭМГ электродов вариант 1



Держатели индуктора настенный



Меркури



Одноразовые подушечки для носа



Гуттер для хранения мрт образов



Обучающий надер виллод, пенопластовую модель
голова и надер. МРТ образцов



Кресло оператора



Электрошапочка для регистрации ЭЭГ



Электроды для электроэнцефалографии

