


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

I. Базовый состав: системы реанимационной открытой для новорожденных, моделей: BN-100, BN-100A, BN-100B, BN-100G:

1. Блок обогревателя.



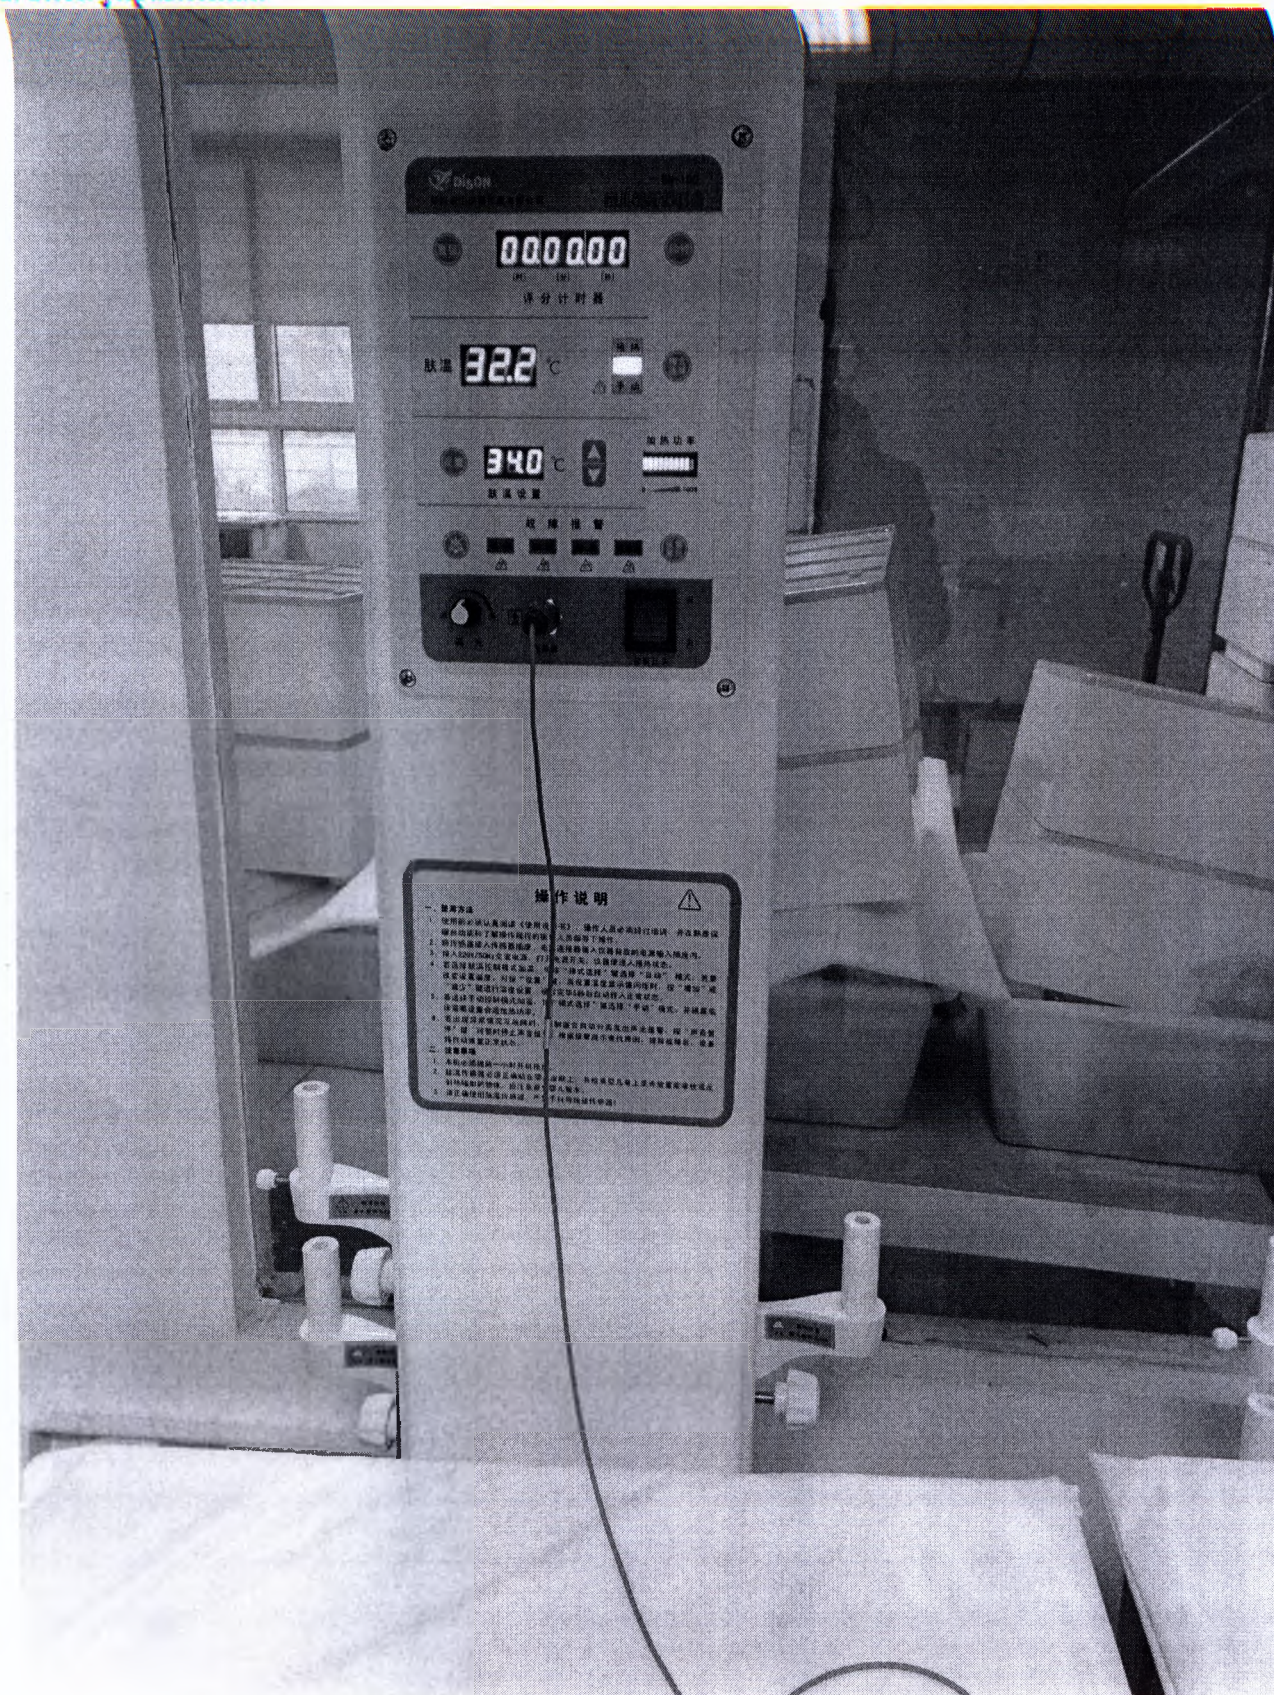

操作说明


一、操作方法

1. 使用前请认真阅读《使用说明书》，操作人员必须经过培训，并在熟练后方可操作。
2. 操作人员必须佩戴好防护用品，避免直接接触患者皮肤，避免造成交叉感染。
3. 将电源线插入电源插座，并检查电源线是否完好。
4. 将电源线插入电源插座，并检查电源线是否完好。
5. 将电源线插入电源插座，并检查电源线是否完好。
6. 将电源线插入电源插座，并检查电源线是否完好。
7. 将电源线插入电源插座，并检查电源线是否完好。
8. 将电源线插入电源插座，并检查电源线是否完好。


二、注意事项

1. 使用前必须预热一小时。
2. 使用过程中必须保持设备干燥，严禁将水或其他液体溅入设备内部。
3. 使用过程中必须保持设备清洁，严禁用手触摸设备表面。

3. Мобильное основание.

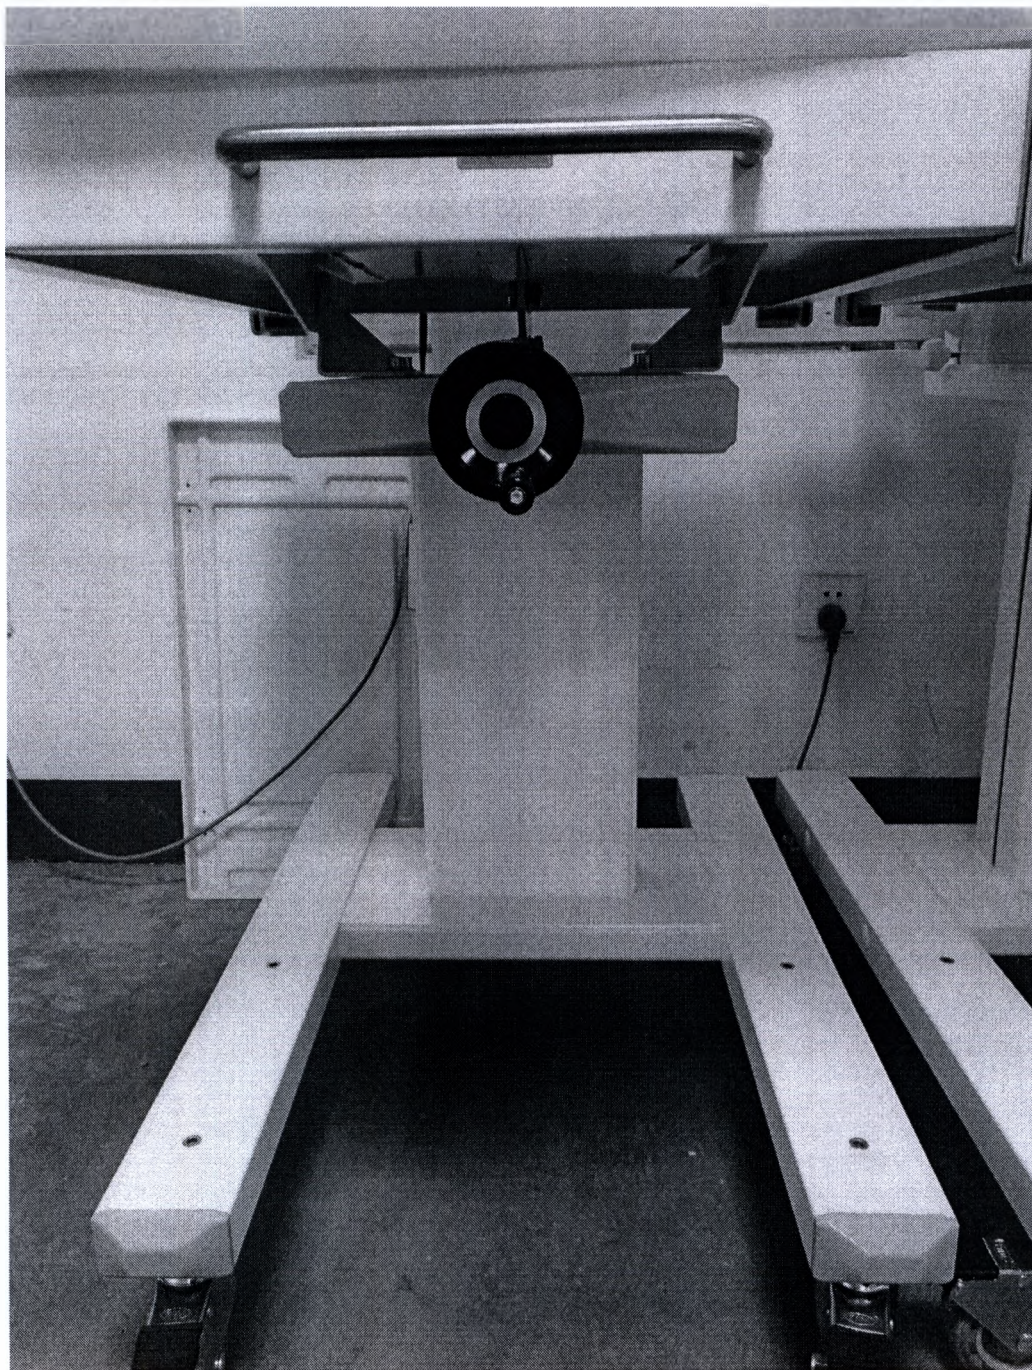

4. Стол рабочий.

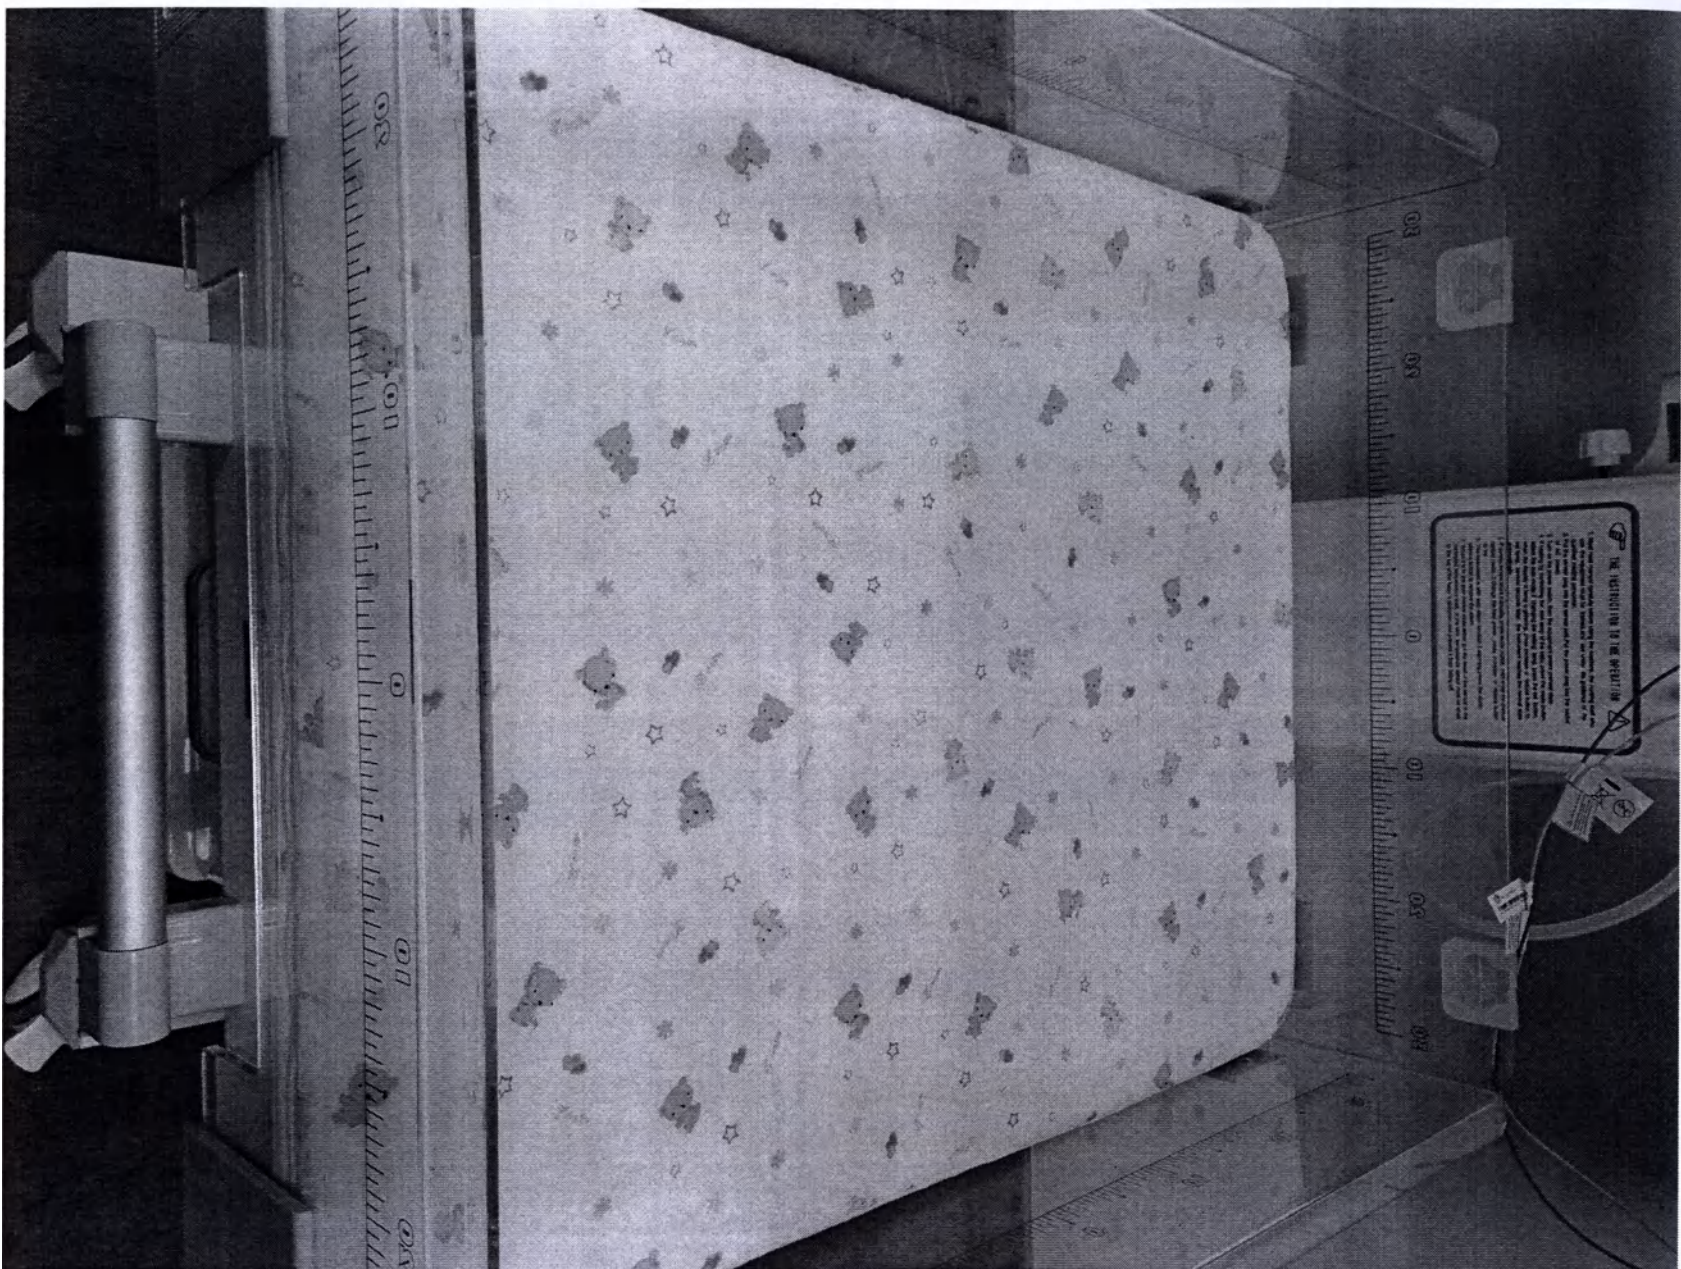


II. Принадлежности к системе реанимационной открытой для новорожденных, моделей: BN-100, BN-100A, BN-100B, BN-100G:


1. Блок обогревателя.




2. Блок обогревателя с галогеновой лампой освещения.

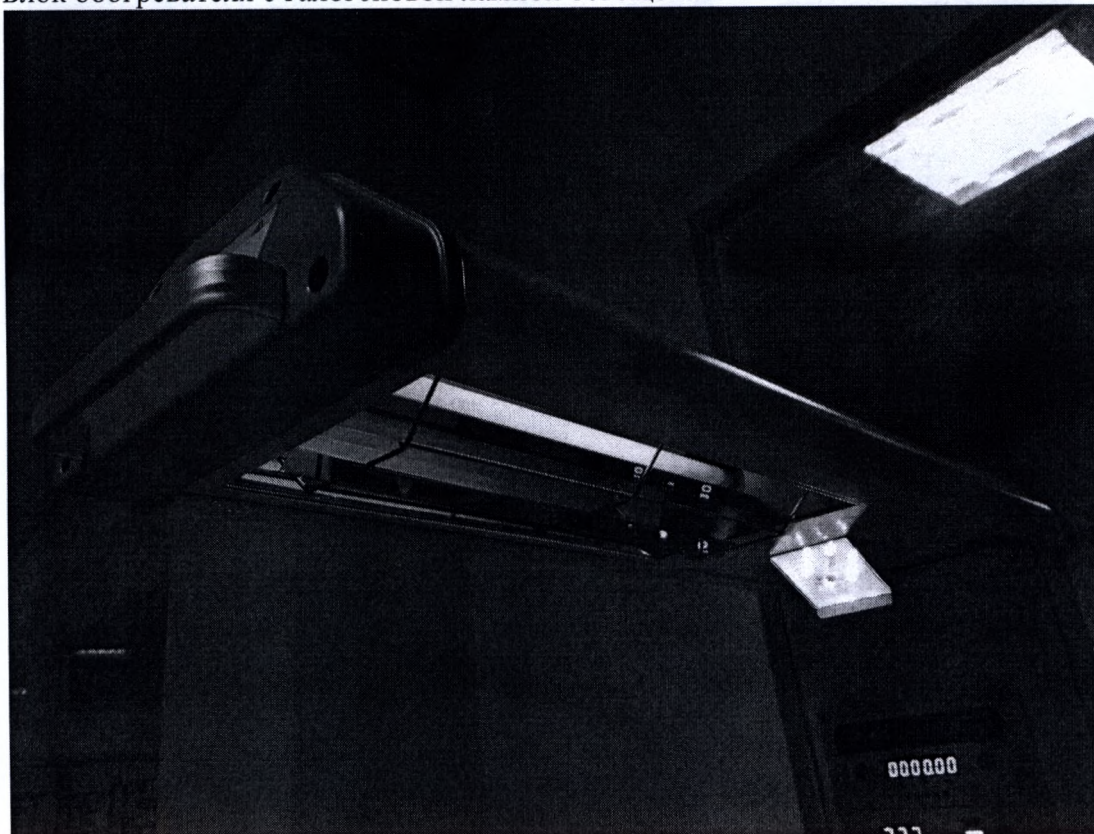

3. Блок управления.

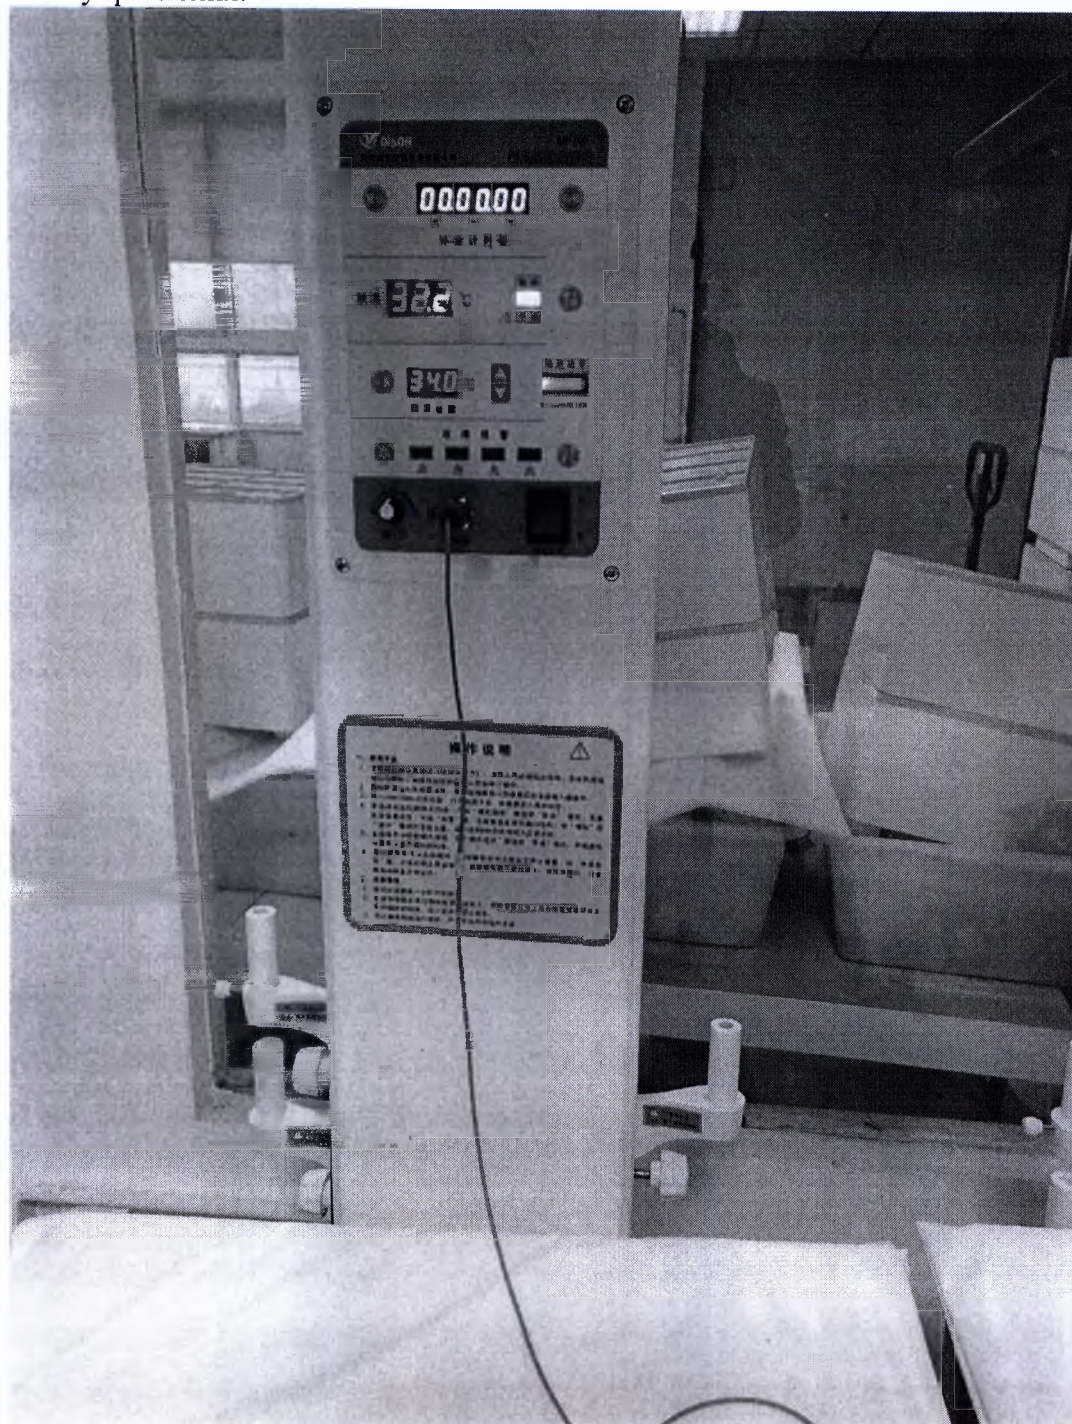


4. Блоки с лампами для фототерапии.

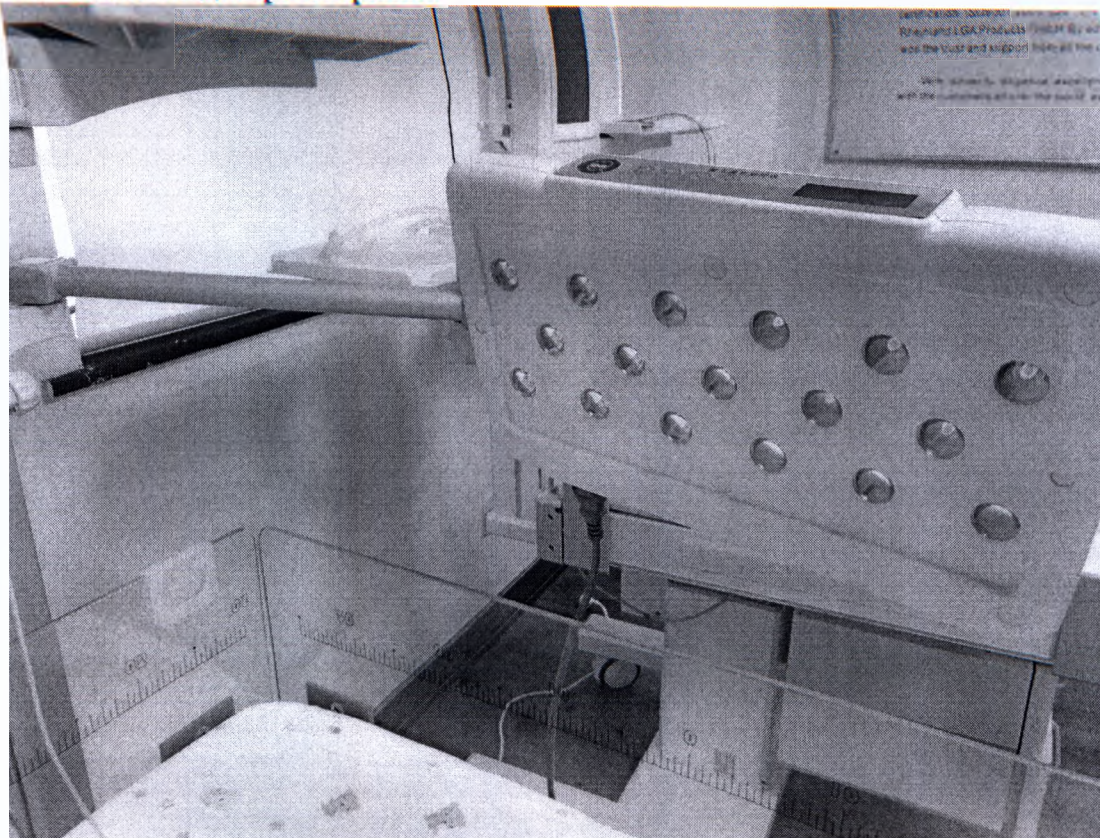


5. Штатив для внутривенных вливаний.




6. Крючок.

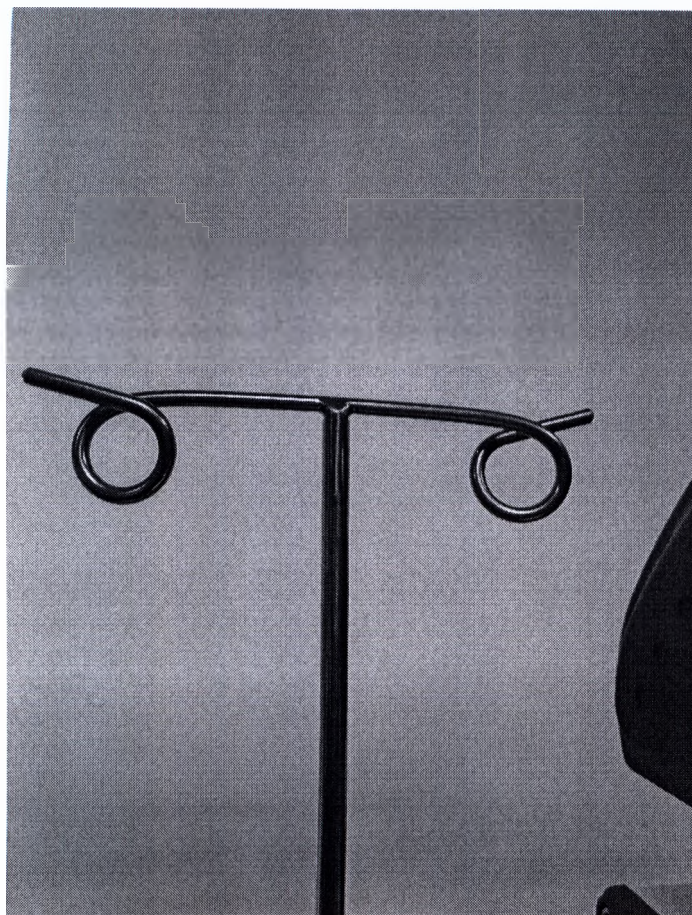


7. Мобильное основание.

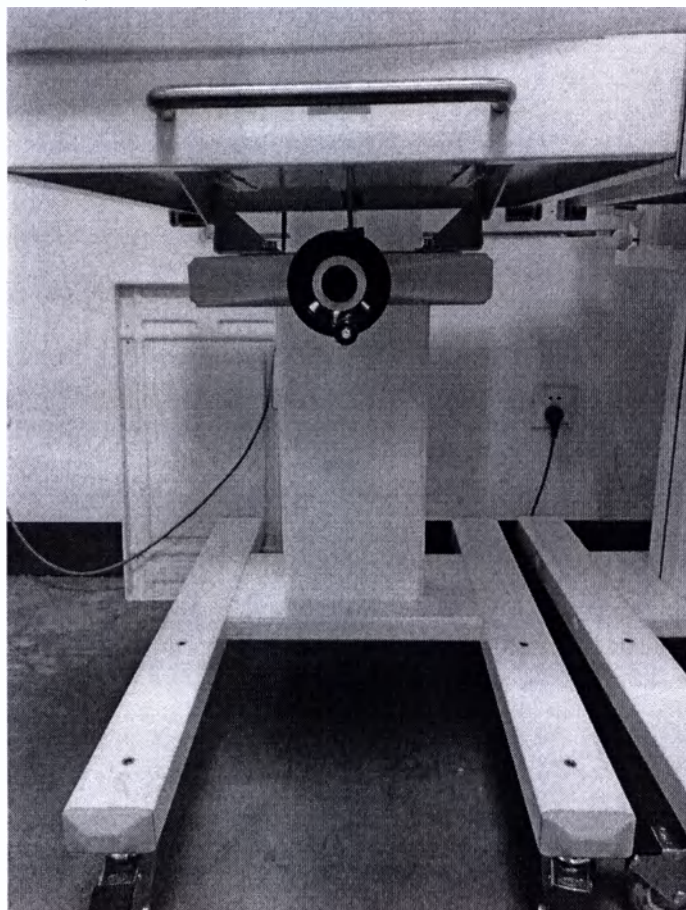


8. Полка приборная.

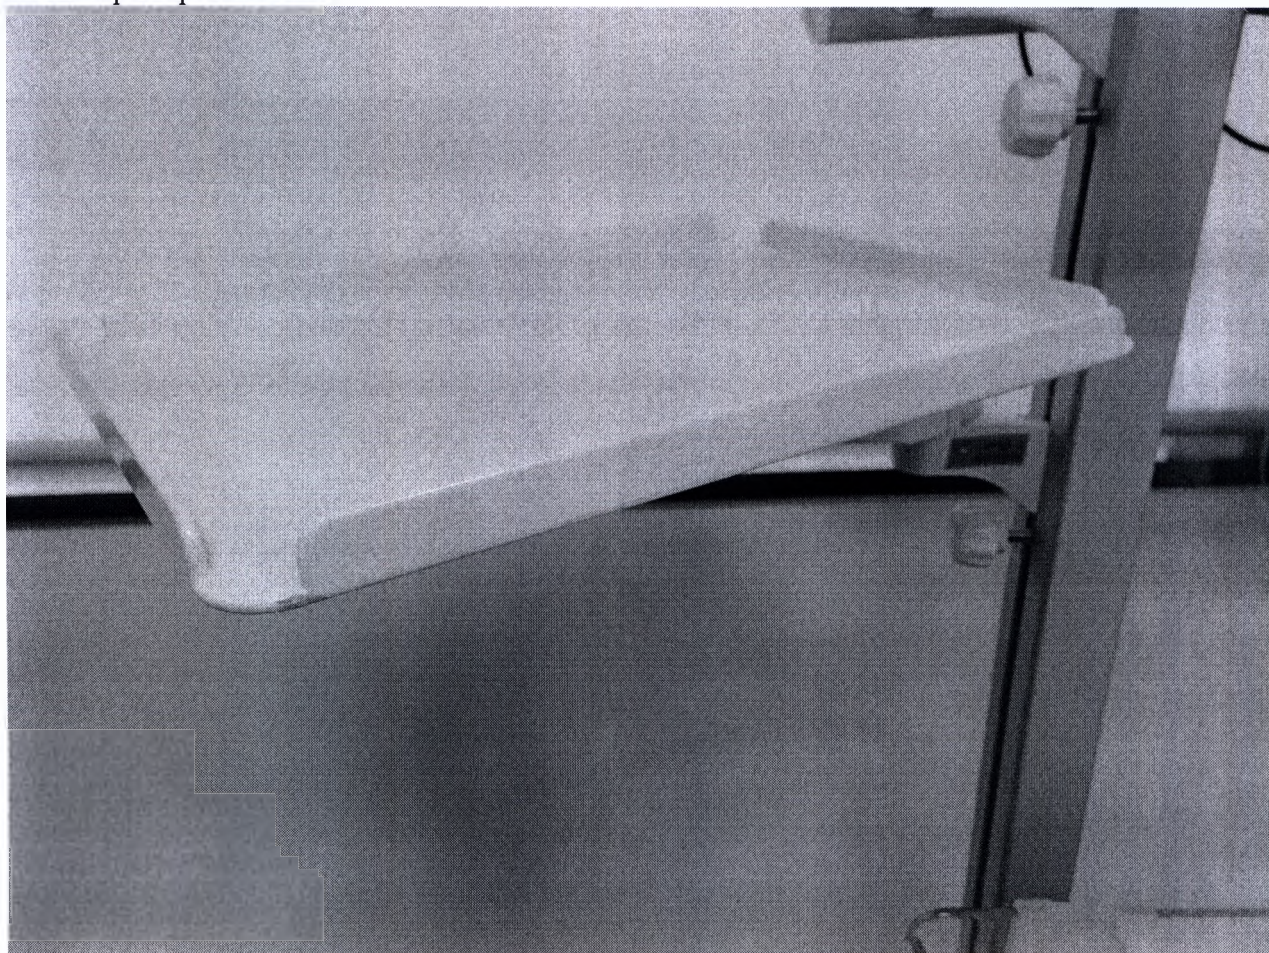


9. Стол рабочий.

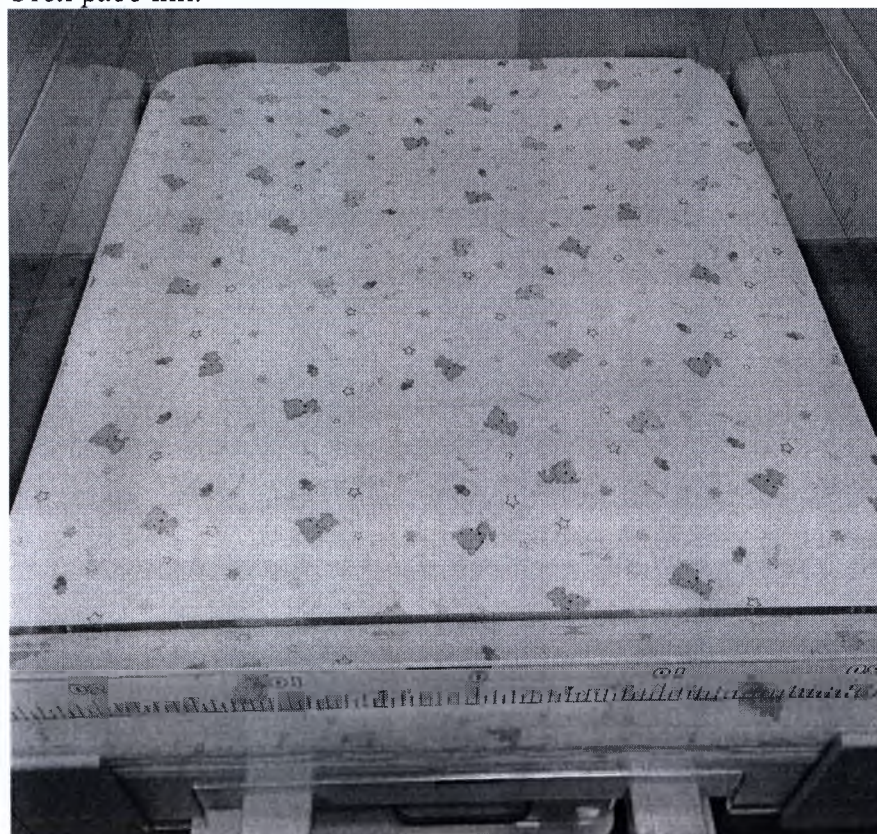


10. Ограждение.

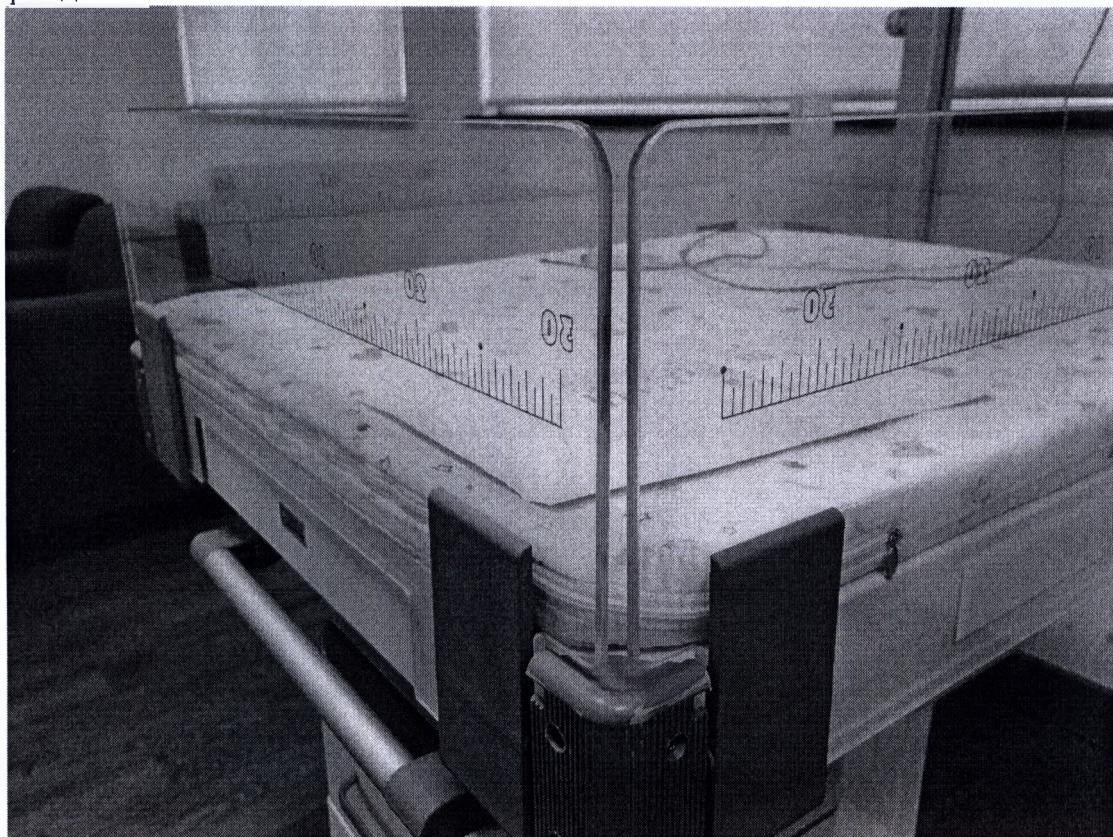


11. Датчик температуры кожи.

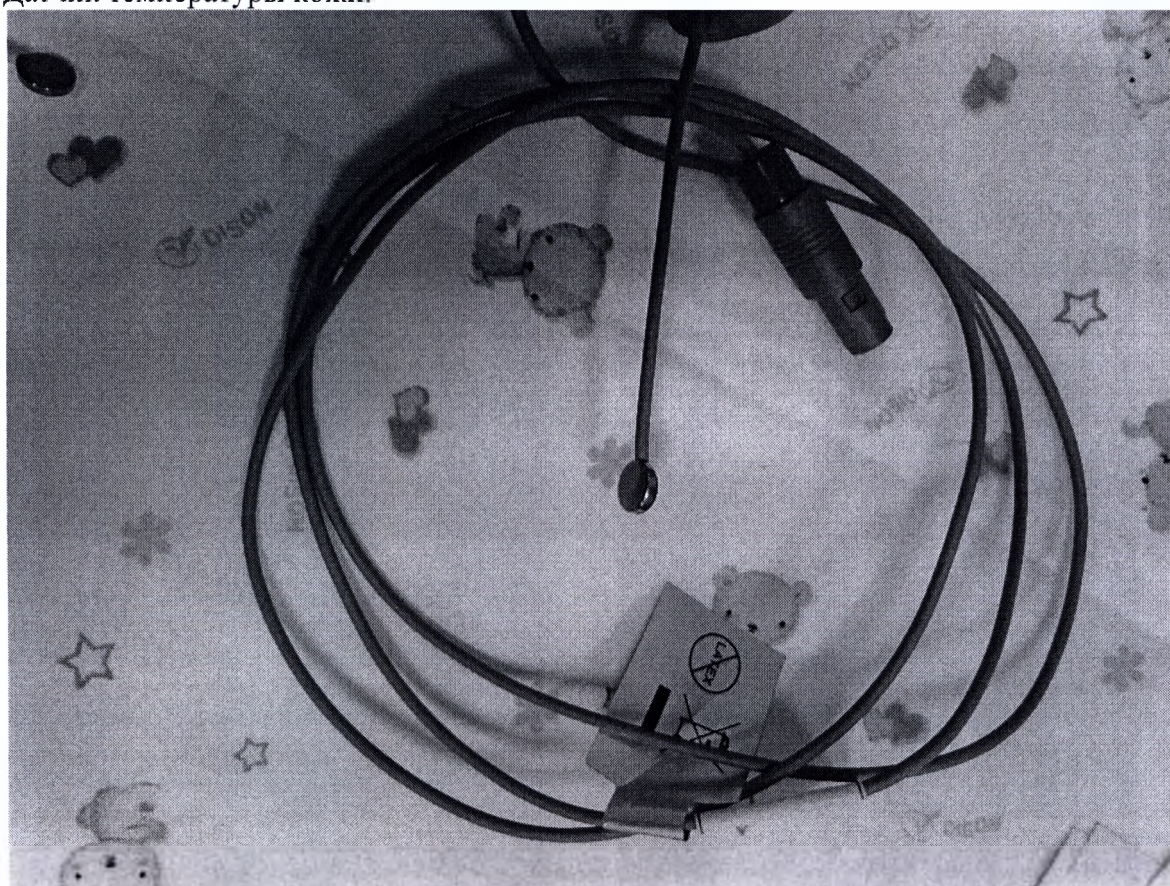


12. Матрас.

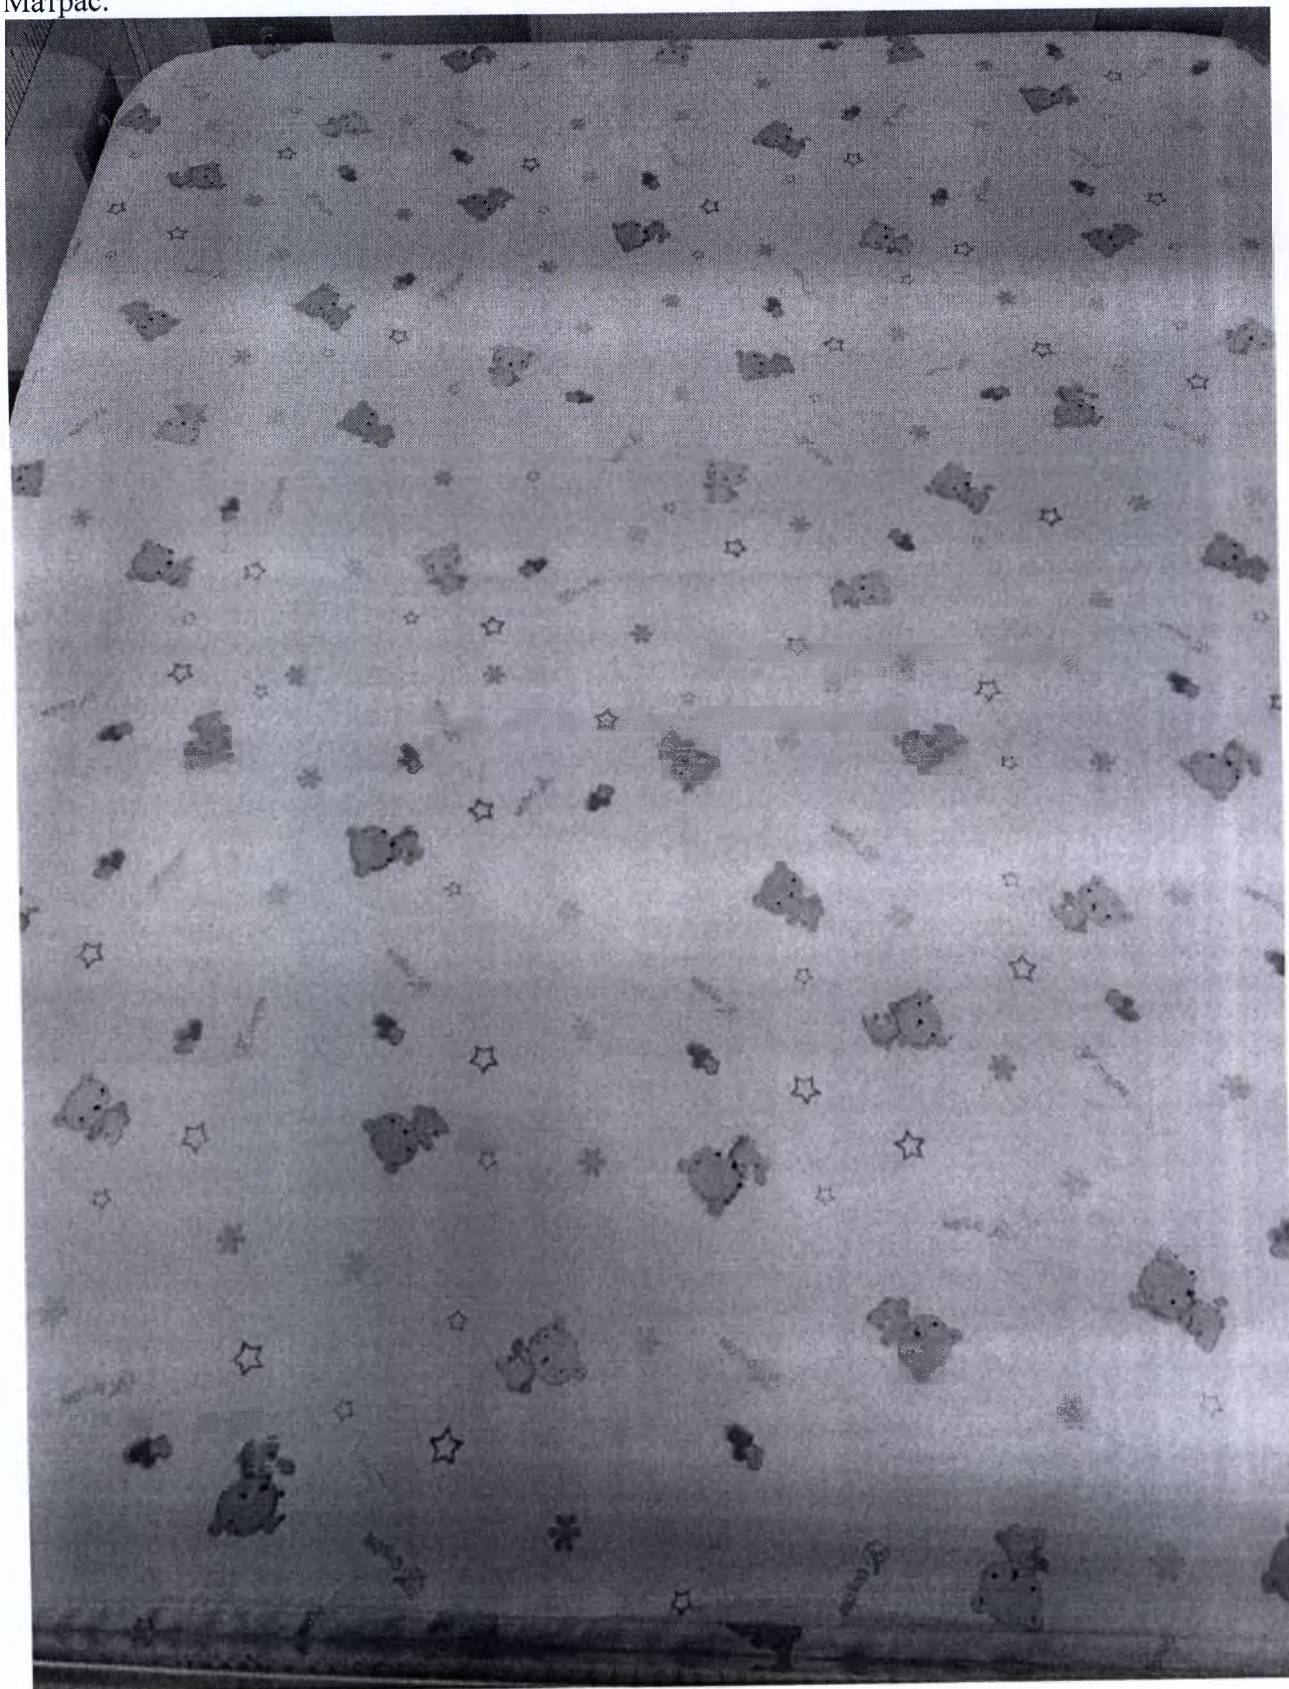


13. Стойка разборная.

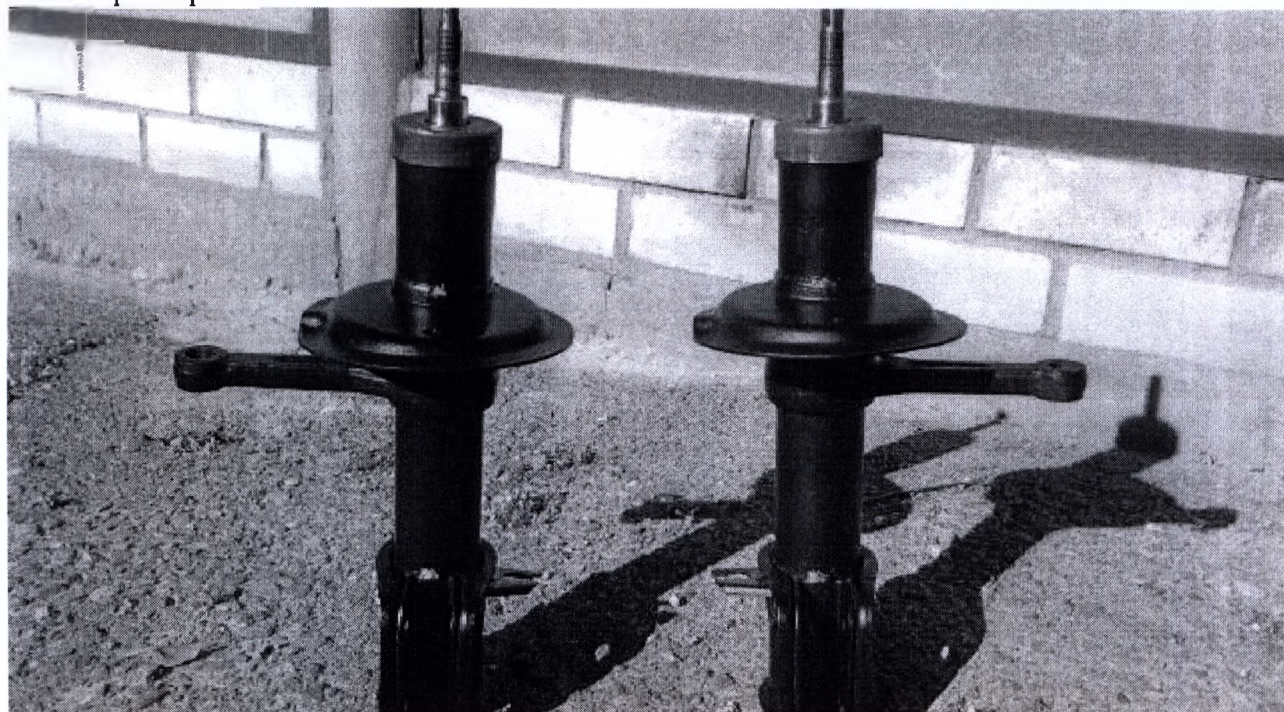


14. Лоток для кассеты рентгеновской.

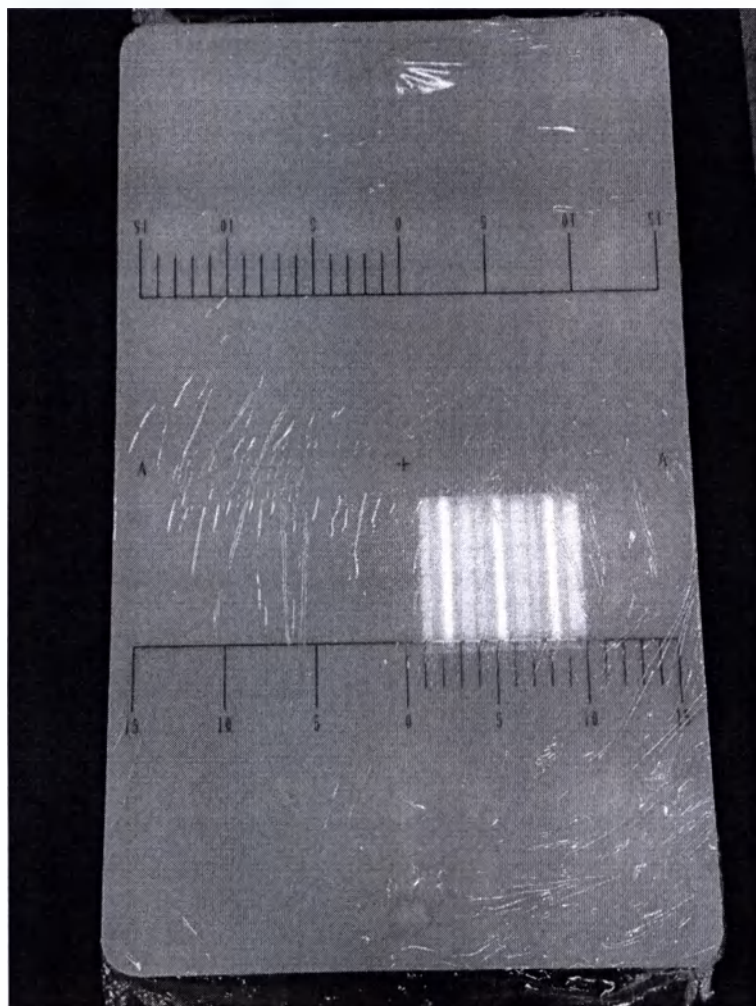

15. Регулятор наклона стола рабочего.

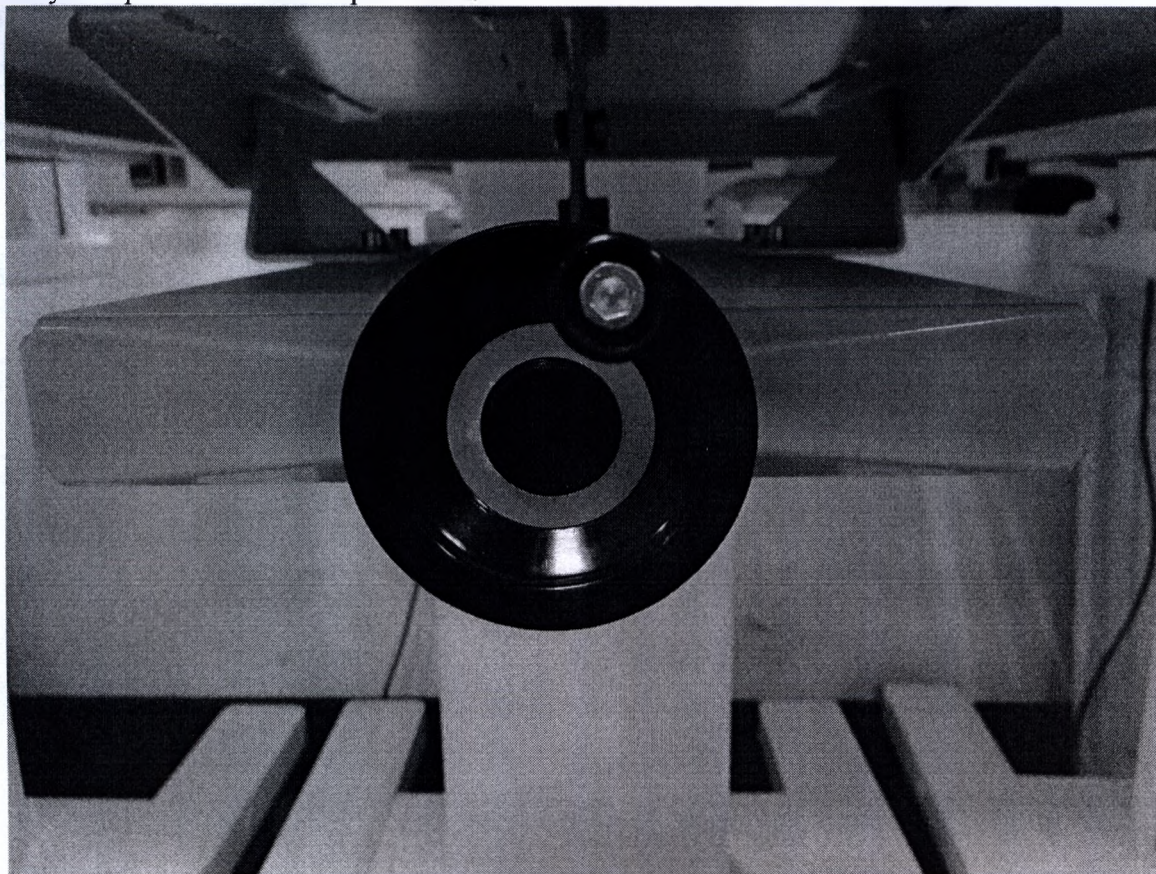

16. Ручки фиксации стола рабочего.

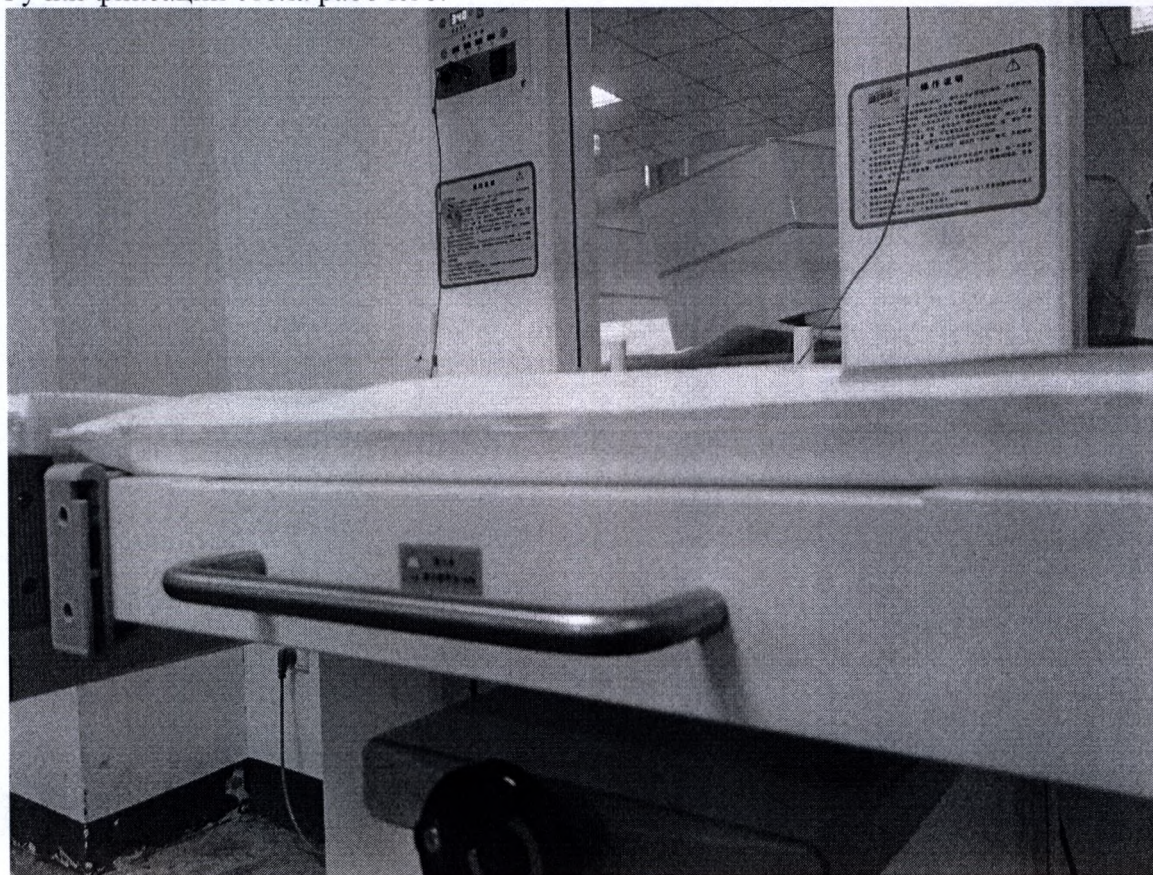

Генеральный директор

Белых В.А.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 13 листов.

