




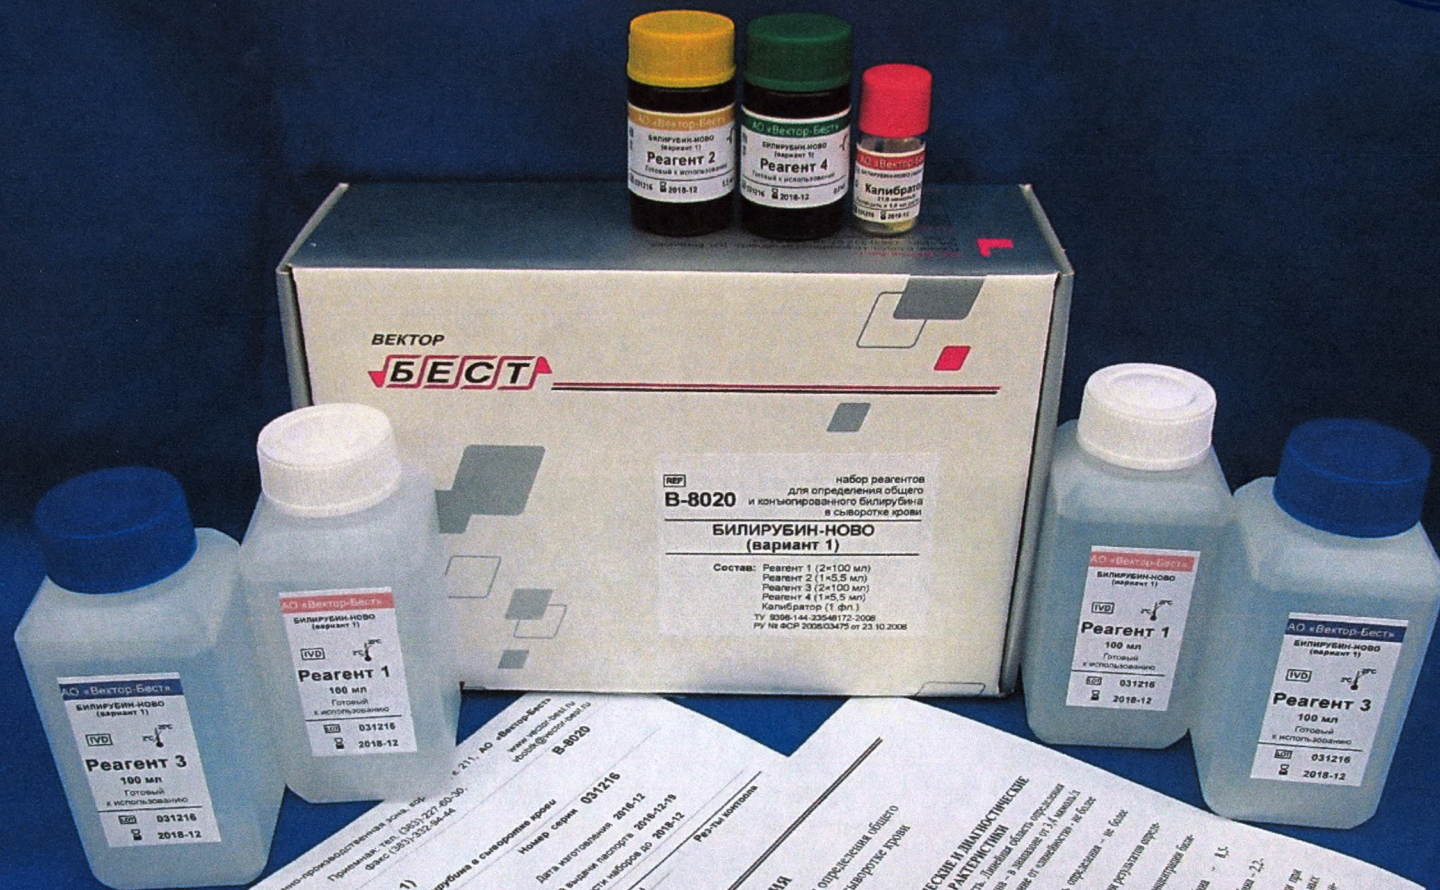

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 47
Для заказа: 8(800)111-1111, 8(8432)222-2222, факс: 8(8432)222-2222
Почтовый ящик: 8021117-1, Ново-Савиновский район, г. Казань, Республика Татарстан

ПАССПОРТ № 326718
БИЛИРУБИН-НОВО (вариант 2)
Набор реактивов для определения билирубина в сыворотке крови методом спектрофотометрии

ТУ 9399-144-2004/0173-2008
Использовать при температуре 2-8°C, допускать замораживание
Хранить при температуре 2-8°C, допускать замораживание

Дата изготовления: 2016-11
Дата окончания срока годности: 2018-11
Срок годности: 24 месяца со дня изготовления

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реактивов для определения билирубина в сыворотке крови методом спектрофотометрии

БИЛИРУБИН-НОВО
предназначен для количественного определения билирубина в сыворотке крови методом спектрофотометрии. Набор реактивов включает в себя: Реагент 1, Реагент 2, Реагент 3, Реагент 4, Калибратор.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реактивов предназначен для определения билирубина в сыворотке крови методом спектрофотометрии.

2. ПРИМЕНЕНИЕ
Набор реактивов применяется для определения билирубина в сыворотке крови методом спектрофотометрии.

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Билирубин в сыворотке крови реагирует с Реагентом 1, образуя комплекс, который поглощает свет на длине волны 465 нм.

4. МЕТОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Билирубин в сыворотке крови определяется методом спектрофотометрии.