


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов, предназначенный для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови (Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«28» 05 2020 г.

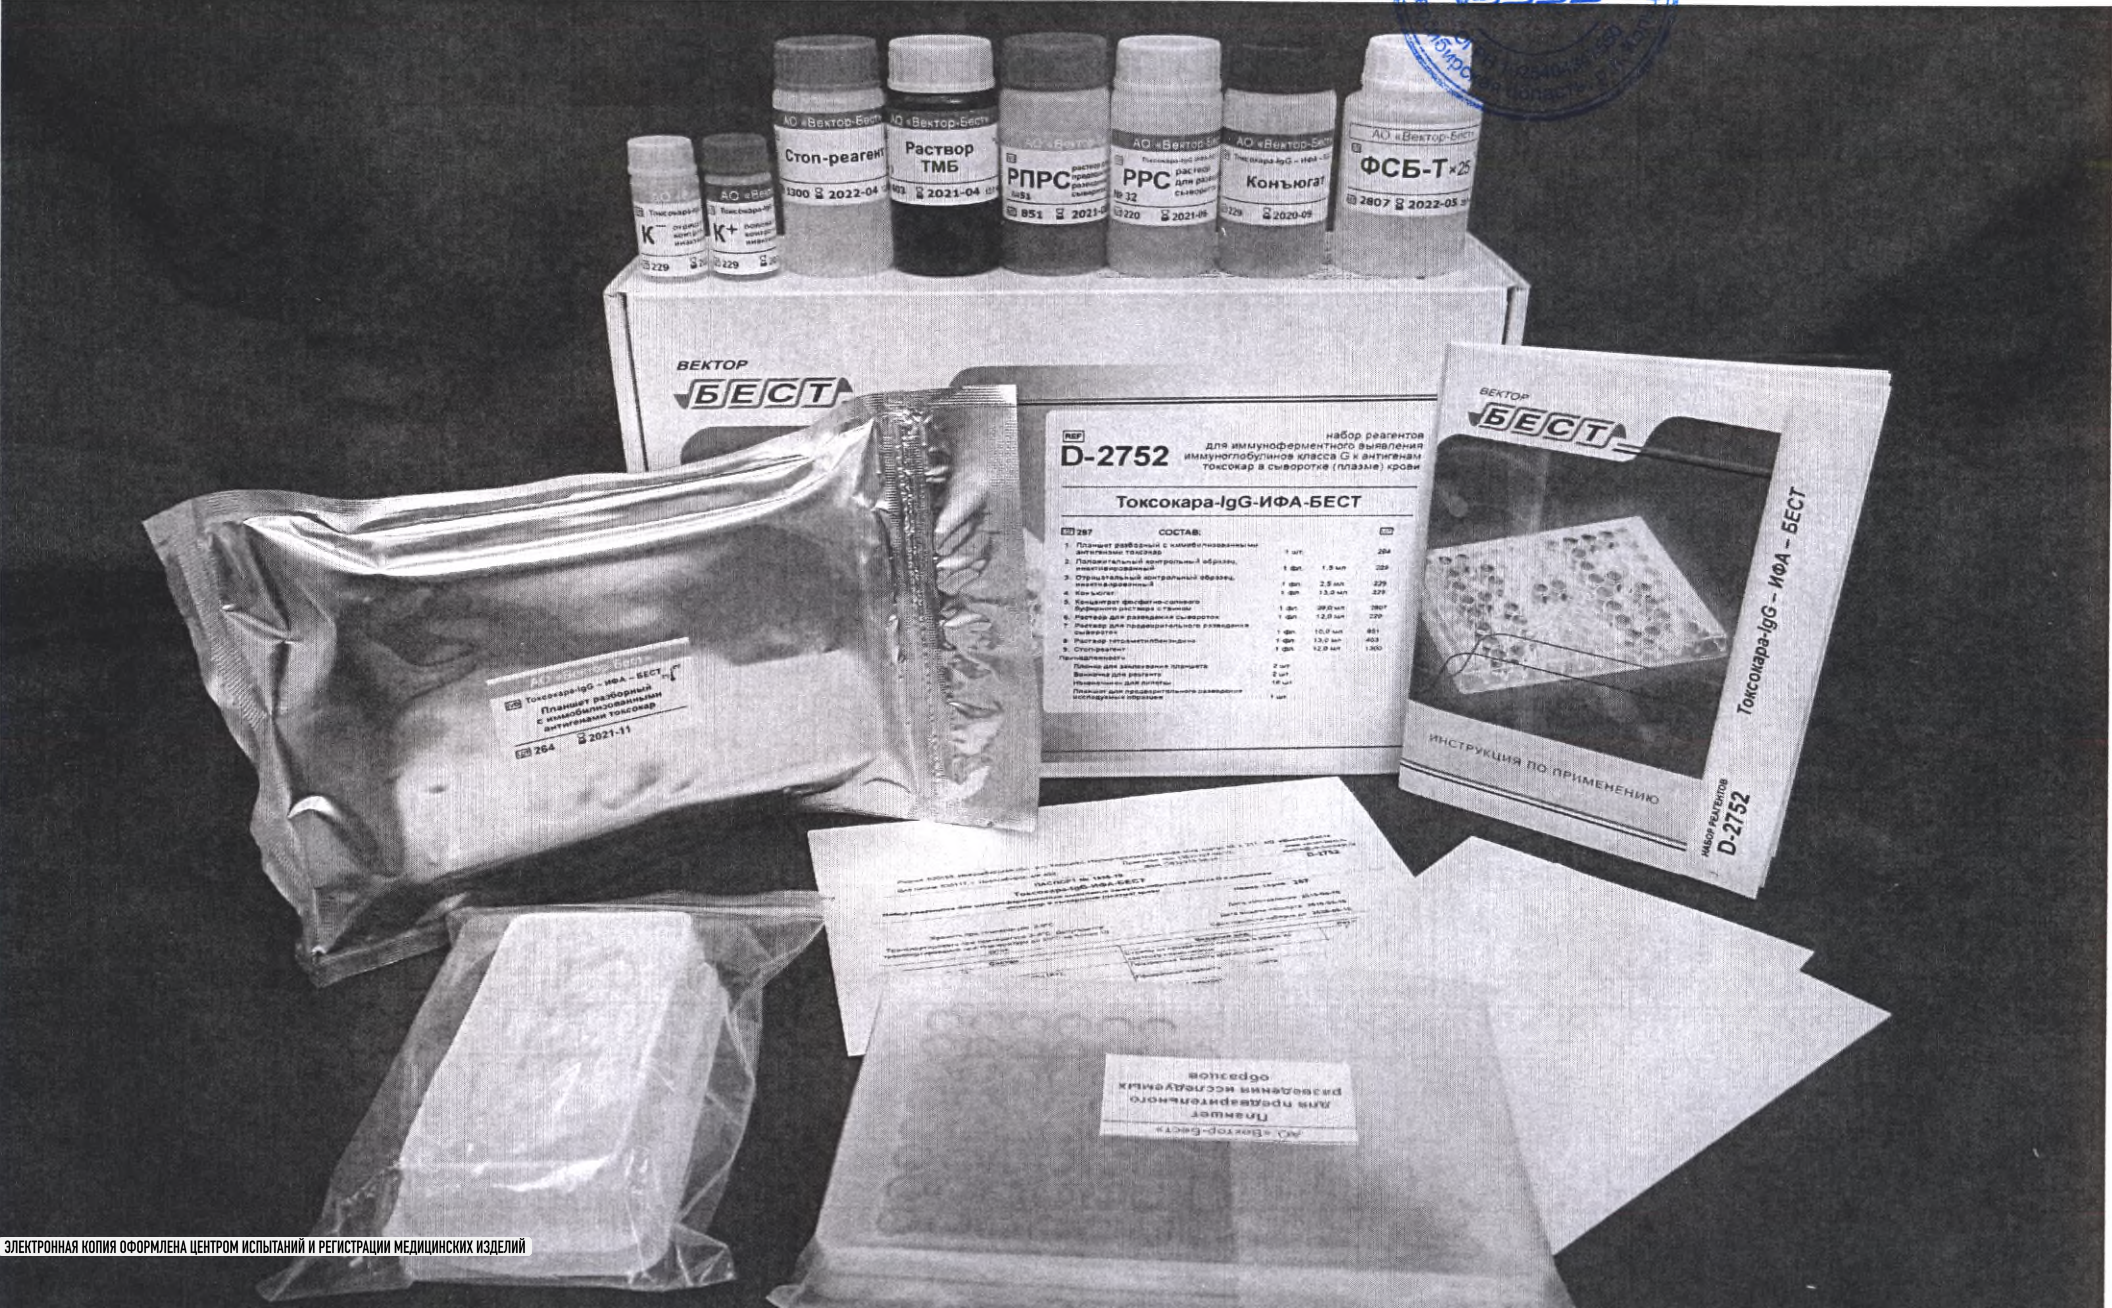


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов, предназначенный для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови (Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




28.05.2020 г.

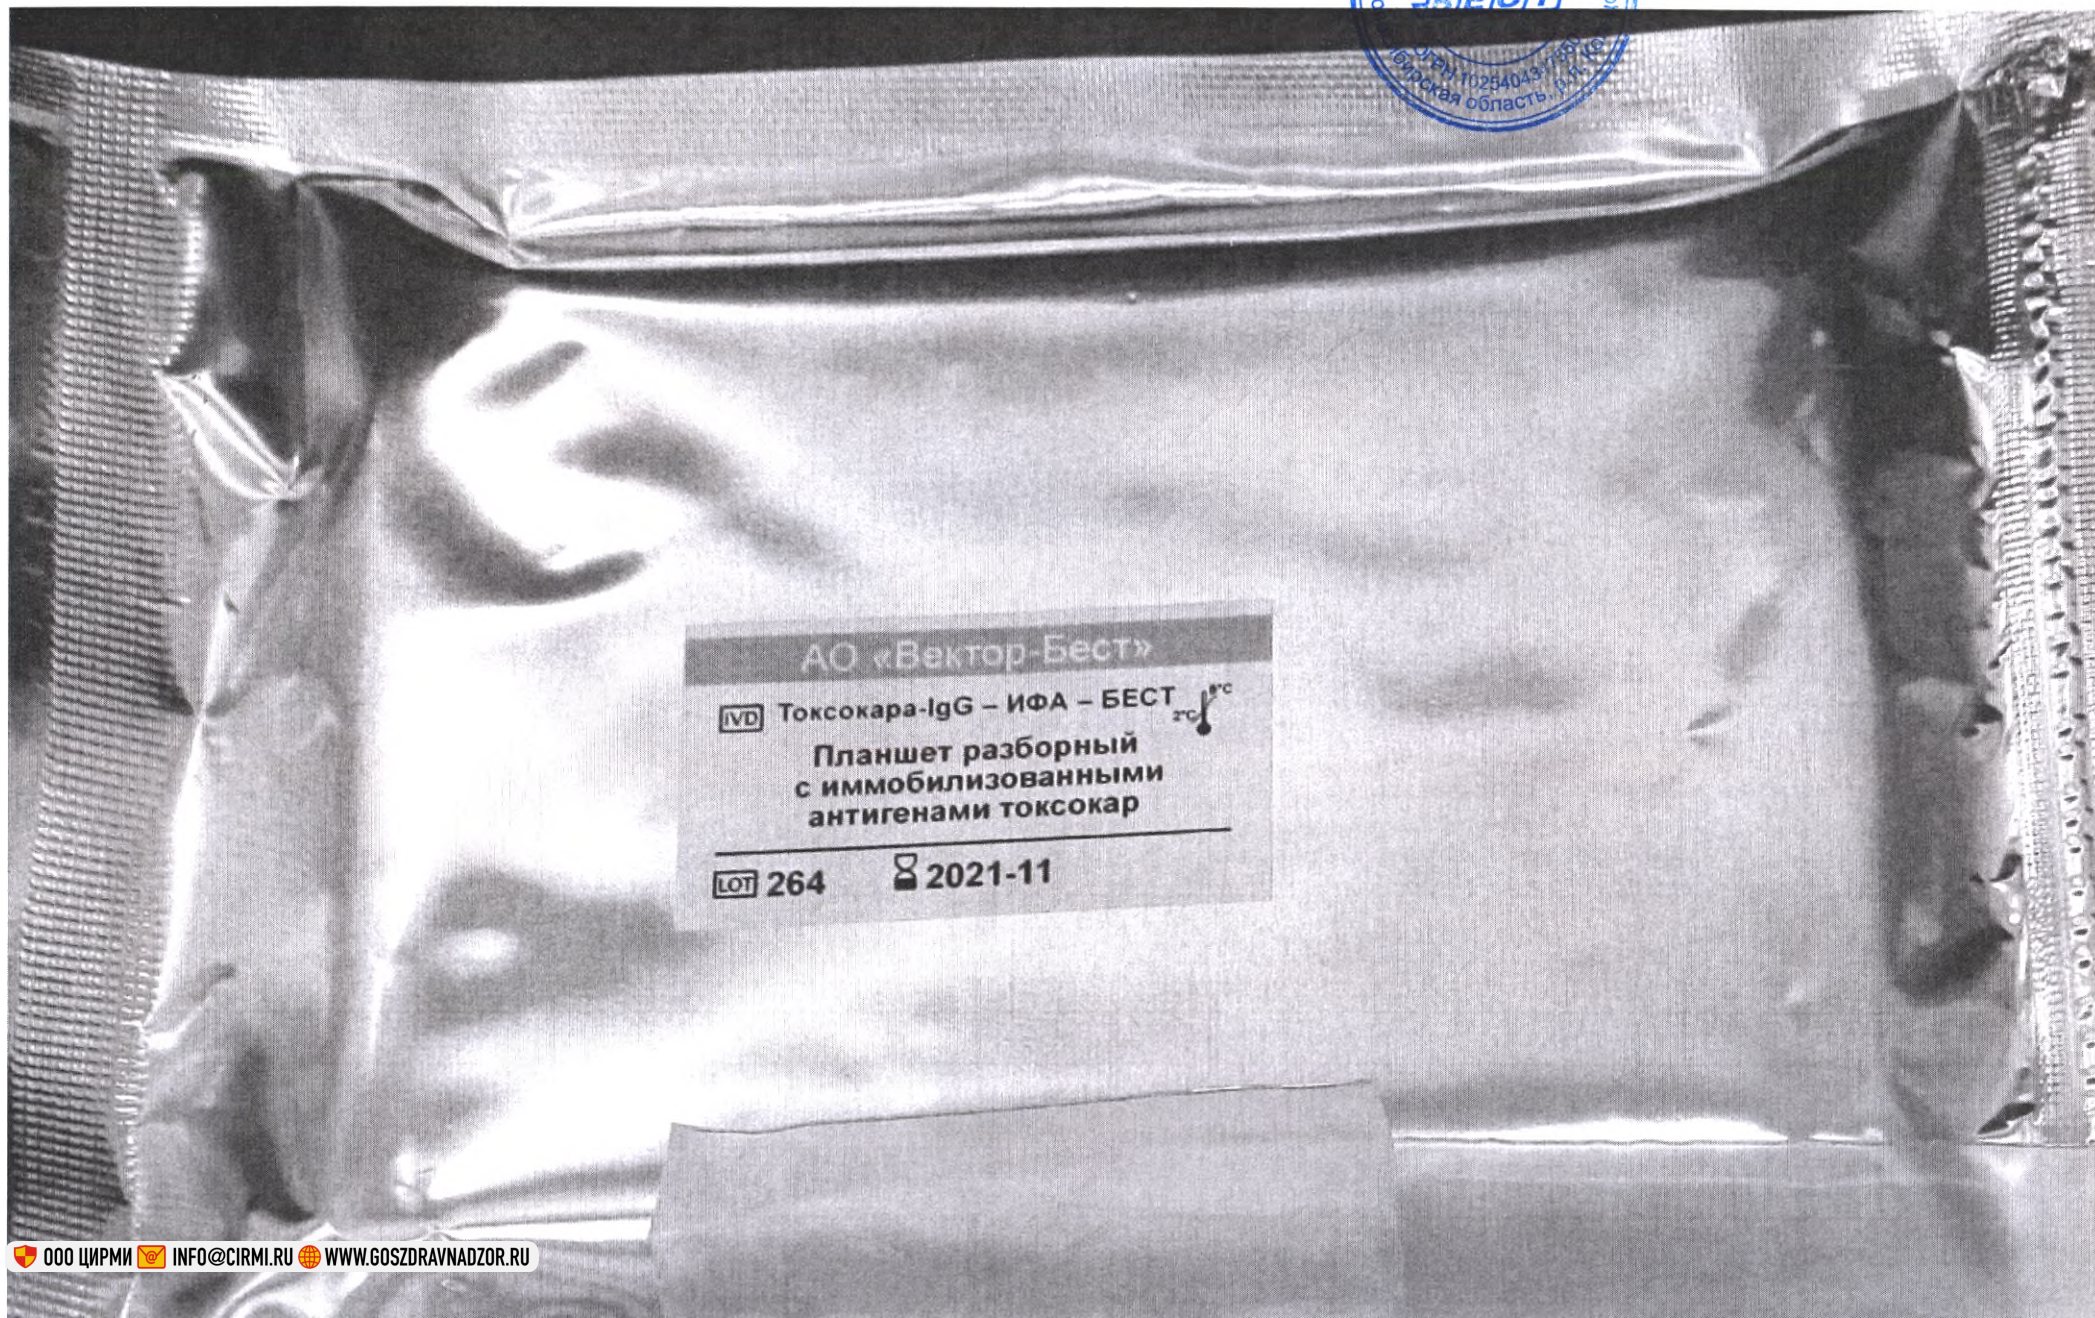

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов, предназначенный для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови (Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«28» 05 2020 г.

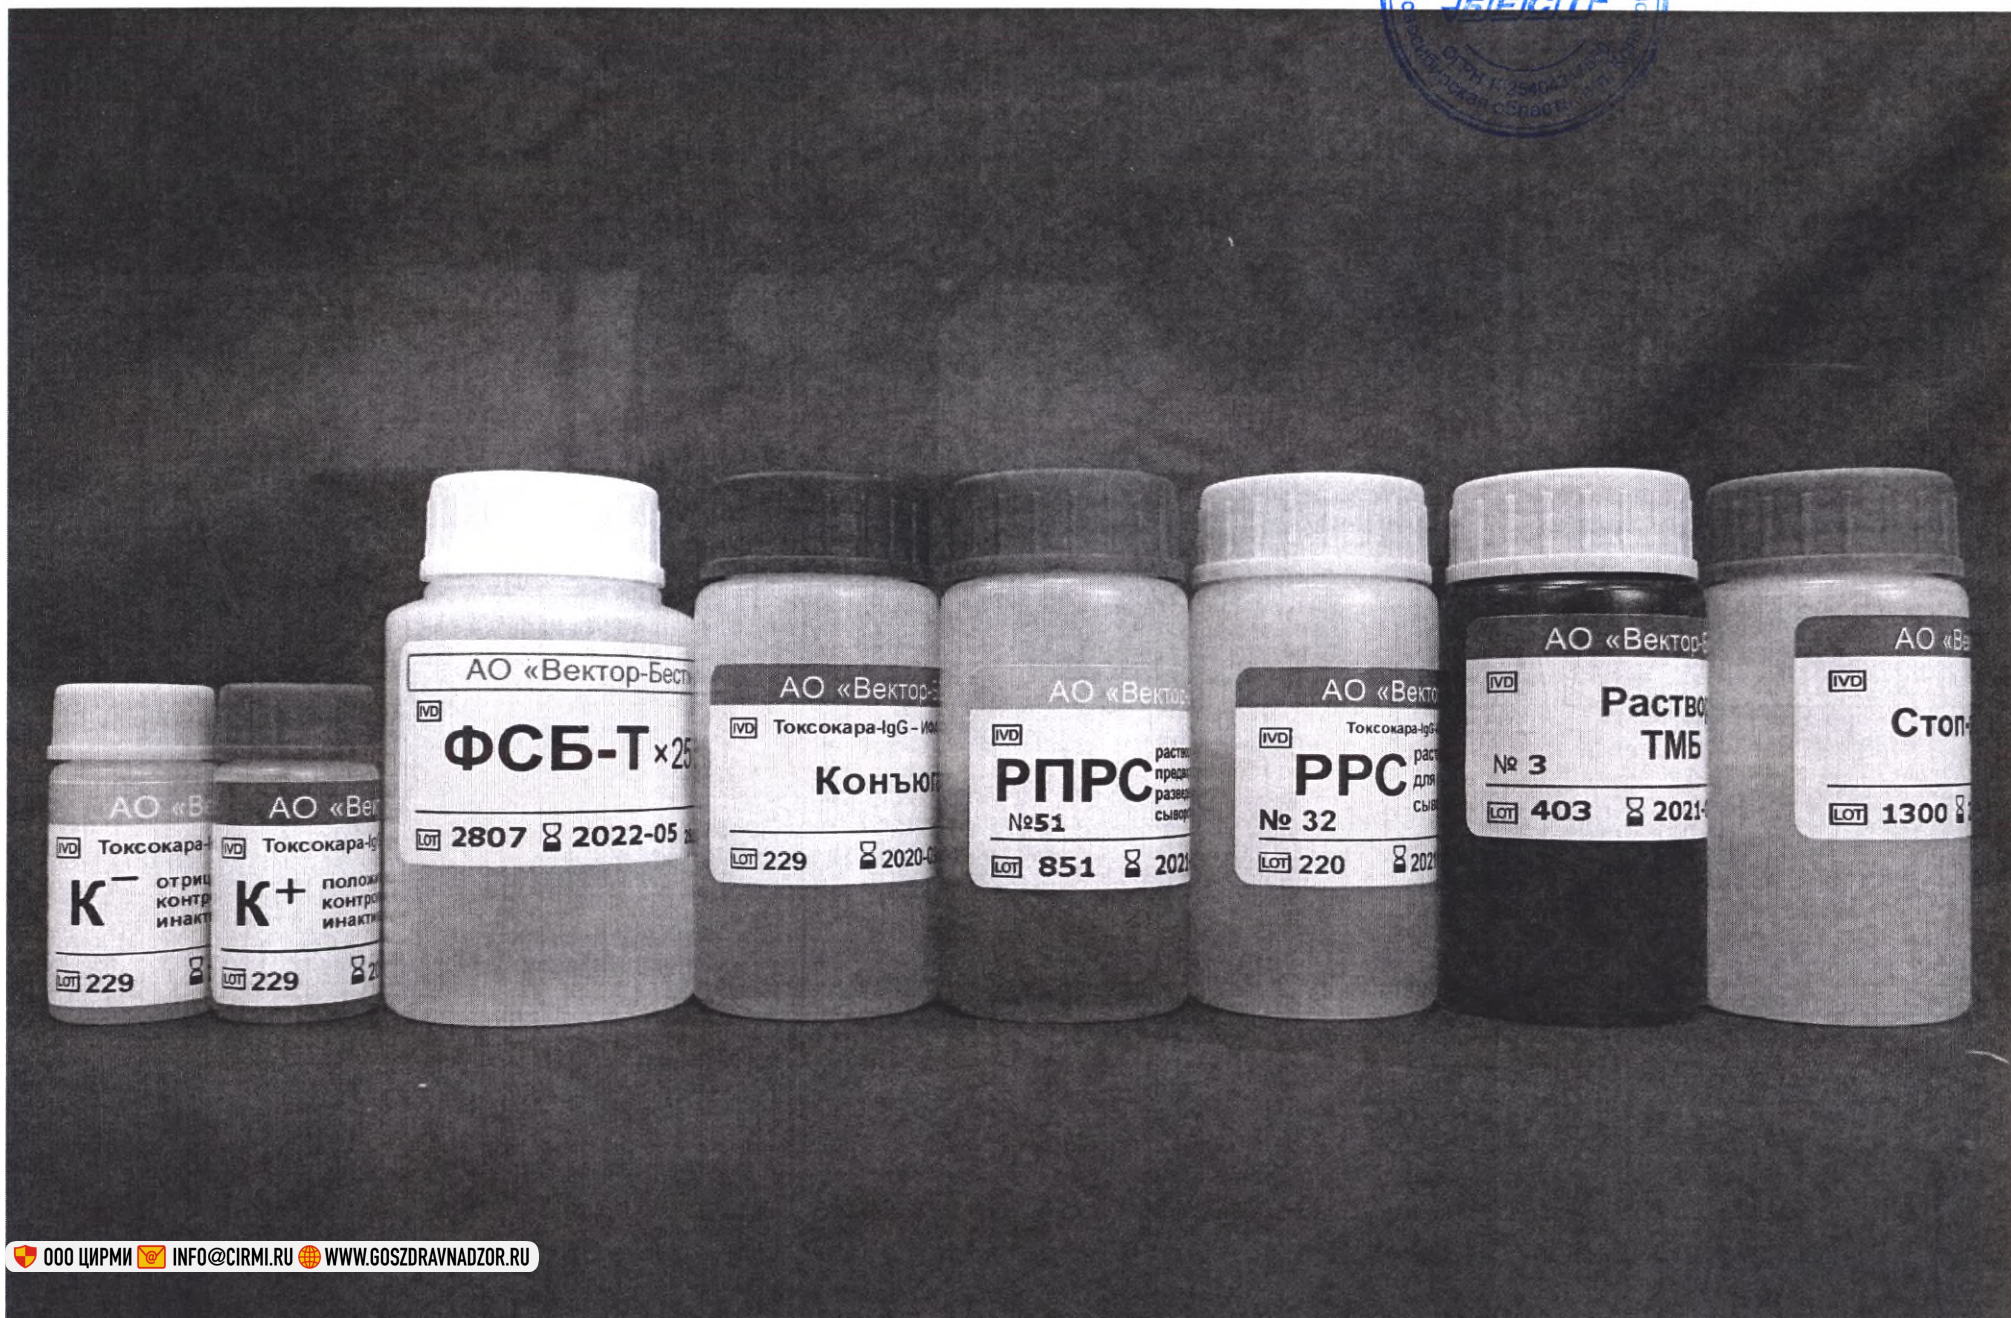

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов, предназначенный для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови (Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

05 2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов, предназначенный для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови (Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«28» 05

2020 г.

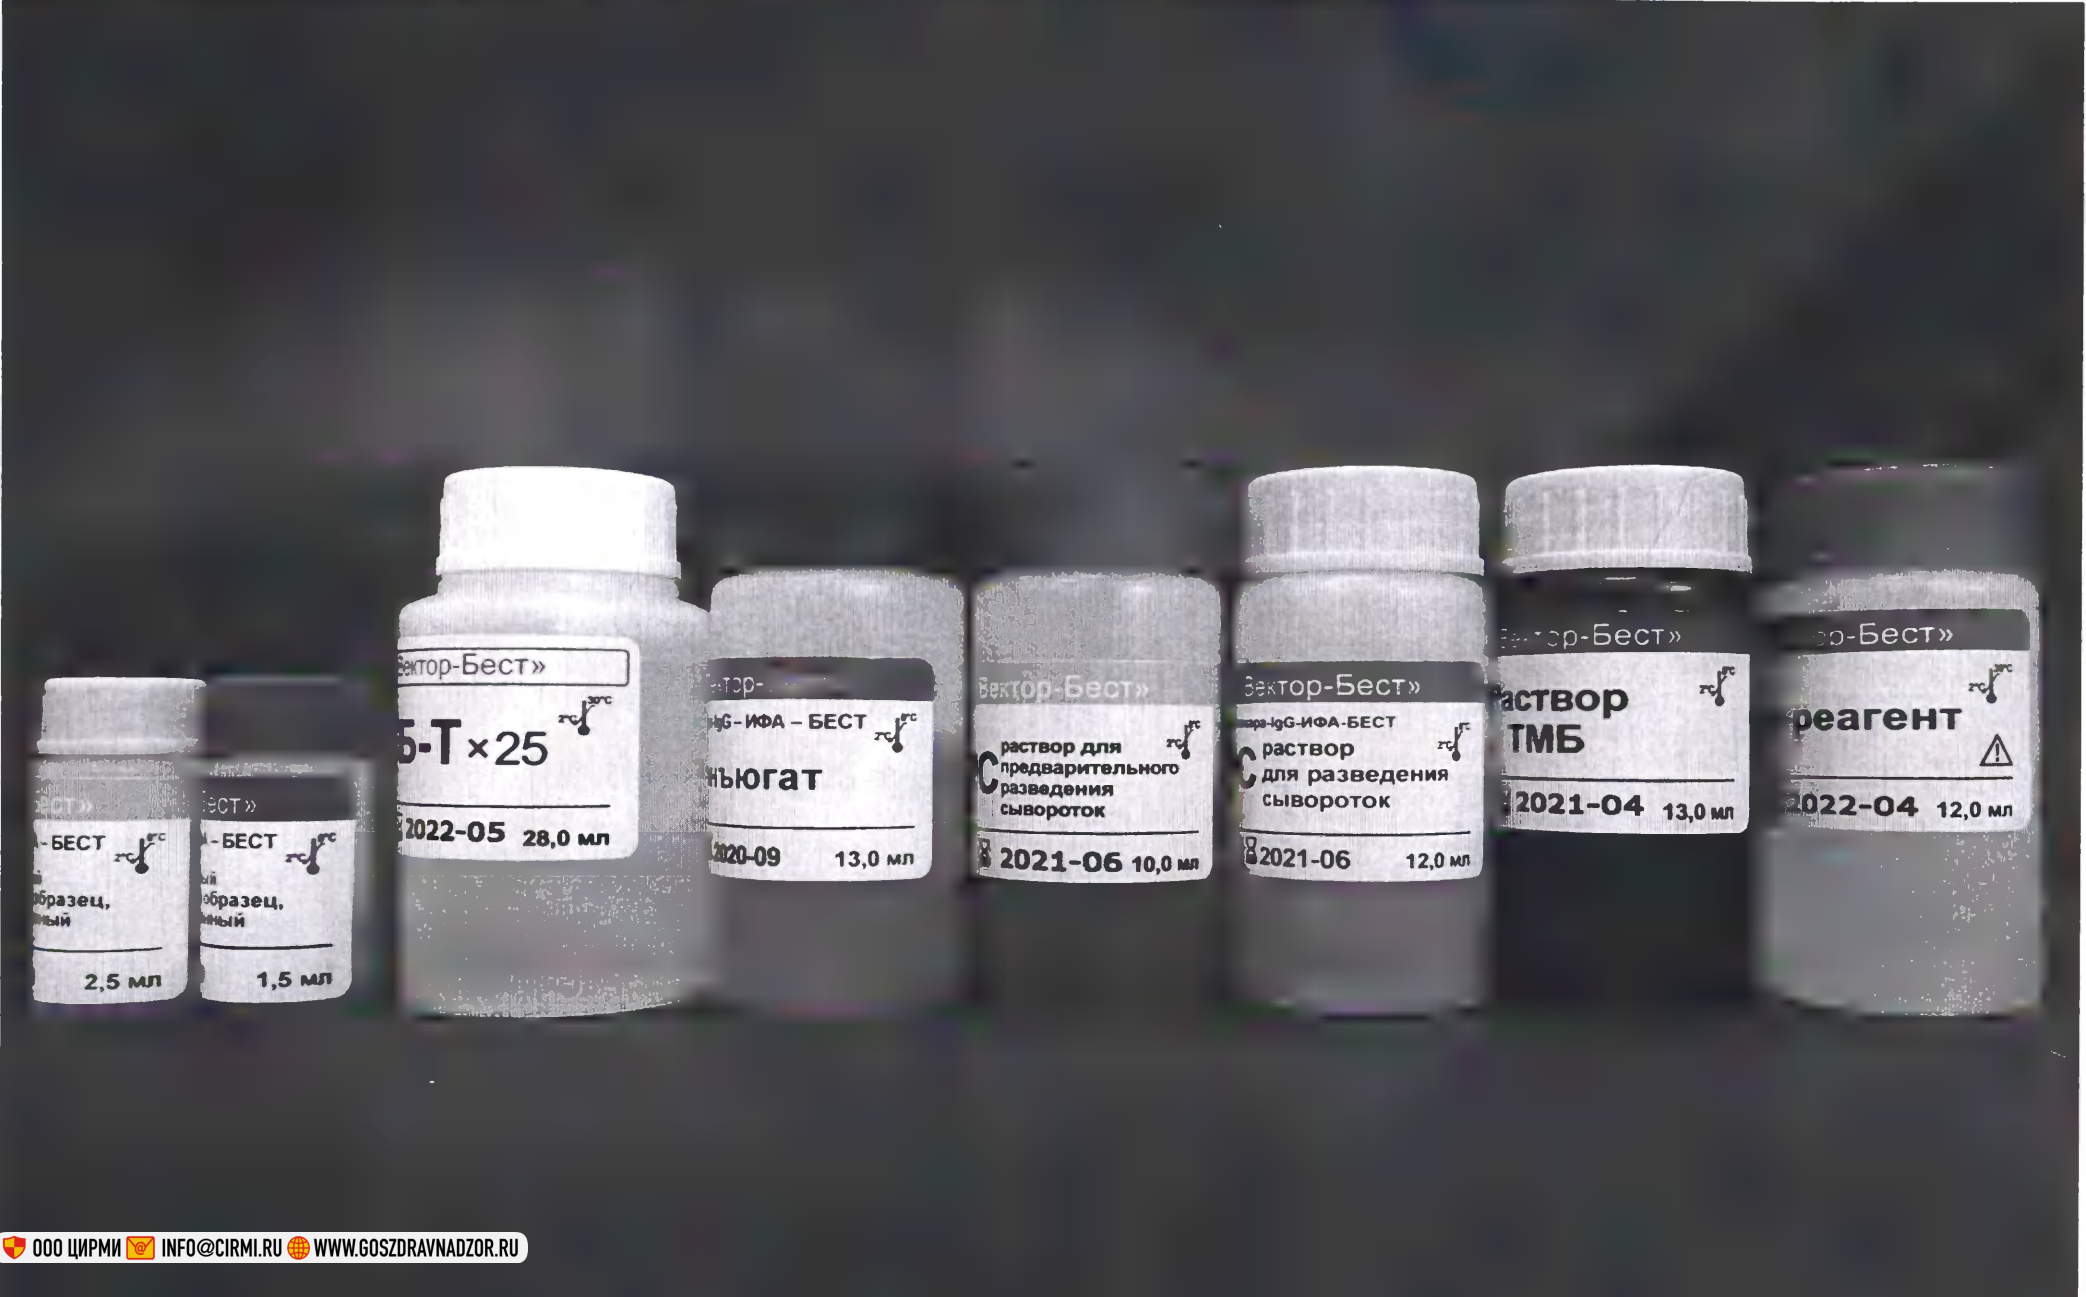

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов, предназначенный для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови (Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.

«28» 05 2020 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-2752

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G к антигенам
токсокар в сыворотке (плазме) крови

Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ

LOT 287

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными антигенами токсокар	1 шт.	264
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	229
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 2,5 мл	229
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	229
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2807
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	220
7. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл. 10,0 мл	851
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл	403
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1300

Принадлежности:

Пленка для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночка для реагента	2 шт.
Наконечники для пипетки	16 шт.
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов, предназначенный для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови (Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ)» № 2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «28» 05 2020 г.




ВЕКТОР

БЕСТ

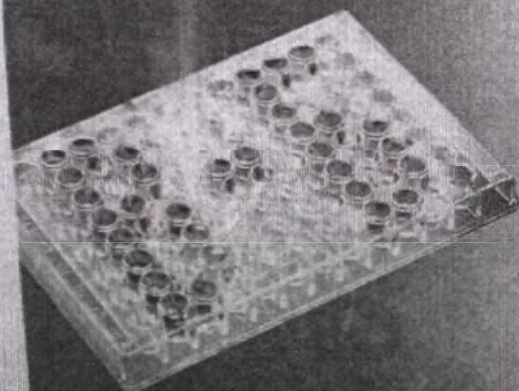

REF **D-2752**




LOT

287

ТУ 9398-395-23548172-2012

ПУ № РЗН 2013/1307 от 07.04.2017



2019-06-10

2020-06-10

Токсокара-IgG-ИФА-БЕСТ

IVD



27521006200028700532

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита C и HBsAg отсутствуют