


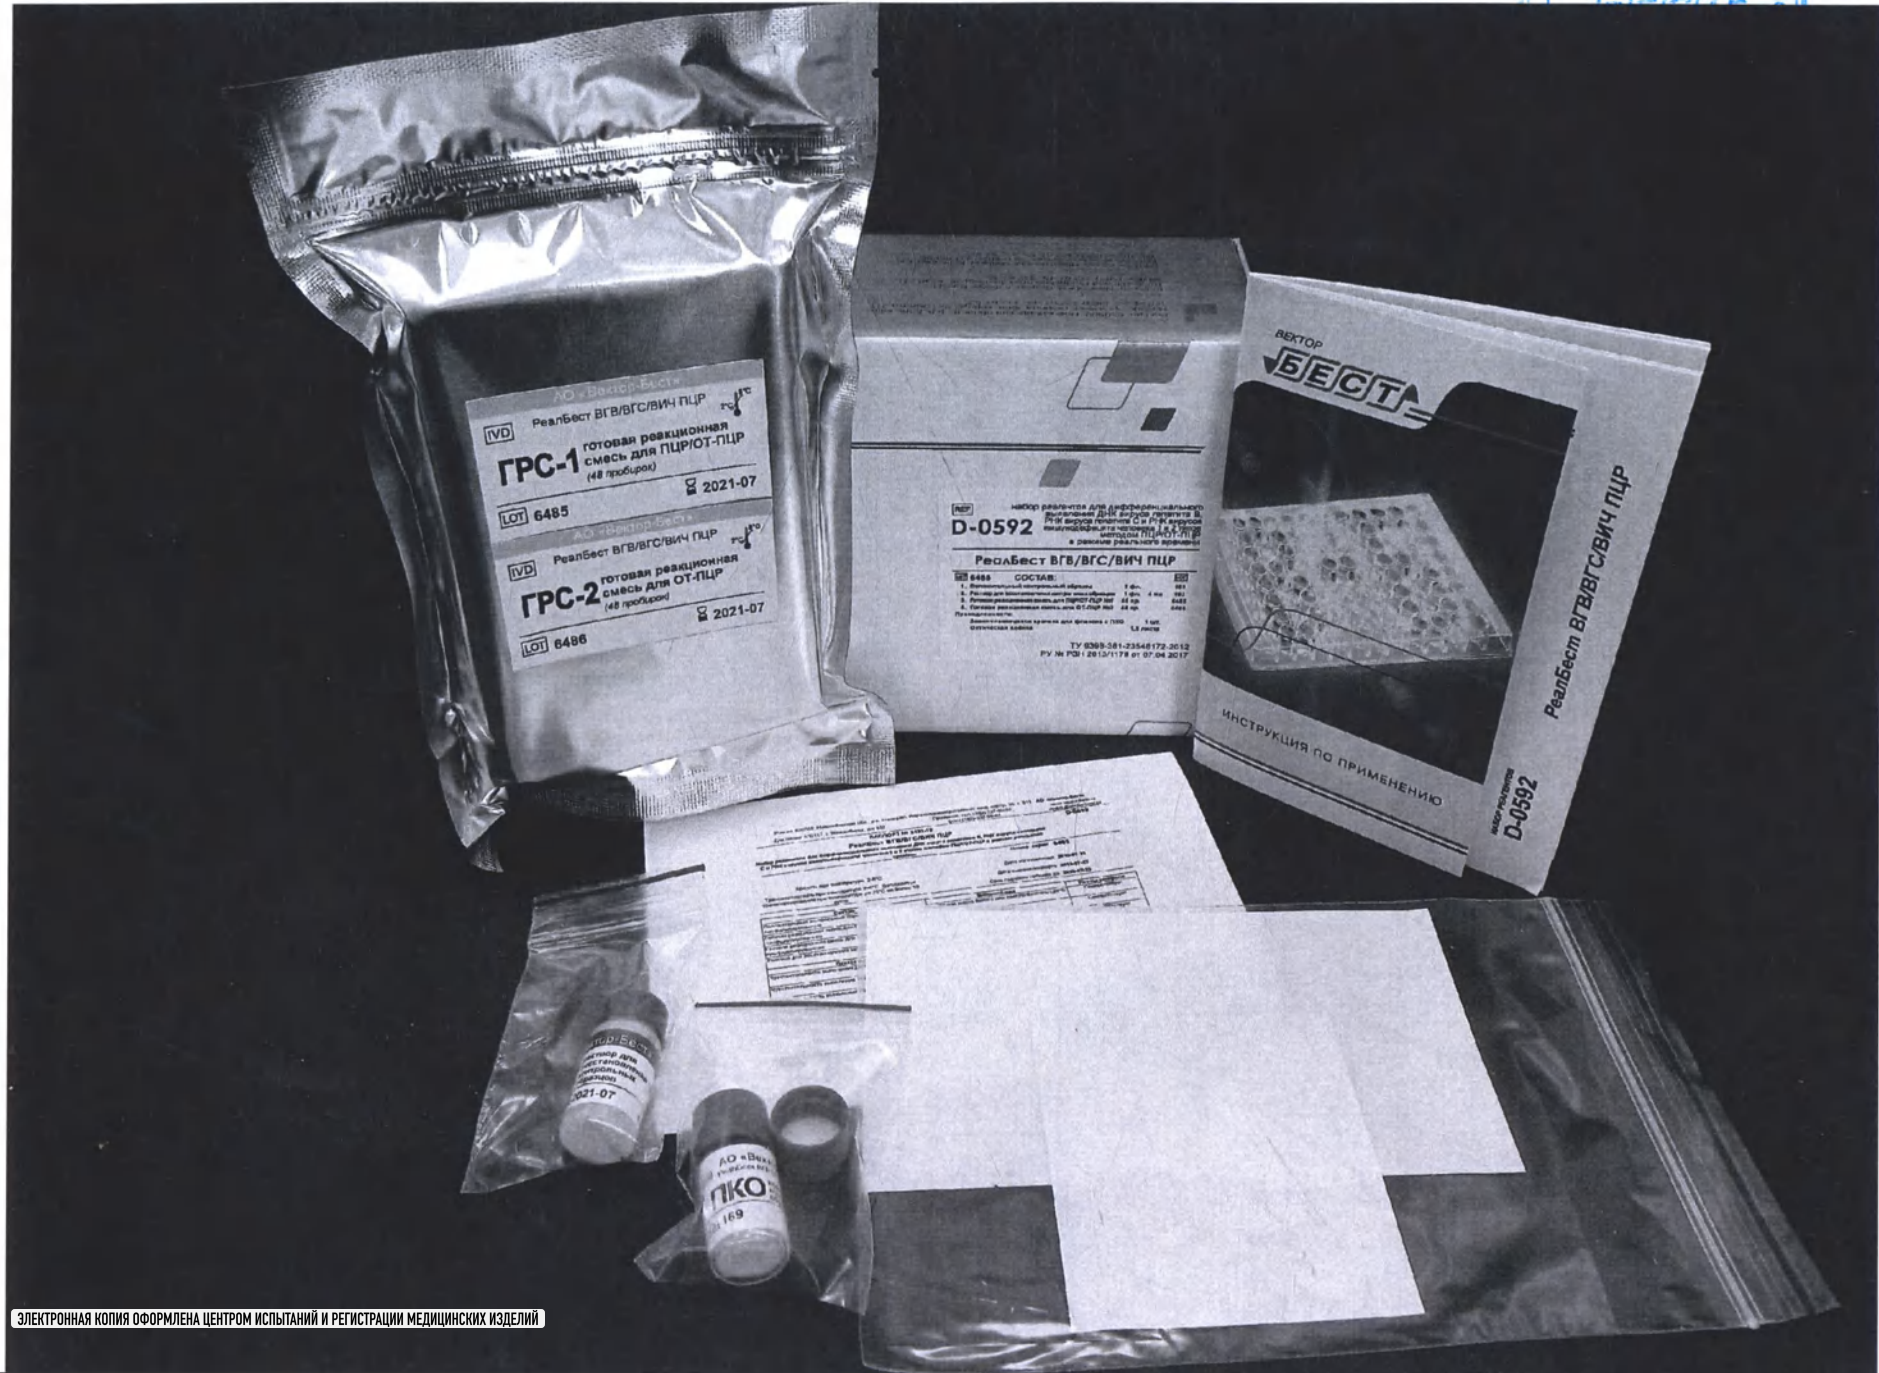

БЕКТОР

БЕСТ

REF

D-0592

набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С и РНК вирусов иммунодефицита человека 1 и 2 типов методом ПЦР/ОТ-ПЦР в режиме реального времени

РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР

LOT 6485

СОСТАВ:

LOT

1. Положительный контрольный образец	1 фл.	169
2. Раствор для восстановления контрольных образцов	1 фл. 4 мл	103
3. Готовая реакционная смесь для ПЦР/ОТ-ПЦР №1	48 пр.	6485
4. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР №2	48 пр.	6486

Принадлежности:

Завинчивающаяся крышка для флакона с ПКО	1 шт.
Оптическая плёнка	1,5 листа


ТУ 9398-381-23548172-2012
ПУ № РЗН 2013/1179 от 07.04.2017

БЕКТОР

БЕСТ

REF **D-0592**

LOT **6485**



IVD

Σ 48



2019-07-23

2020-07-23

РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР



05922307200648500159



Для профессионального применения



IVD

РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР



ГРС-1 готовая реакционная
смесь для ПЦР/ОТ-ПЦР
(48 пробирок)

LOT

6485



2021-07

АО «Вектор-Бест»

IVD

РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР




ГРС-2 готовая реакционная
смесь для ОТ-ПЦР
(48 пробирок)

LOT


6486



2021-07

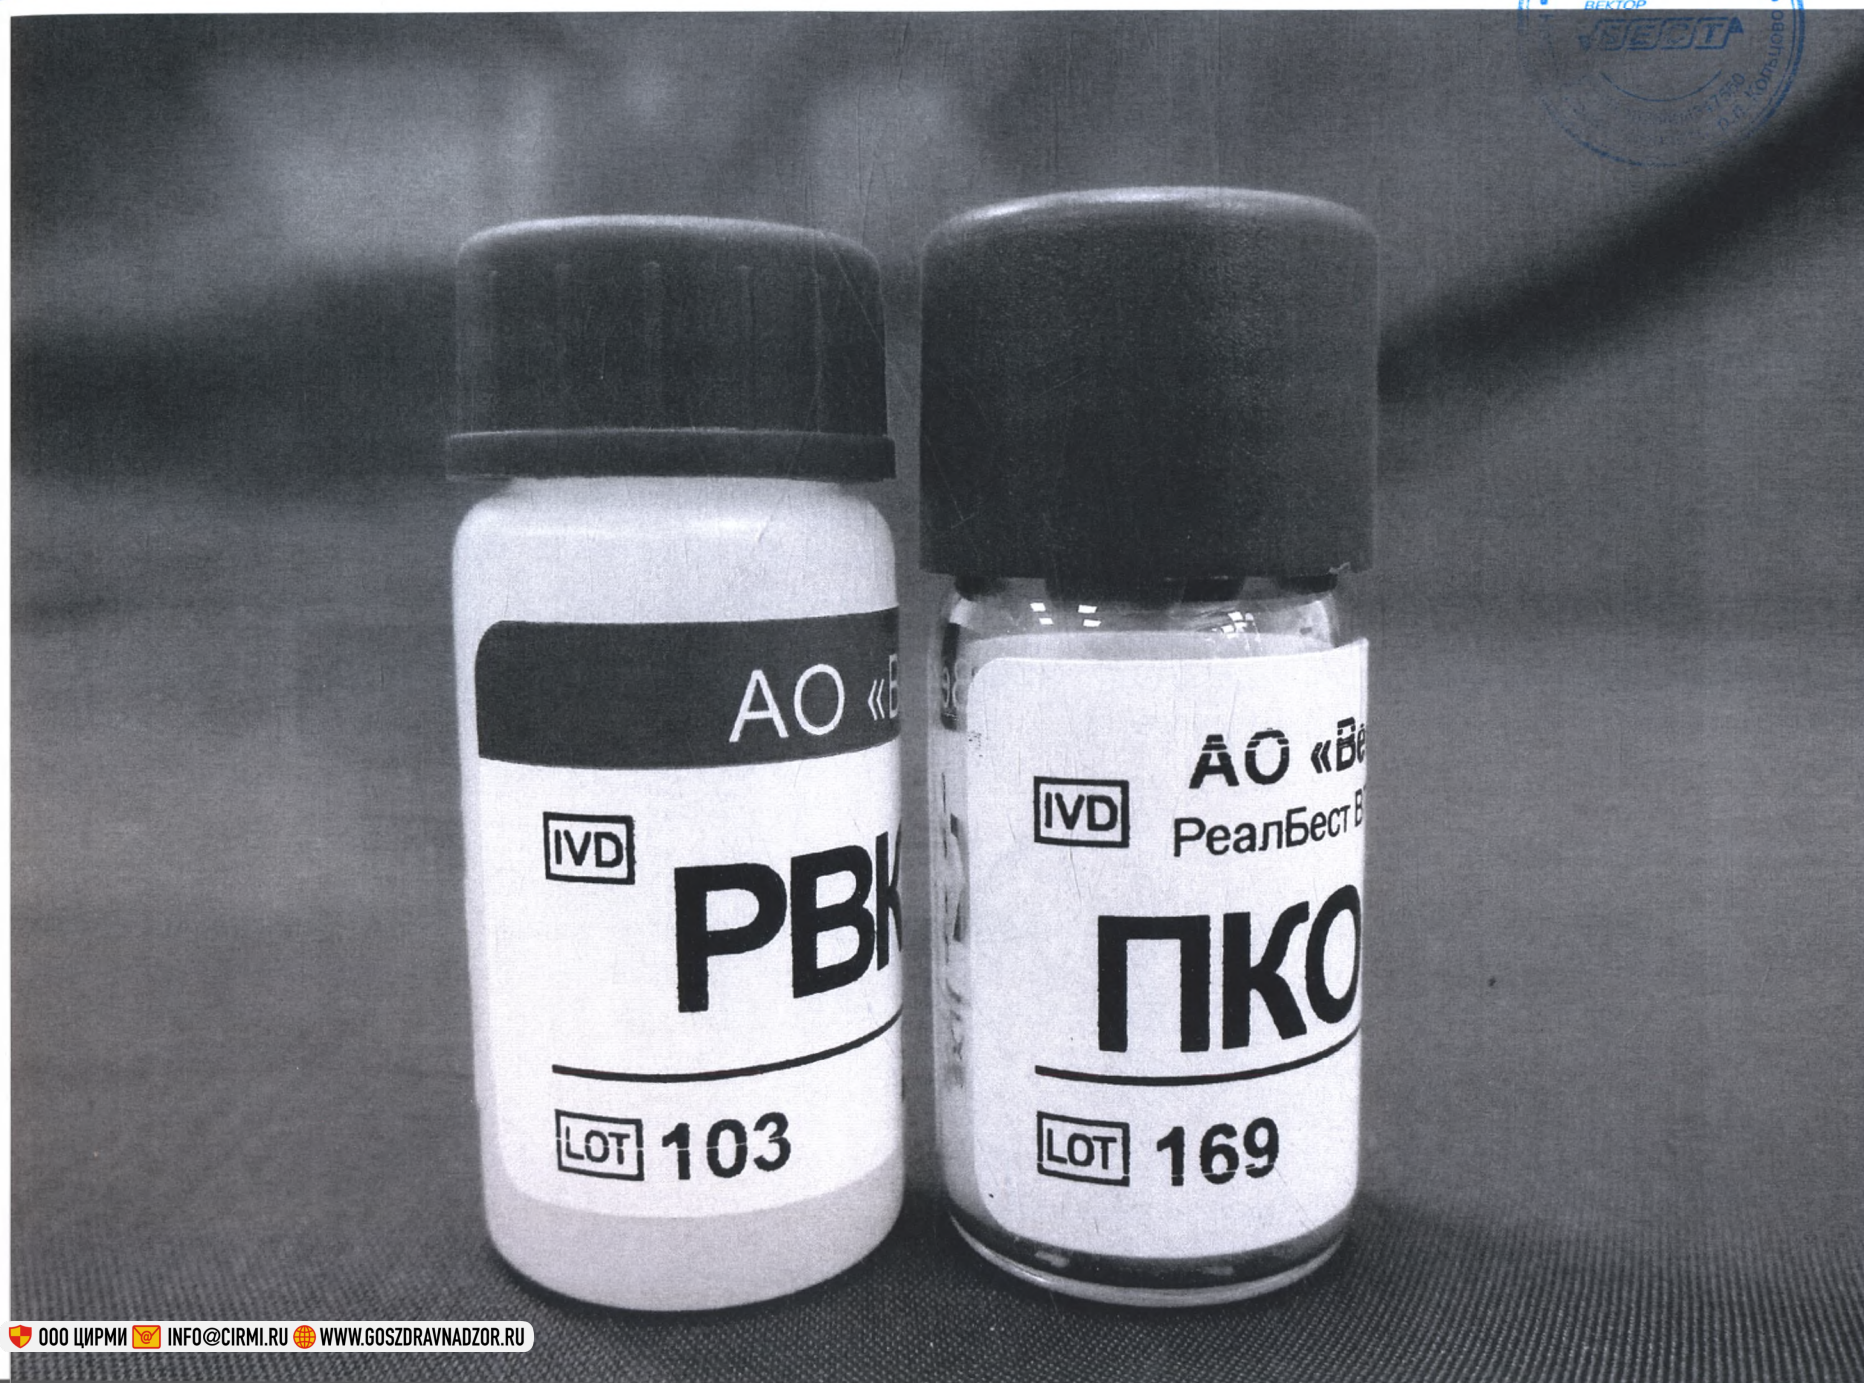



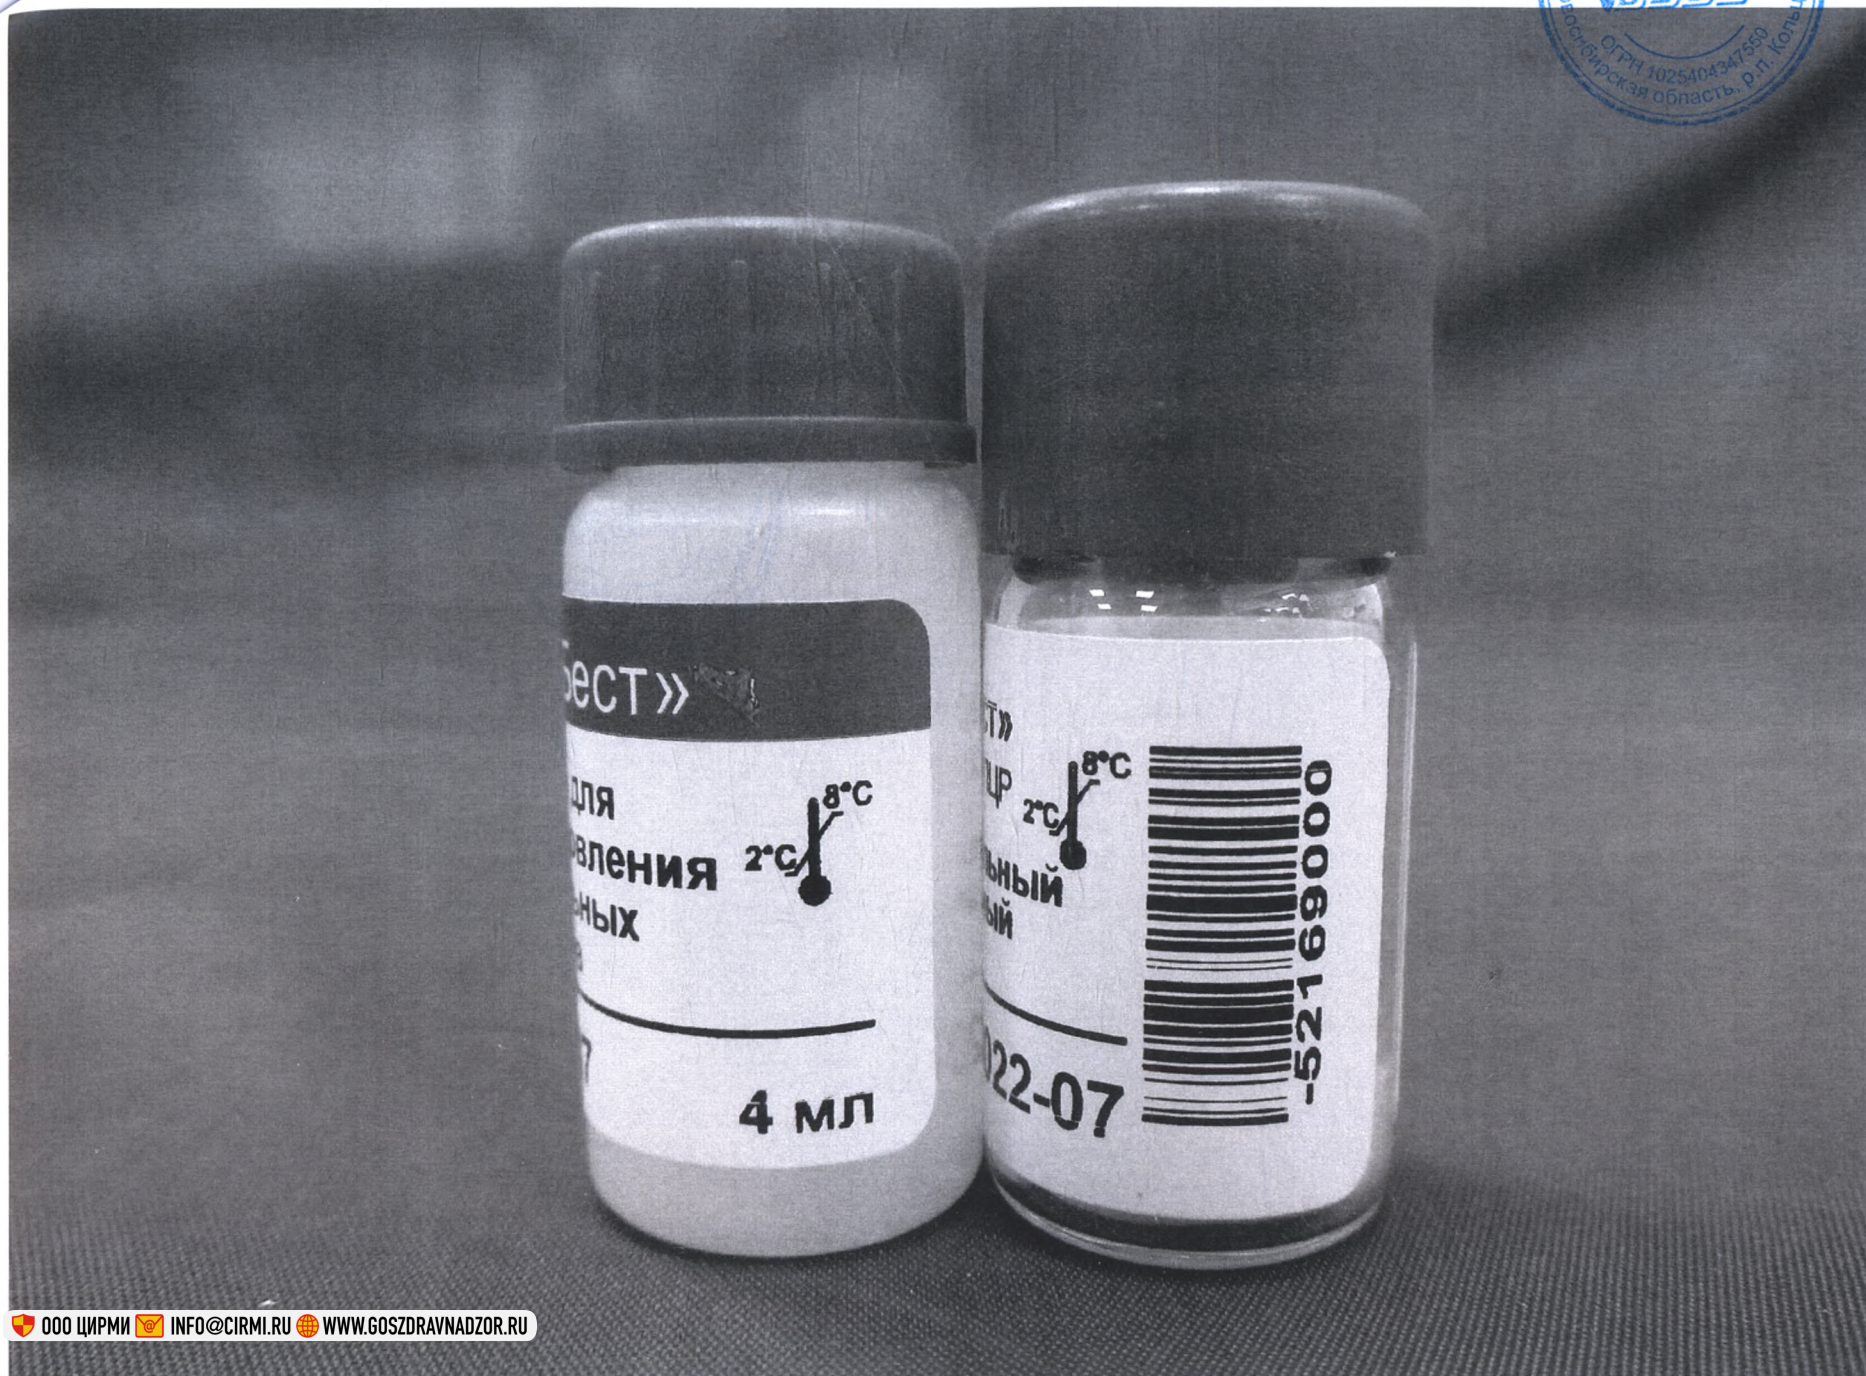

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 7 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



Масяго А.В.

201 г.