


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma genitalium* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Mycoplasma genitalium*)» (Комплект 1)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«06» ФЕВ 2020 г.

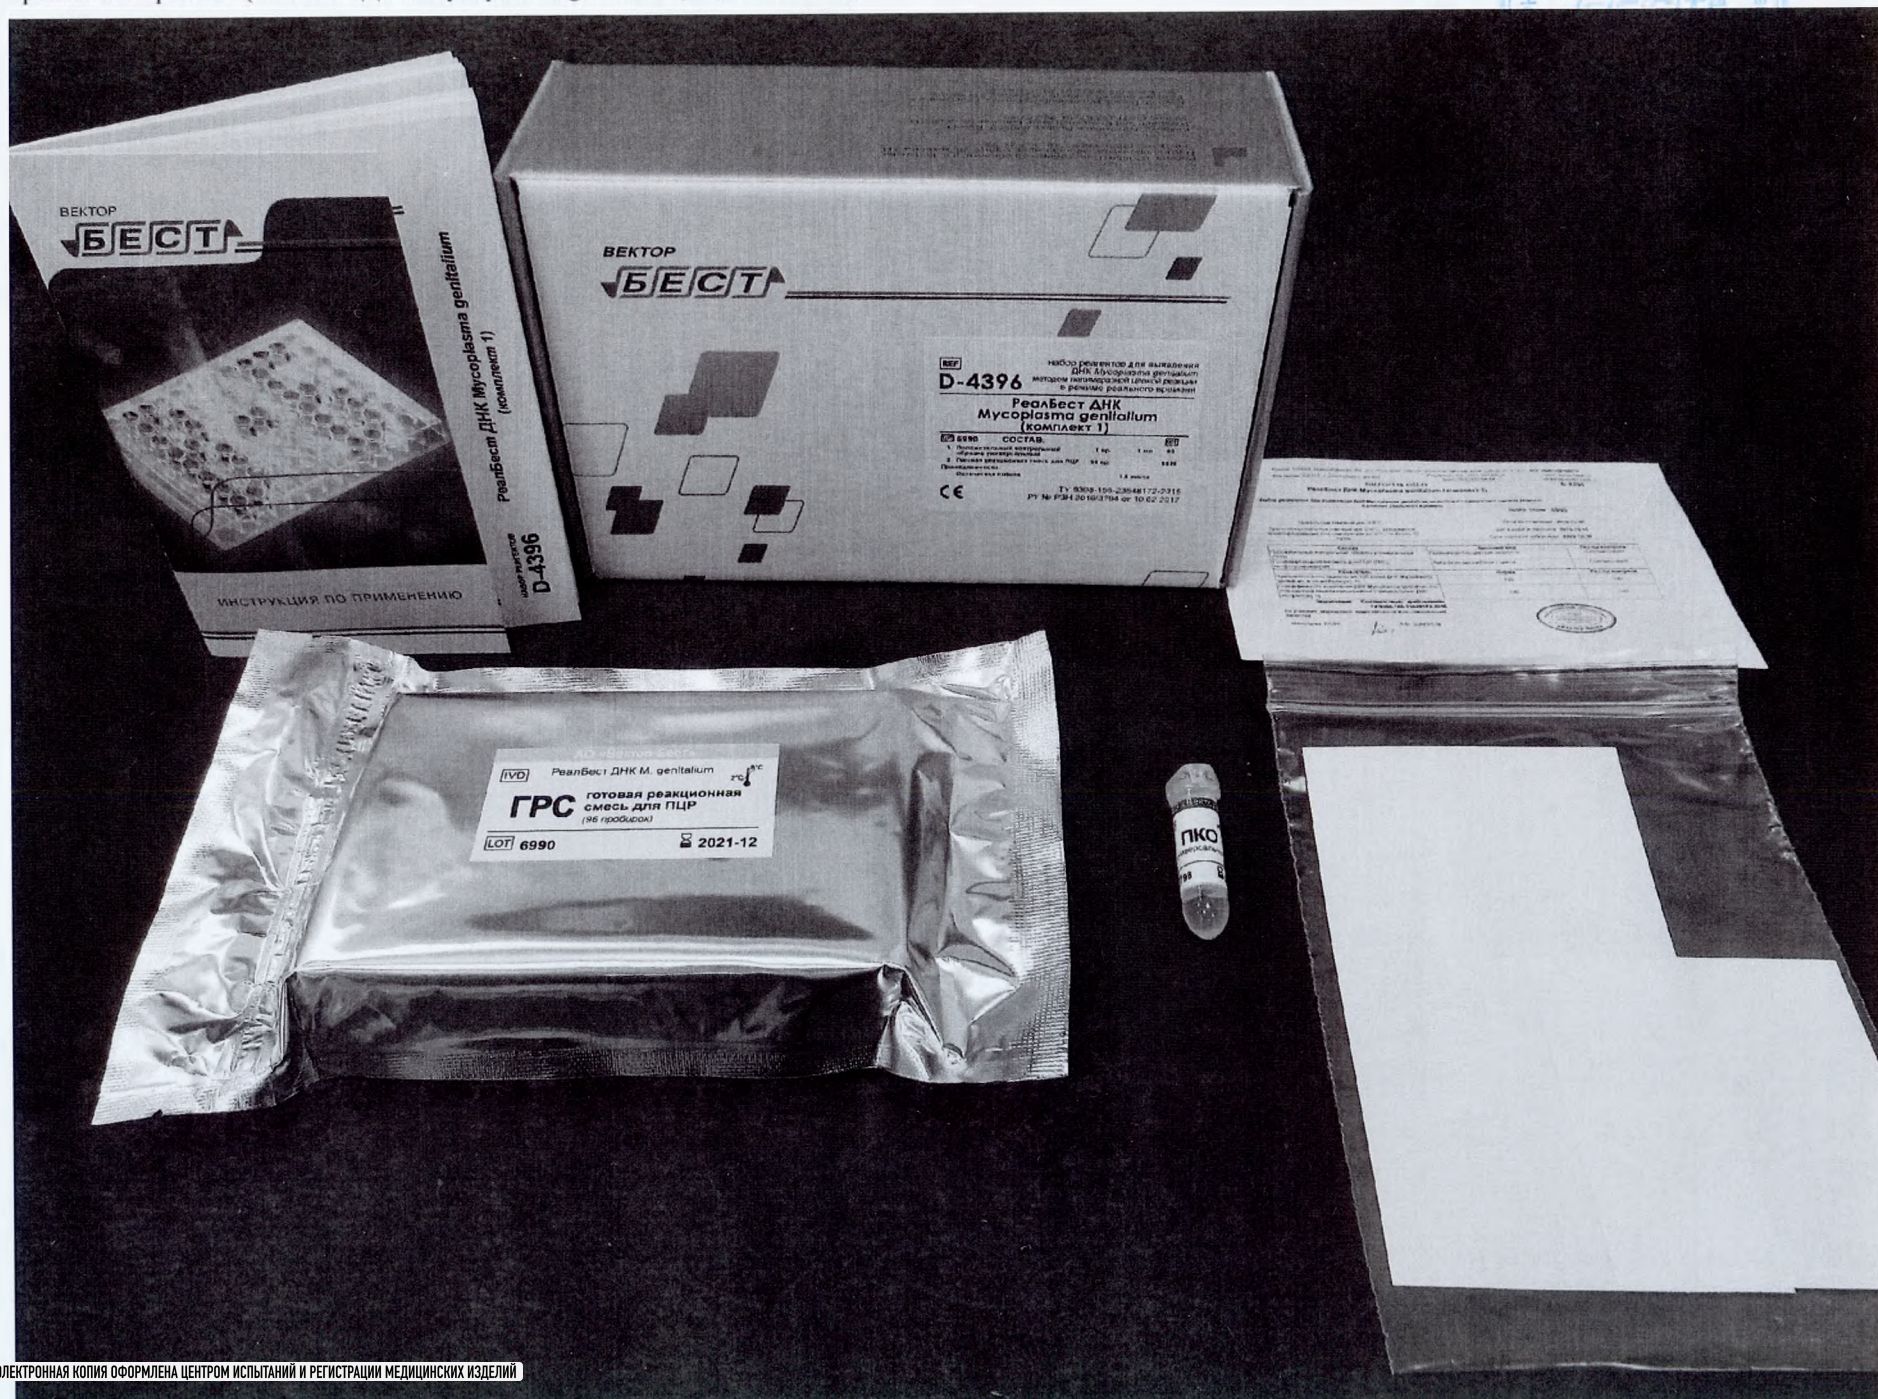

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma genitalium* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Mycoplasma genitalium*)» (Комплект 1) №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
Хусаинов М.Д.
2020 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-4396

набор реагентов для выявления
ДНК *Mycoplasma genitalium*
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

**РеалБест ДНК
Mycoplasma genitalium
(комплект 1)**

LOT 6990

СОСТАВ:

LOT

- | | | | |
|--|--------|------|------|
| 1. Положительный контрольный образец универсальный | 1 пр. | 1 мл | 93 |
| 2. Готовая реакционная смесь для ПЦР | 96 пр. | | 6990 |

Принадлежности:
Оптическая плёнка

1,5 листа

CE

ТУ 9398-156-23548172-2015
ПУ № РЗН 2016/3794 от 10.02.2017

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma genitalium* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Mycoplasma genitalium*)» (Комплект 1) №2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» _____ 2020 г.




ВЕКТОР

БЕСТ

REF **D-4396**

LOT **6990**



IVD



2019-12-10

2020-12-10

**РеалБест ДНК
Mycoplasma genitalium
(комплект 1)**



43961012200699000002




Для профессионального применения

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma genitalium* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Mycoplasma genitalium*)» (Комплект 1) №1

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
2020 г.

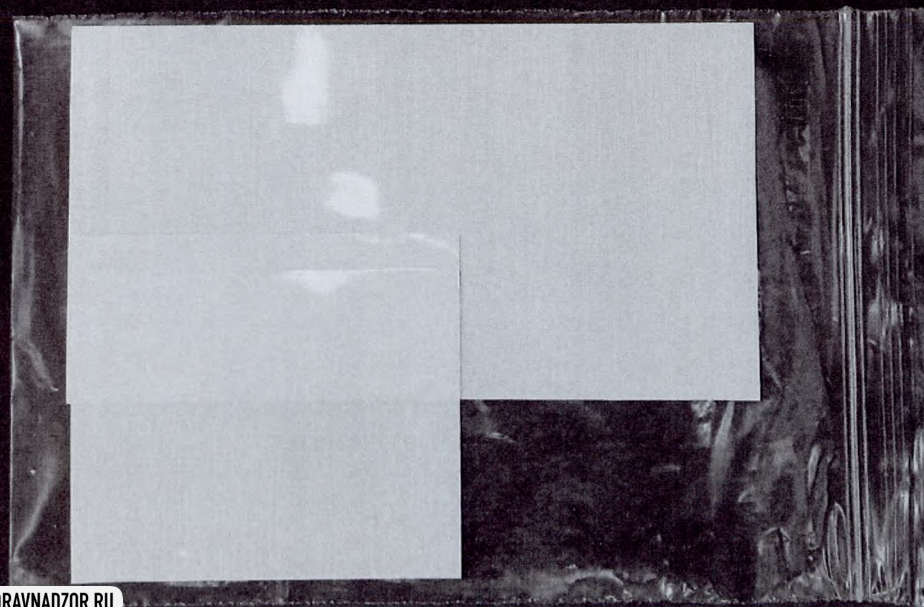

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК Mycoplasma genitalium)» (Комплект 1) №2

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК Mycoplasma genitalium)» (Комплект 1) №3


Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma genitalium* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Mycoplasma genitalium*)» (Комплект 1) №4


Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «04» _____ 2020 г.

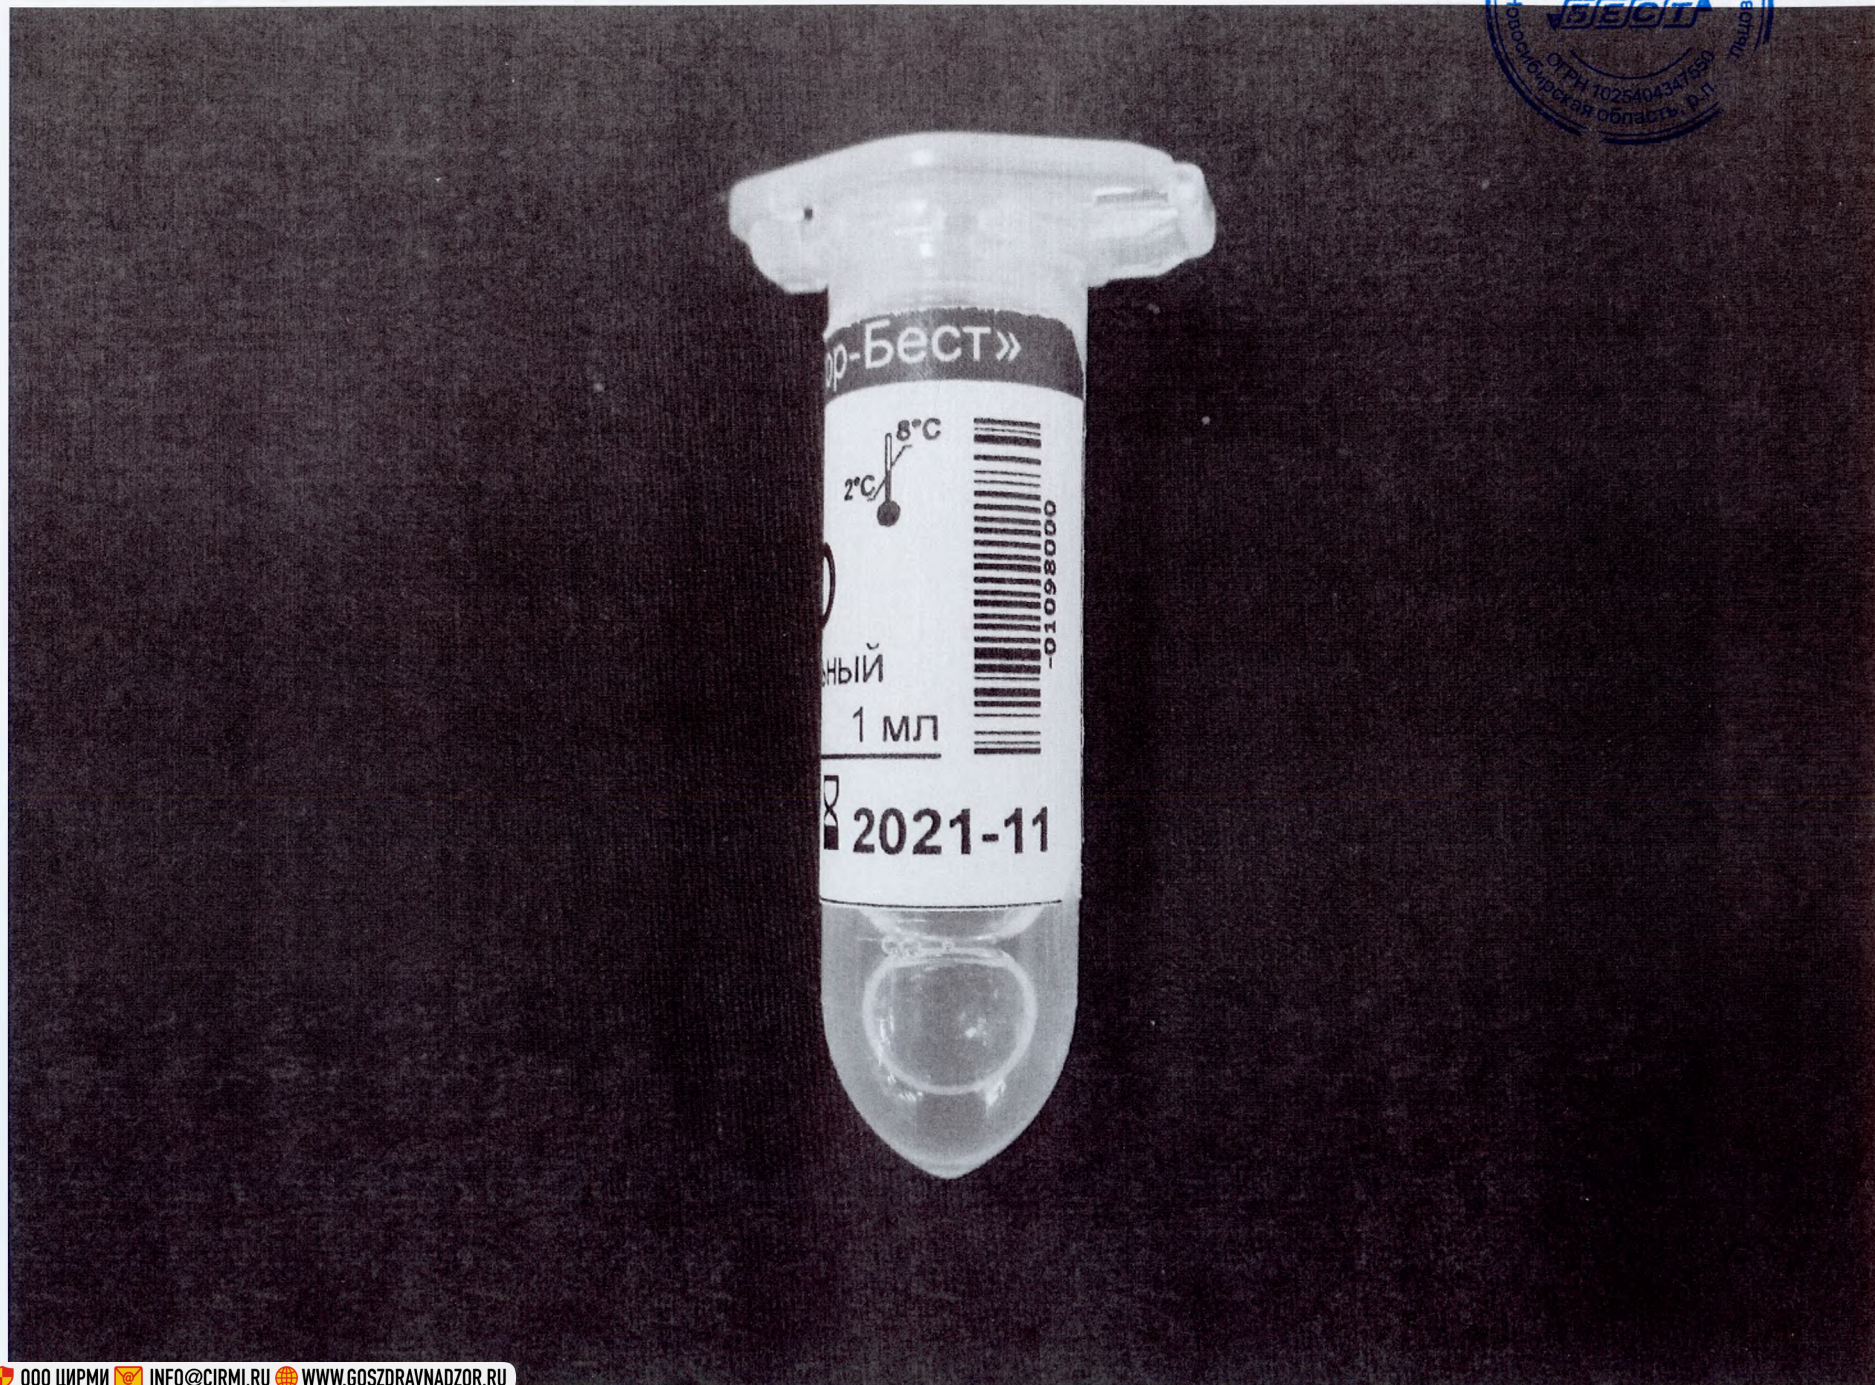

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma genitalium* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Mycoplasma genitalium*)» (Комплект 2)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«06» ~~фев~~ 2020 г.

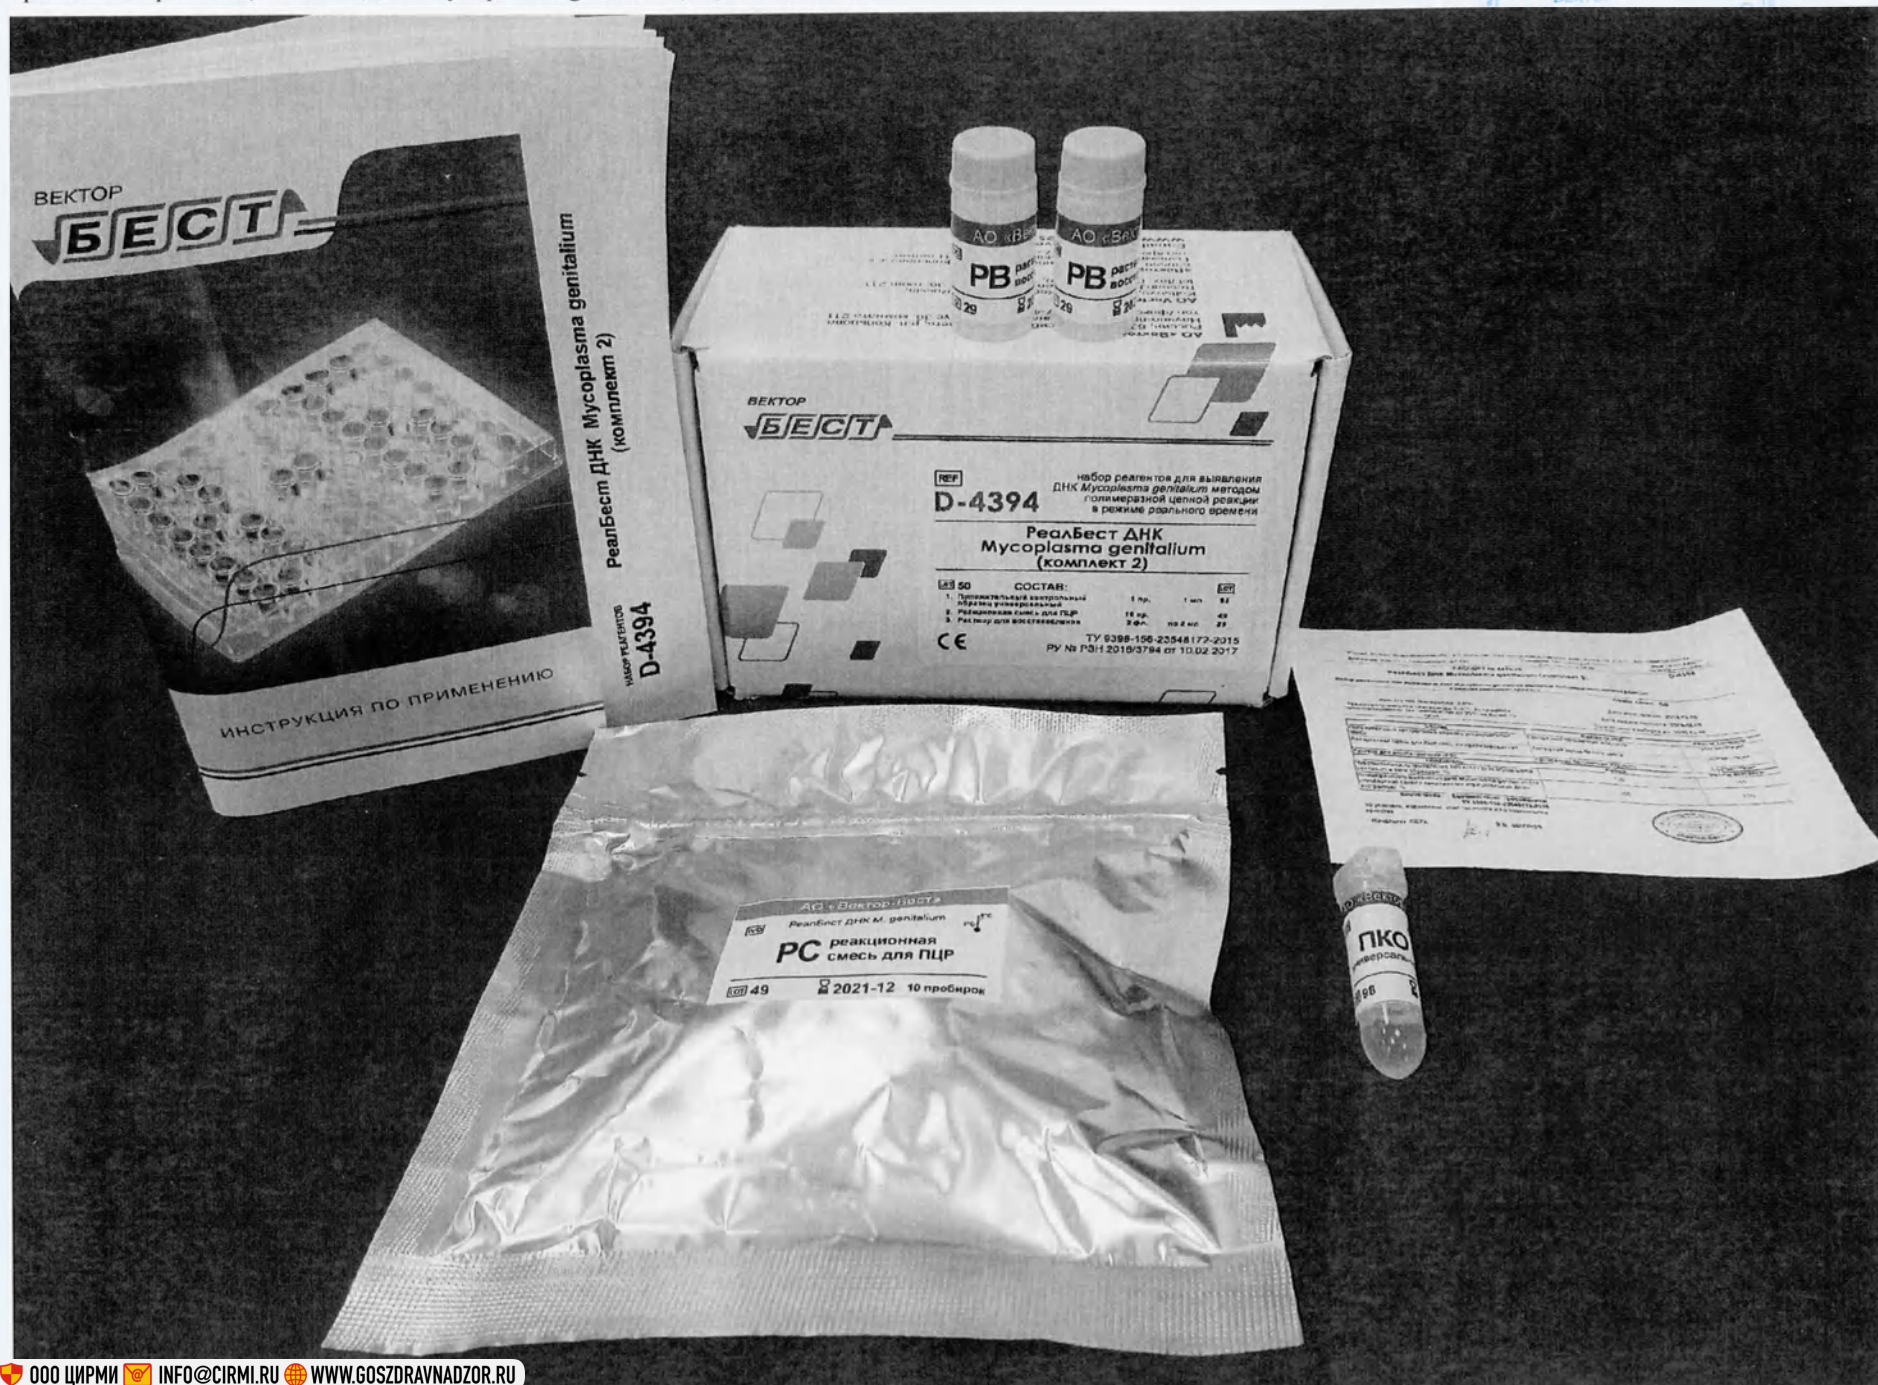

ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-4394

набор реагентов для выявления
ДНК *Mycoplasma genitalium* методом
полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

РеалБест ДНК
Mycoplasma genitalium
(комплект 2)

LOT 50

СОСТАВ:



LOT

1. Положительный контрольный образец универсальный
2. Реакционная смесь для ПЦР
3. Раствор для восстановления

1 пр.	1 мл	93
10 пр.		49
2 фл.	по 2 мл	29

CE

ТУ 9398-156-23548172-2015
ПУ № РЗН 2016/3794 от 10.02.2017

REF **D-4394** LOT **50**
    **2019-12-16**
 **2020-12-16**

**РеалБест ДНК
Mycoplasma genitalium
(комплект 2)**



43941612200005000001




Для профессионального применения

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma genitalium* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Mycoplasma genitalium*)» (Комплект 2) №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«06» ФЕВ 2020 г.

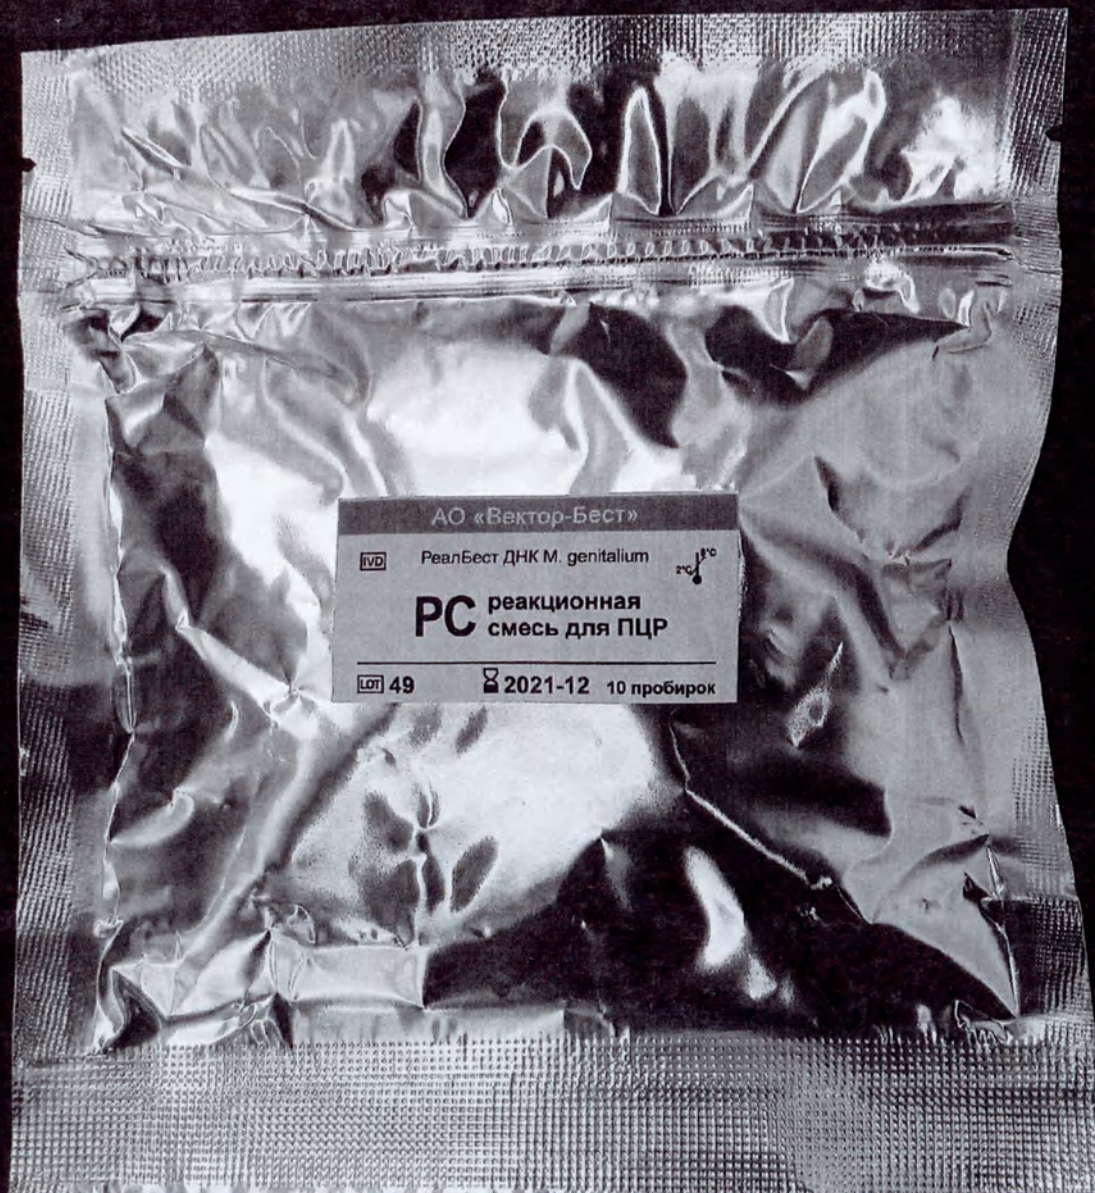

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma genitalium* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Mycoplasma genitalium*)» (Комплект 2) №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


06 Фев

Хусайнов М.Д.

2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК Mycoplasma genitalium)» (Комплект 2) №3

Генеральный

директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
06 ФЕВ 2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma genitalium* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Mycoplasma genitalium*)» (Комплект 2) №4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

 Хусаинов М.Д.
«06» FEB 2020 г.

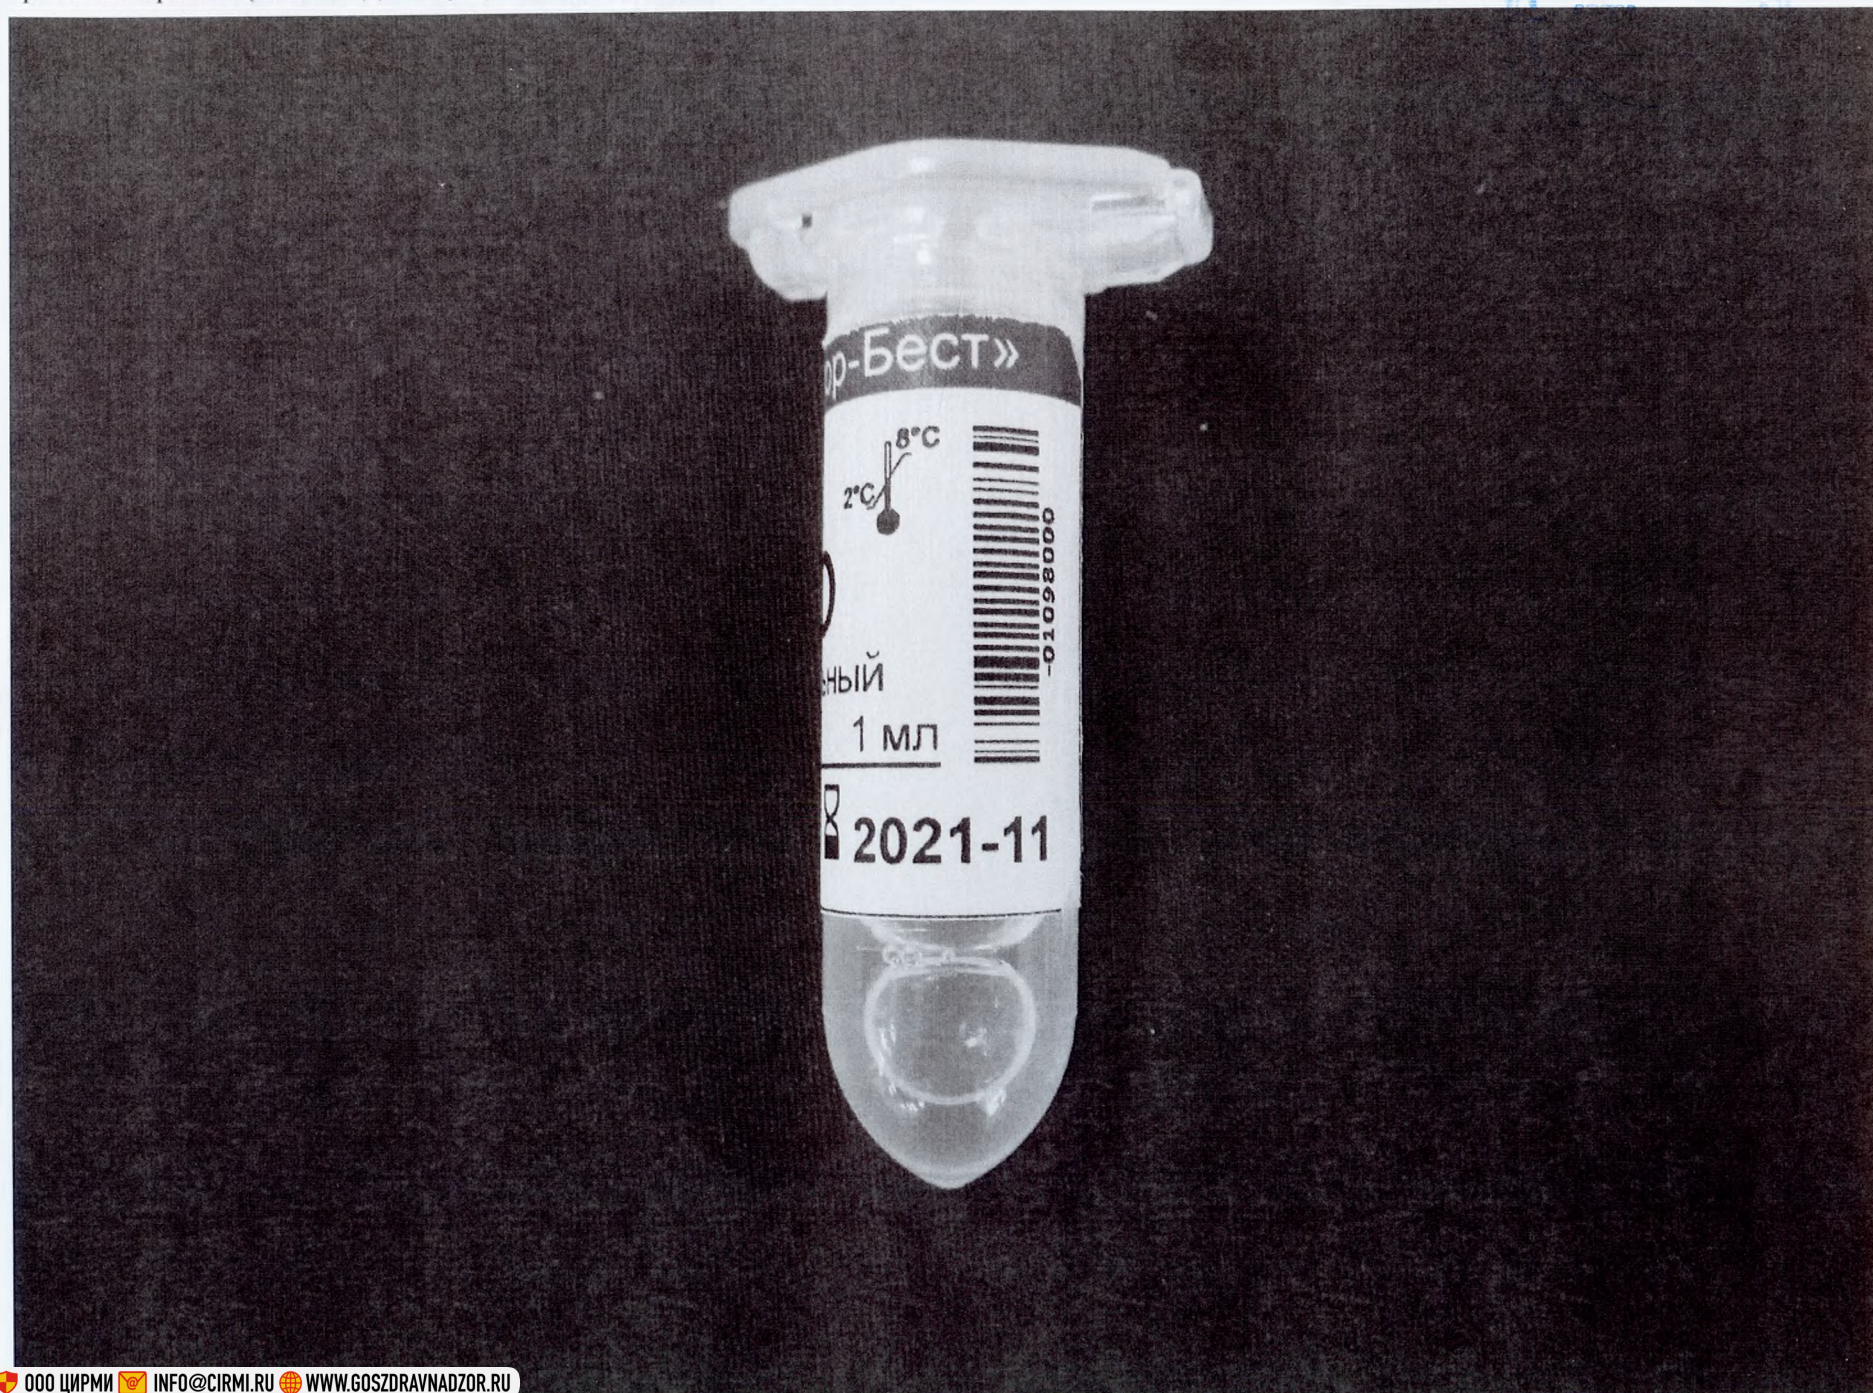

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma genitalium* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Mycoplasma genitalium*)» (Комплект 2) №5

Генеральный

директор

АО «Вектор-Бест»

 Хусаинов М.Д.
«06»  2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma genitalium* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Mycoplasma genitalium*)» (Комплект 2) №6

Генеральный

директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
06 ФЕВ
2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma genitalium* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Mycoplasma genitalium*)» (Комплект 2) №7

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «06» ФЕВ 2020 г.

