


06 2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 1)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«04» 06 2020 г.

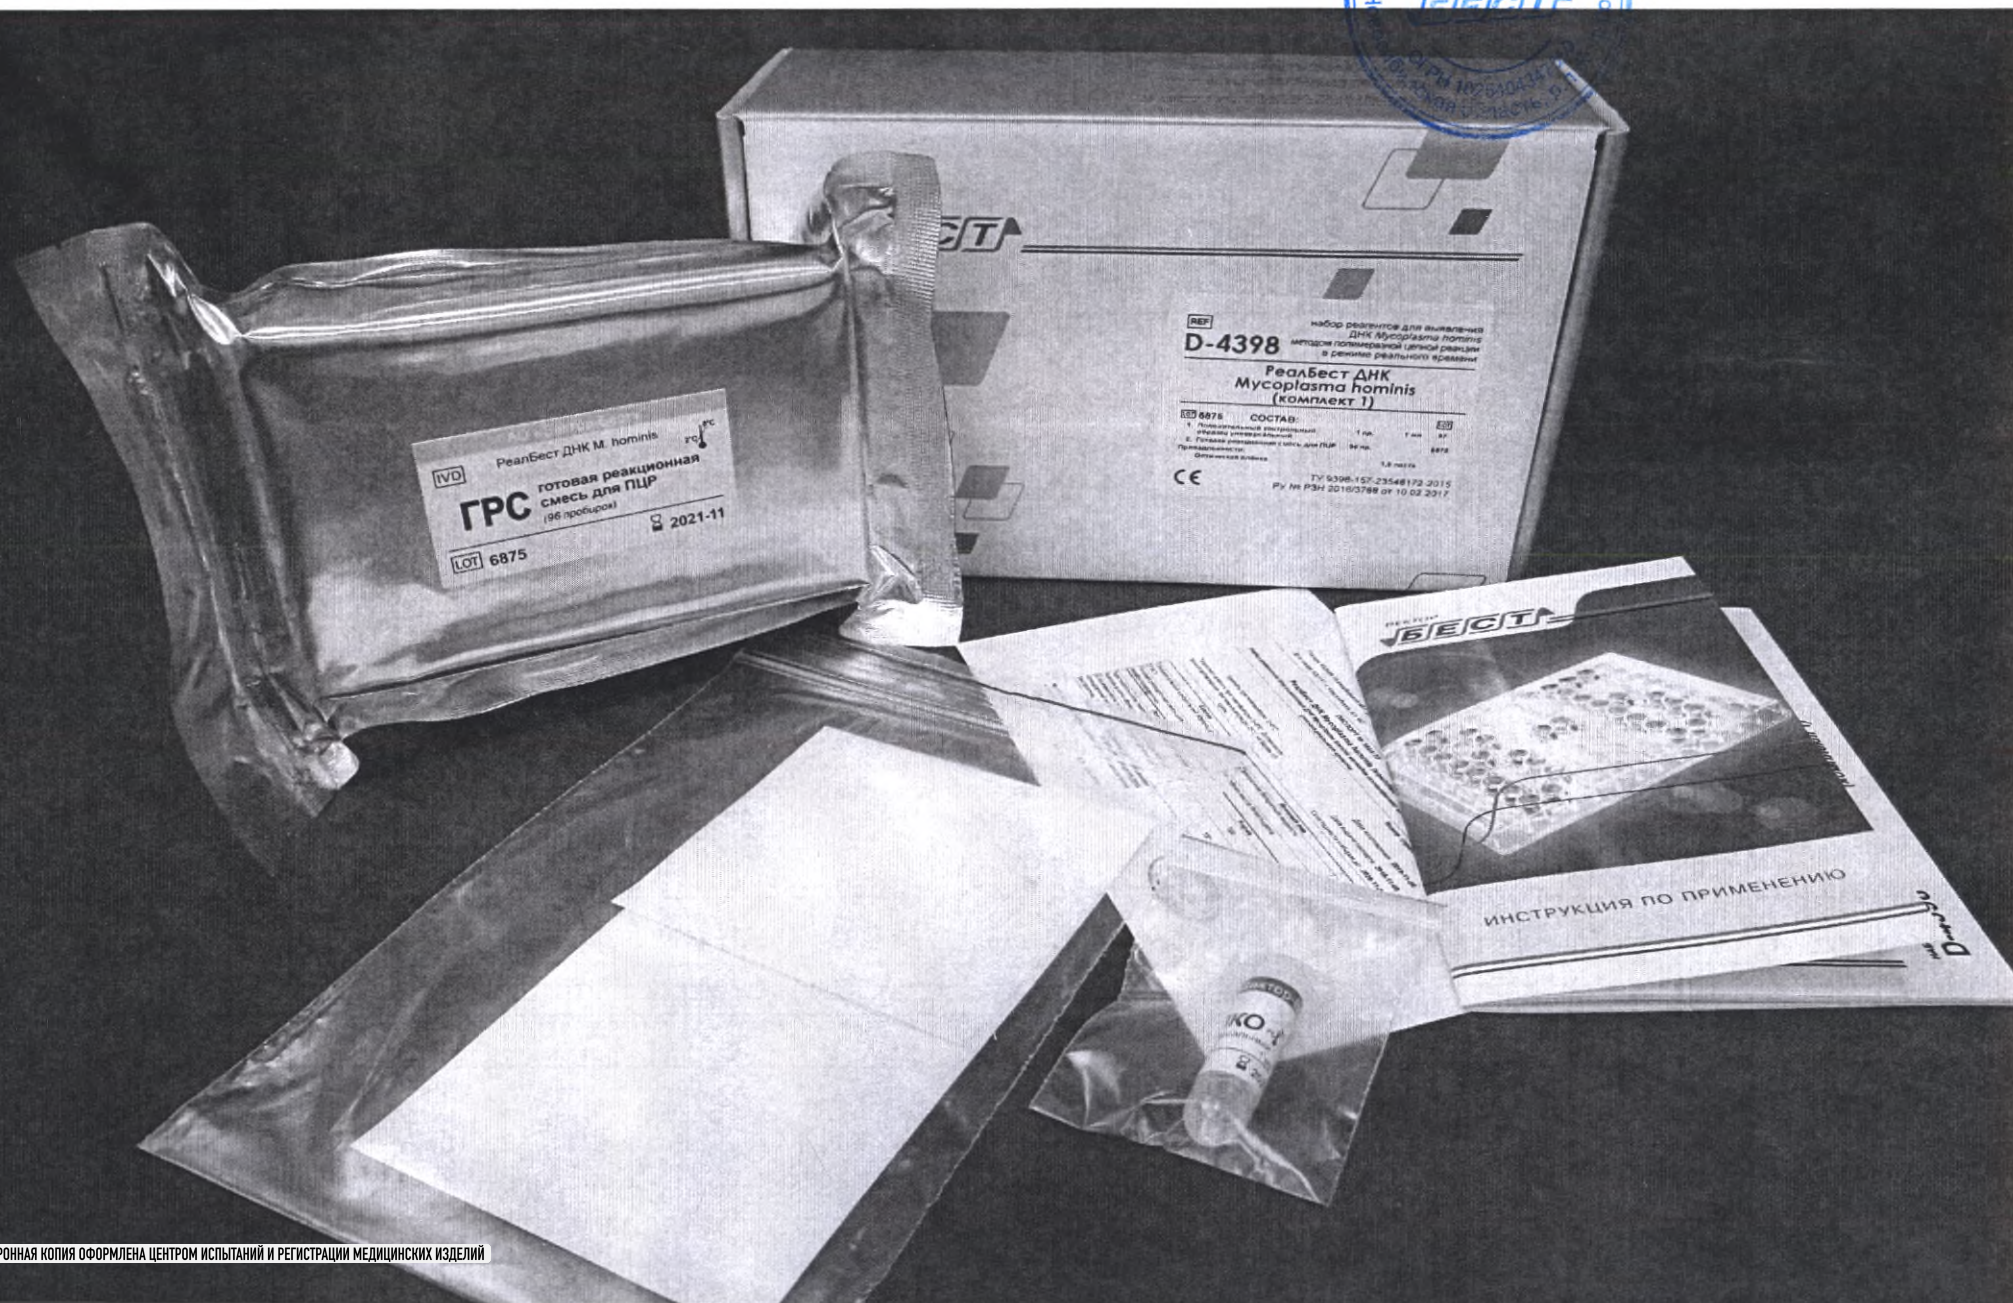

ВЕКТОР
БЕСТ

REF

D-4398

набор реагентов для выявления
ДНК *Mycoplasma hominis*
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

**РеалБест ДНК
Mycoplasma hominis
(комплект 1)**

LOT 6875

СОСТАВ:

- | | | | |
|--|--------|-----------|------|
| 1. Положительный контрольный образец универсальный | 1 пр. | 1 мл | 97 |
| 2. Готовая реакционная смесь для ПЦР | 96 пр. | | 6875 |
| Принадлежности: | | | |
| Оптическая плёнка | | 1,5 листа | |

CE

ТУ 9398-157-23548172-2015
ПУ № РЗН 2016/3788 от 10.02.2017

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 1)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«04» 06 2020 г.




ВЕКТОР

БЕСТ

REF **D-4398**

LOT **6875**



IVD

Σ 96



2019-11-08



2020-11-08

**РеалБест ДНК
Mycoplasma hominis
(комплект 1)**



43980811200687500018

Для профессионального применения

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 1)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

« 04 »

06

2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 1)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«04» 06 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 1)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.



«04» 06 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 1)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.




«04» 06 2020 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 2)»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«04» 06 2020 г.

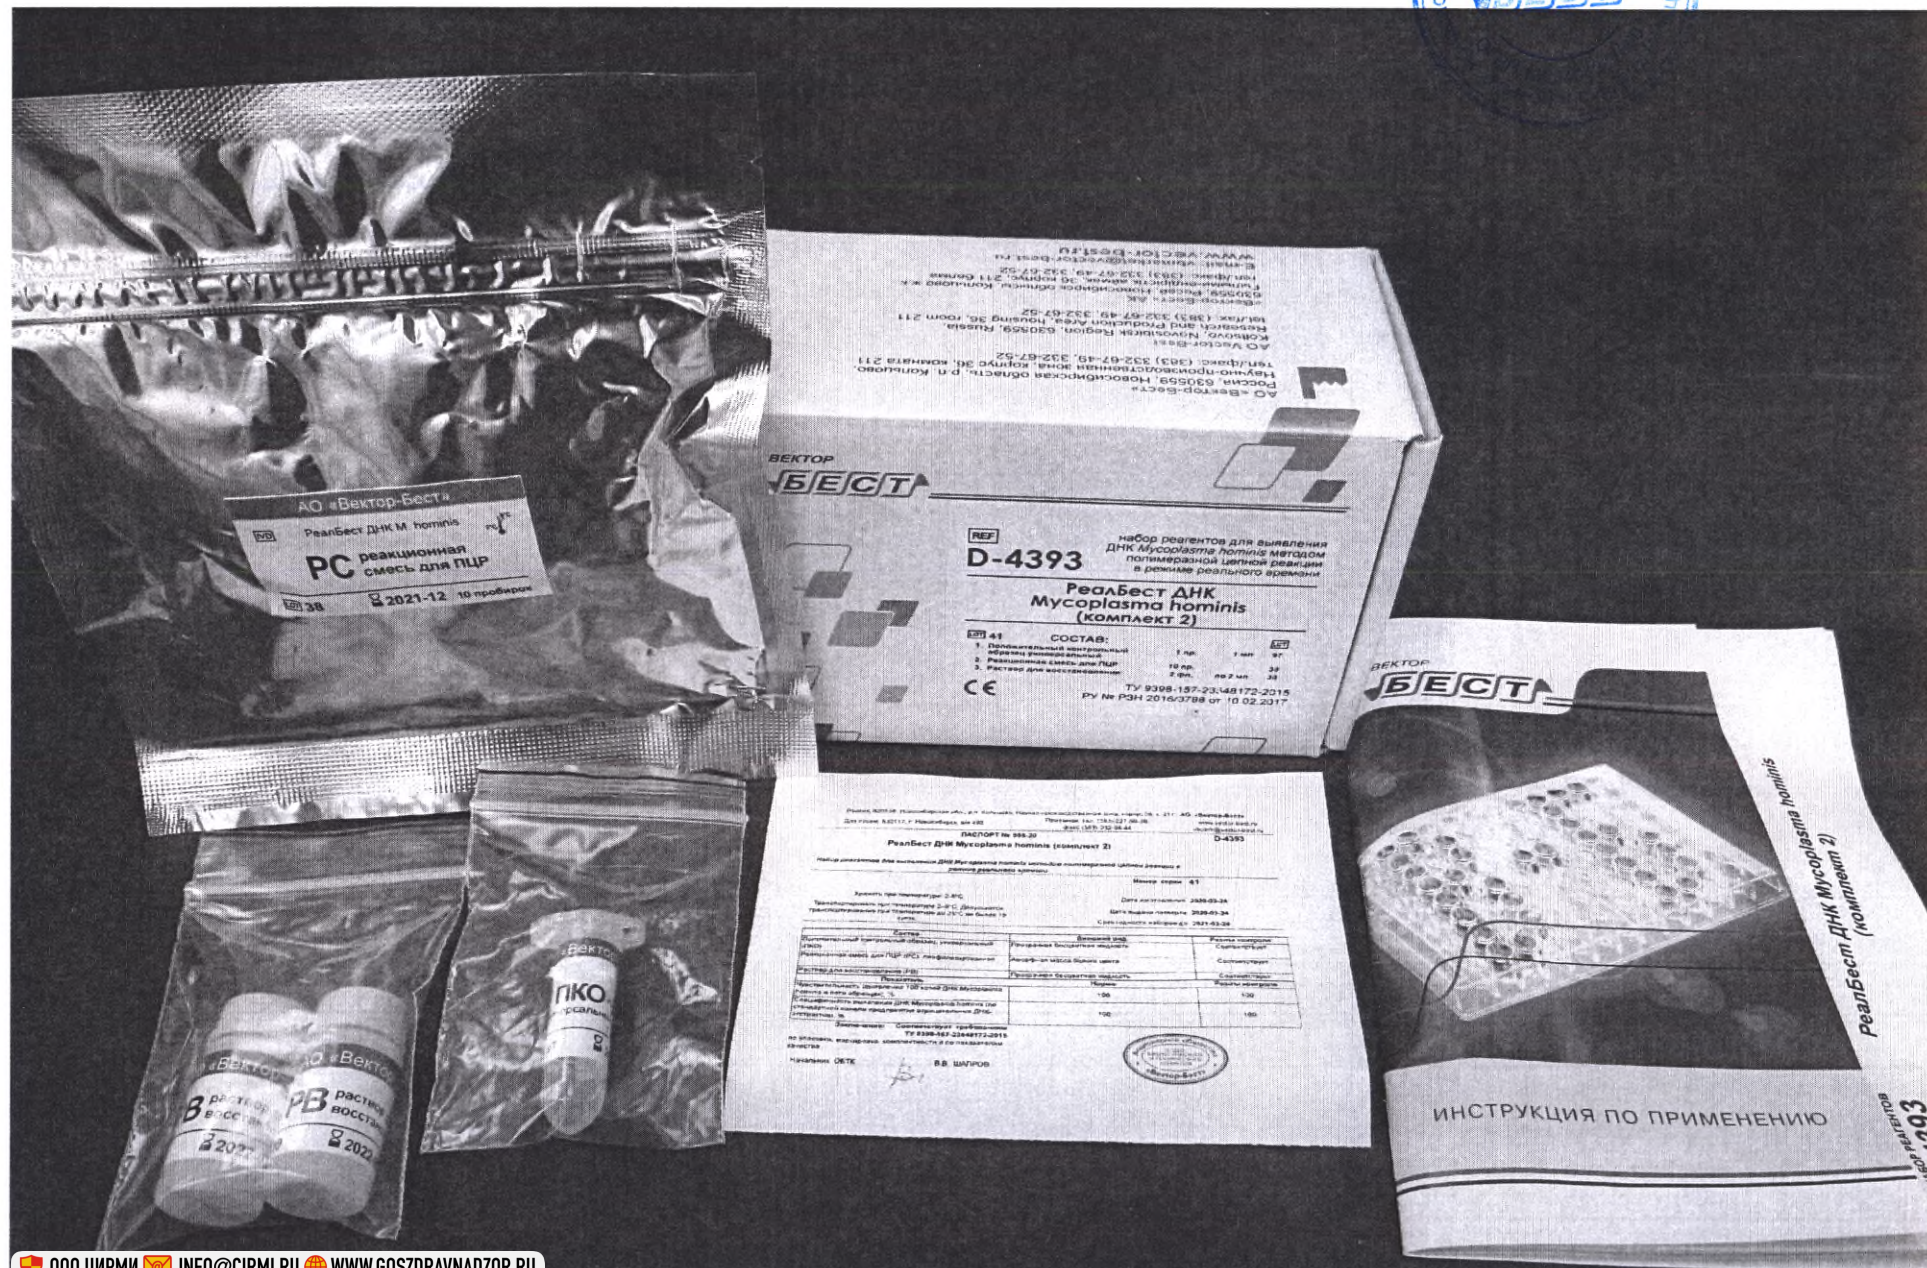

Графическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 2)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

D-4393

набор реагентов для выявления
ДНК *Mycoplasma hominis* методом
полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

**РеалБест ДНК
Mycoplasma hominis
(комплект 2)**

LOT 41

СОСТАВ:

LOT


1. Положительный контрольный образец универсальный	1 пр.	1 мл	97
2. Реакционная смесь для ПЦР	10 пр.		38
3. Раствор для восстановления	2 фл.	по 2 мл	30

CE

ТУ 9398-157-23548172-2015
ПУ № РЗН 2016/3788 от 10.02.2017

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 2)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«04» _____ 06 _____ 2020 г.



REF **D-4393** LOT **41**

2 8
°C
IVD Σ 100

2020-03-24

2021-03-24

**РеалБест ДНК
Mycoplasma hominis
(комплект 2)**



43932403210004100001




Для профессионального применения

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 2)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«04» 06 2020 г.

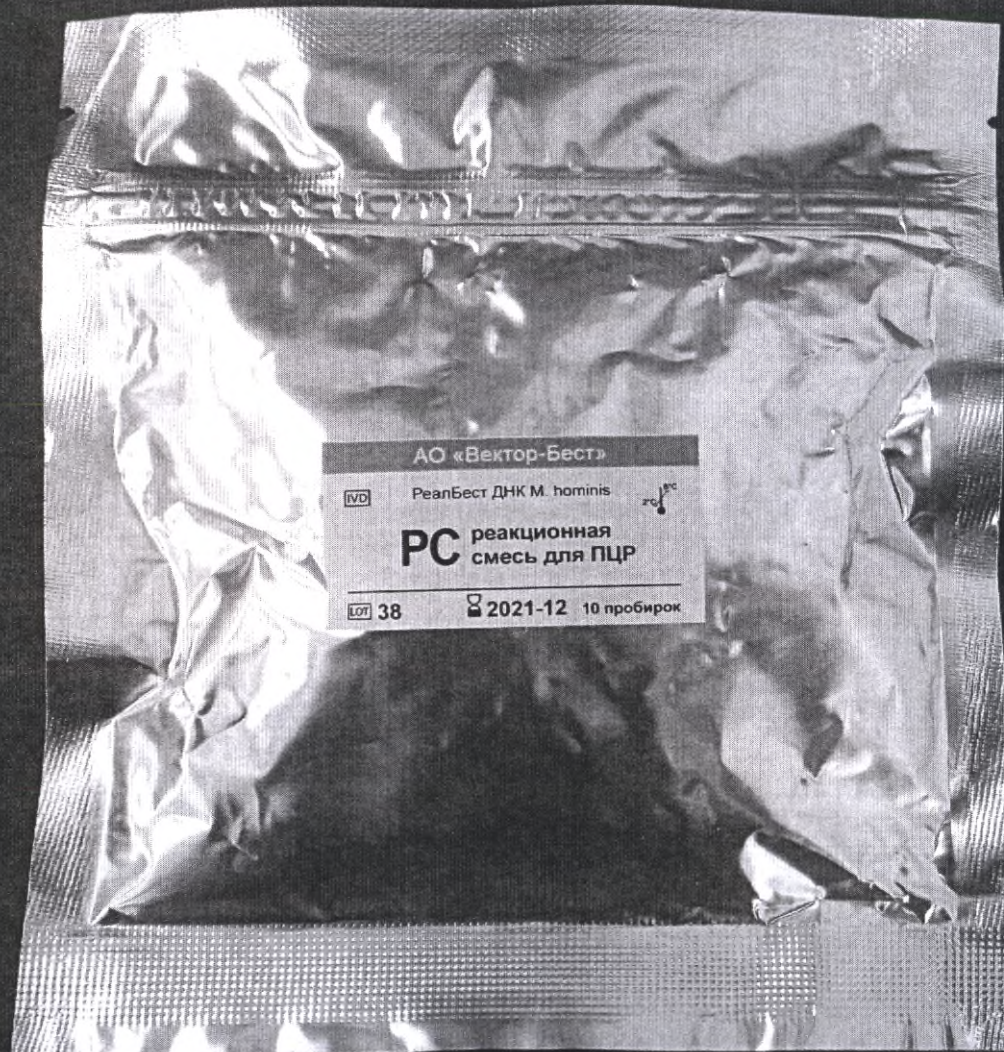

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 2)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

«04»

06

2020 г.

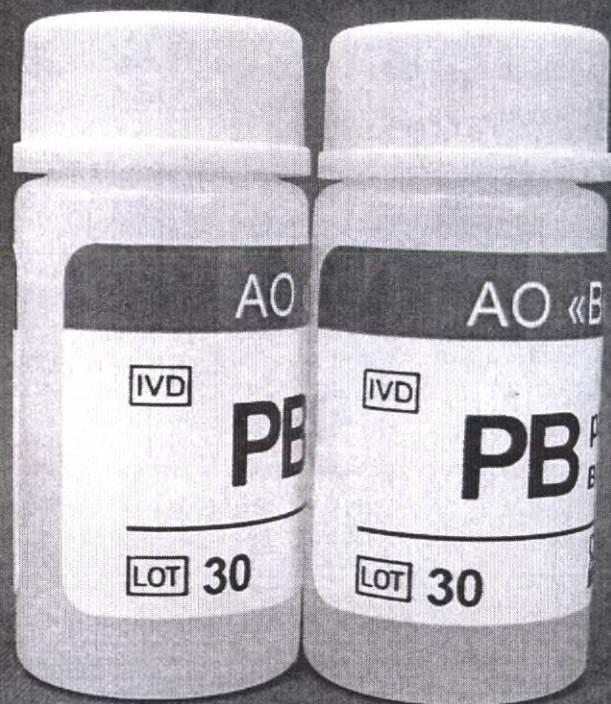


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 2)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«04» _____ 06 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 2)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«04» _____ 06 2020 г.

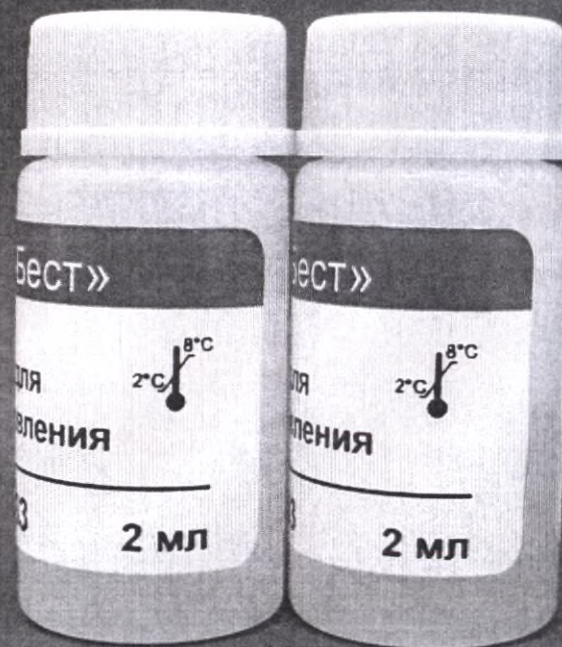

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 2)» № 5

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
« 04 » 06 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 2)» № 6

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«04» 06 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma hominis* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК *Mycoplasma hominis* (комплект 2)» № 7

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«04» 06 2020 г.

