

БЕКТОР

БЕСТ

REF

D-8487

набор реагентов для дифференциального выявления и количественного определения ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

РеалБест ДНК ВПЧ ВКР
генотип количественный (комплект 2)

LOT 23


СОСТАВ:

LOT

1. Положительный контрольный образец	2 фл.	13
2. Реакционная смесь для ПЦР (РС 1, 2, 3, 4)	44 пр.	
2.1 РС 1	11 пр.	49
2.2 РС 2	11 пр.	49
2.3 РС 3	11 пр.	49
2.4 РС 4	11 пр.	23
3. Реакционная смесь для ПЦР (РС 5)	11 пр.	23
4. Раствор для восстановления	8 фл. по 2 мл	25
5. Раствор для восстановления контрольных образцов	1 фл. 4 мл	101

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для дифференциального выявления и количественного определения ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип количественный (комплект 2)»

АО «Вектор-Бест»

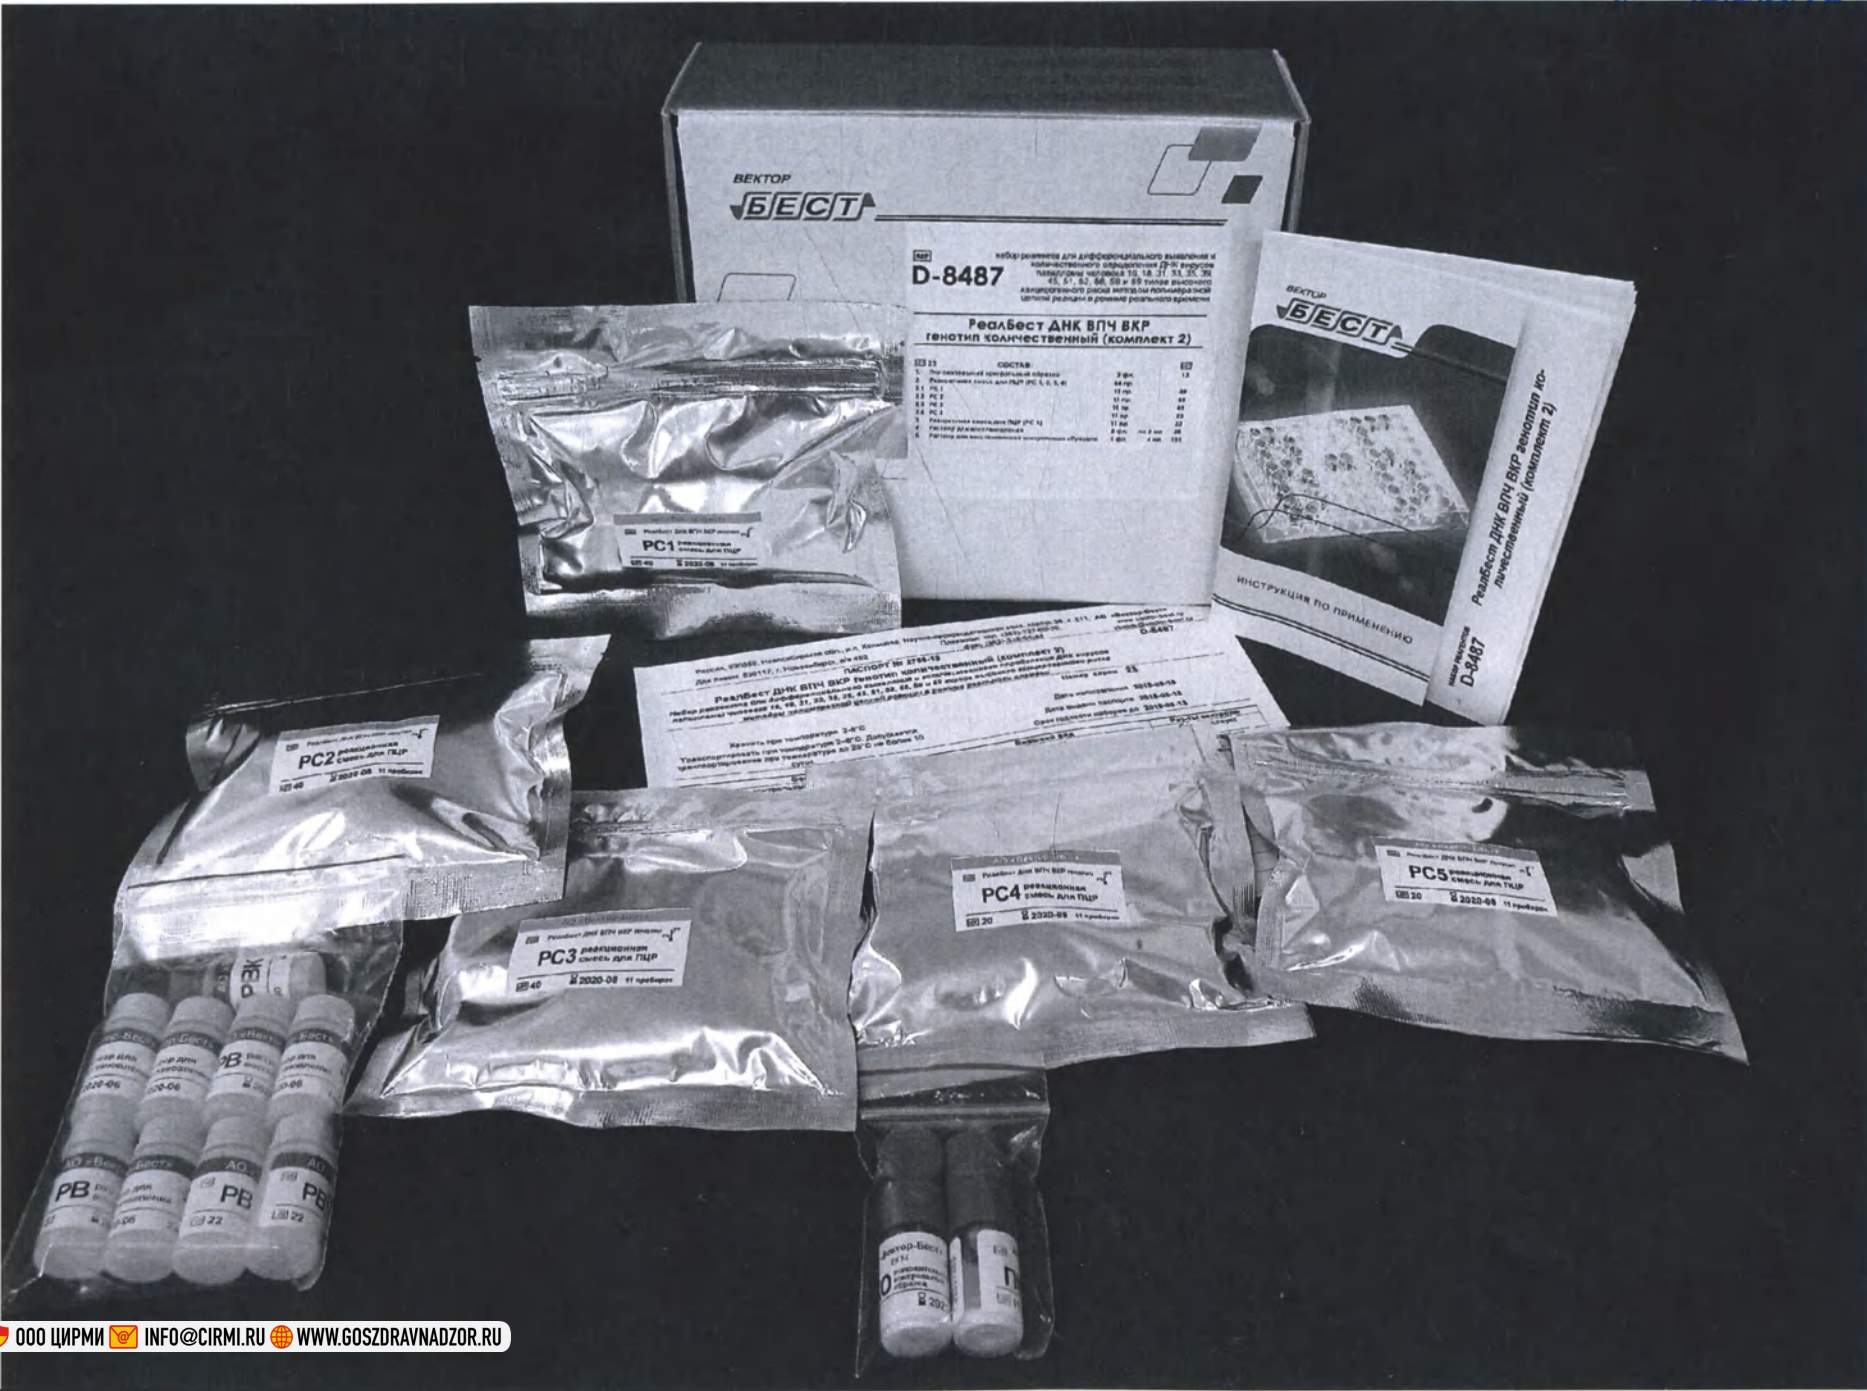

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для дифференциального выявления и количественного определения ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип количественный (комплект 1))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»





ВЕКТОР
БЕСТ

REF

D-8478

набор реагентов для дифференциального выявления
и количественного определения ДНК вирусов
папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58 и 59 типов высокого канцерогенного
риска методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени

РеалБест ДНК ВПЧ ВКР
генотип количественный (комплект 1)

LOT 6300

СОСТАВ:

1. Положительный контрольный образец	2 фп.	12
2. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС 1, 2, 3, 4)	4 планш. по 96 пр.	6300
3. Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС 5)	96 пр.	6301
4. Раствор для восстановления контрольных образцов	1 фп. 4 мл	101

Принадлежности:

Оптическая плёнка

6 листов.



REACTUM
ВЕСТ

REF **D-8478**

Σ 96

LOT

6300

TU 9398-320-23548172-2011

2019-06-03

РУ № ФСР 2012/13457 от 06.04.2017

2020-06-03

РеалБест ДНК ВПЧ ВКР
генотип количественный (комплект 1)

IVD



CE



84780306200630000041

Для профессионального применения









фотографическое изображение общего вида упаковочного изделия «РеалБест ДНК ВПЧ ВКР» для дифференциального выявления и количественного определения ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ВПЧ ВКР» генотип количественный (комплект 2))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



графическое изображение упаковки с типичного и типичного - набор реагентов для дифференциального выявления и количественного
деления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59 типов высокого канцерогенного риска методом
«иммерсионной цепной реакции в режиме реального времени» РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип количественный (комплект 2))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



BEKTOP

БЕСТ

REF **D-8487**

Σ₉₉

LOT

23

ТУ 9398-320-23548172-2011

РУ № ФСР 2012/13457 от 06.04.2017



2019-06-04

2020-06-04

РеалБест ДНК ВПЧ ВКР
генотип количественный (комплект 2)

IVD



CE



84870406200002300001


Для профессионального применения

фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для дифференциального выявления и количественного определения ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип количественный (комплект 2)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»





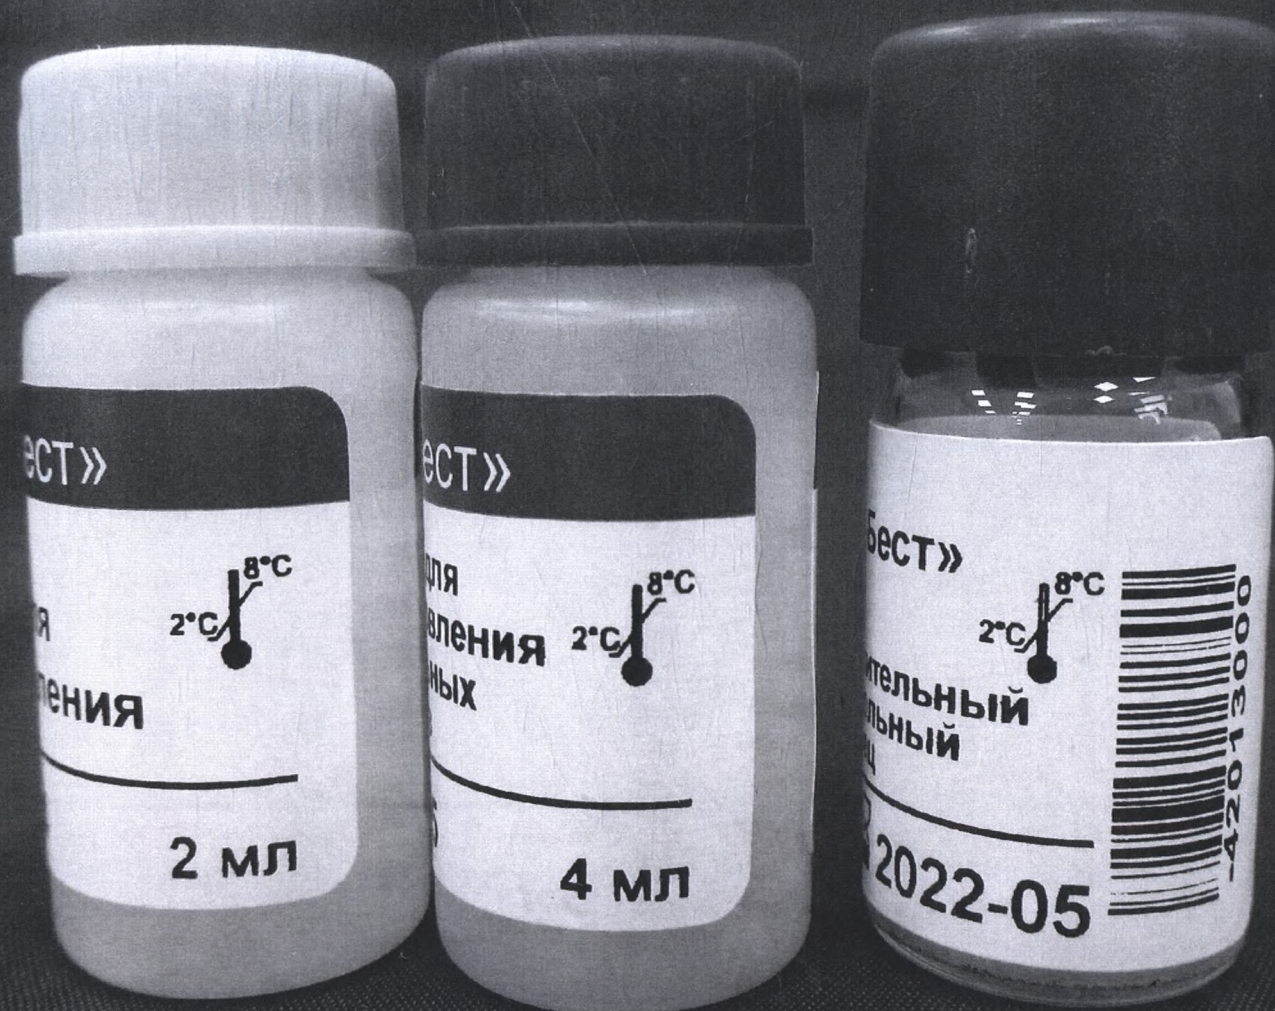

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для дифференциального типирования и определения ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип количественный (комплект 2)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

