


Фототрафикское изображение общедоступно в открытом доступе
 иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в
 сыворотке крови (РЭА-ИФА-БЕСТ)»

Генеральный директор
 АО «Вектор-Бест»



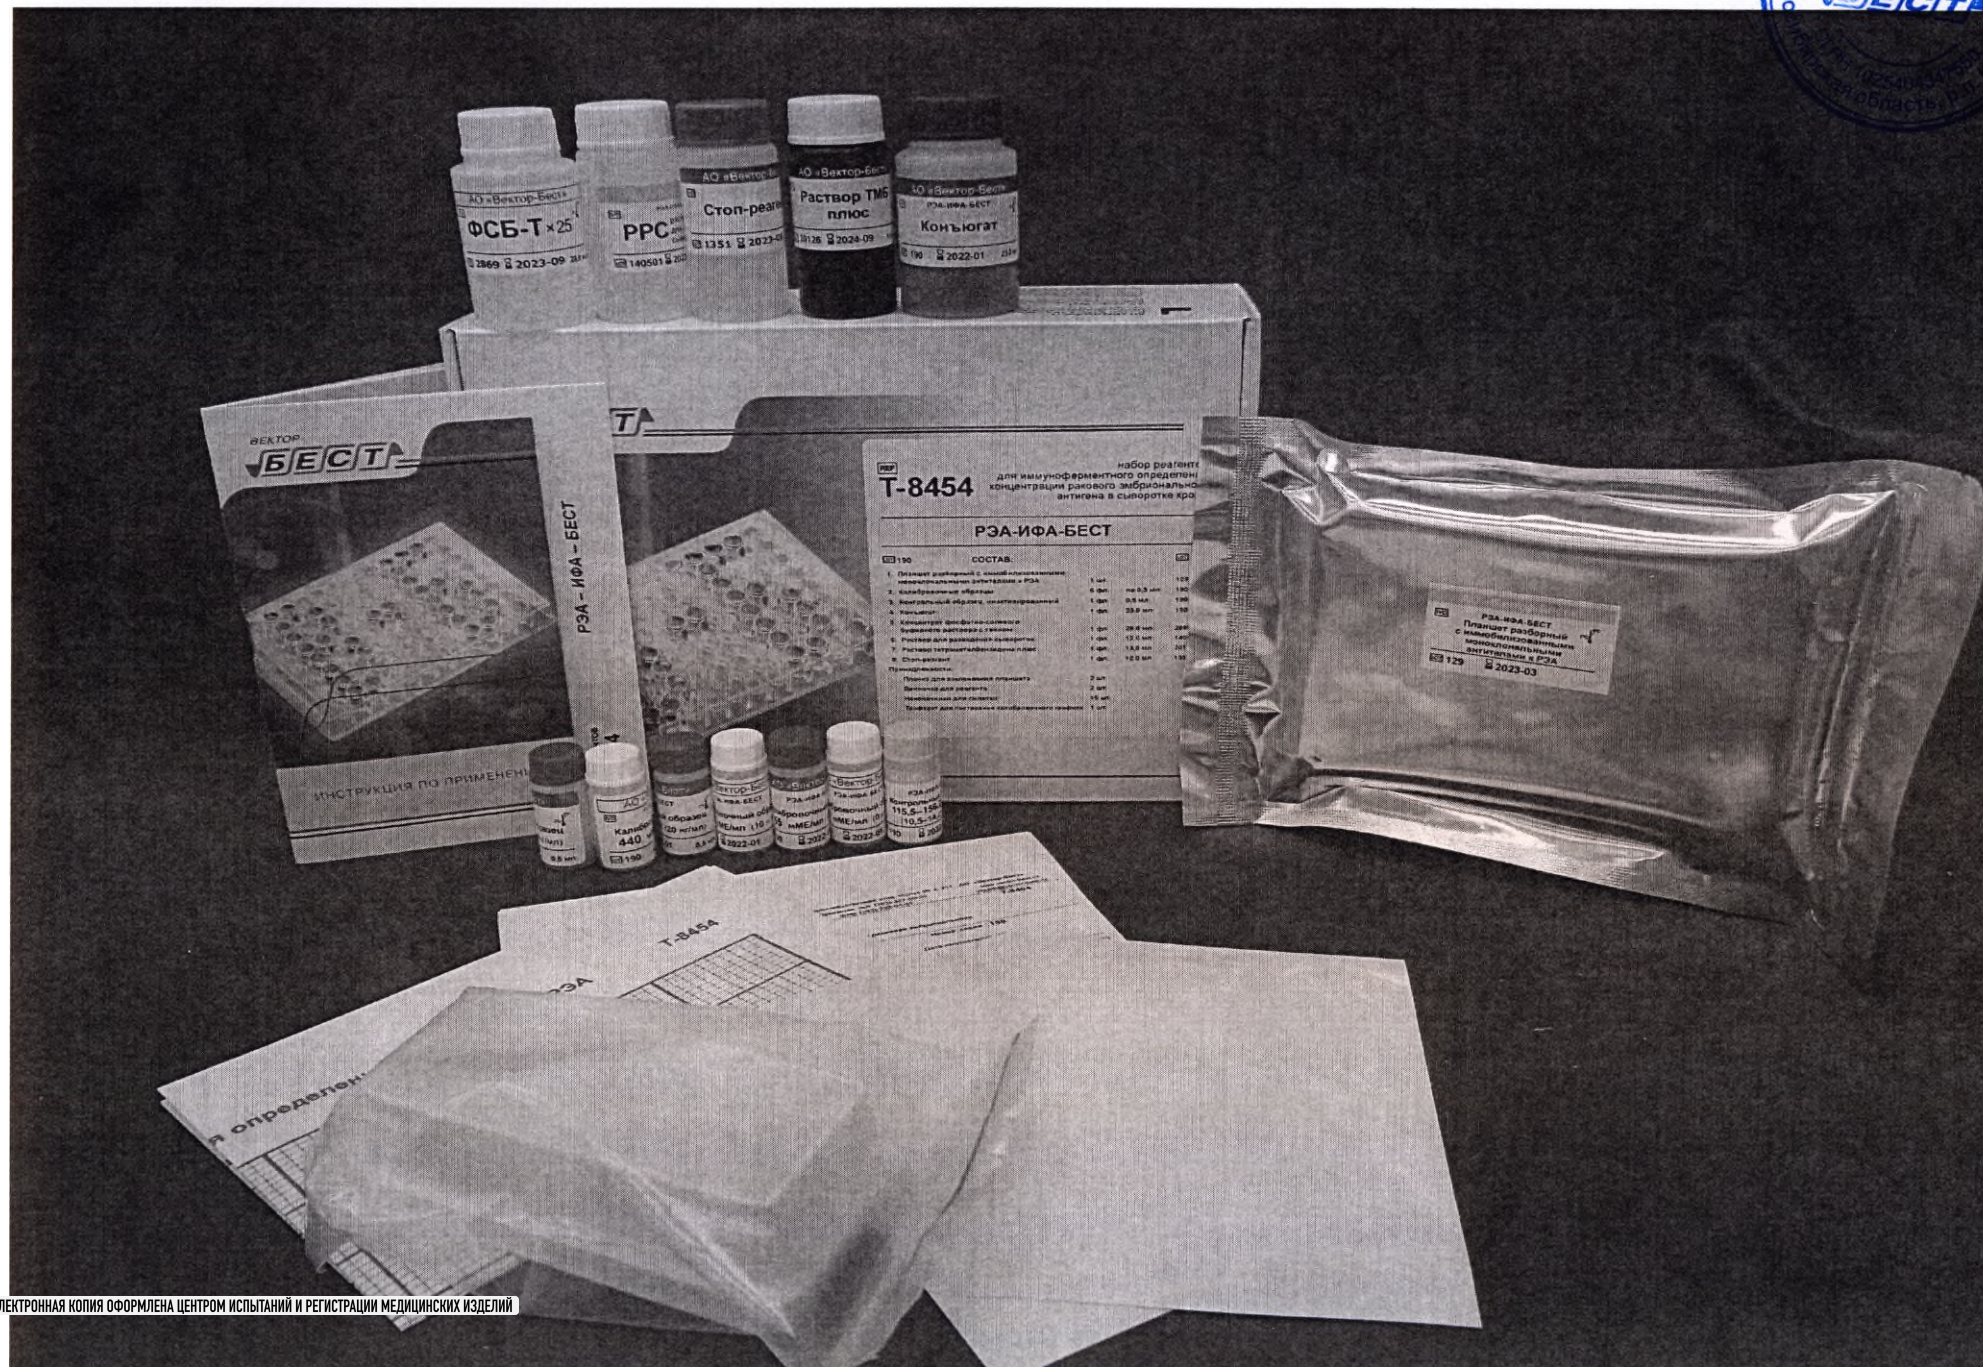

REF

T-8454

набор реагентов
для иммуноферментного определения
концентрации ракового эмбрионального
антигена в сыворотке крови


РЭА-ИФА-БЕСТ

LOT 190

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к РЭА	1 шт.		129
2. Калибровочные образцы	6 фл.	по 0,5 мл	190
3. Контрольный образец, инактивированный	1 фл.	0,5 мл	190
4. Конъюгат	1 фл.	23,0 мл	190
5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл	2869
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	140501
7. Раствор тетраметилбензидина плюс	1 фл.	13,0 мл	20126
8. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1351
Принадлежности:			
Пленка для заклеивания планшета	2 шт.		
Ванночка для реагента	2 шт.		
Наконечники для пилетки	16 шт.		
Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.		

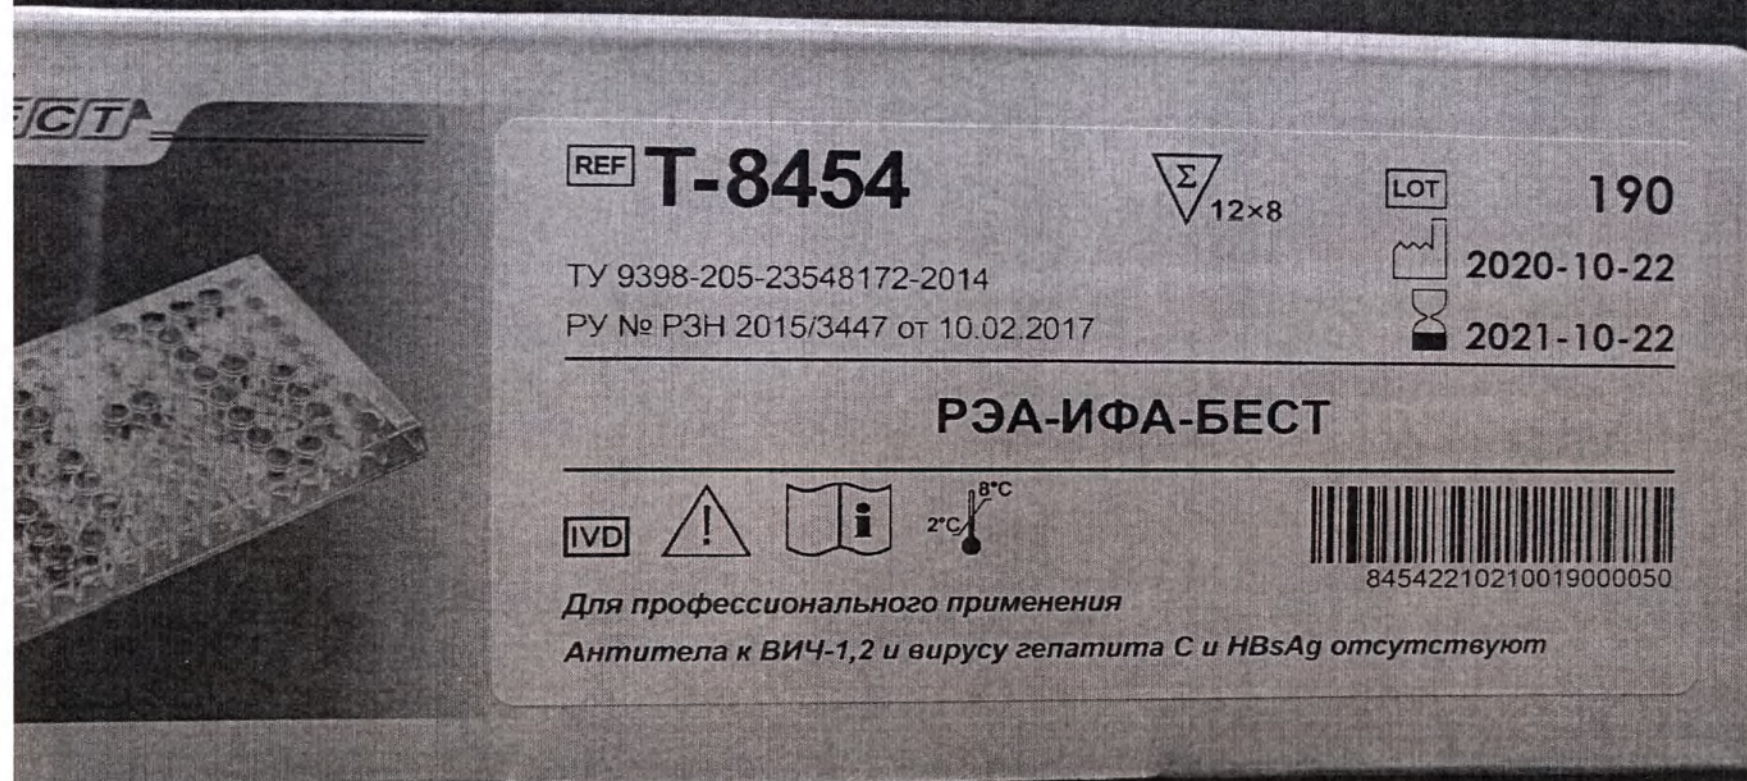

REF **T-8454**

Σ
12x8

LOT **190**

ТУ 9398-205-23548172-2014

ПУ № РЗН 2015/3447 от 10.02.2017

 **2020-10-22**

 **2021-10-22**

РЕА-ИФА-БЕСТ

IVD




84542210210019000050


Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови (РЭА-ИФА-БЕСТ)» № 1

АО «Вектор-Бест»

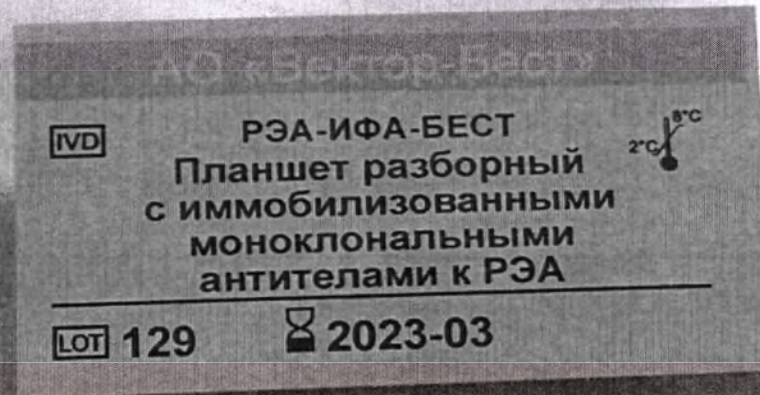


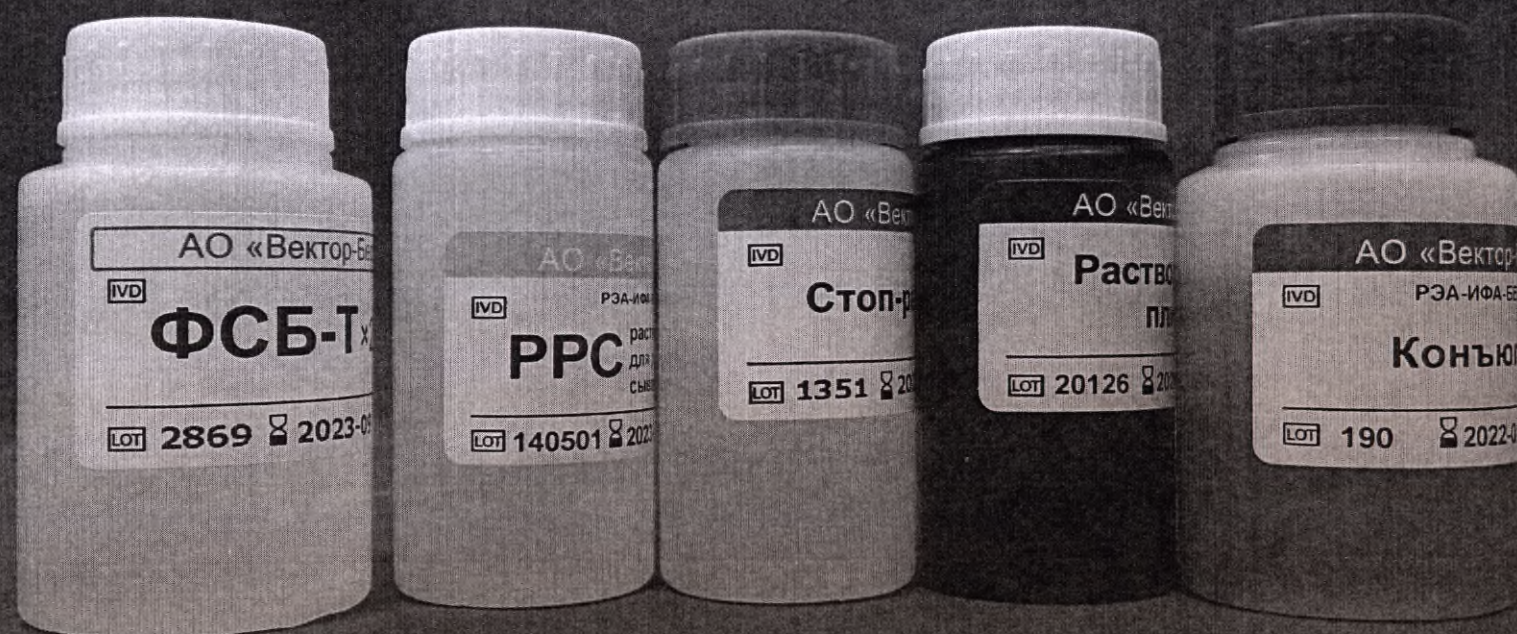


иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови (РЭА-ИФА-БЕСТ)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусанов М.Д.
«27» 2020 г.

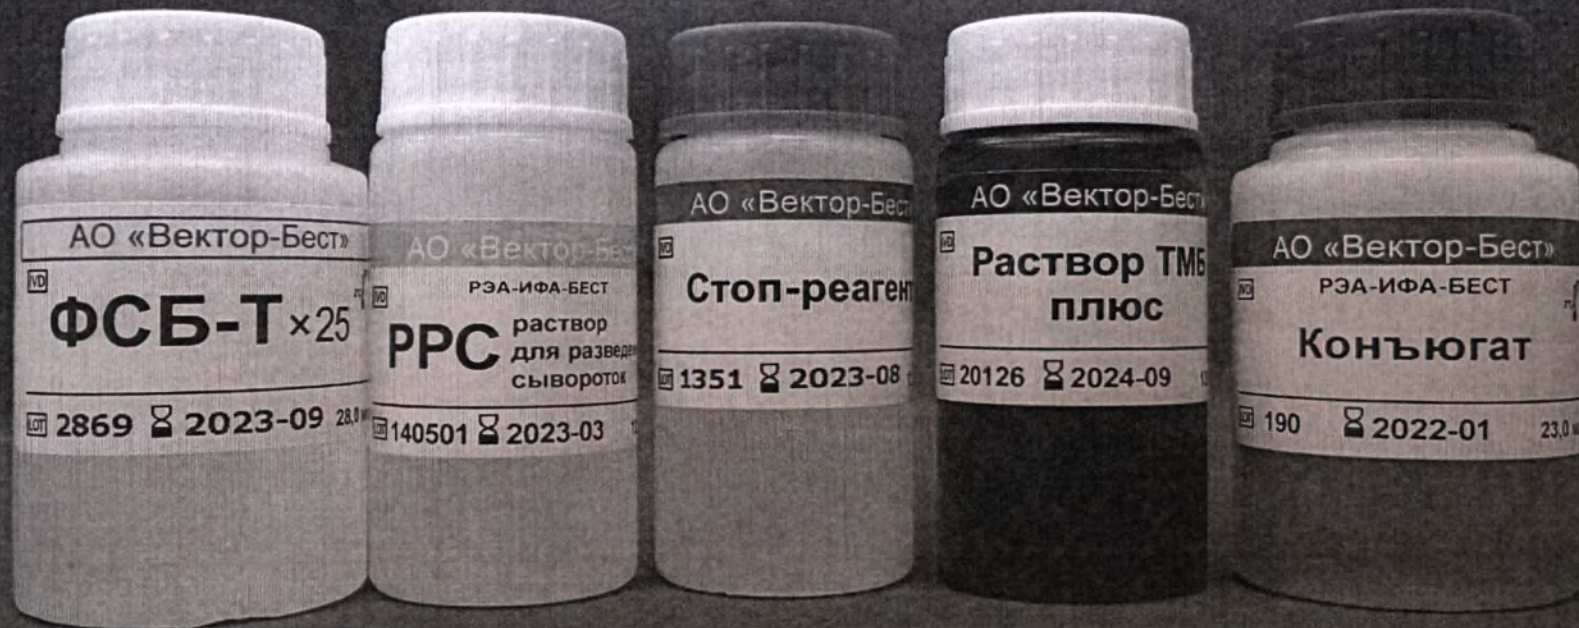

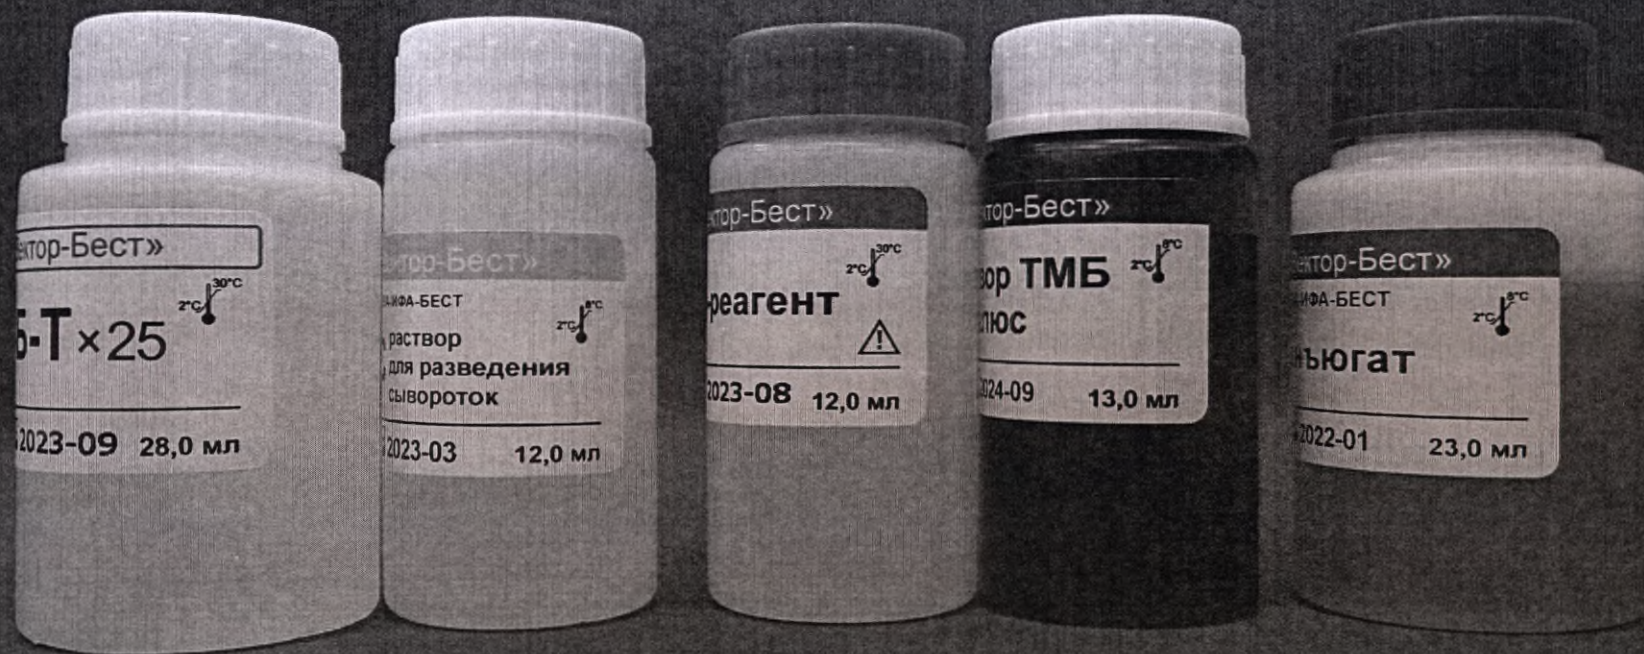


Фотографируется изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови (РЭА-ИФА-БЕСТ)» № 5

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

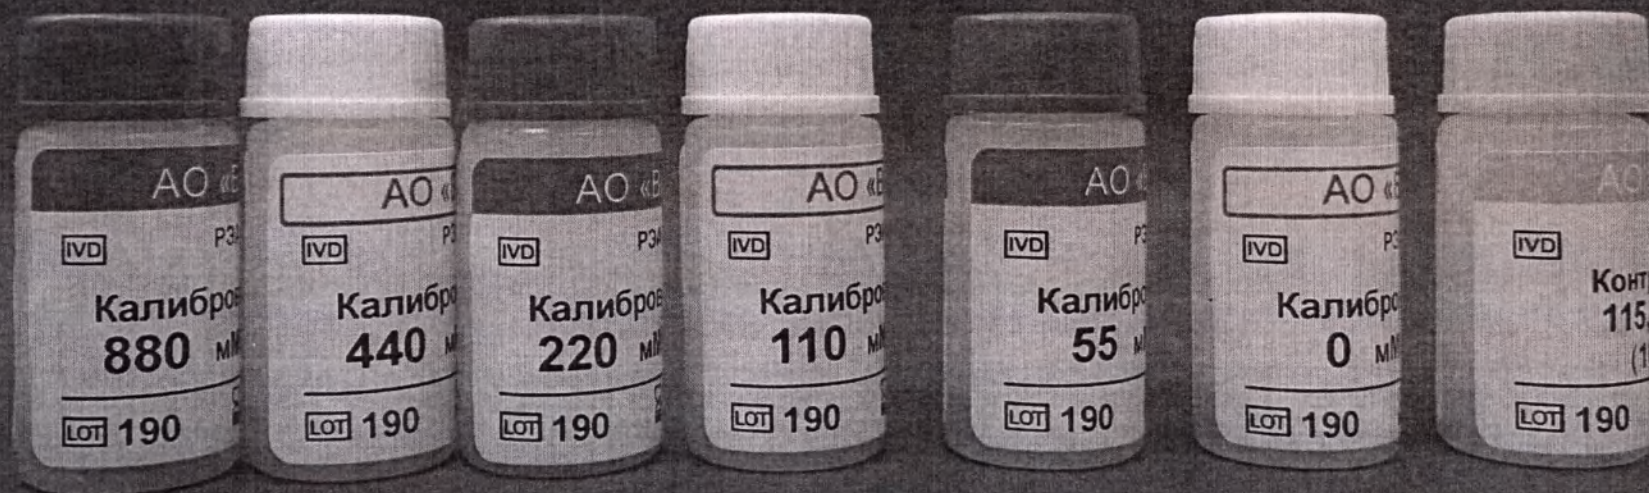

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови (РЭА-ИФА-БЕСТ)» № 6

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

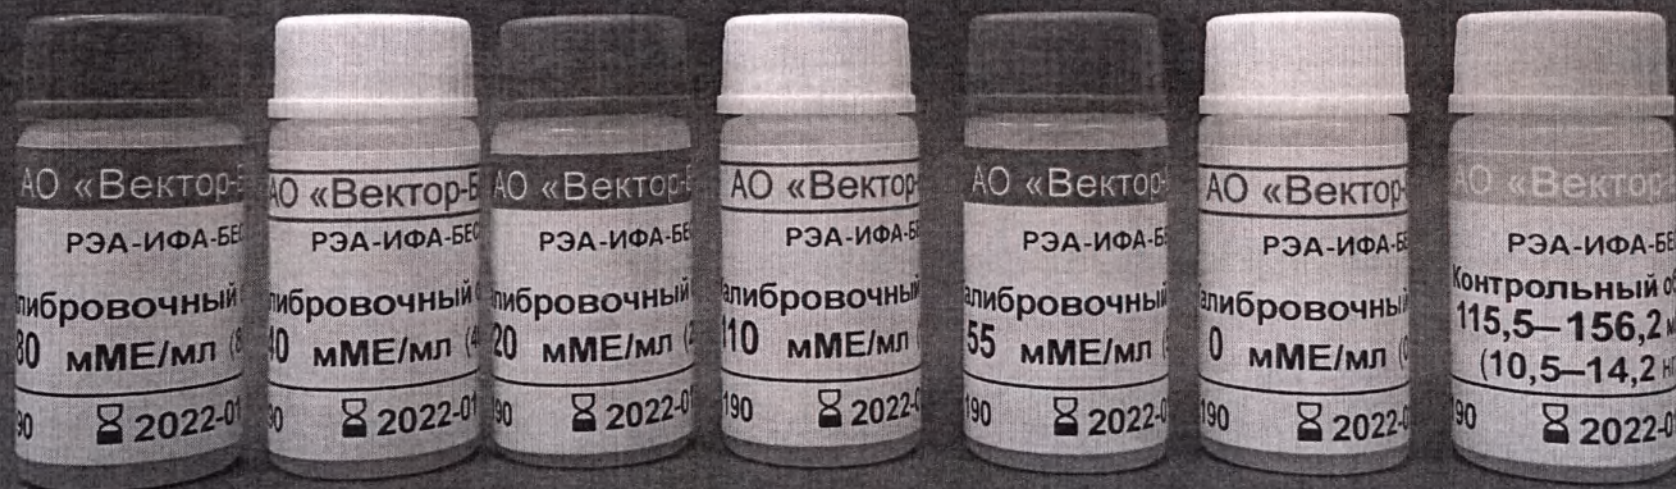

Фототрафаретное изображение компонентов медицинского изделия «Панель реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови (РЭА-ИФА-БЕСТ)» № 7

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

