


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 1)

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д. 2020 г.

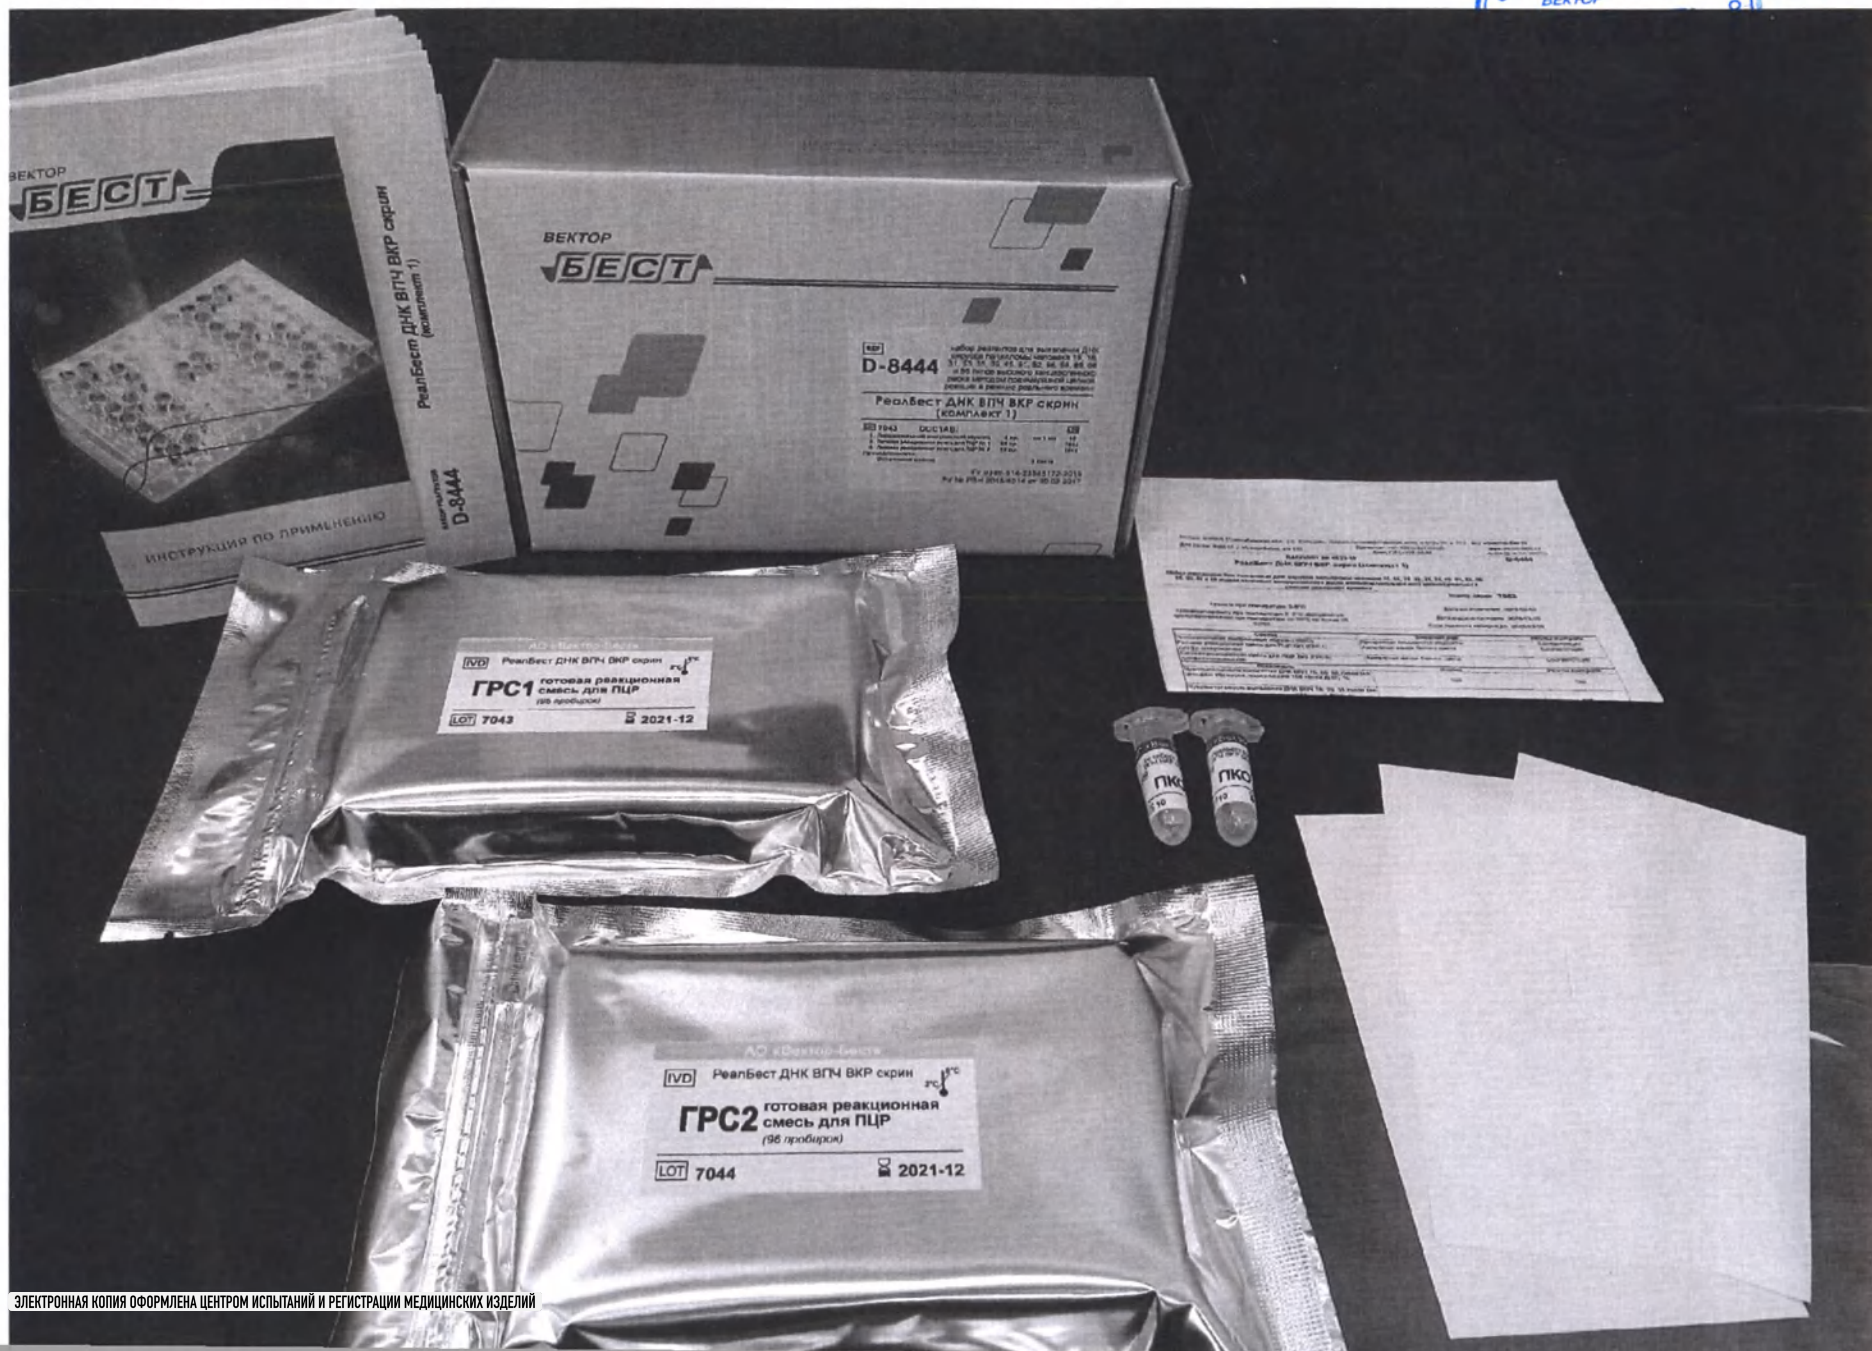

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 1) №1

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«08.02.2020» 2020 г.

ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-8444

набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

**РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин
(комплект 1)**

LOT 7043

СОСТАВ:

1. Положительный контрольный образец	2 пр.	по 1 мл	10
2. Готовая реакционная смесь для ПЦР № 1	96 пр.		7043
3. Готовая реакционная смесь для ПЦР № 2	96 пр.		7044

Принадлежности:

Оптическая плёнка

3 листа

ТУ 9398-514-23548172-2015
ПУ № РЗН 2016/4014 от 10.02.2017


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 1) №2

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д. 06 ФЕВ 2020 г.

ВЕКТОР

БЕСТ

REF **D-8444** LOT **7043**



IVD

Σ 96



2019-12-19

2020-12-19

**РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин
(комплект 1)**




84441912200704300001



Для профессионального применения

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 1) №1

Генеральный директор АО «Бектор-Бест» Хусаинов М.Д. 2020 г.

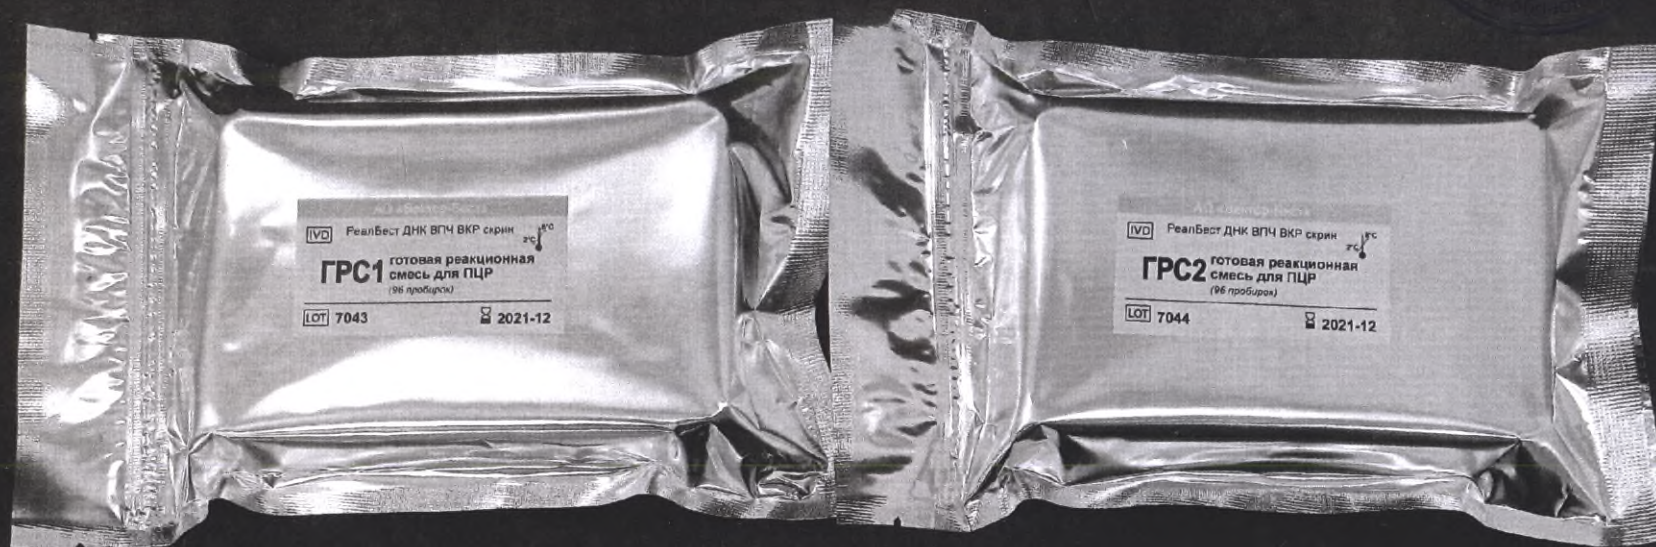

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 1) №2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«06.02» 2020 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 1) №3

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д. 2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 1) №4

Генеральный директор: Хусаинов М.Д.
АО «Бектор-Бест» 2020 г.

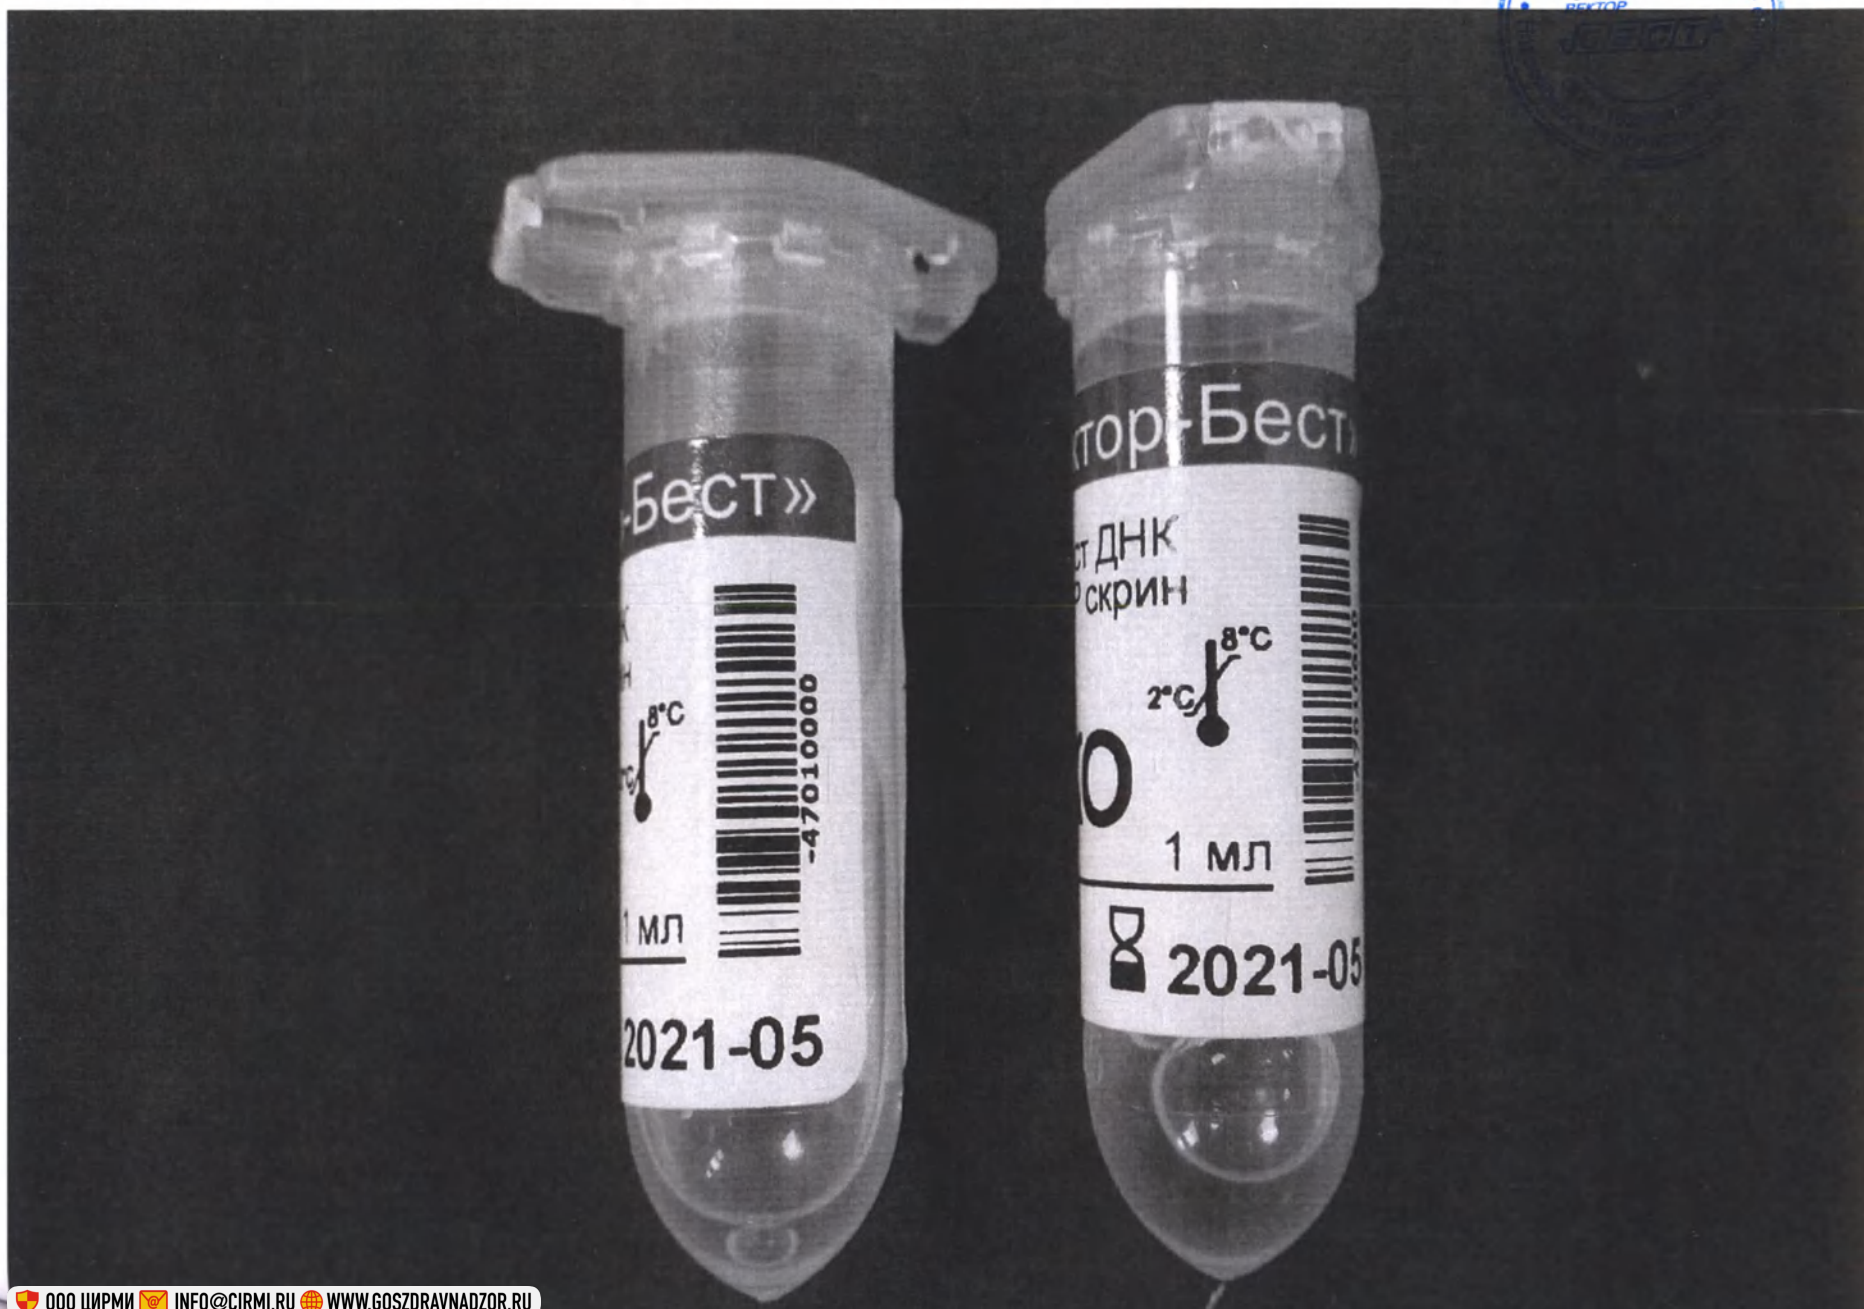


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 2)

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д. 2020 г.

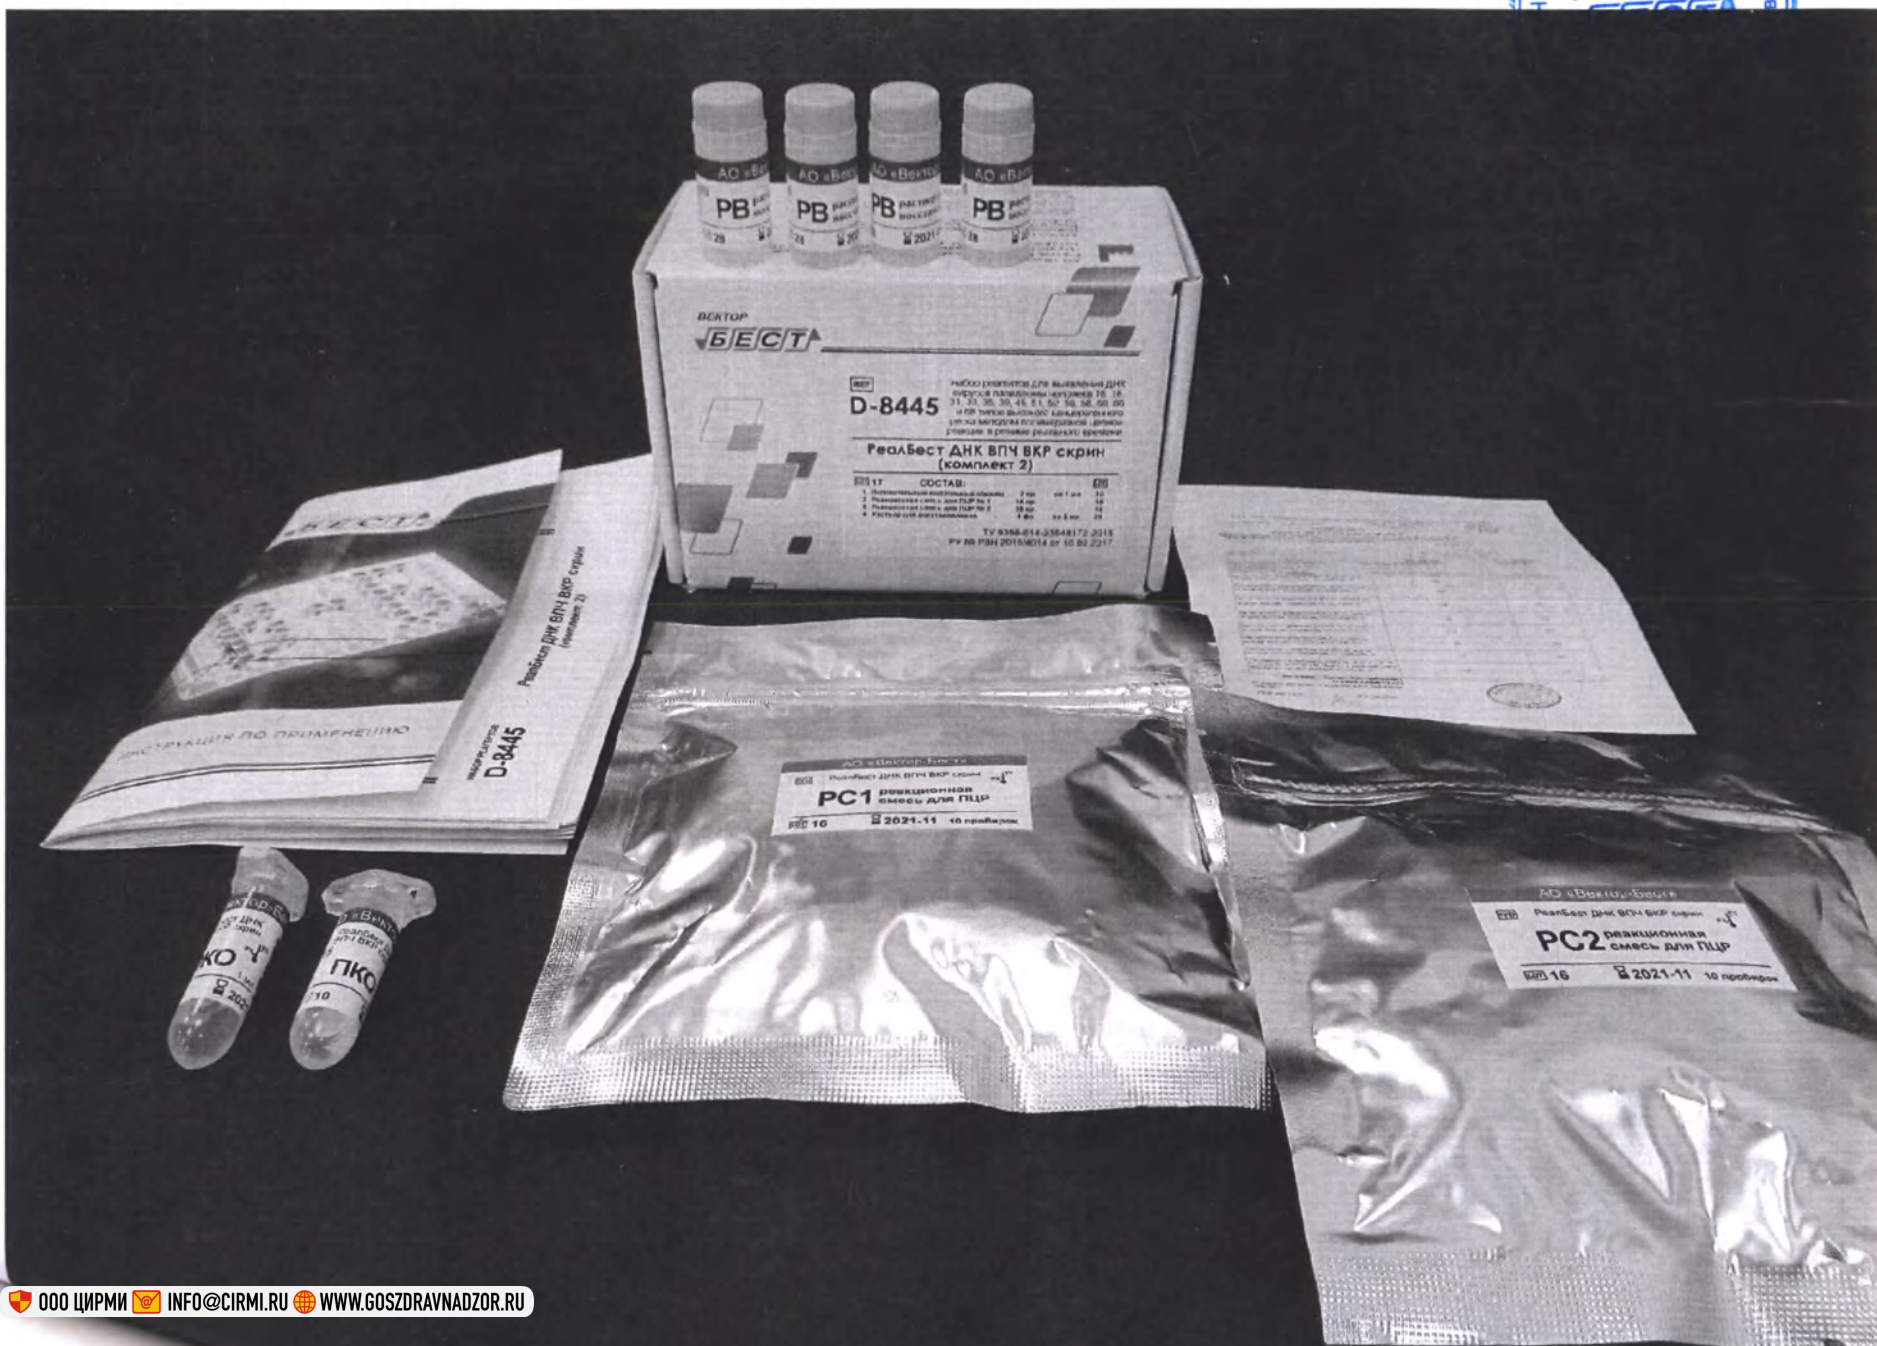

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 2) №1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
06 FEB 2020 г.

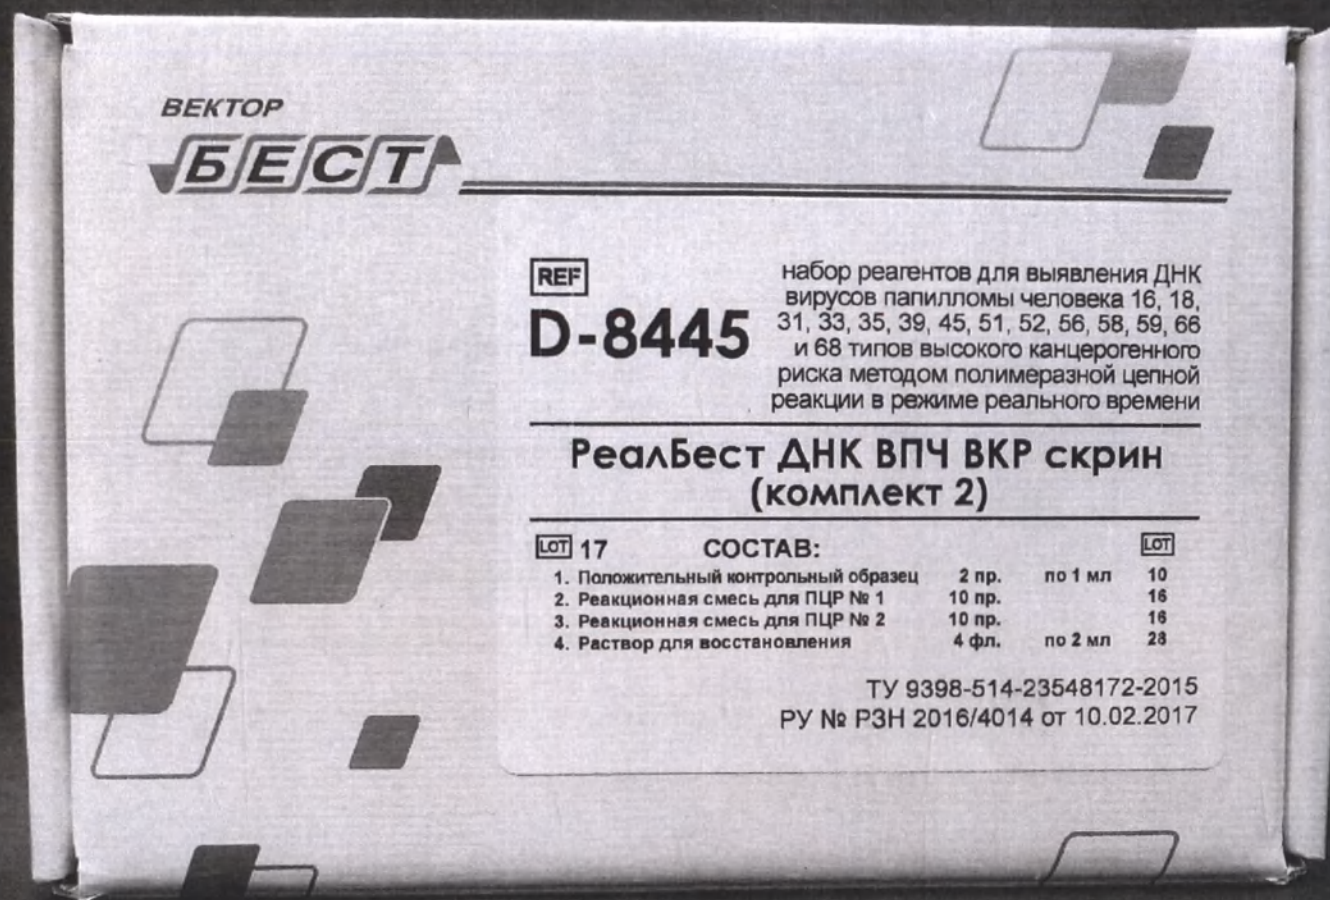

REF

D-8445

набор реагентов для выявления ДНК
вирусов папилломы человека 16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66
и 68 типов высокого канцерогенного
риска методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени

**РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин
(комплект 2)**

LOT 17

СОСТАВ:

LOT

1. Положительный контрольный образец	2 пр.	по 1 мл	10
2. Реакционная смесь для ПЦР № 1	10 пр.		16
3. Реакционная смесь для ПЦР № 2	10 пр.		16
4. Раствор для восстановления	4 фл.	по 2 мл	28



ТУ 9398-514-23548172-2015

ПУ № РЗН 2016/4014 от 10.02.2017

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 2) №2

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д. 2020 г.



REF **D-8445** LOT **17**
    **2019-11-07**
 **2020-11-07**

**РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин
(комплект 2)**



84450711200001700003



Для профессионального применения

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 2) №1

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«86» FEB 2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 2) №2

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д. 2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 2) №3

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д. 2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 2) №4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
«06-06» 2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 2) №5

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
Хусаинов М.Д.
«06 Фев» 2020 г.

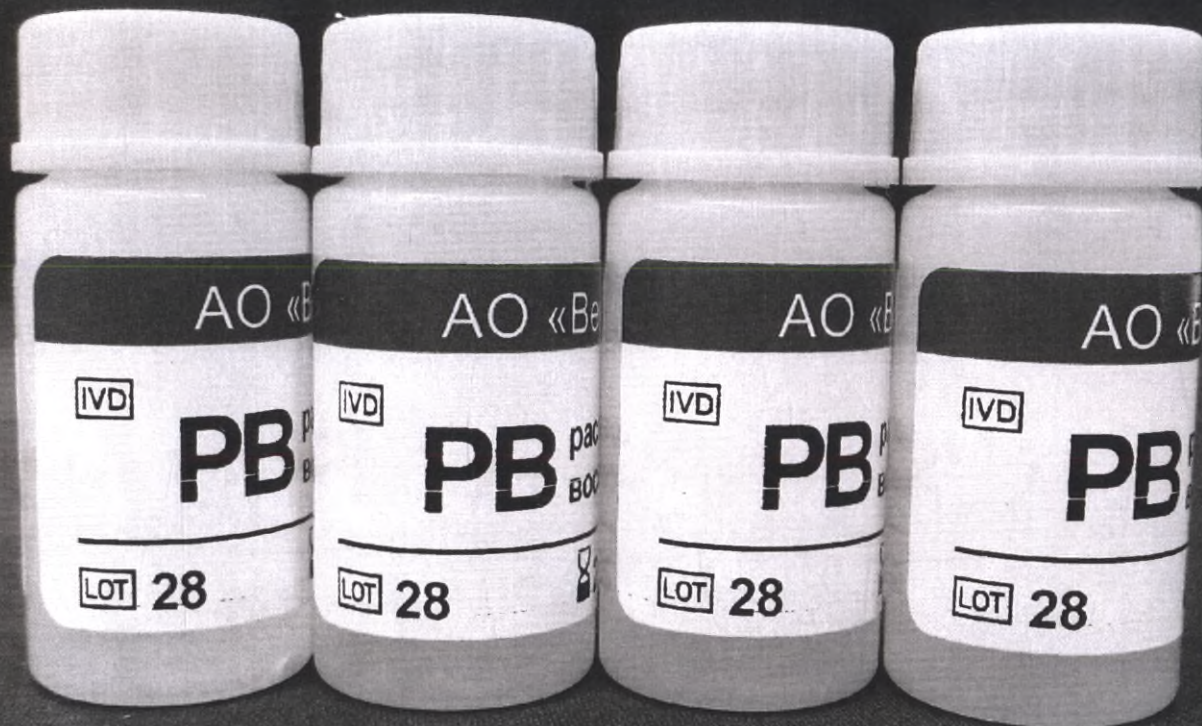

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 2) №6

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
_____ 2020 г.

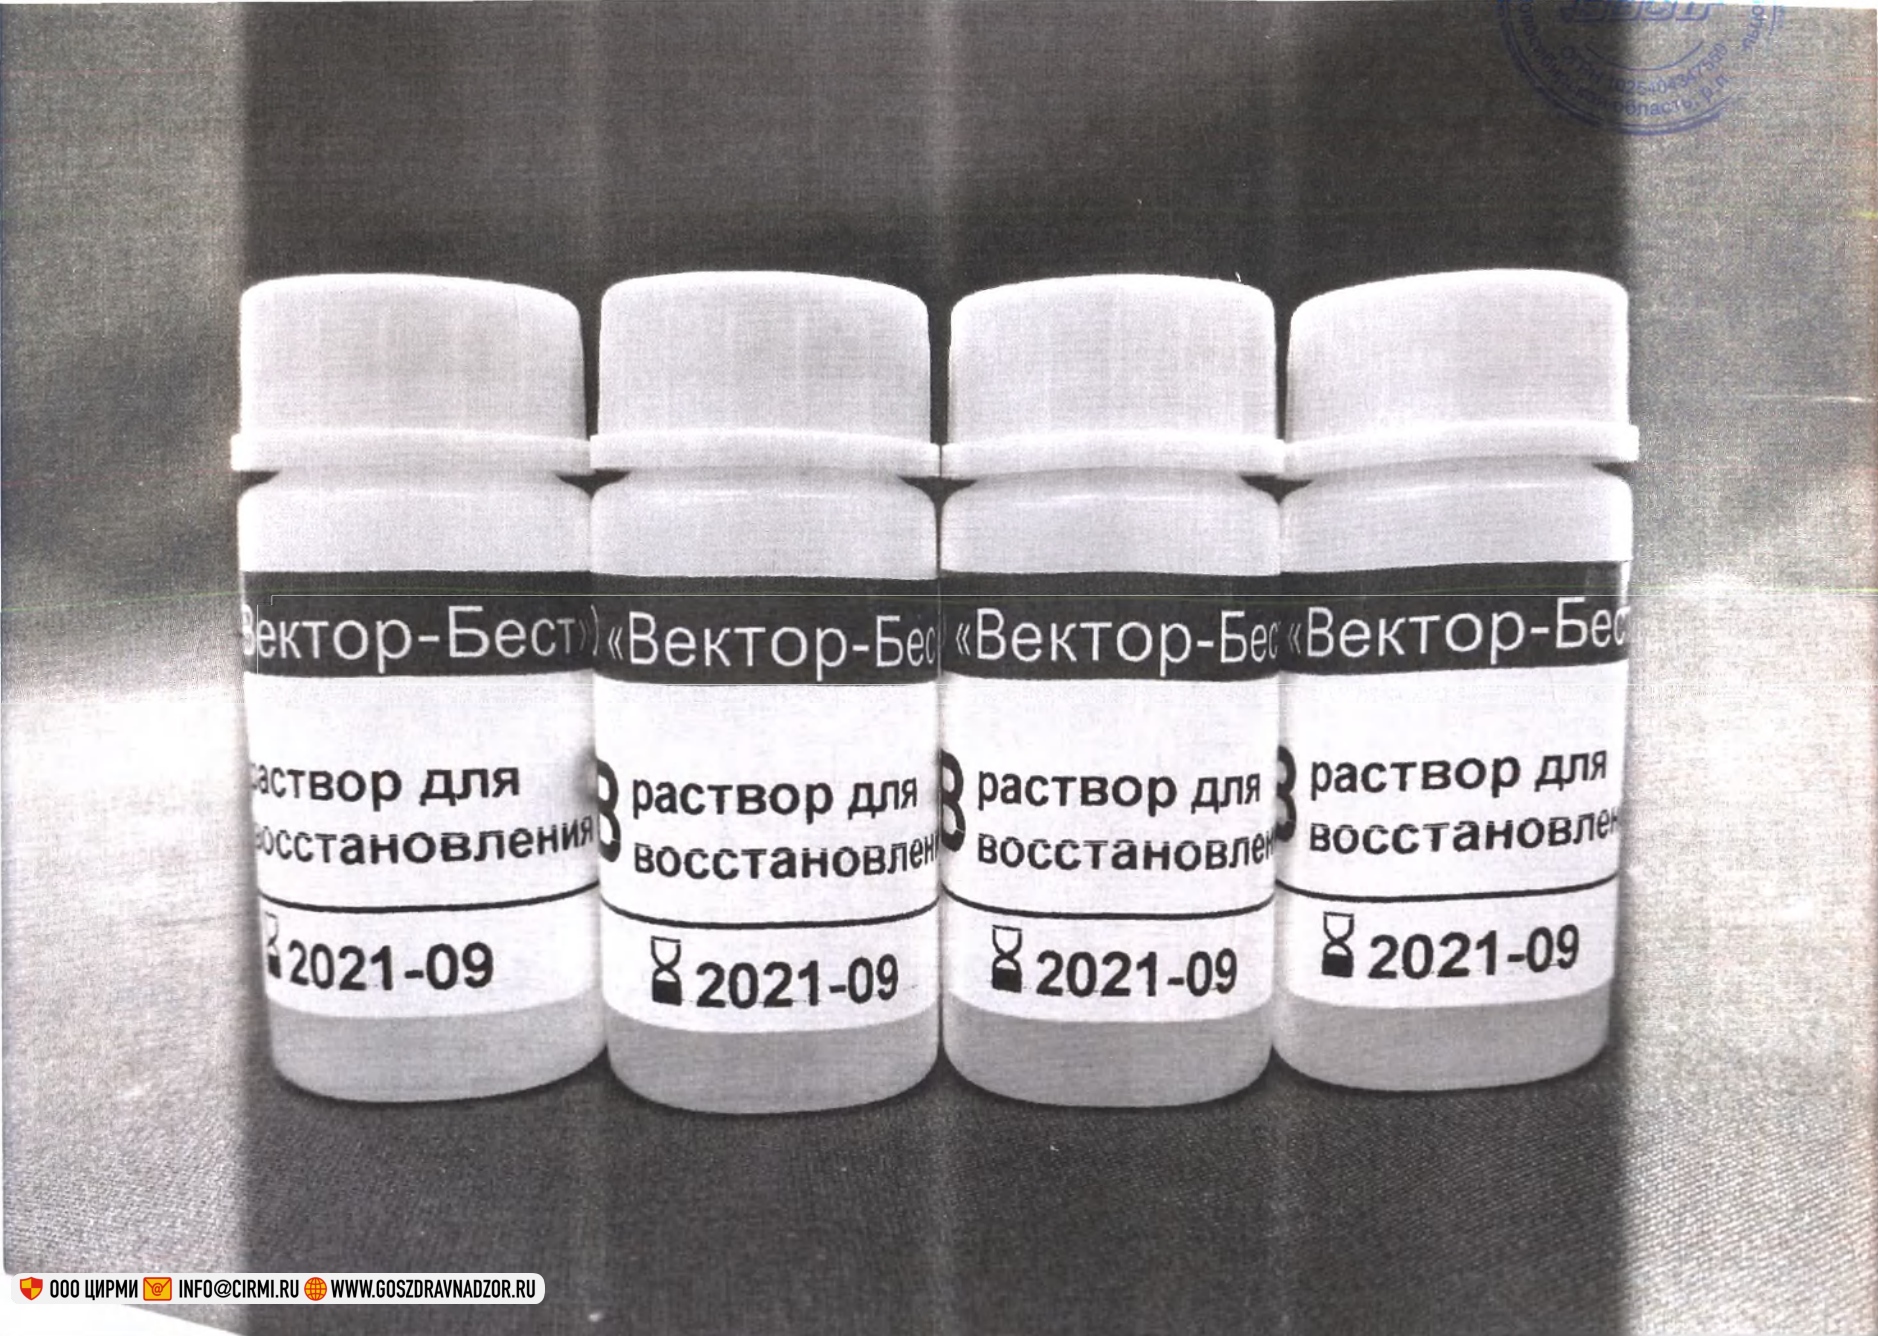

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов высокого канцерогенного риска методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ВПЧ ВКР скрин)» (Комплект 2) №7

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» «18» ФЕВ 2020 г.

