

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Генератор высокочастотный для системы диатермической электрохирургии
общего назначения «Лектрафьюз» (Lektrafuse), с принадлежностями»**

Содержание


Генератор высокочастотный для системы диатермической электрохирургии общего назначения «Лектрафьюз» (Lektrafuse), (лицевая поверхность).	2
Генератор высокочастотный для системы диатермической электрохирургии общего назначения «Лектрафьюз» (Lektrafuse), (оборотная поверхность).	3
Генератор высокочастотный для системы диатермической электрохирургии общего назначения «Лектрафьюз» (Lektrafuse) с принадлежностями.	4
Педаль управления	5
Кабель сетевой	6
Кабель соединения аппаратов, для выравнивания потенциалов	7

Приложение	8
------------	---


Свод маркировки упаковки медицинского изделия

Потребительская упаковка (складная картонная коробка) для Генератора высокочастотного для системы диатермической электрохирургии общего назначения «Лектрафьюз» (Lektrafuse)	9
Маркировка на этикетке, наклеенной на складную картонную коробку Генератора высокочастотного для системы диатермической электрохирургии общего назначения «Лектрафьюз» (Lektrafuse) (складная картонная коробка)	10
Маркировка на этикетке, наклеенной на складную картонную коробку педали управления	11
Маркировка на этикетке, наклеенной на складную картонную коробку кабеля соединения аппаратов, для выравнивания потенциалов	12

1. Генератор высокочастотный для систем
(Lektrafuse), (лицевая поверхность).

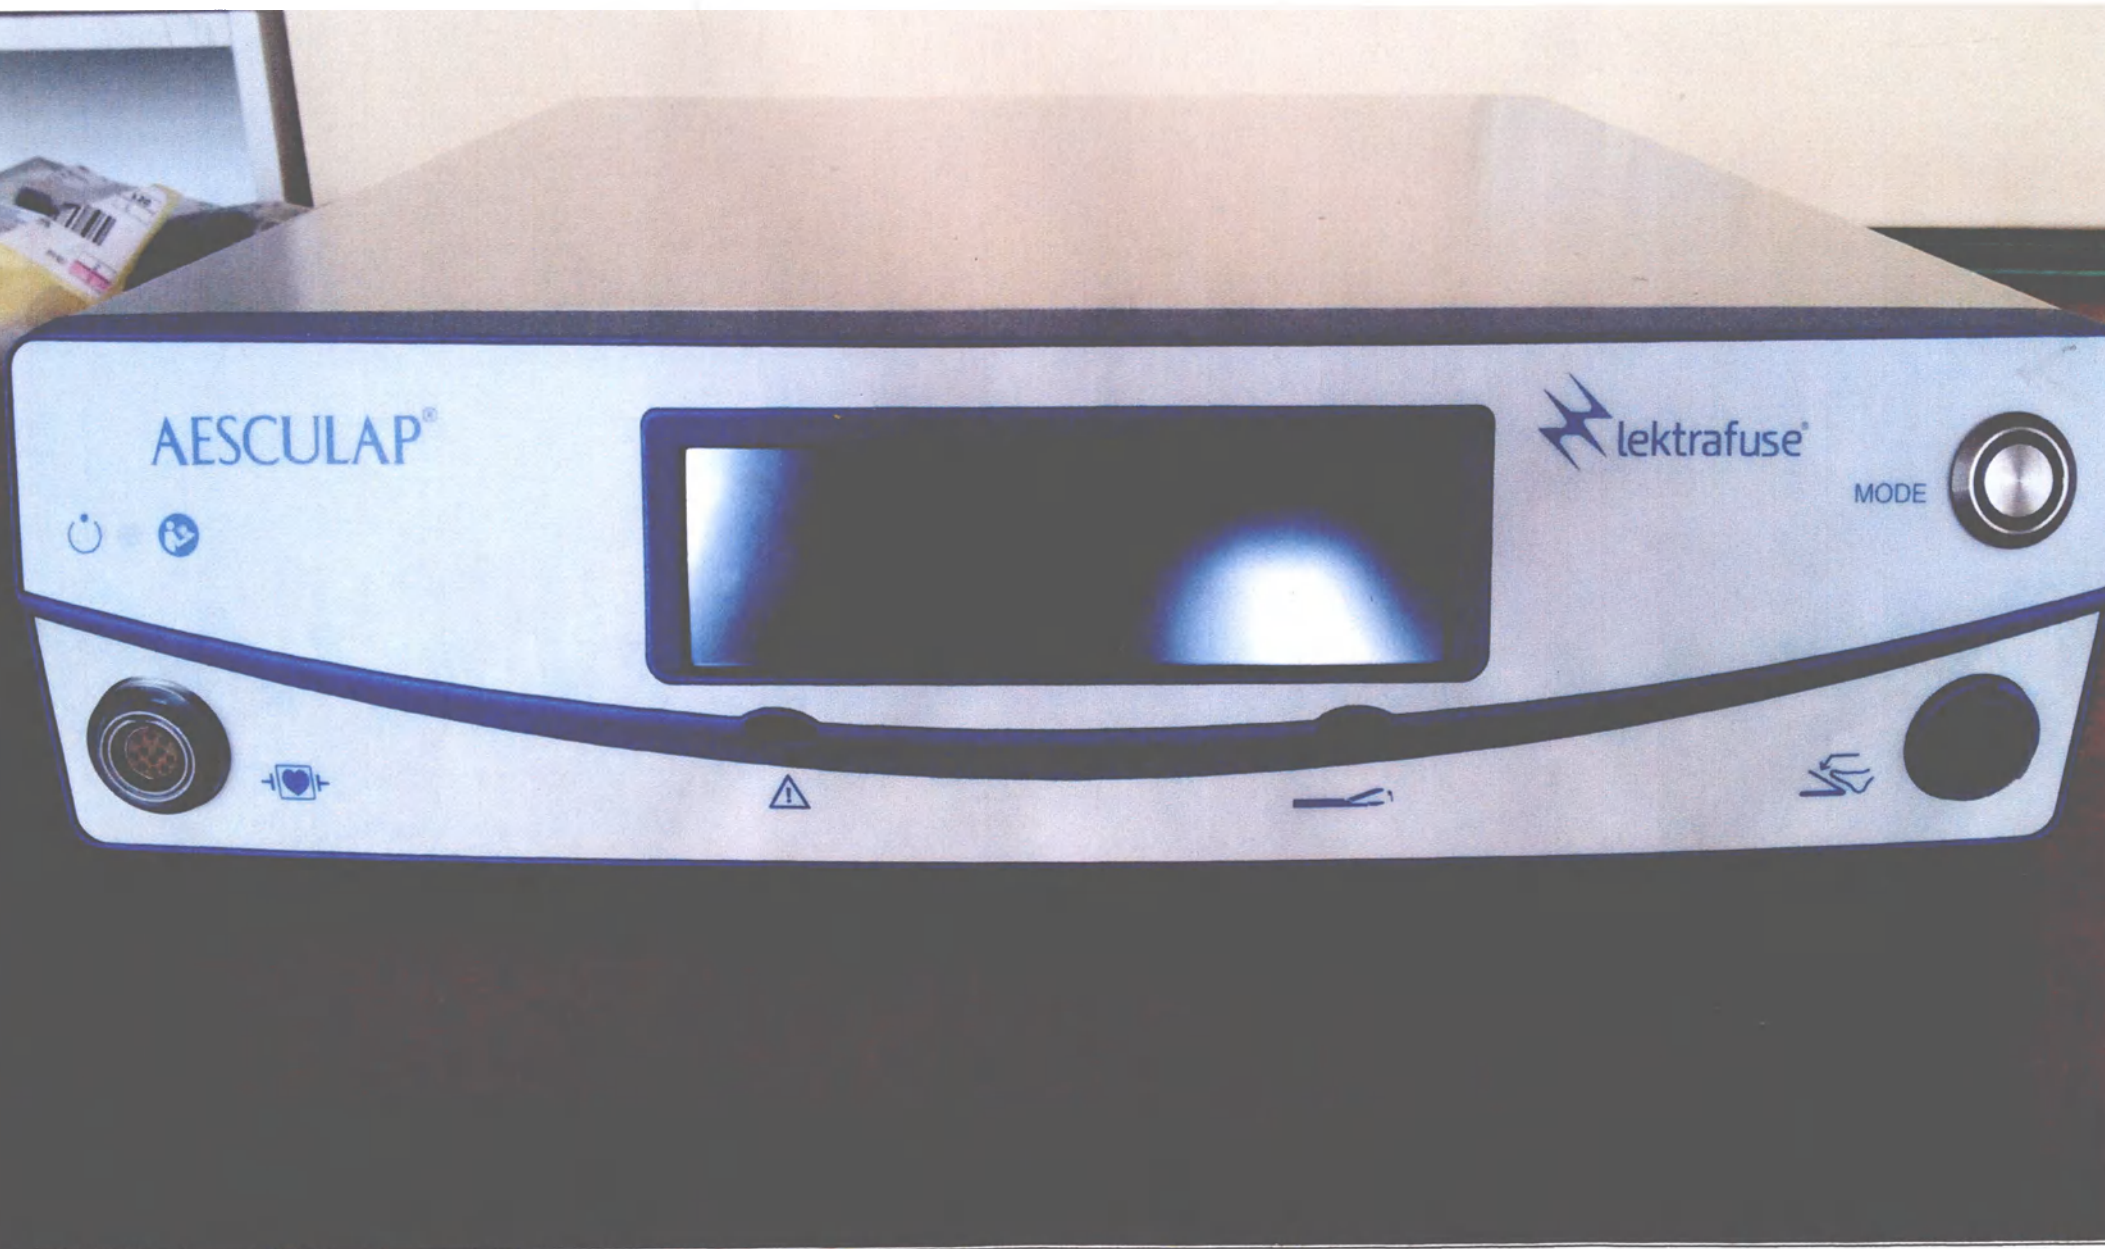


2. Генератор высокочастотный
(Lektrafuse), (оборотная поверхность).

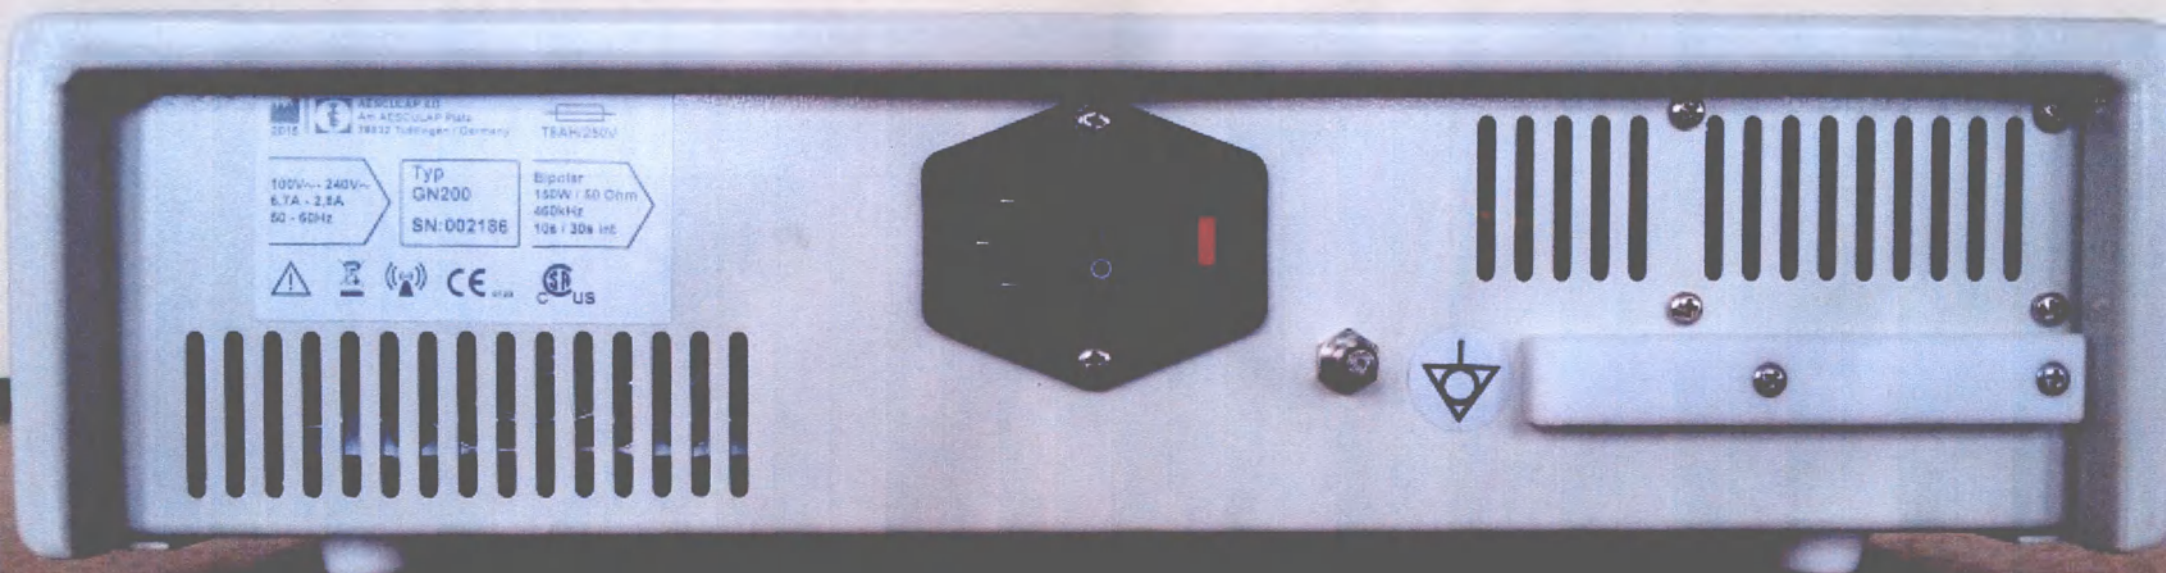

генератор высокочастотный для системы диатермической электрохирургии общего назначения «Лектрафьюз» (Lektrafuse) с принадлежностями.



Генератор высокочастотный для системы
диатермической электрохирургии
общего назначения «Лектрафьюз»
(Lektrafuse)
Педаль управления
Тележка с сеткой стальной для хранения
принадлежностей
Кабель сетевой и кабель соединения
аппаратов для выравнивания
потенциалов
Щипцы электрохирургические
биполярные «Кайман» (Caiman) для
открытой и малоинвазивной хирургии к
генератору высокочастотному для
системы диатермической
электрохирургии общего назначения
«Лектрафьюз» (Lektrafuse)

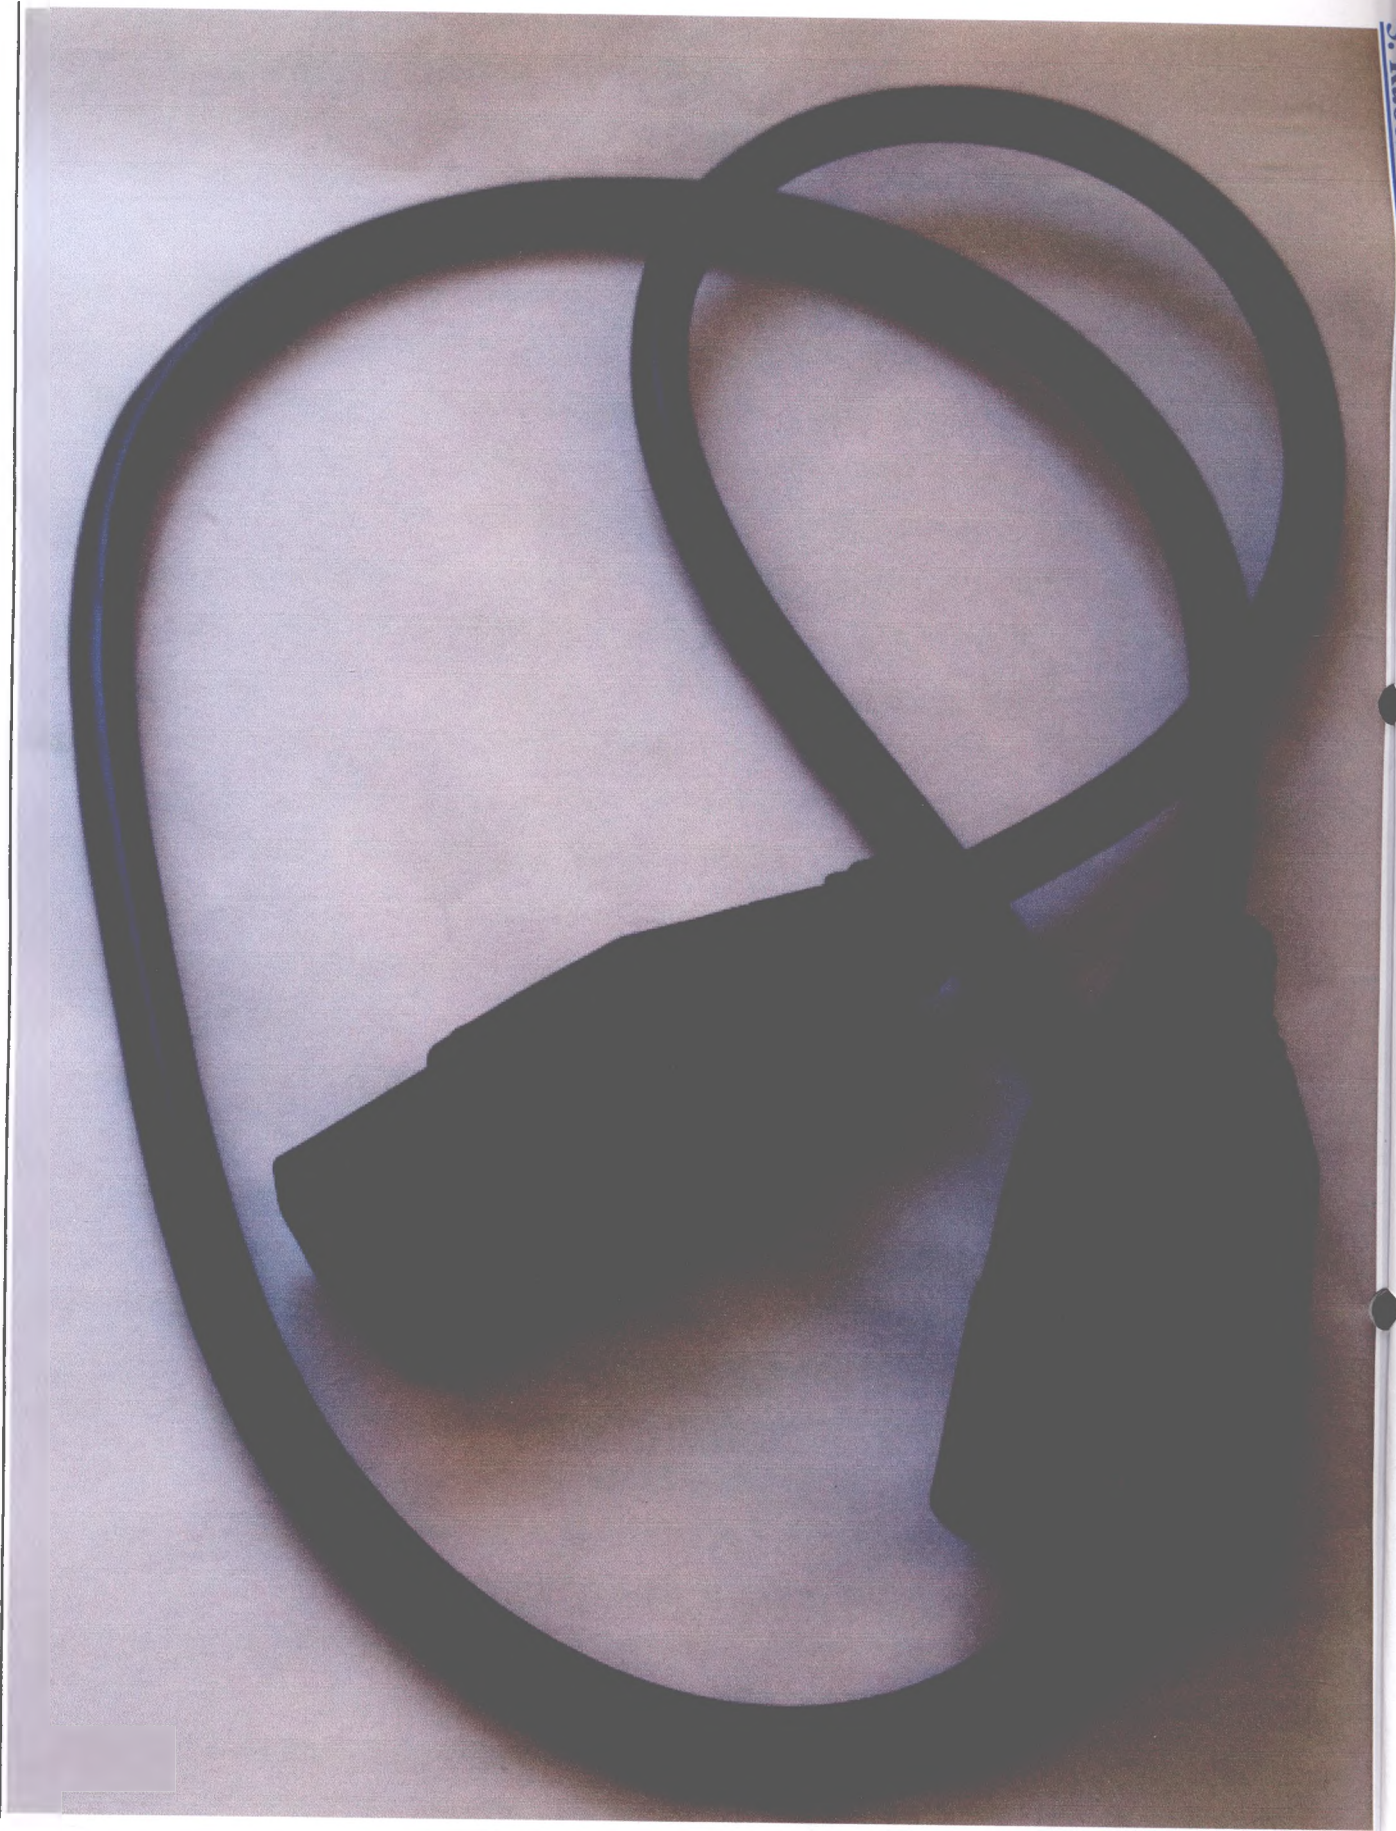





ПЕРЕВОД МАРКИРОВКИ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Генератор высокочастотный для системы диатермической
электрохирургии общего назначения «Лектрафьюз» (Lektrafuse), с
принадлежностями»

1. Потребительская упаковка (складная картонная коробка) для Генератора высокочастотного для системы диатермической электрохирургии общего назначения «Лектрафьюз» (Lektrafuse)

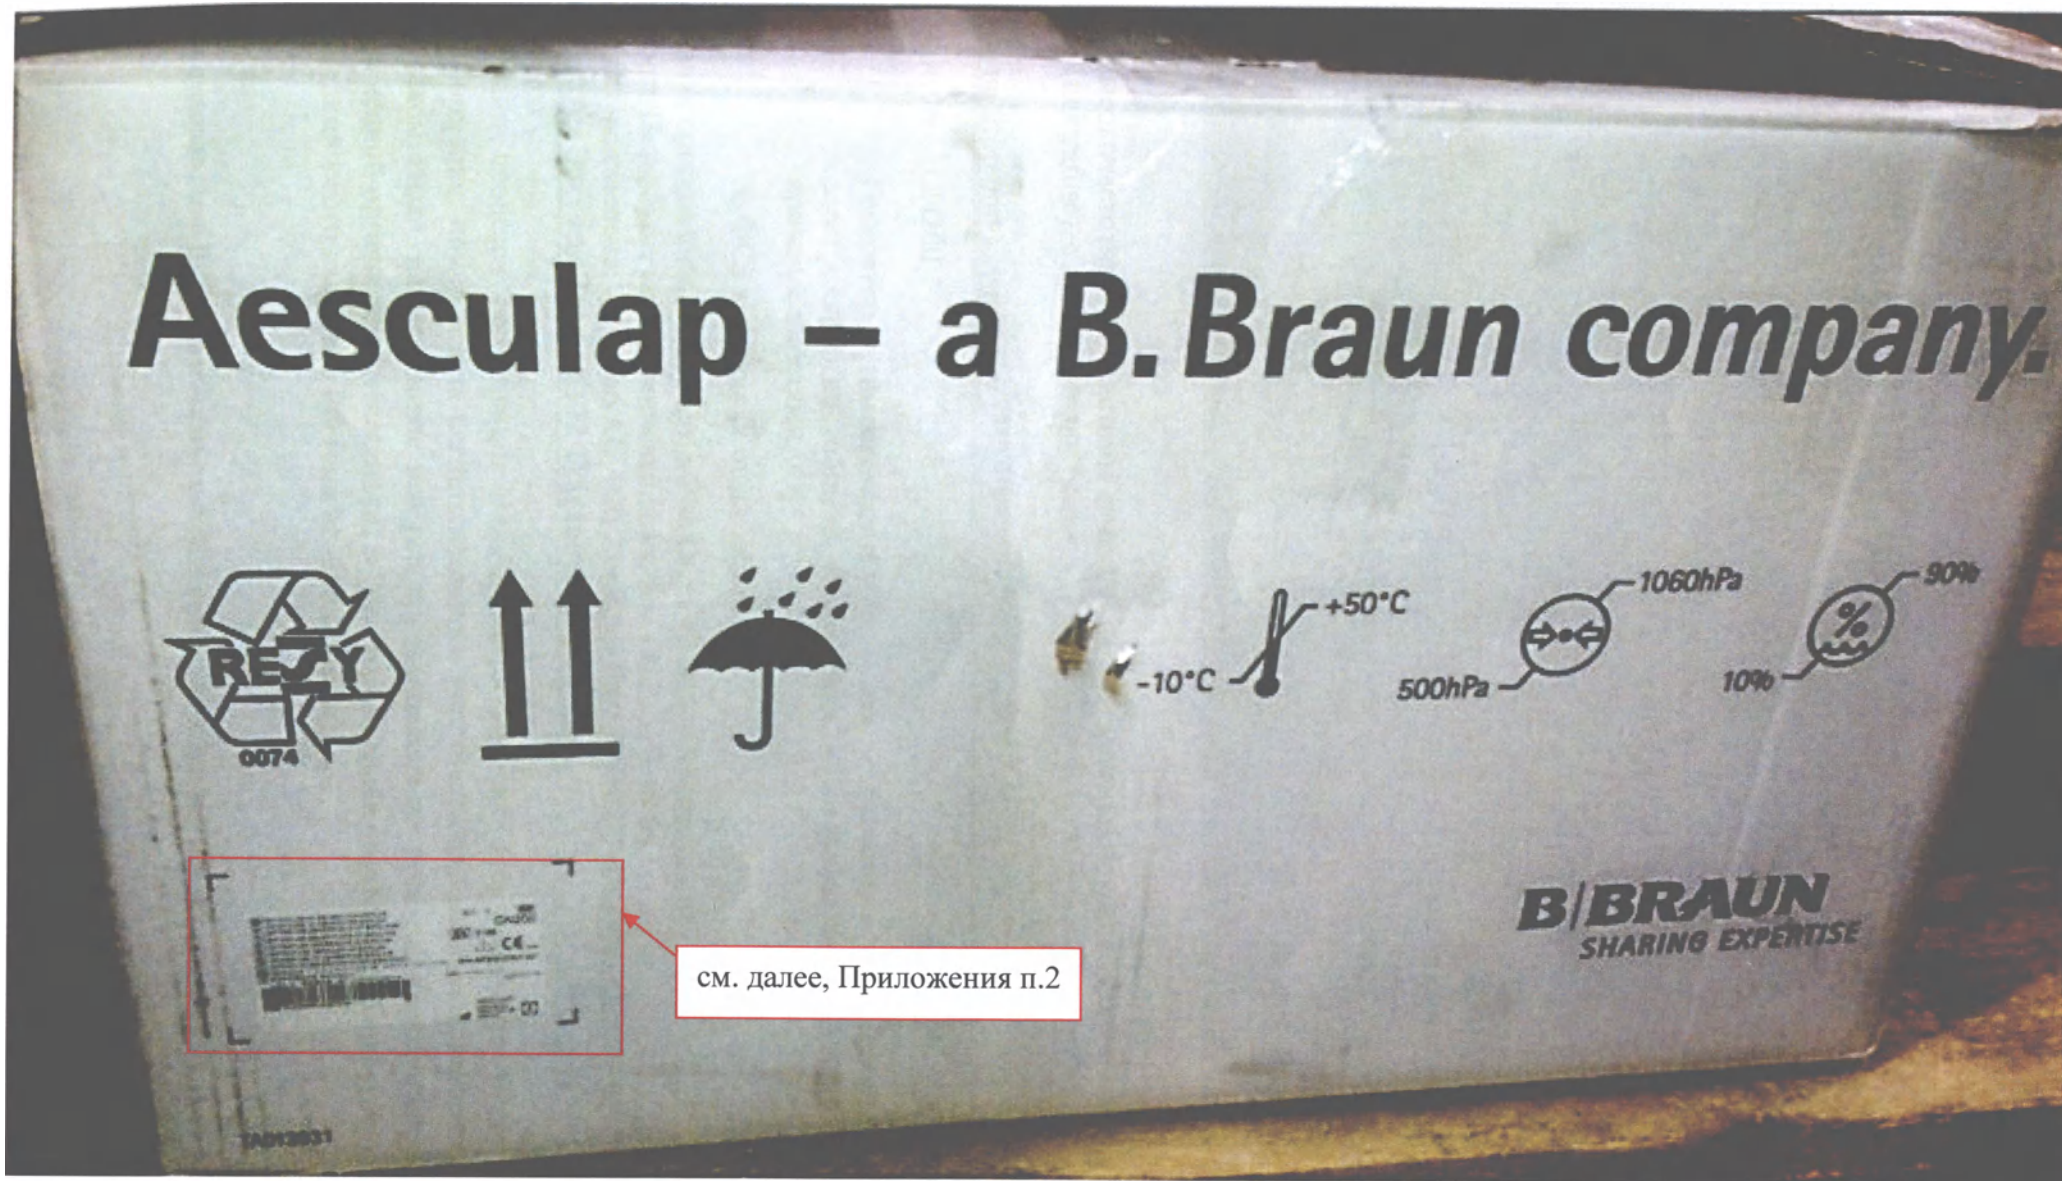

Маркировка на этикетке, наклеенной на складную картонную коробку Генератора высокочастотного для системы диатермической электрохирургии общего назначения «Лектрафьюз» (Lektrafuse) (складная картонная коробка)

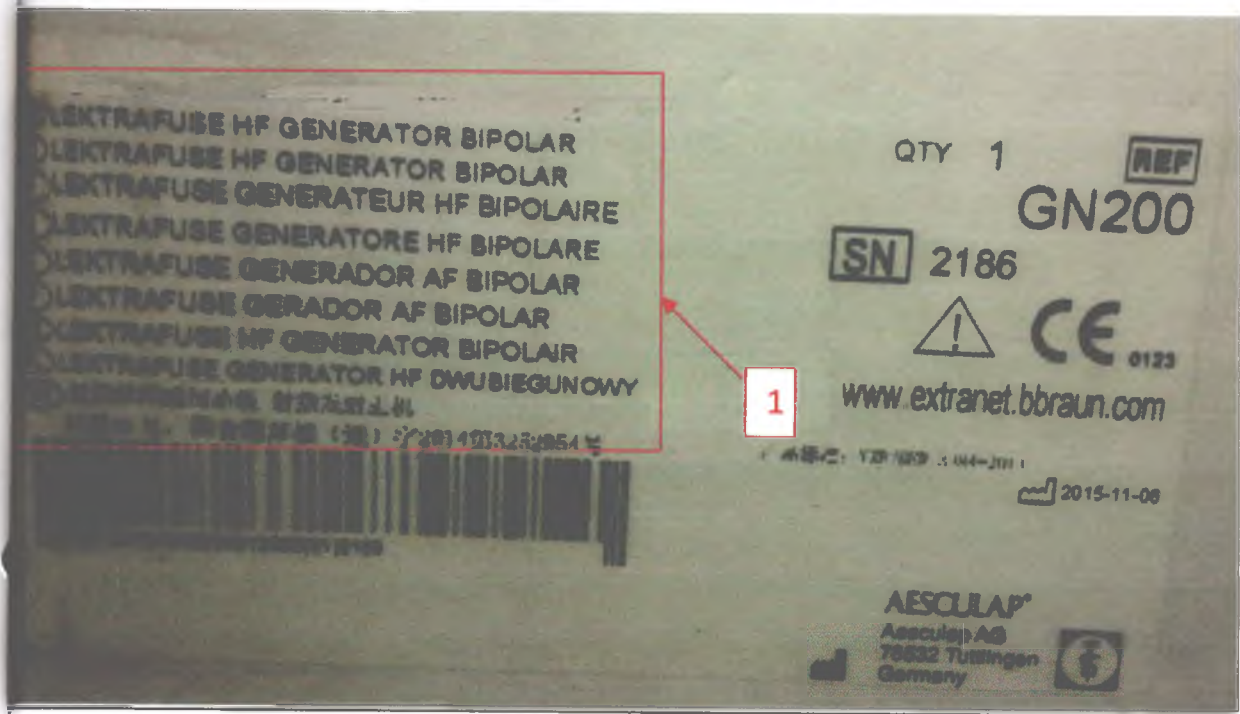

Генератор высокочастотный для системы диатермической электрохирургии общего назначения «Лектрафьюз» (Lektrafuse), с принадлежностями

Пакет стикера на вторичную упаковку : 1

RUS	Арт. № GN200	PGT
Описание	Генератор высокочастотный для системы диатермической электрохирургии общего назначения «Лектрафьюз» (Lektrafuse), с принадлежностями	
Номер и дата рег. уд.	№ ФСЗ xxxx/xxxxx от дд.мм.гггг	
Уполномоченная организация (импортер) в РФ: ООО «Б.Браун Медикал», 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.10, тел. (812) 320-40-04		
Производитель/Произведено: Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Germany. «Эскулап АГ» , Ам Эскулап-Плац, 78532 Тюттлинген, Германия		

После завершения процесса регистрации медицинского изделия дополнительно будет нанесена следующая информация: номер и дата регистрационного удостоверения, наименование медицинского изделия на русском языке, наименование и адрес производителя на русском языке, наименование и адрес уполномоченной организации (импортера) в РФ, символ знака соответствия при декларировании ответственности медицинского изделия в РФ (при необходимости)*.

Обозначение символов см. в Выписке из технической документации раздел «Маркировка».

Маркировка на этикетке, наклеенной на складную картонную коробку педали управления



- Педаль управления


Акет стикера на вторичную упаковку:¹

RUS	Арт. № GN201	
Описание	Педаль управления	
Номер и дата рег. уд.	№ ФСЗ xxxx/xxxxx от dd.mm.yyyy	
Уполномоченная организация (импортер) в РФ: ООО «Б.Браун Медикал», 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.10, тел. (812) 320-40-04		
Производитель/Произведено: Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Germany. Эскулап АГ», Ам Эскулап-Плац, 78532 Туттлинген, Германия		

После завершения процесса регистрации на изделие дополнительно будет нанесена следующая информация: номер и дата регистрационного удостоверения, наименование изделия на русском языке, наименование и адрес производителя на русском языке, наименование и адрес уполномоченной организации (импортера) в РФ, символ знака соответствия при декларировании соответствия медицинскому изделию в РФ (при необходимости)*.

Обозначение символов см. в Выписке из технической документации раздел «Маркировка».

Маркировка на этикетке, наклеенной на складную картонную коробку кабеля соединения аппаратов, выравнивания потенциалов

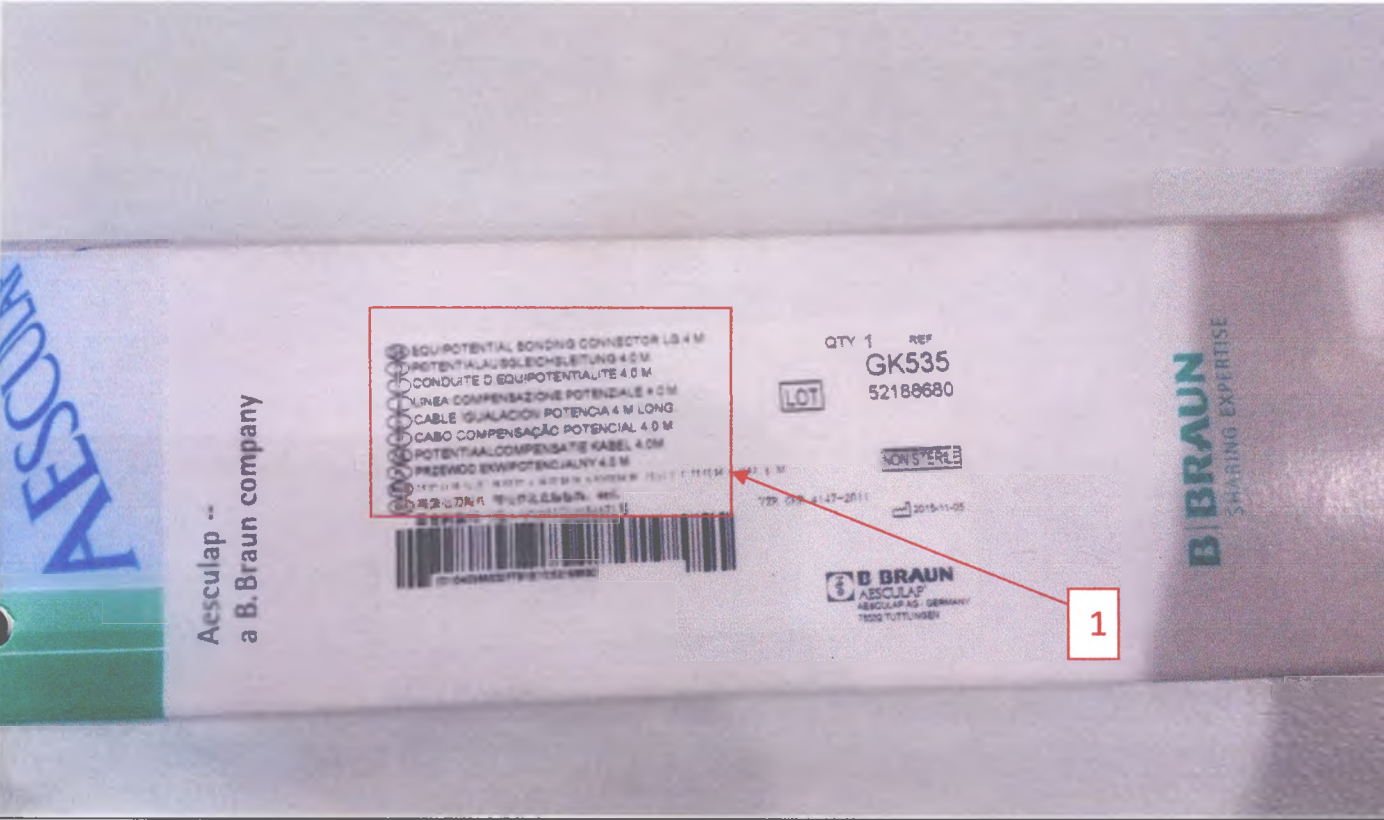

Кабель соединения аппаратов, для выравнивания потенциалов

акет стикера на вторичную упаковку : 1

	Арт. № GK535	
Описание	Кабель соединения аппаратов, для выравнивания потенциалов	
Номер и дата рег. уд.	№ ФСЗ xxxx/xxxxx от дд.мм.гггг	
Уполномоченная организация (импортер) в РФ: ООО «Б.Браун Медикал», 91040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.10, тел. (812) 320-40-04		
Производитель/Произведено: Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Germany. Эскулап АГ», Ам Эскулап-Плац, 78532 Туттлинген, Германия		

После завершения процесса регистрации медицинского изделия на упаковку дополнительно добавлены: номер и дата регистрационного удостоверения, наименование медицинского изделия на русском языке, наименование и адрес производителя на русском языке, наименование и адрес уполномоченной организации (импортера) в РФ, символ знака соответствия при декларировании соответствия медицинского изделия в РФ (при необходимости)*.

Обозначение символов см. в Выписке из технической документации раздел «Маркировка».

Прошито и пронумеровано и скреплено печатью 12

прислужив листа(ов)

Копия верна.

Генеральный директор

Петухов М.М.

(подпись)

М.П.

«25» декабря 201 7 года

