

SIEMENS

ООО «Сименс»

Директор Департамента

Системы визуализации и терапии

Подразделение «Здравоохранение»

Аспидов А.В.

«06» ноября 2015 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

«Система компьютерной томографии SOMATOM Score»



Общий вид медицинского изделия (ракурс 1)

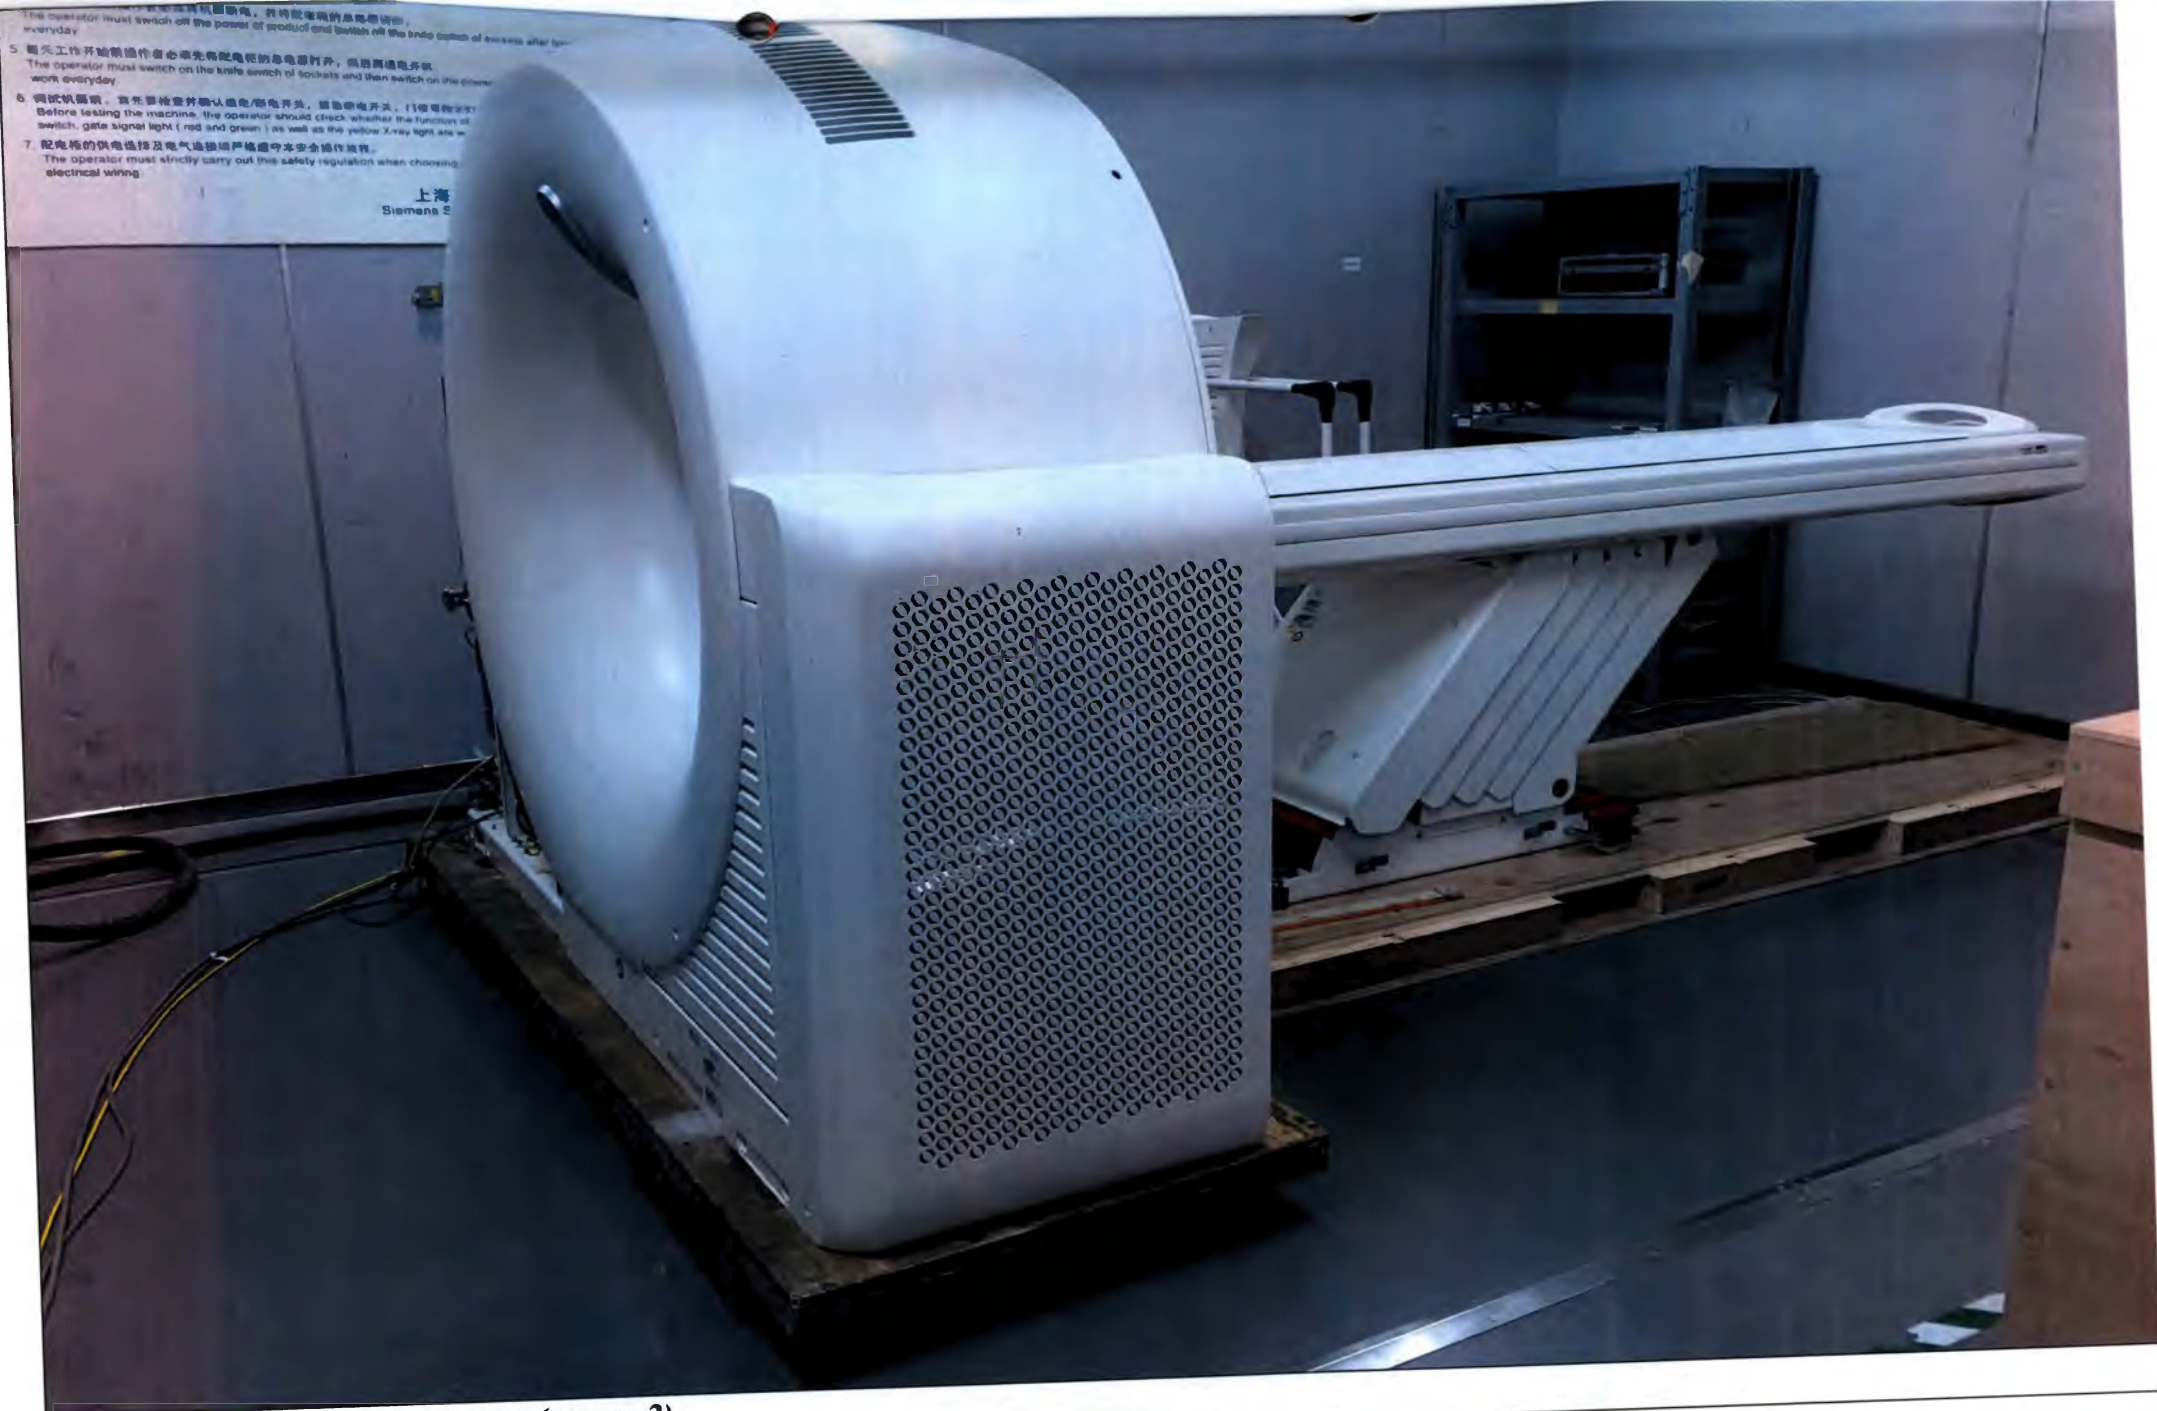


5. 每天工作开始前操作者必须先检查配电箱的总电源开关，并确认配电箱的总电源开关处于关闭状态。
The operator must switch on the knife switch of sockets and then switch on the power work everyday.

6. 调试机器前，要先检查并确认总电源/配电箱，并检查配电箱，门电等是否正常。
Before testing the machine, the operator should check whether the function of switch, gate signal light (red and green) as well as the yellow X-ray light are normal.

7. 配电箱的供电连接及电气连接必须严格遵守安全操作规程。
The operator must strictly carry out this safety regulation when choosing electrical wiring.

上海
Siemens


Общий вид медицинского изделия (ракурс 2)

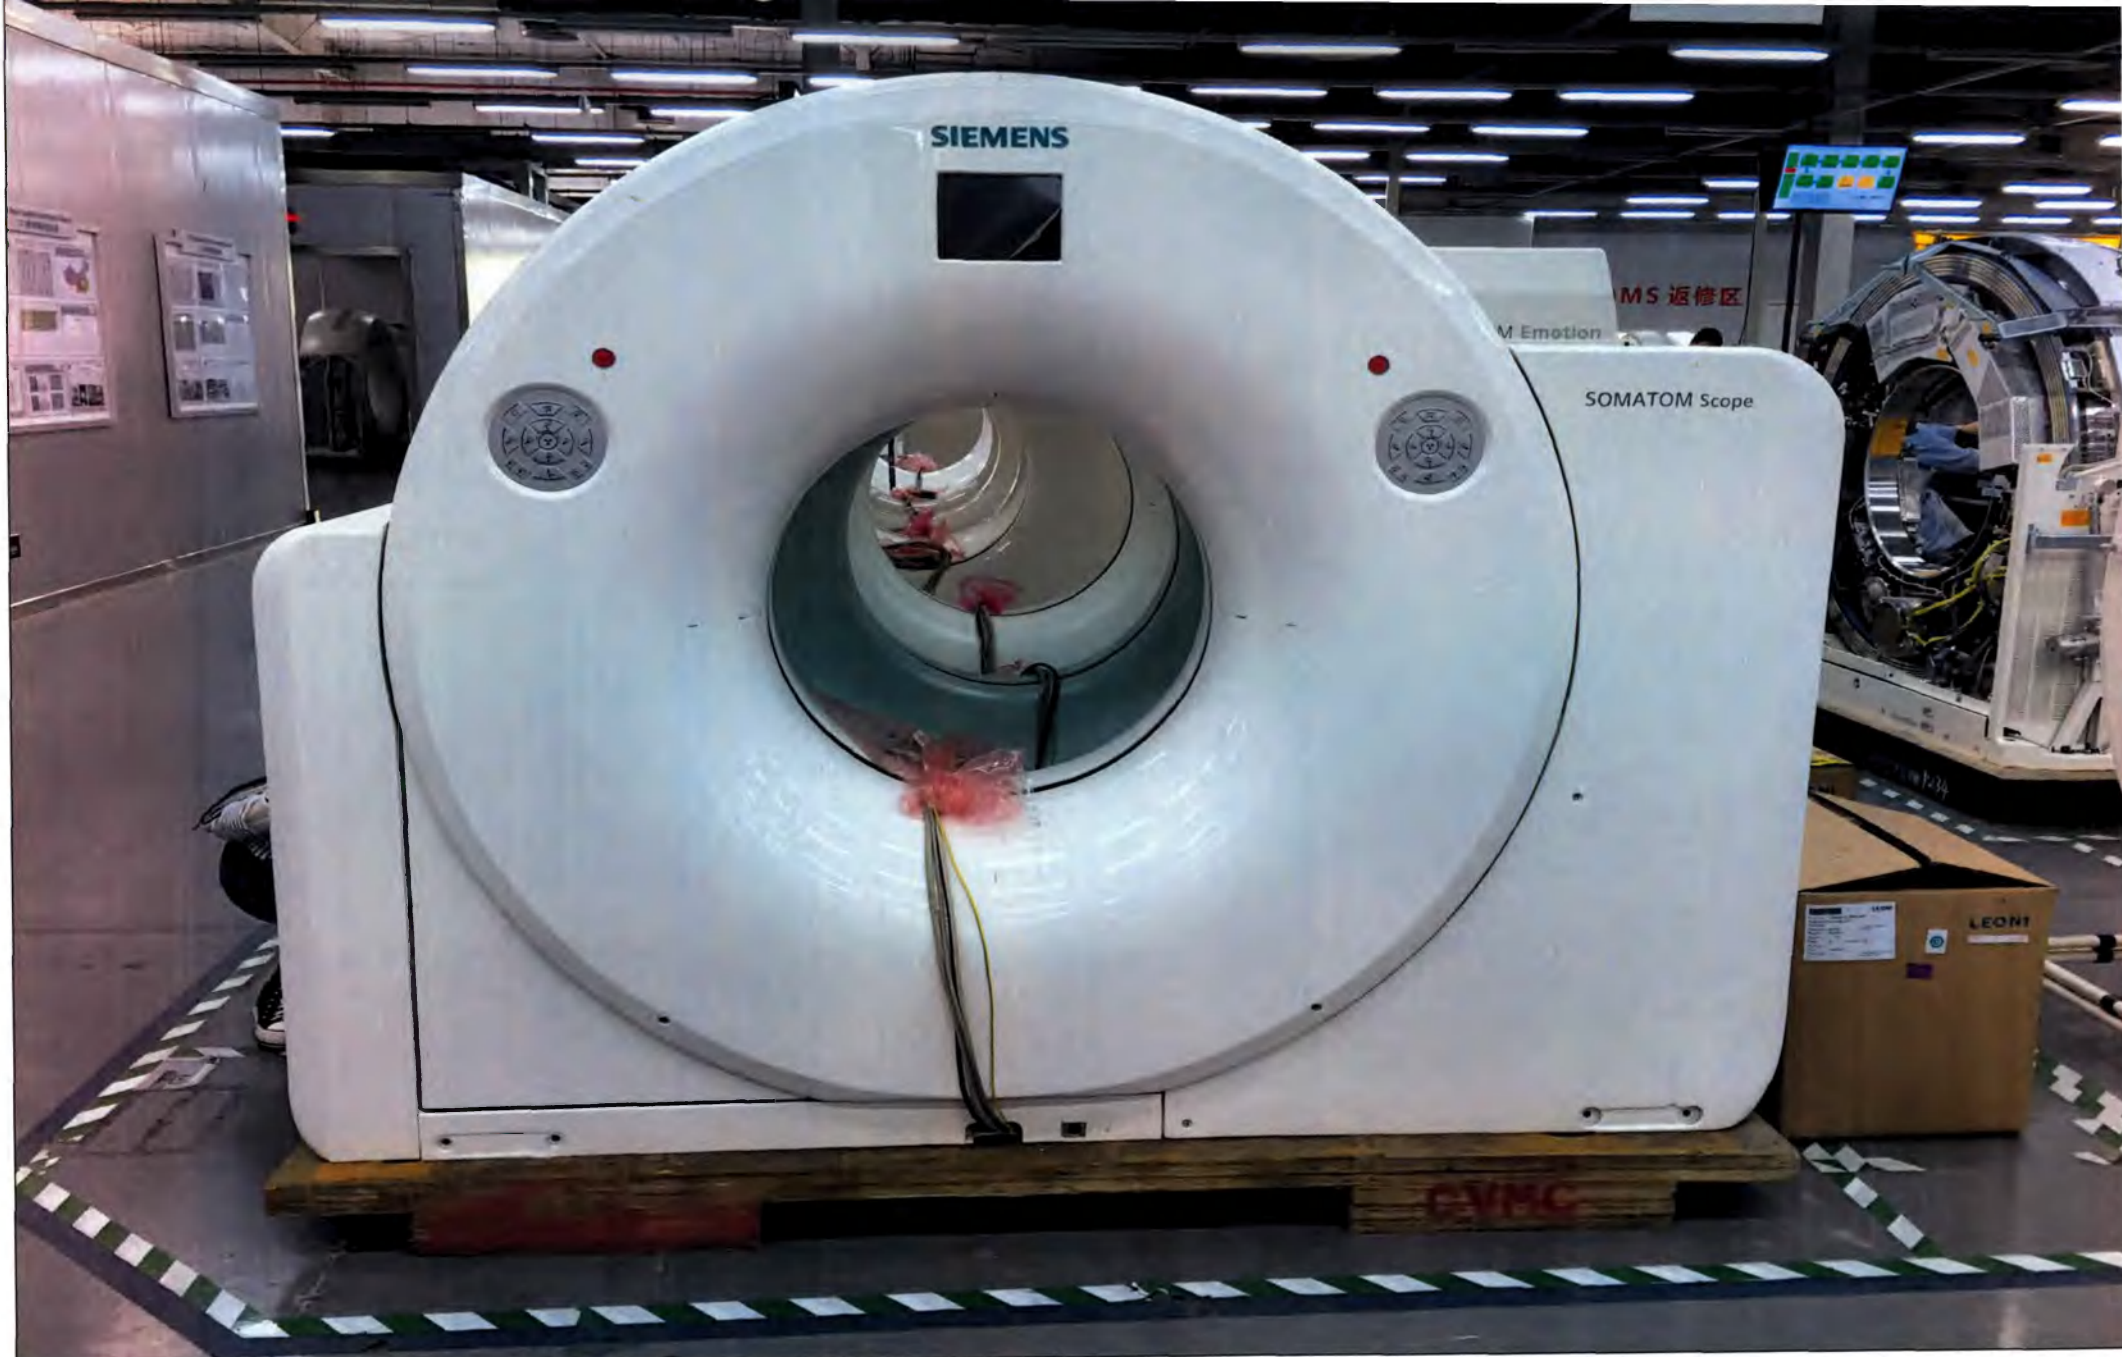

Общий вид медицинского изделия (ракурс 3)



Рисунок 1. Гентри, основной блок, в составе: рентгеновская трубка, коллиматор, детектор, генератор, дисплей, панель управления гентри, переговорное устройство

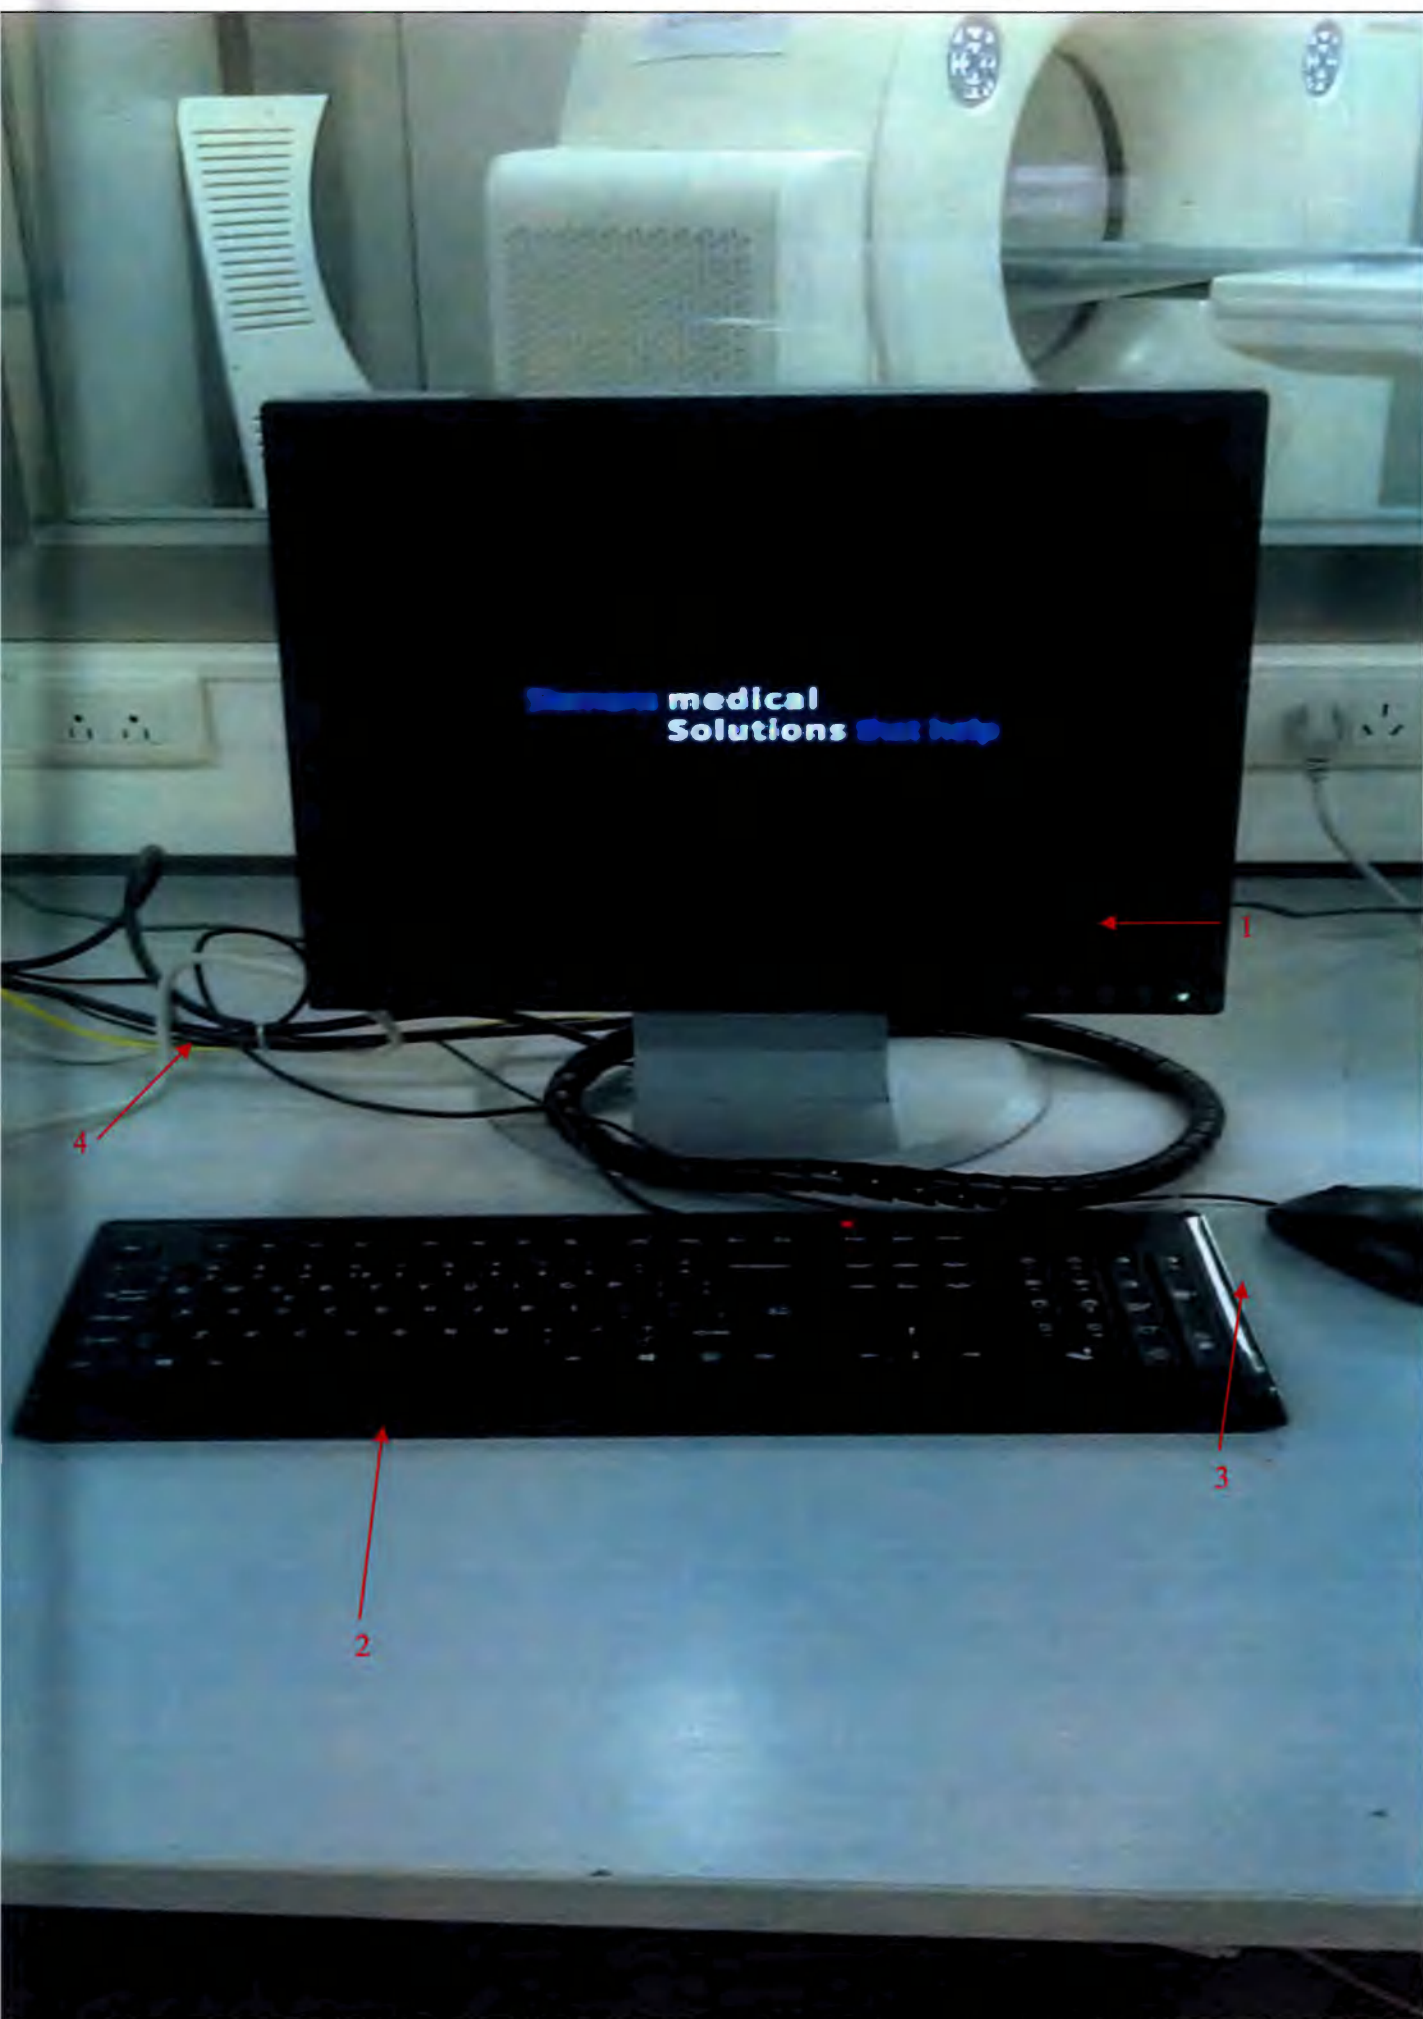

нок 2а. Консоль, в составе: **Монитор(1)**, **клавиатура (2)**, **мышь (3)**, **кабель соединительный(4)**,
емный блок, блок управления

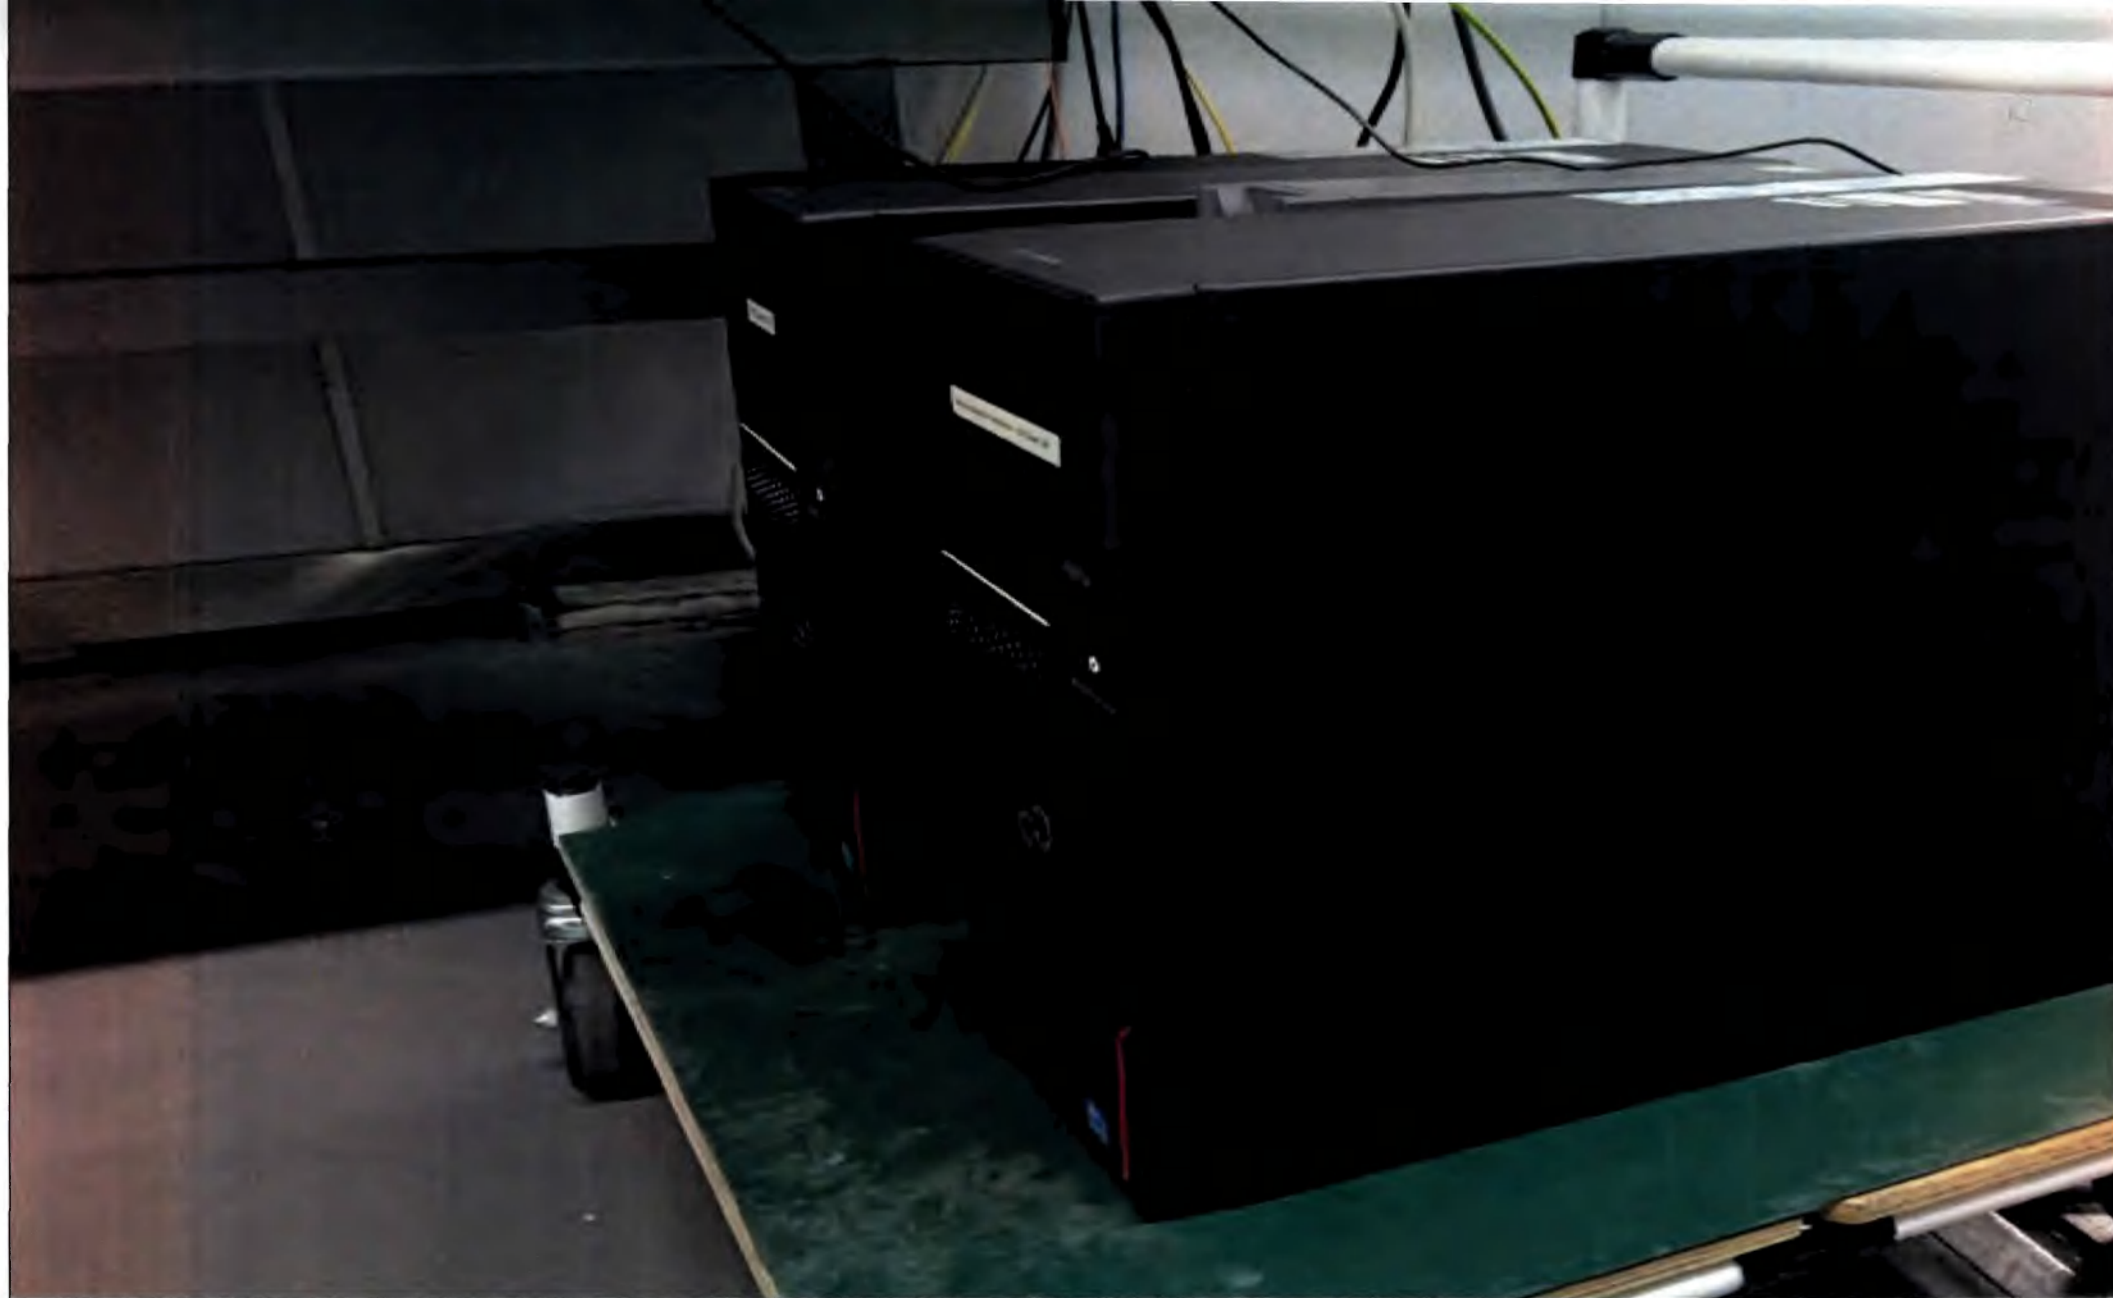


Рисунок 26. Консоль, в составе: Монитор, клавиатура, мышь, кабель соединительный, **системный блок**, блок управления



Рисунок 2с. Консоль, в составе: Монитор, клавиатура, мышь, кабель соединительный, системный блок, блок управления

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

CT Examination (КТ- обследование)

Инструкции по эксплуатации – SOMATOM Score
syngo CT VC30 - easyIQ version

Answers for life.

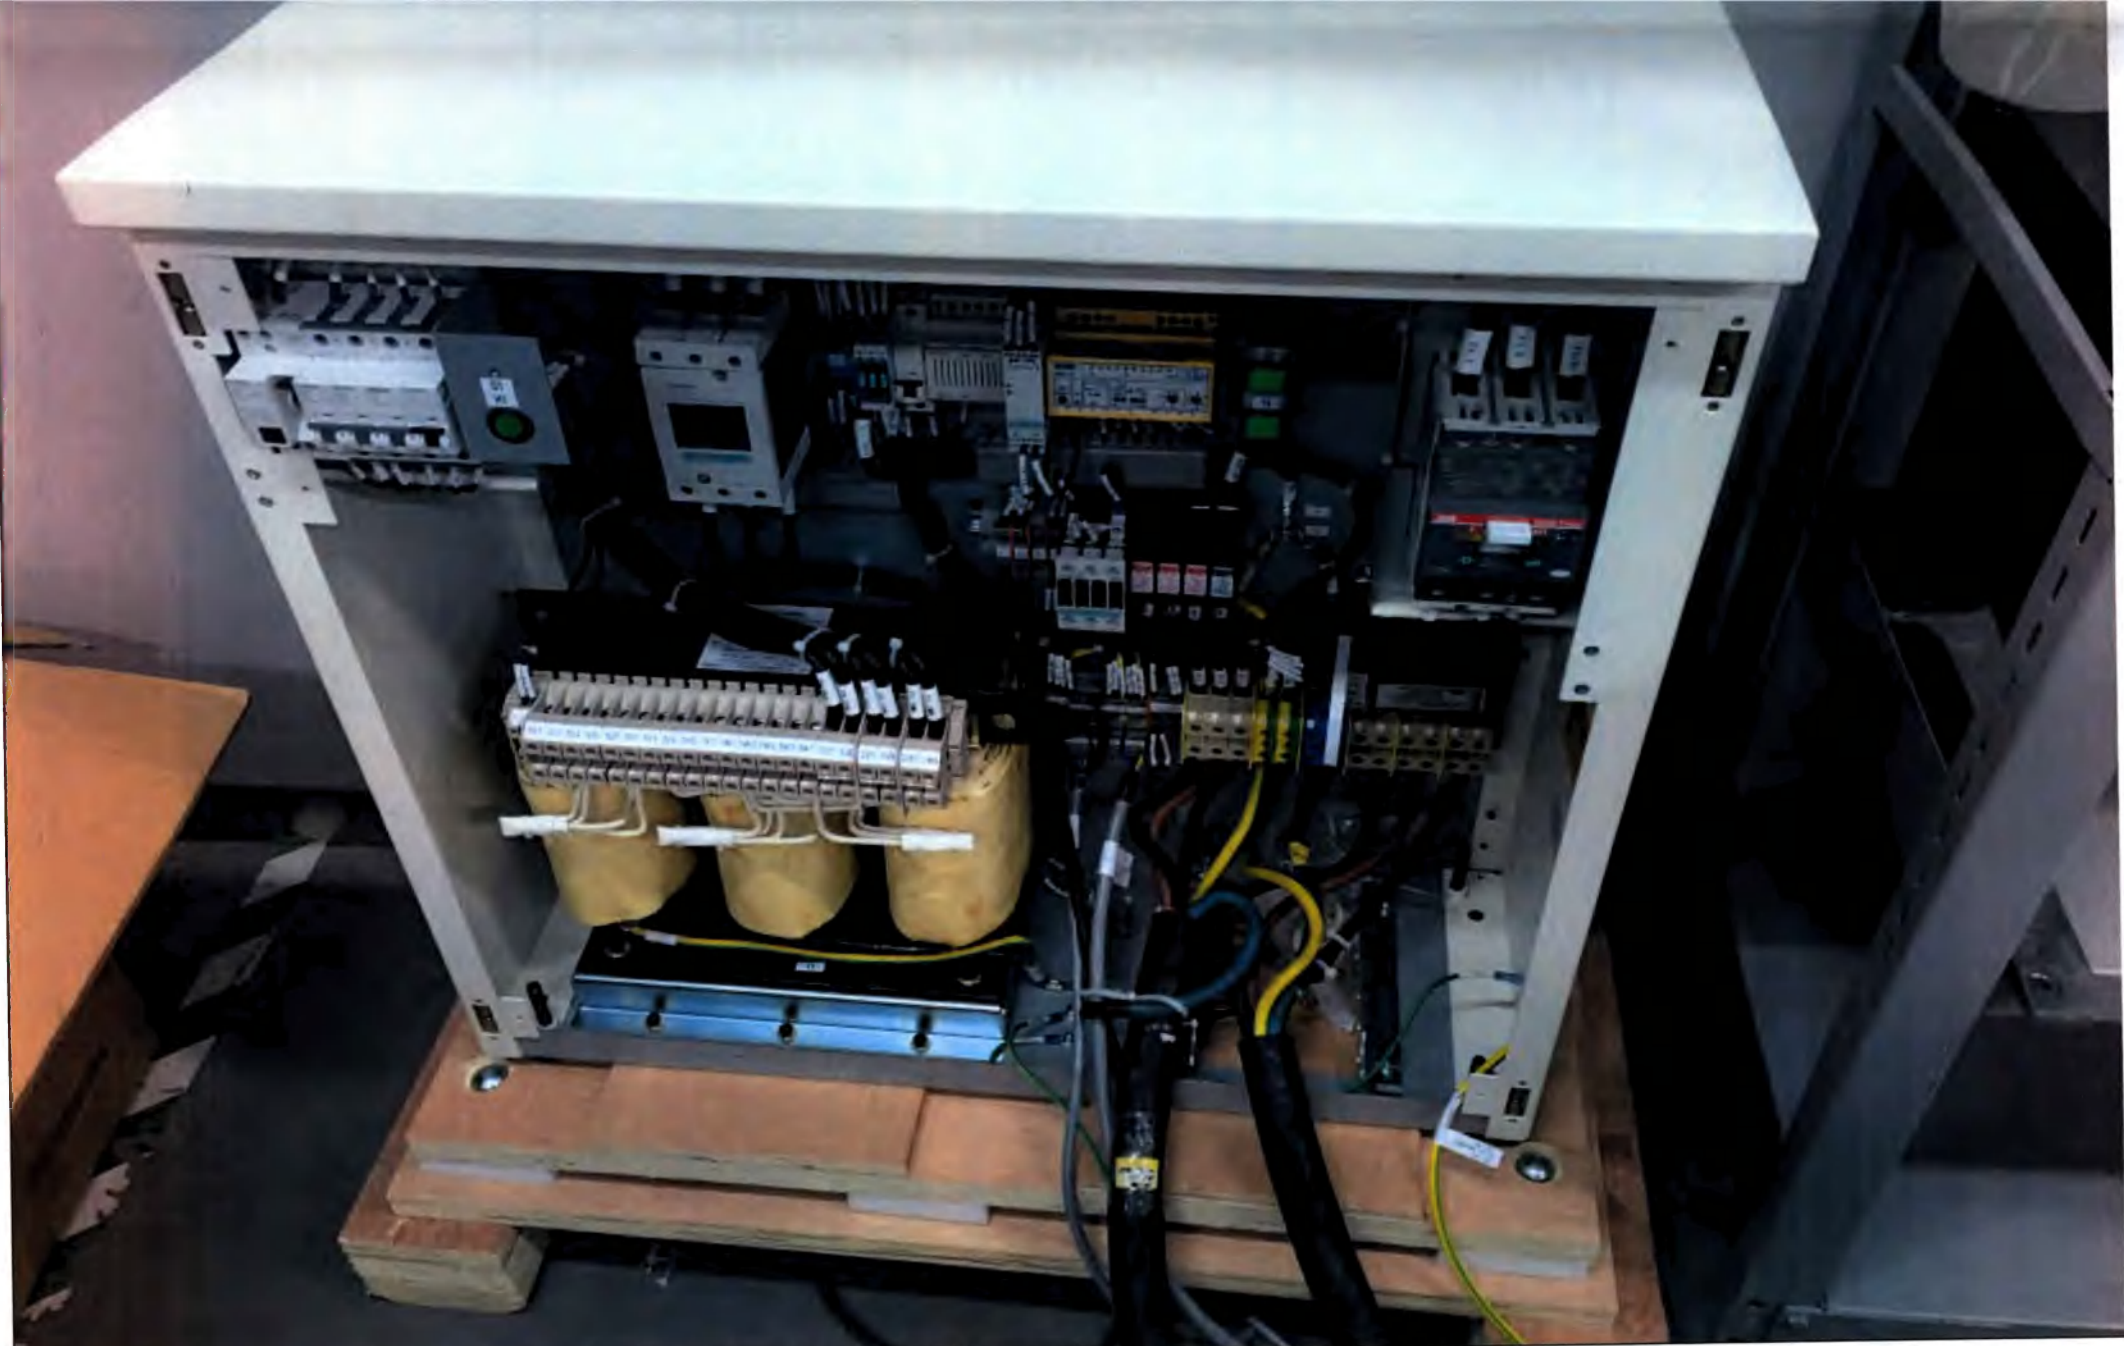


Рисунок 4. Блок сетевого питания (варианты исполнения: 380-480В, 400В)

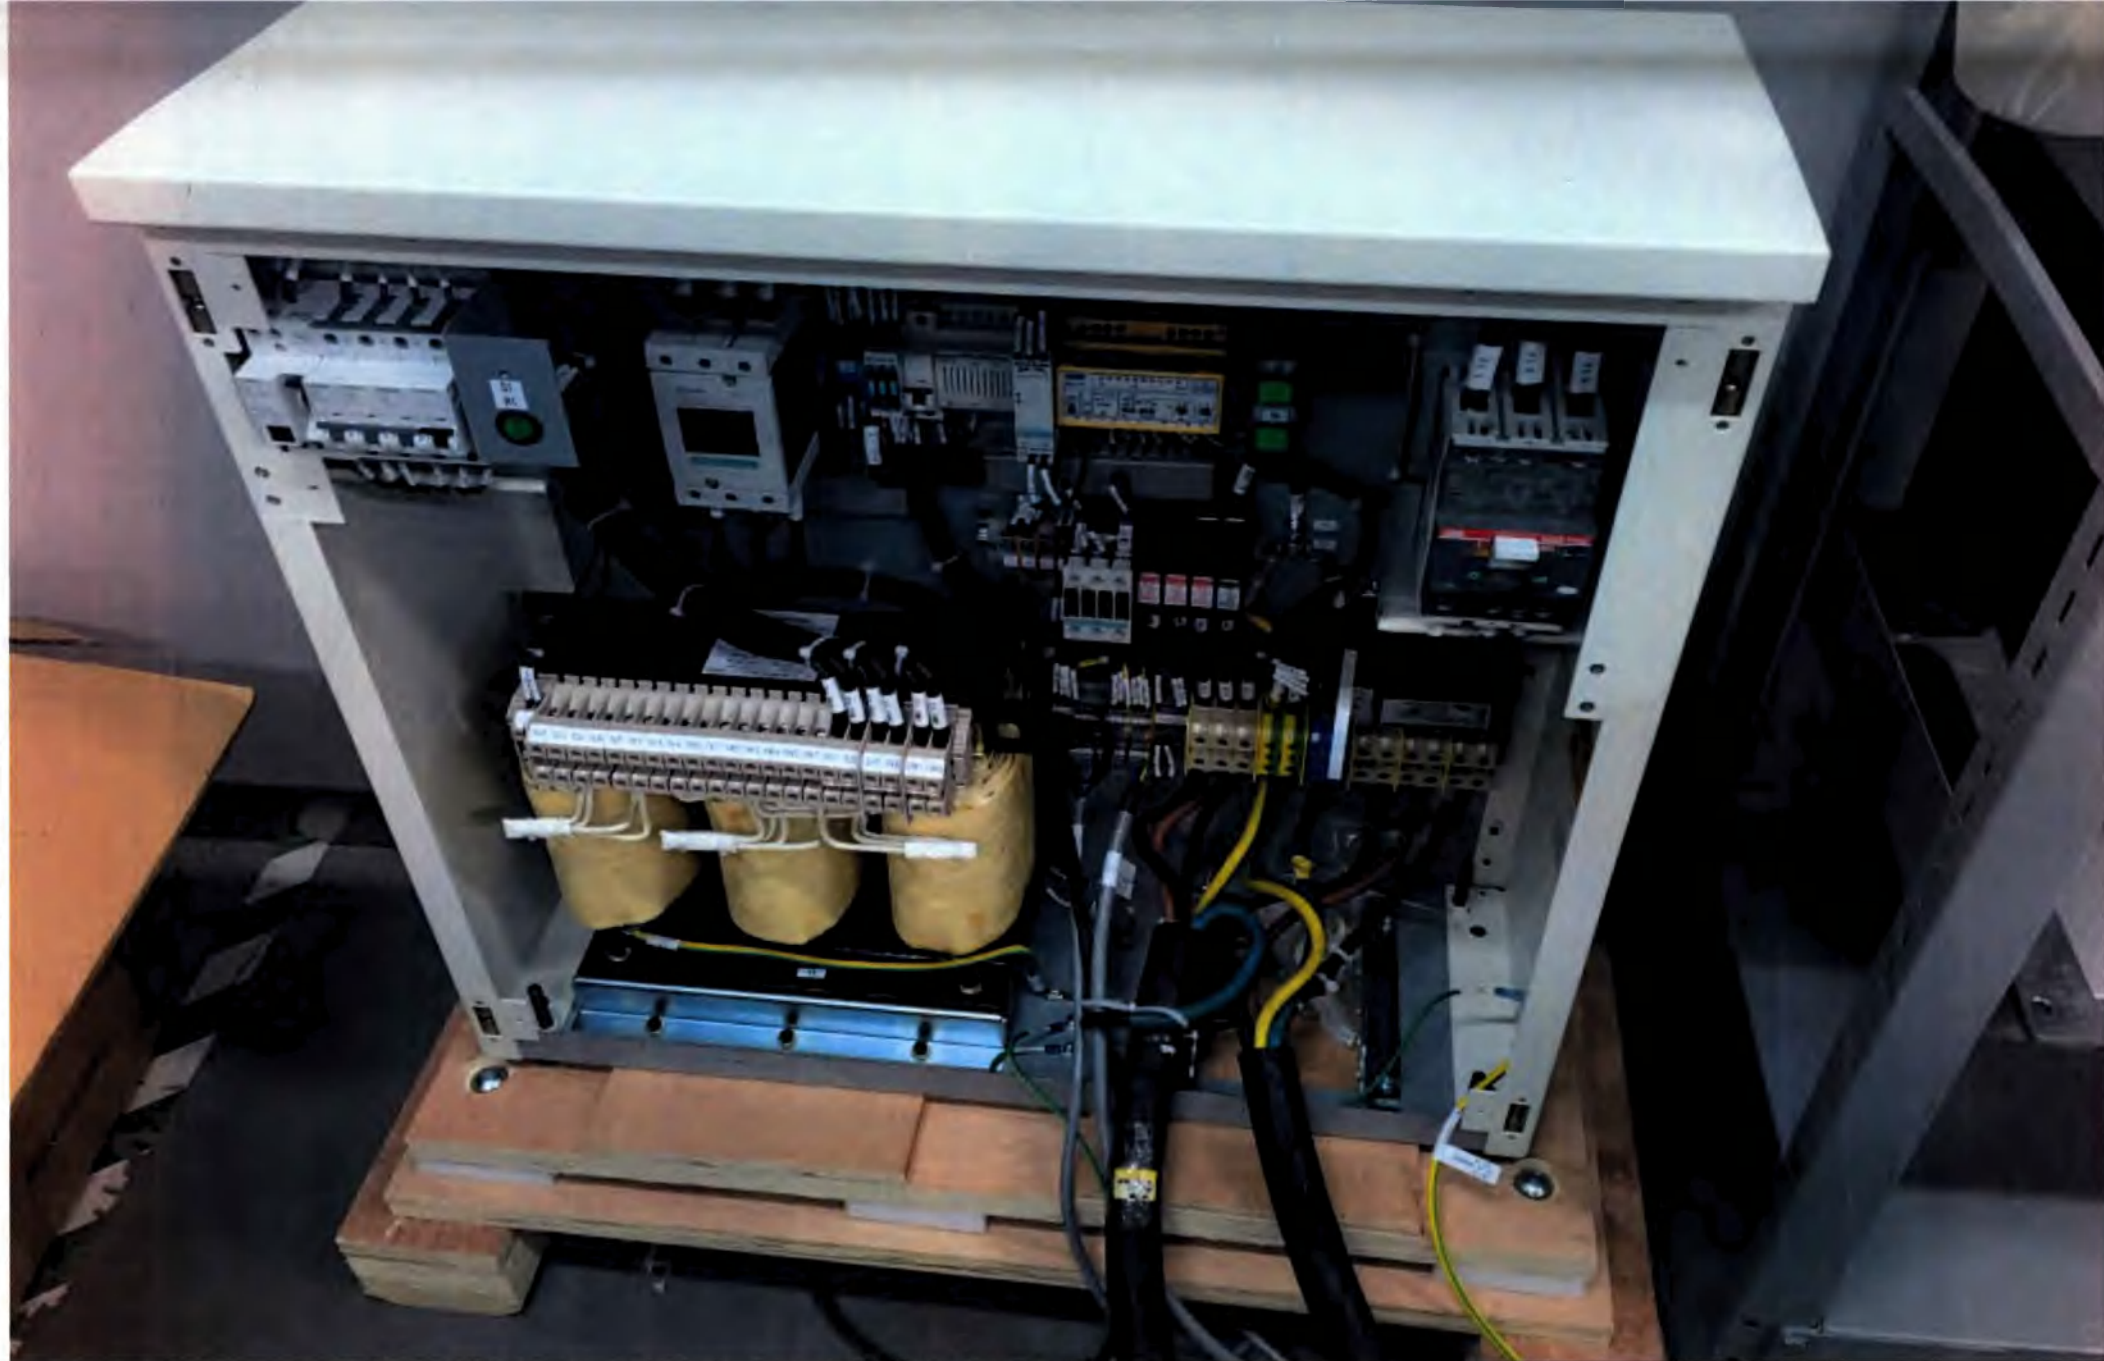


Рисунок 4. Блок сетевого питания (варианты исполнения: 380-480В, 400В)



Рисунок 5. Система реконструкции изображений (варианты исполнения: стандартная, высокопроизводительная, улучшенная) в составе: - модуль управления сканированием; - модуль управления реконструкцией; - модуль анализа изображений



Рисунок 6. Стол пациента, варианты исполнения: стандартный, усиленный, удлиненный

Рисунок 7. Источники бесперебойного питания





Рисунок 8а. Столы оператора рабочие, варианты исполнения: **стандартные**; с контейнером для компьютерной системы

Рисунок 86. Столы оператора рабочие, варианты исполнения: стандартные; с контейнером для компьютерной системы



Рисунок 9. Контейнеры для компьютерной системы





Рисунок 10. Набор для подключения внешних устройств: кабели, разъемы, джойстики



Рисунок 11а. Педальные переключатели стола

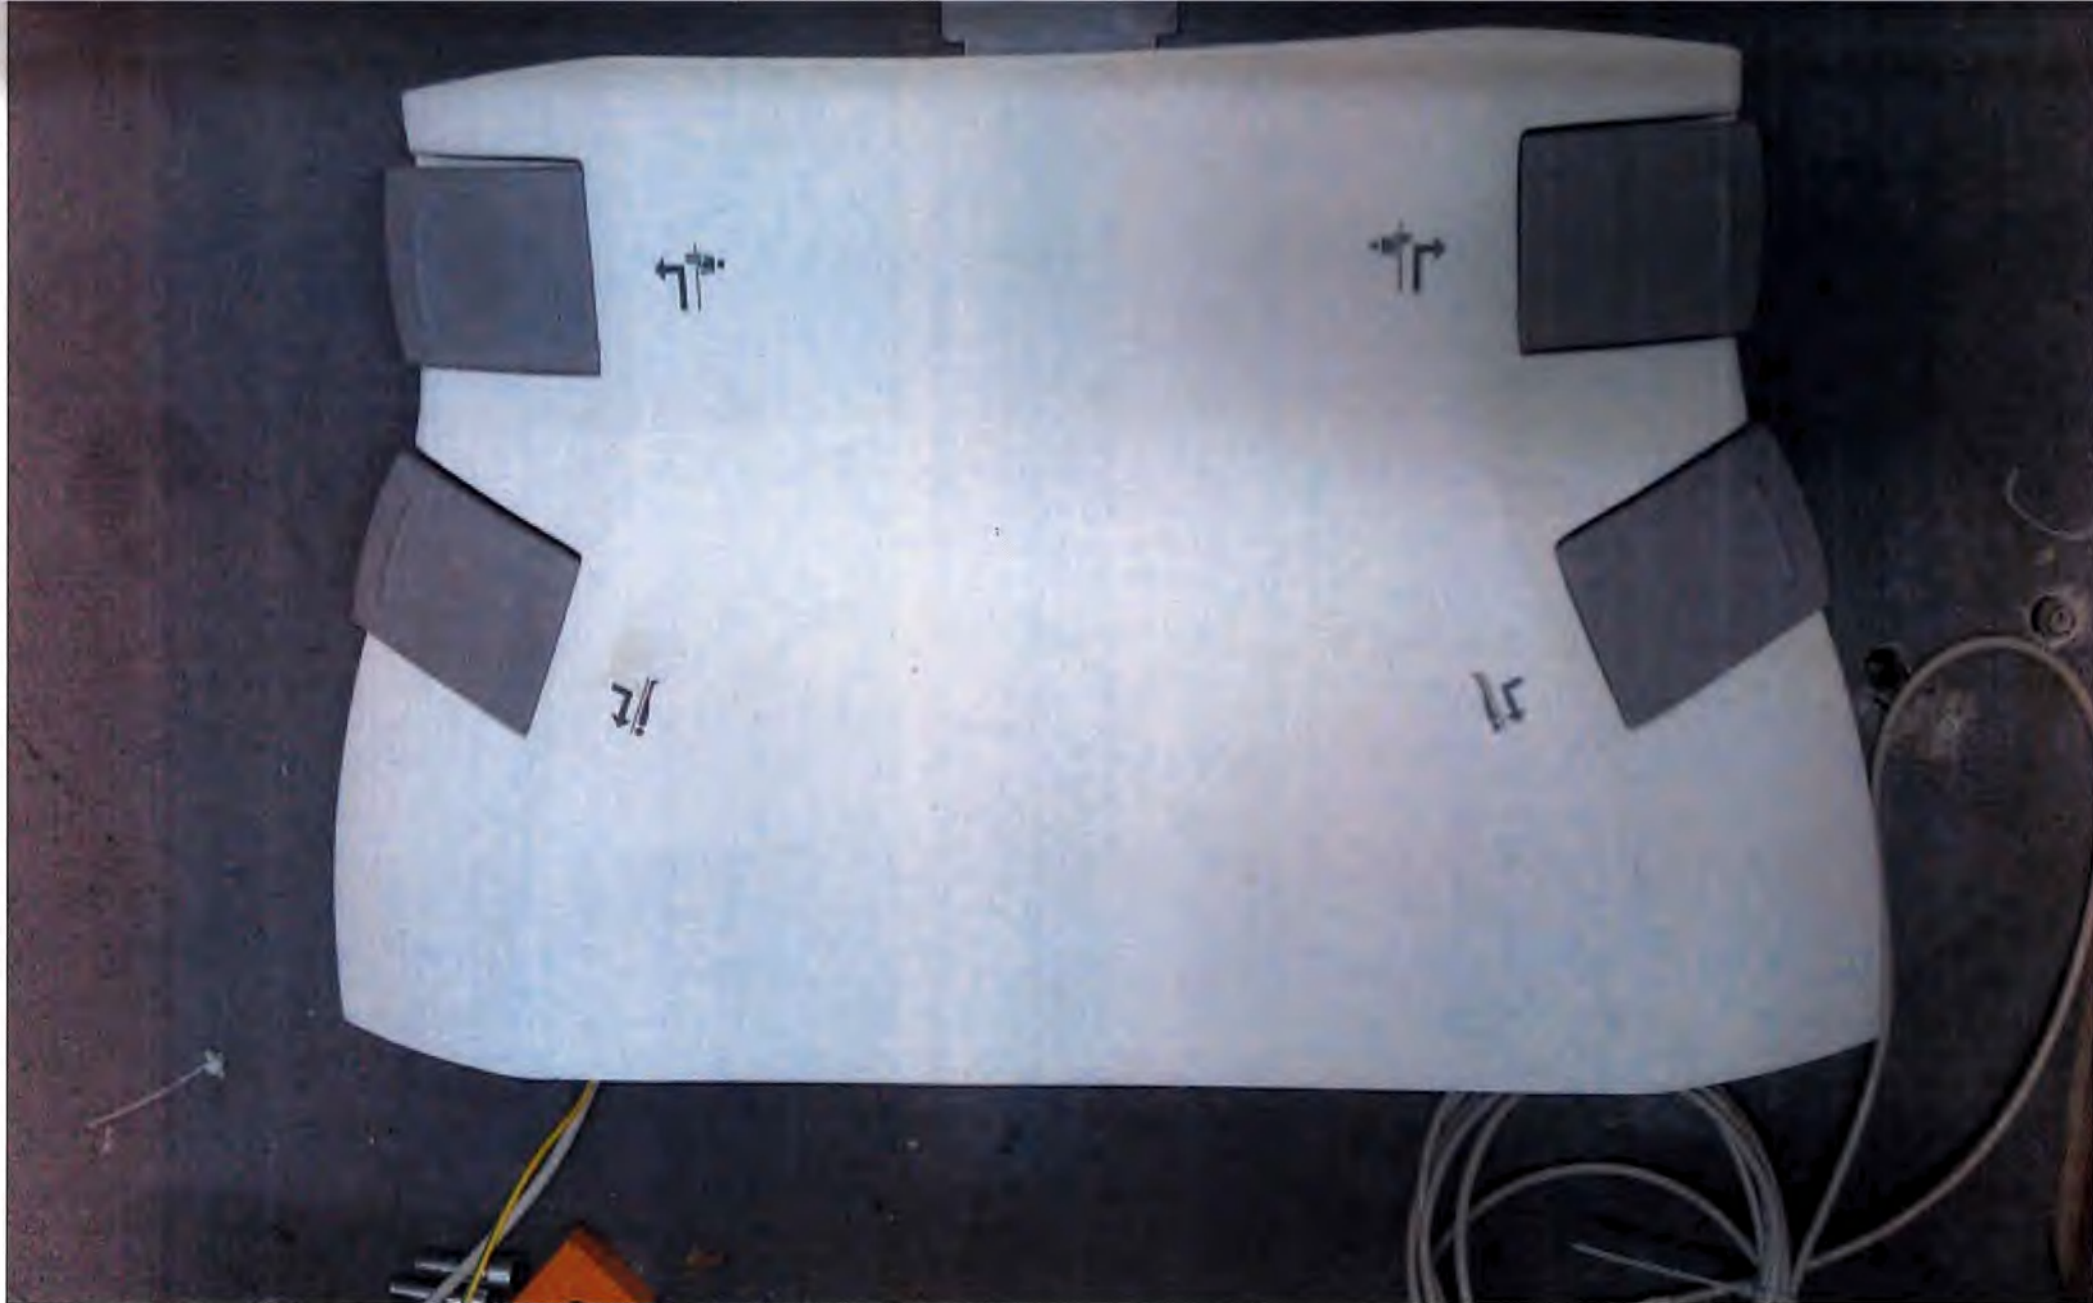


Рисунок 116. Педальные переключатели стола



Рисунок 12а. Монтажные фиксаторы для крепления базового блока



Рисунок 126. Монтажные фиксаторы для крепления базового блока



Рисунок 13а. Комплекты средств для проведения КТ остеоденситометрии, в составе: - **мат для остеоденситометрии**; - контрольный фантом; - гелевый пакет

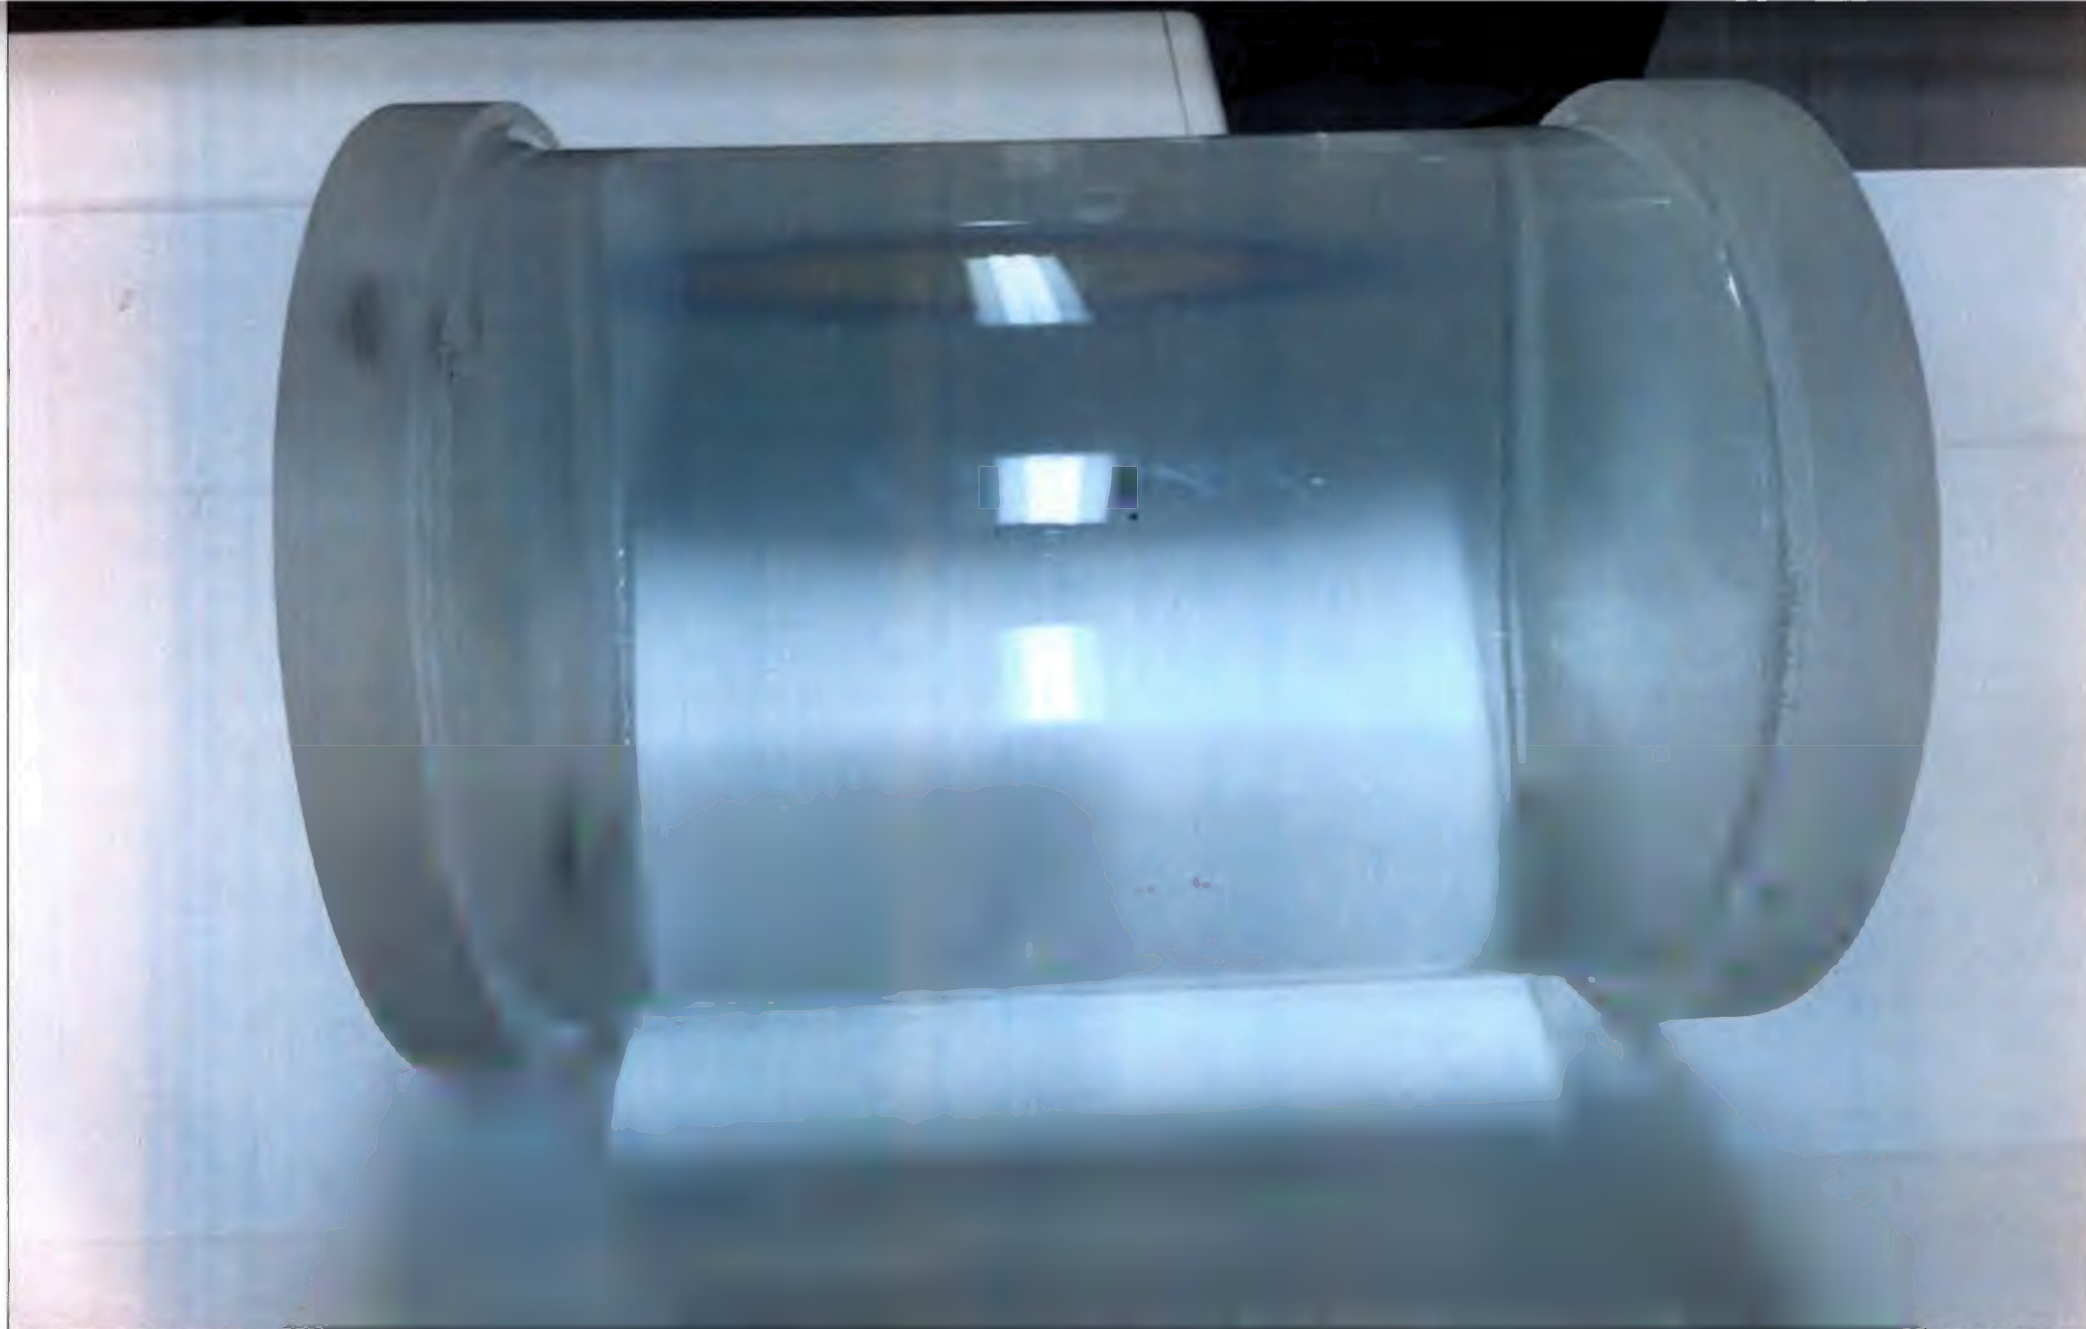


Рисунок 136. Комплекты средств для проведения КТ остеоденситометрии, в составе: - мат для остеоденситометрии; - контрольный фантом; - гелевый пакет



Рисунок 13с. Комплекты средств для проведения КТ остеоденситометрии, в составе: - мат для остеоденситометрии; - контрольный фантом; - гелевый пакет

Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key





Рисунок 15б. Универсальные носилки для транспортировки с принадлежностями в составе:
ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
- транспортировочные ремни, - ручки; - фиксирующие ремни



Рисунок 15с. Универсальные носилки для транспортировки с принадлежностями в составе: -
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
транспортные ремни, ручки, фиксирующие ремни



Рисунок 16. Матрасы для младенцев в составе: - опора тела; - мат; - фиксатор для головы; - ленты-липучки для фиксации рук; - ленты-липучки для фиксации головы и тела; - подушки



Рисунок 17. Дополнительные секции деки стола

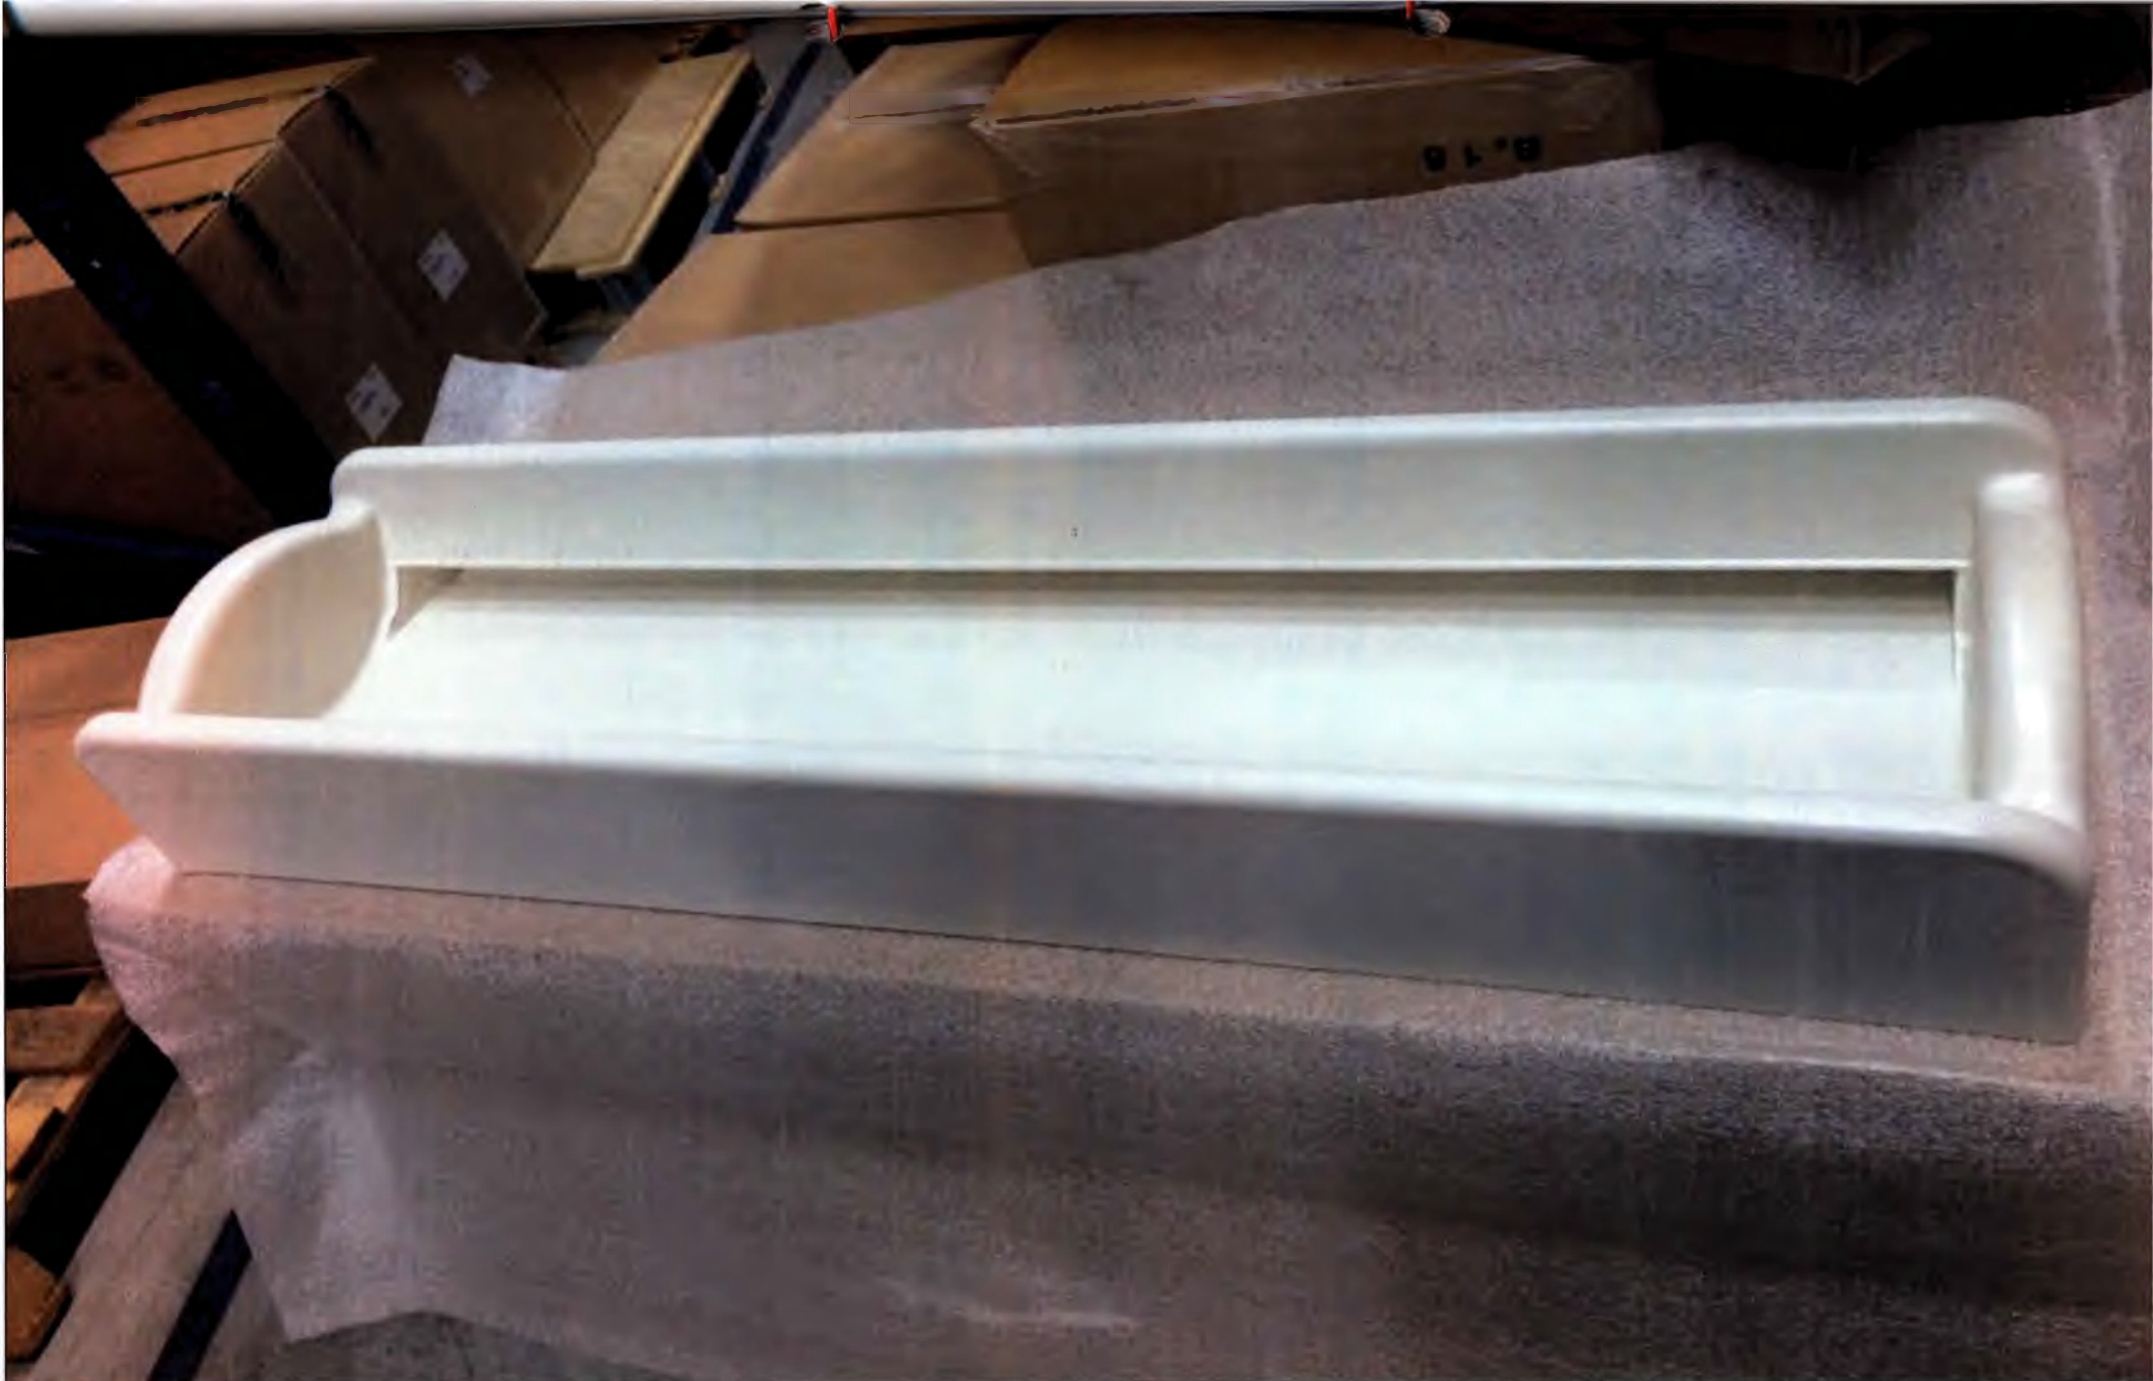


Рисунок 18. Держатели рулонов бумаги



Рисунок 19. Тележки для аксессуаров



Рисунок 20. Маты для позиционирования

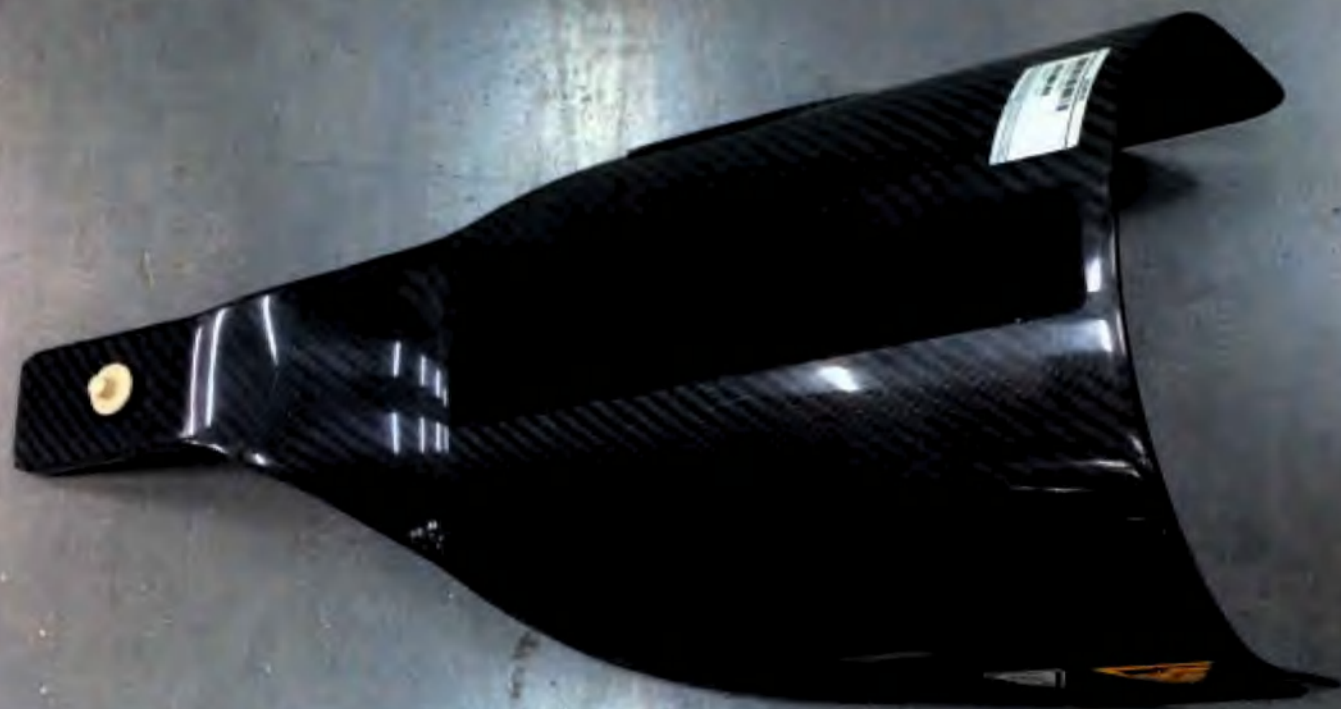


Рисунок 21. Держатели головы



Рисунок 22а. Комплекты вкладышей для головы в составе: - подушки для головы, клиновидные; - пара прокладок тонких; - пара прокладок толстых; - ленты-липучки; - плоская подушка



Рисунок 22б Комплект вкладышей для головы в составе: - подушки для головы, клиновидные; - пара прокладок тонких; - пара прокладок толстых; - ленты-липучки; - плоская подушка



Рисунок 22с. Комплекты вкладышей для головы в составе: - подушки для головы, клиновидные; - пара прокладок тонких; - пара прокладок толстых;



Рисунок 22d. Комплекты вкладышей для головы в составе: - подушки для головы, клиновидные;

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU док толстых; - ленты-липучки; - плоская подушка



Рисунок 23а. **Опоры для головы / предплечья с фиксирующими принадлежностями** в составе: - ленты-липучки; - плоская подушка



Рисунок 236. Опоры для головы / предплечья с фиксирующими принадлежностями в составе: - ленты-липучки; - плоская подушка

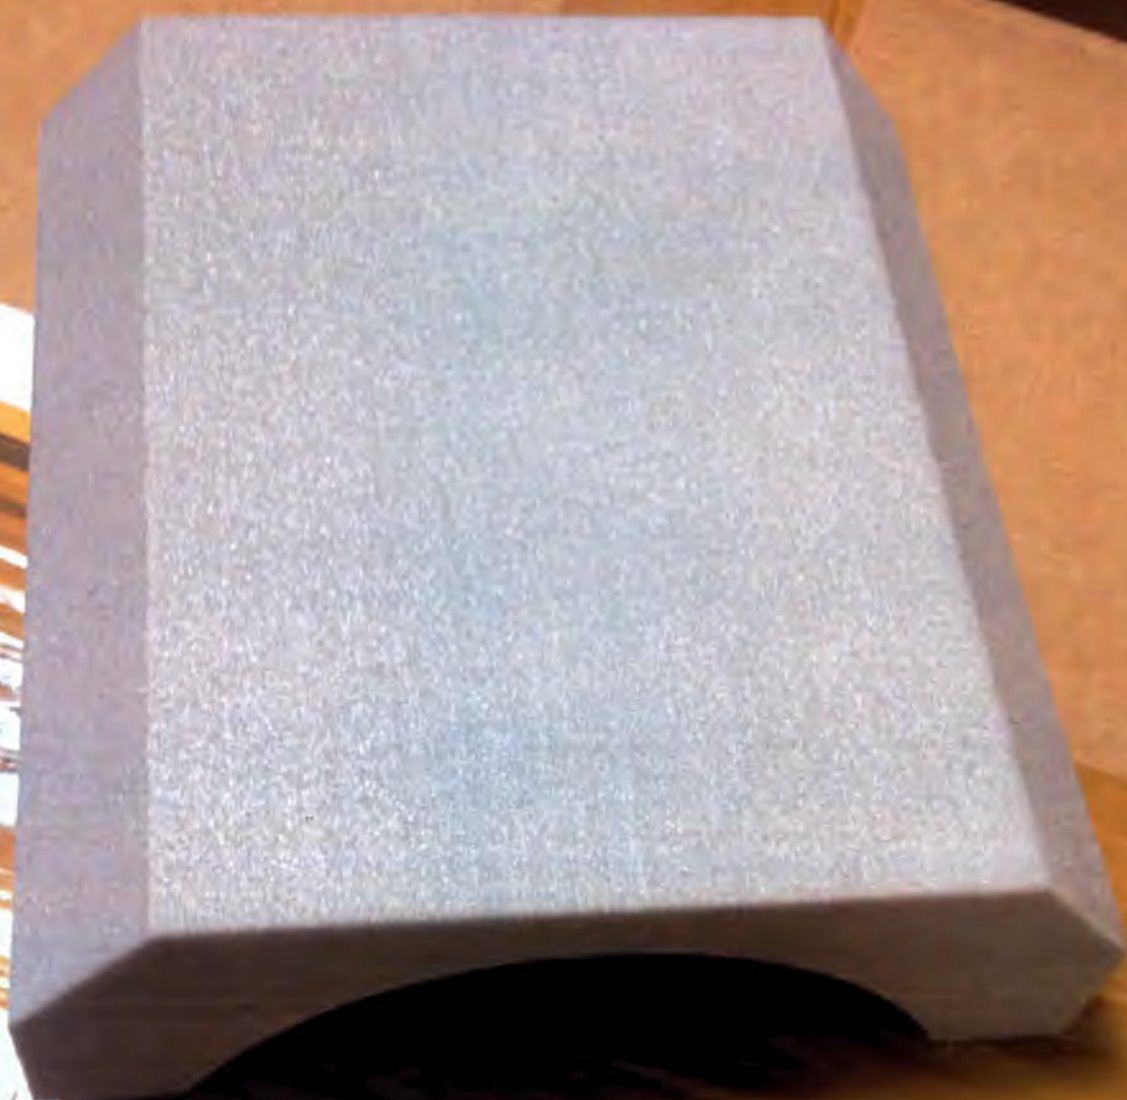


Рисунок 23с. Опоры для головы / предплечья с фиксирующими принадлежностями в составе:





Рисунок 25а. Комплекты ремней для фиксации пациента в составе: - ремни для тела широкие; - ремни для подбородка, широкие; - ремни для подбородка



Рисунок 256. Комплекты ремней для фиксации пациента в составе: - ремни для тела широкие; - ремни для тела узкие; - ремни для головы; - ремни для подбородка, широкие; - ремни для подбородка узкие



Рисунок 25с. Комплекты ремней для фиксации пациента в составе: - ремни для тела широкие; головы; - ремни для подбородка, широкие; - ремни для подбородка узкие



Рисунок 25d. Комплекты ремней для фиксации пациента в составе: - ремни для тела широкие; - ремни для тела узкие; - ремни для головы; - ремни для подбородка, широкие; - ремни для подбородка







Рисунок 28. Защитные накладки на стол

Рисунок 29. Подголовники





Рисунок 30. Подголовники для носилок для транспортировки





Рисунок 32. Подголовники для фронтальных сечений в положении лежа на животе



Рисунок 33. Наклоняемые держатели головы

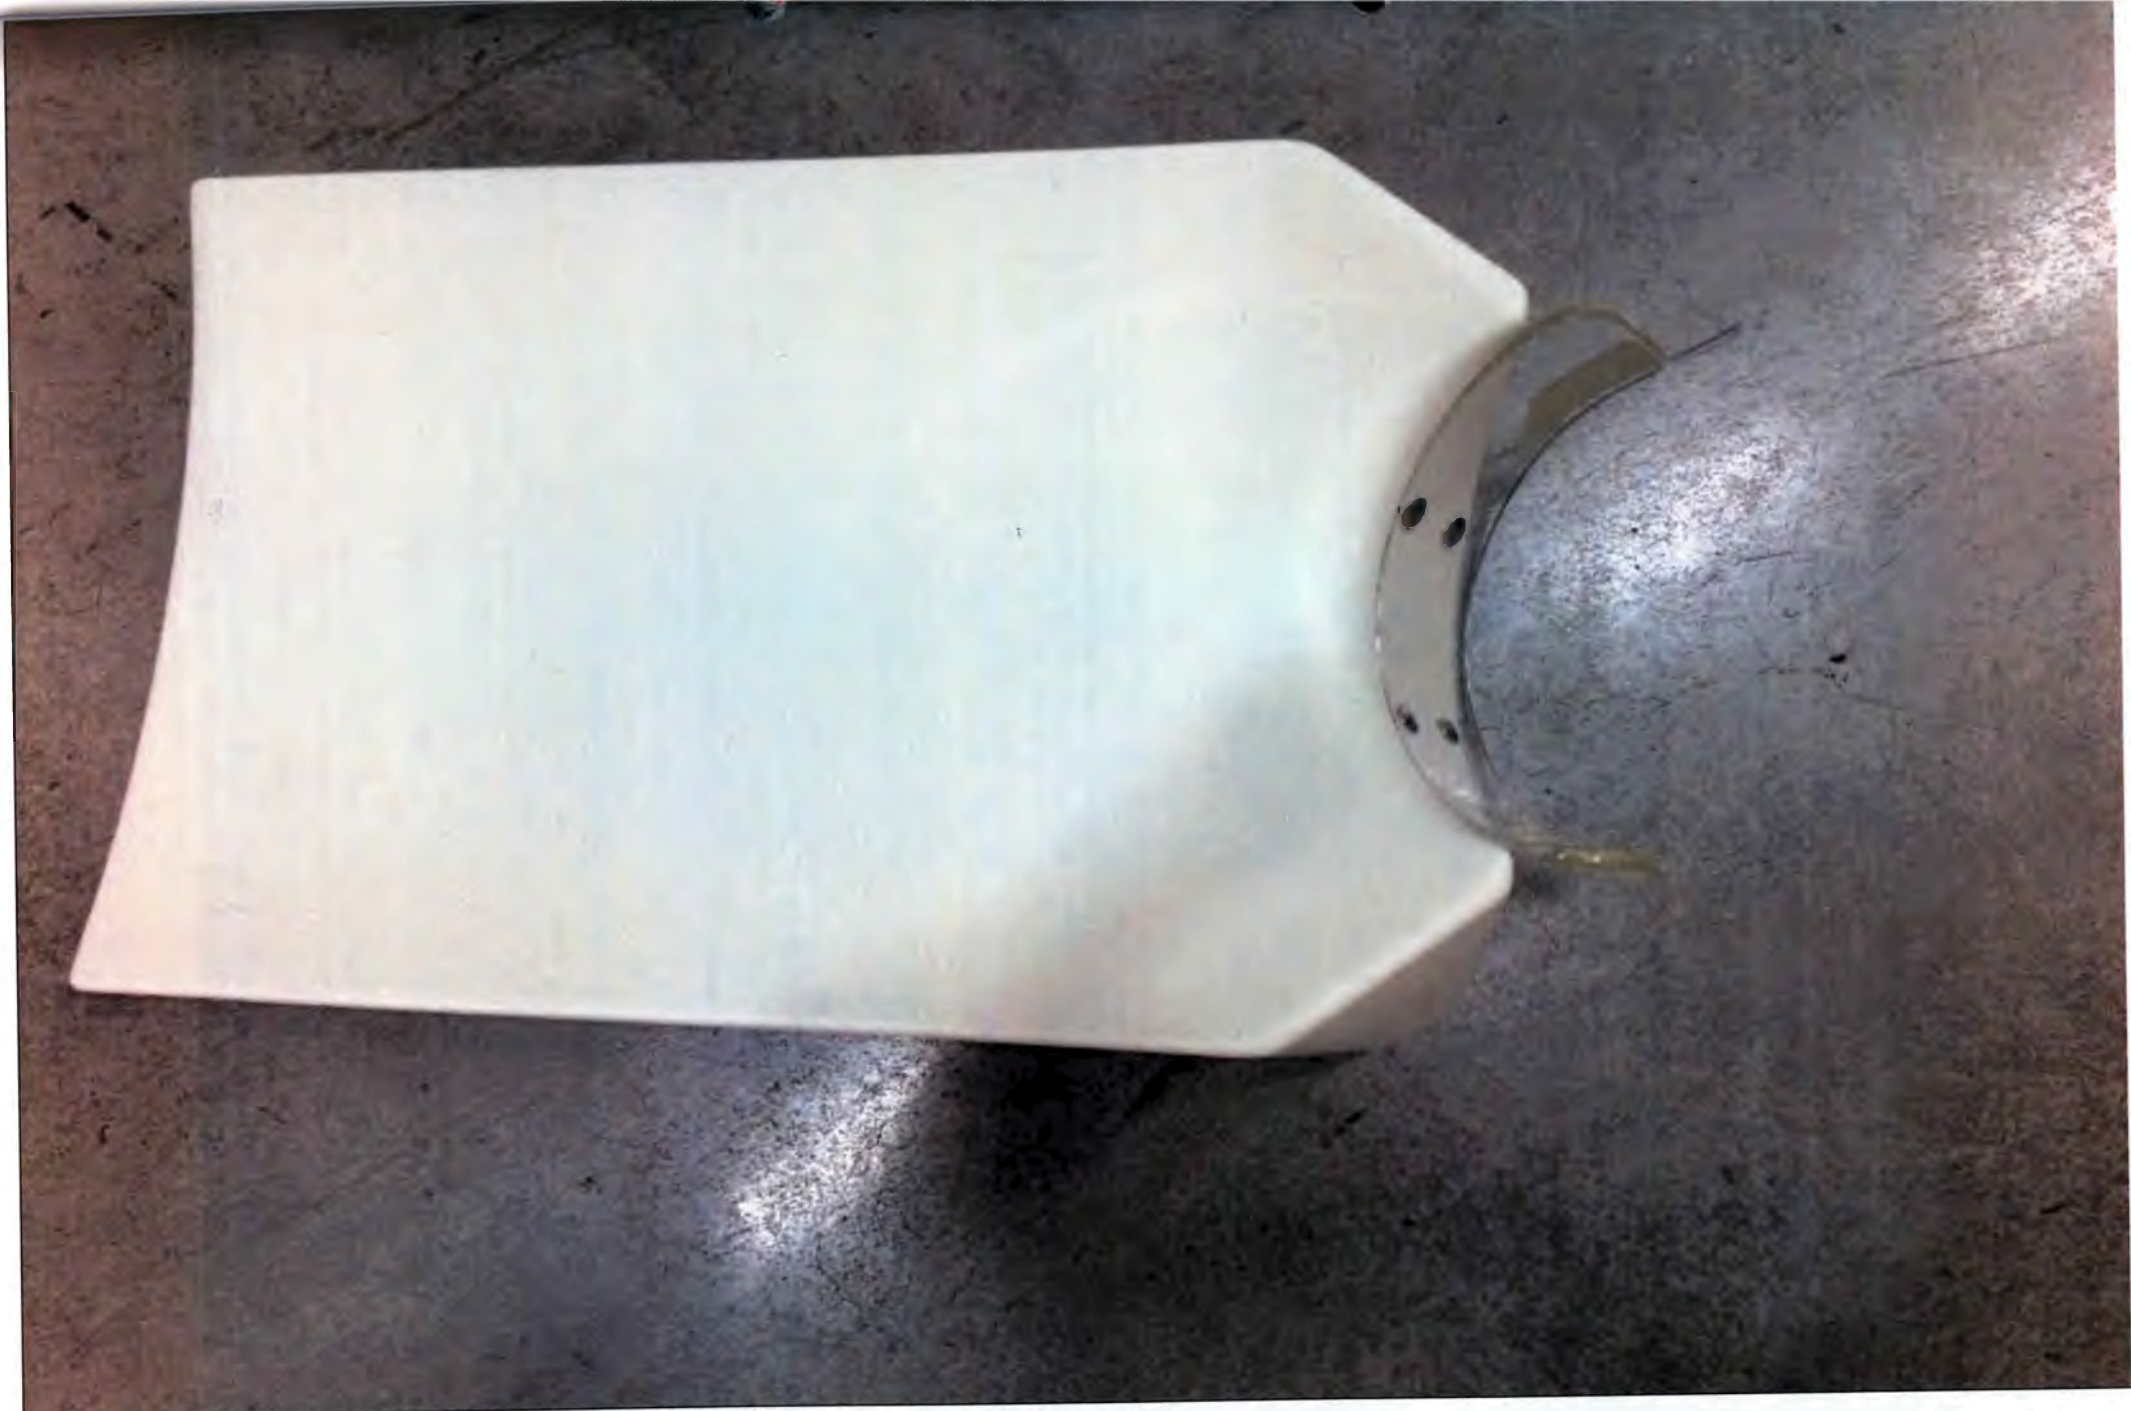


Рисунок 34. Подголовники для фронтальных сечений в положении лежа на спине



Рисунок 35. Опоры для колена



Рисунок 36. Опоры для предплечья



Рисунок 38. Комплект средств для установки монитора при потолочном креплении: - рычаги; - рамы; - кабели



Рисунок 39а. Сателлитные консоли управления, в составе:- монитор;- системный блок;- клавиатура;- мышь;- кабели соединительные



Рисунок 396. Сателлитные консоли управления, в составе: - монитор; - системный блок; - клавиатура; - мышь; - кабели соединительные



Рисунок 40. Блоки управления дополнительные

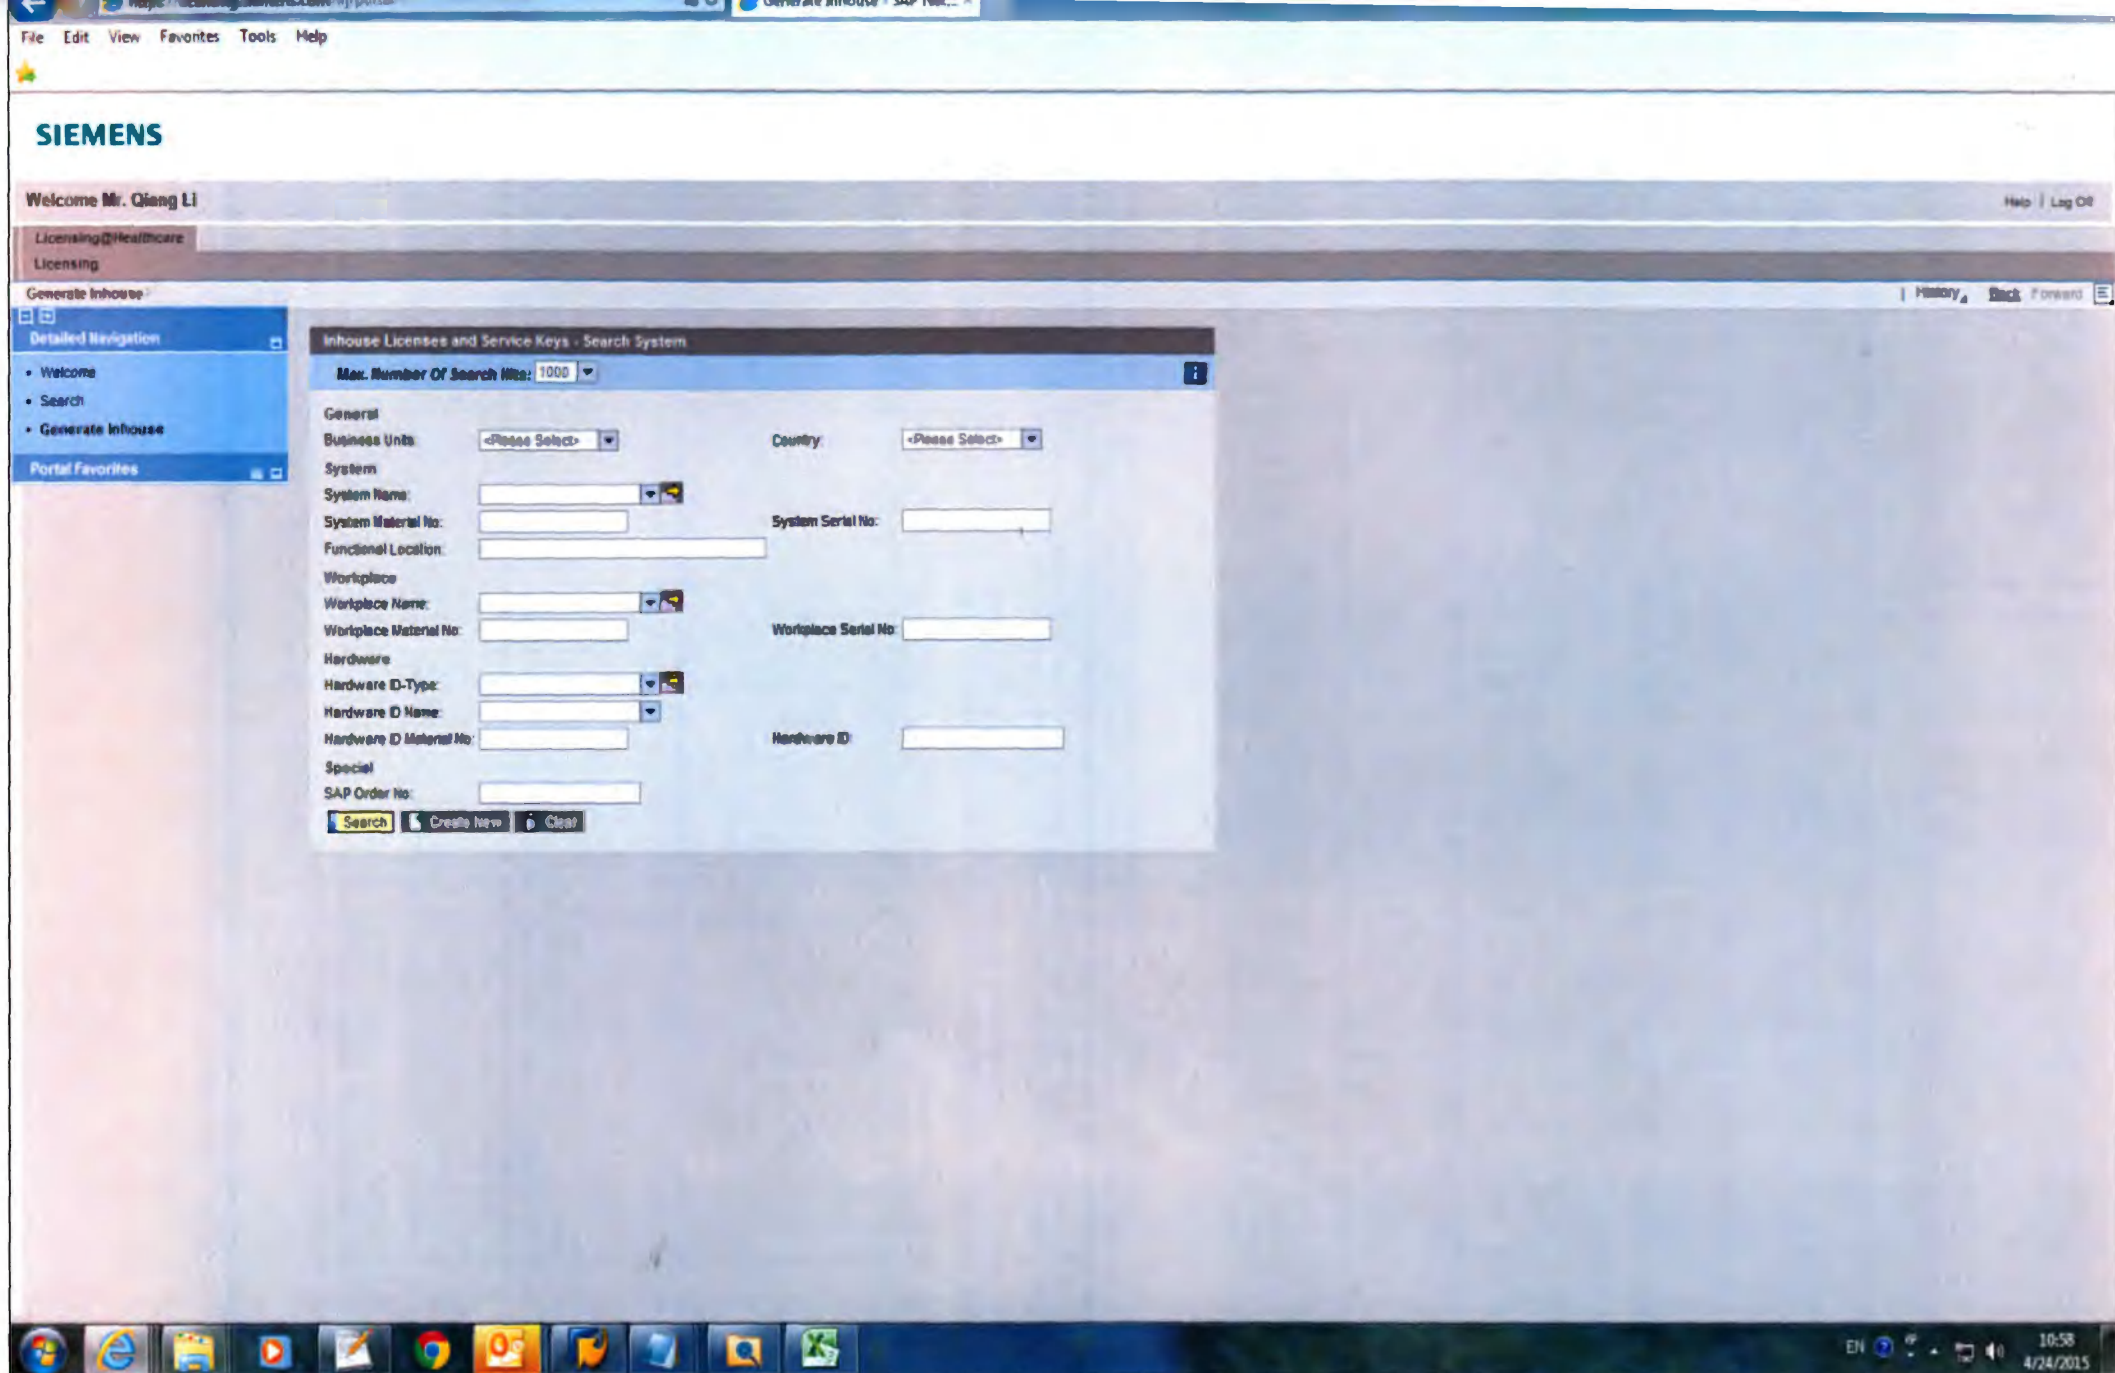


Рисунок 41. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для протоколов сбора данных

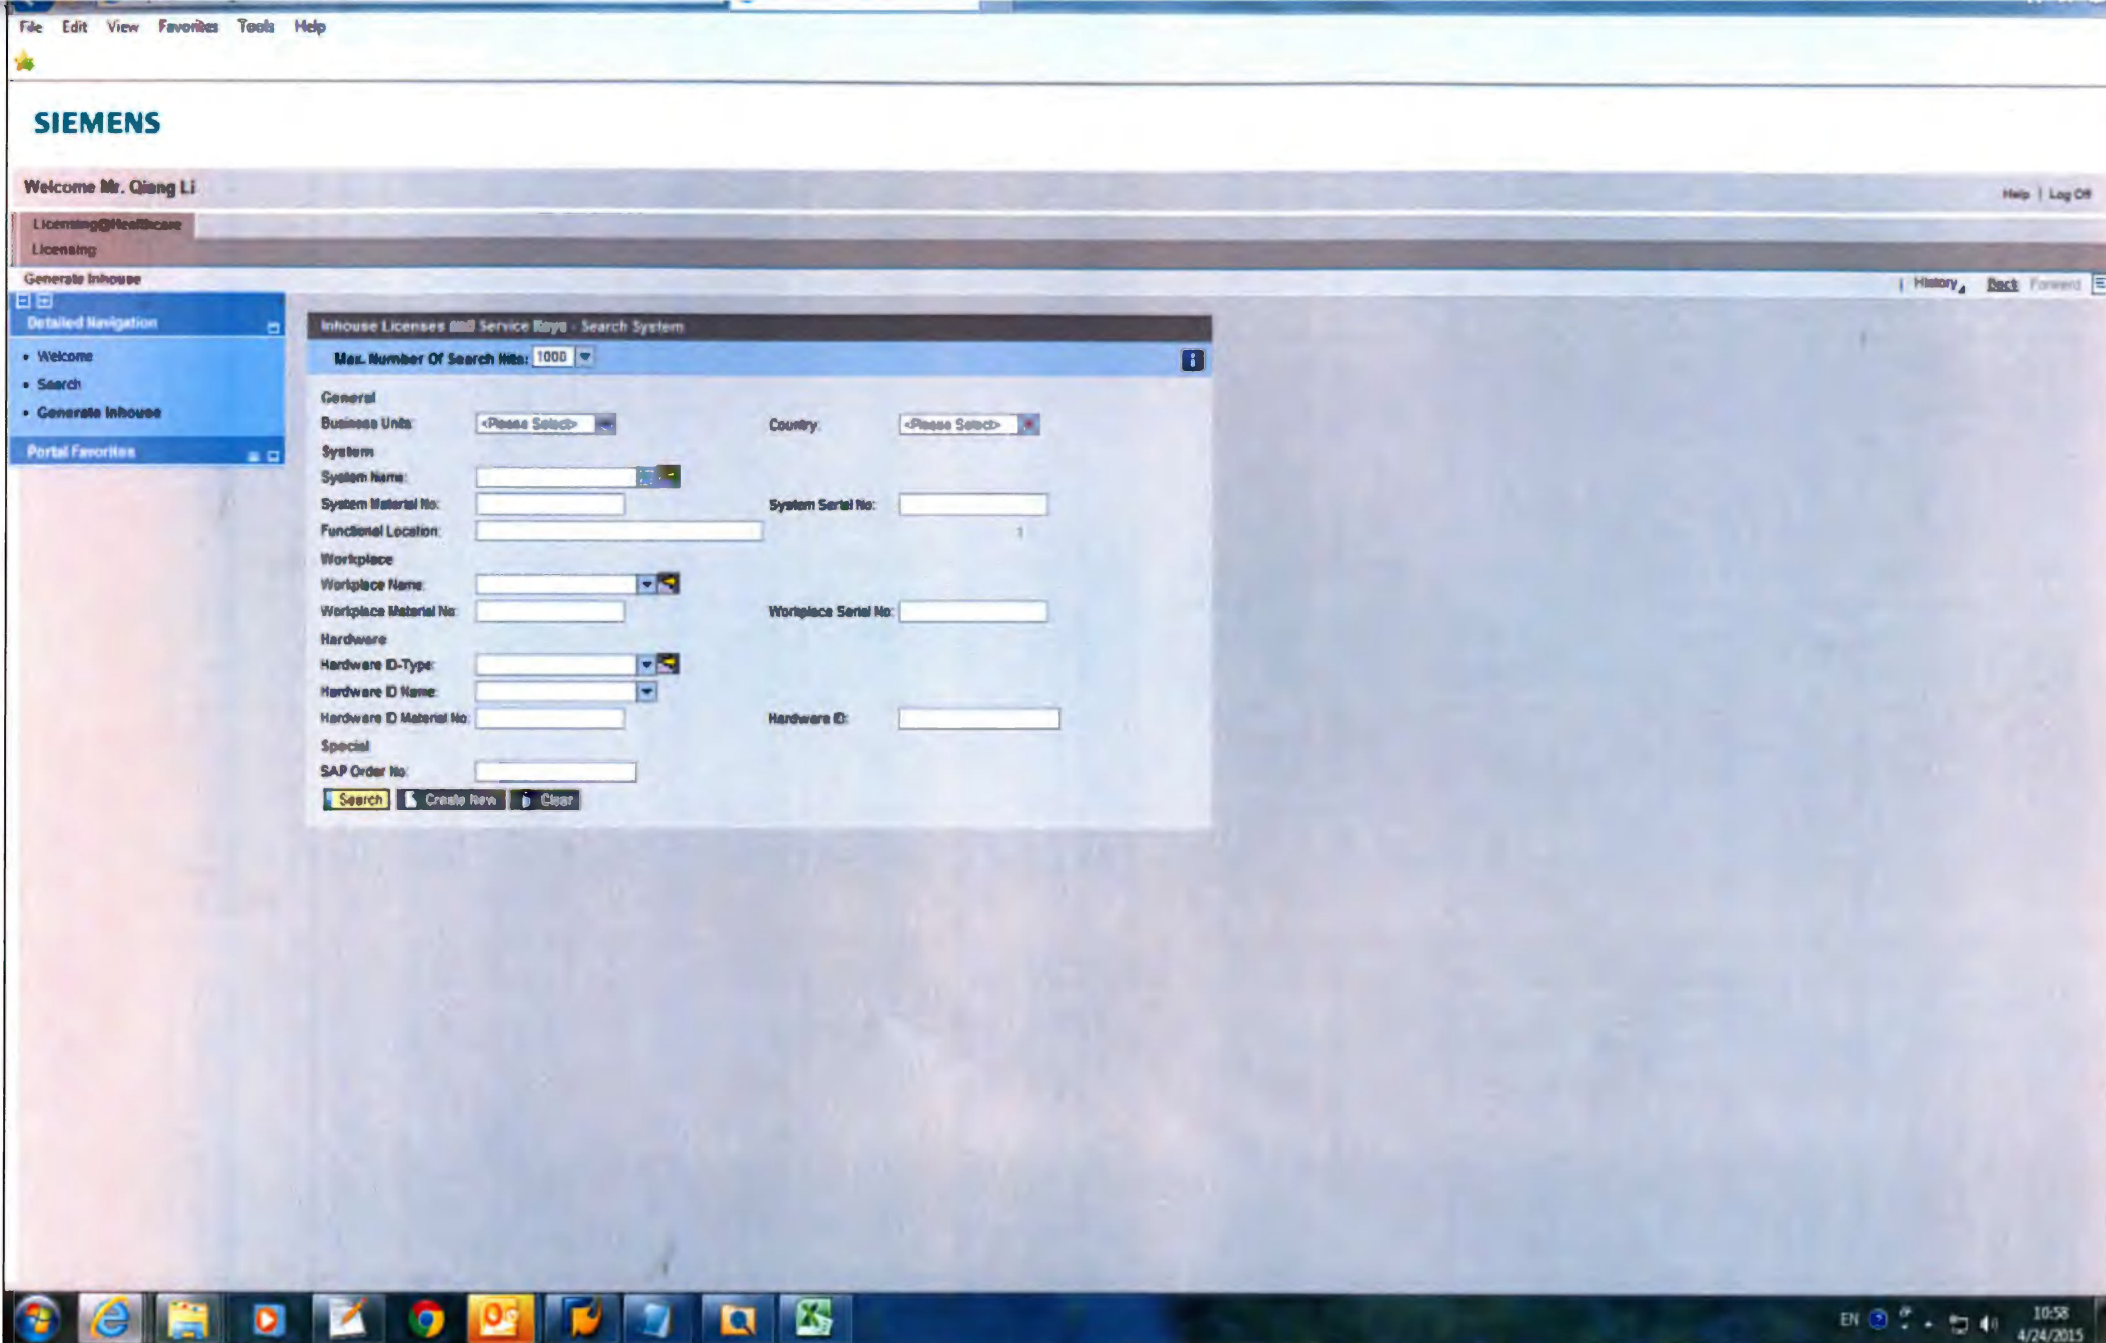


Рисунок 42. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для функциональных системных коммуникаций

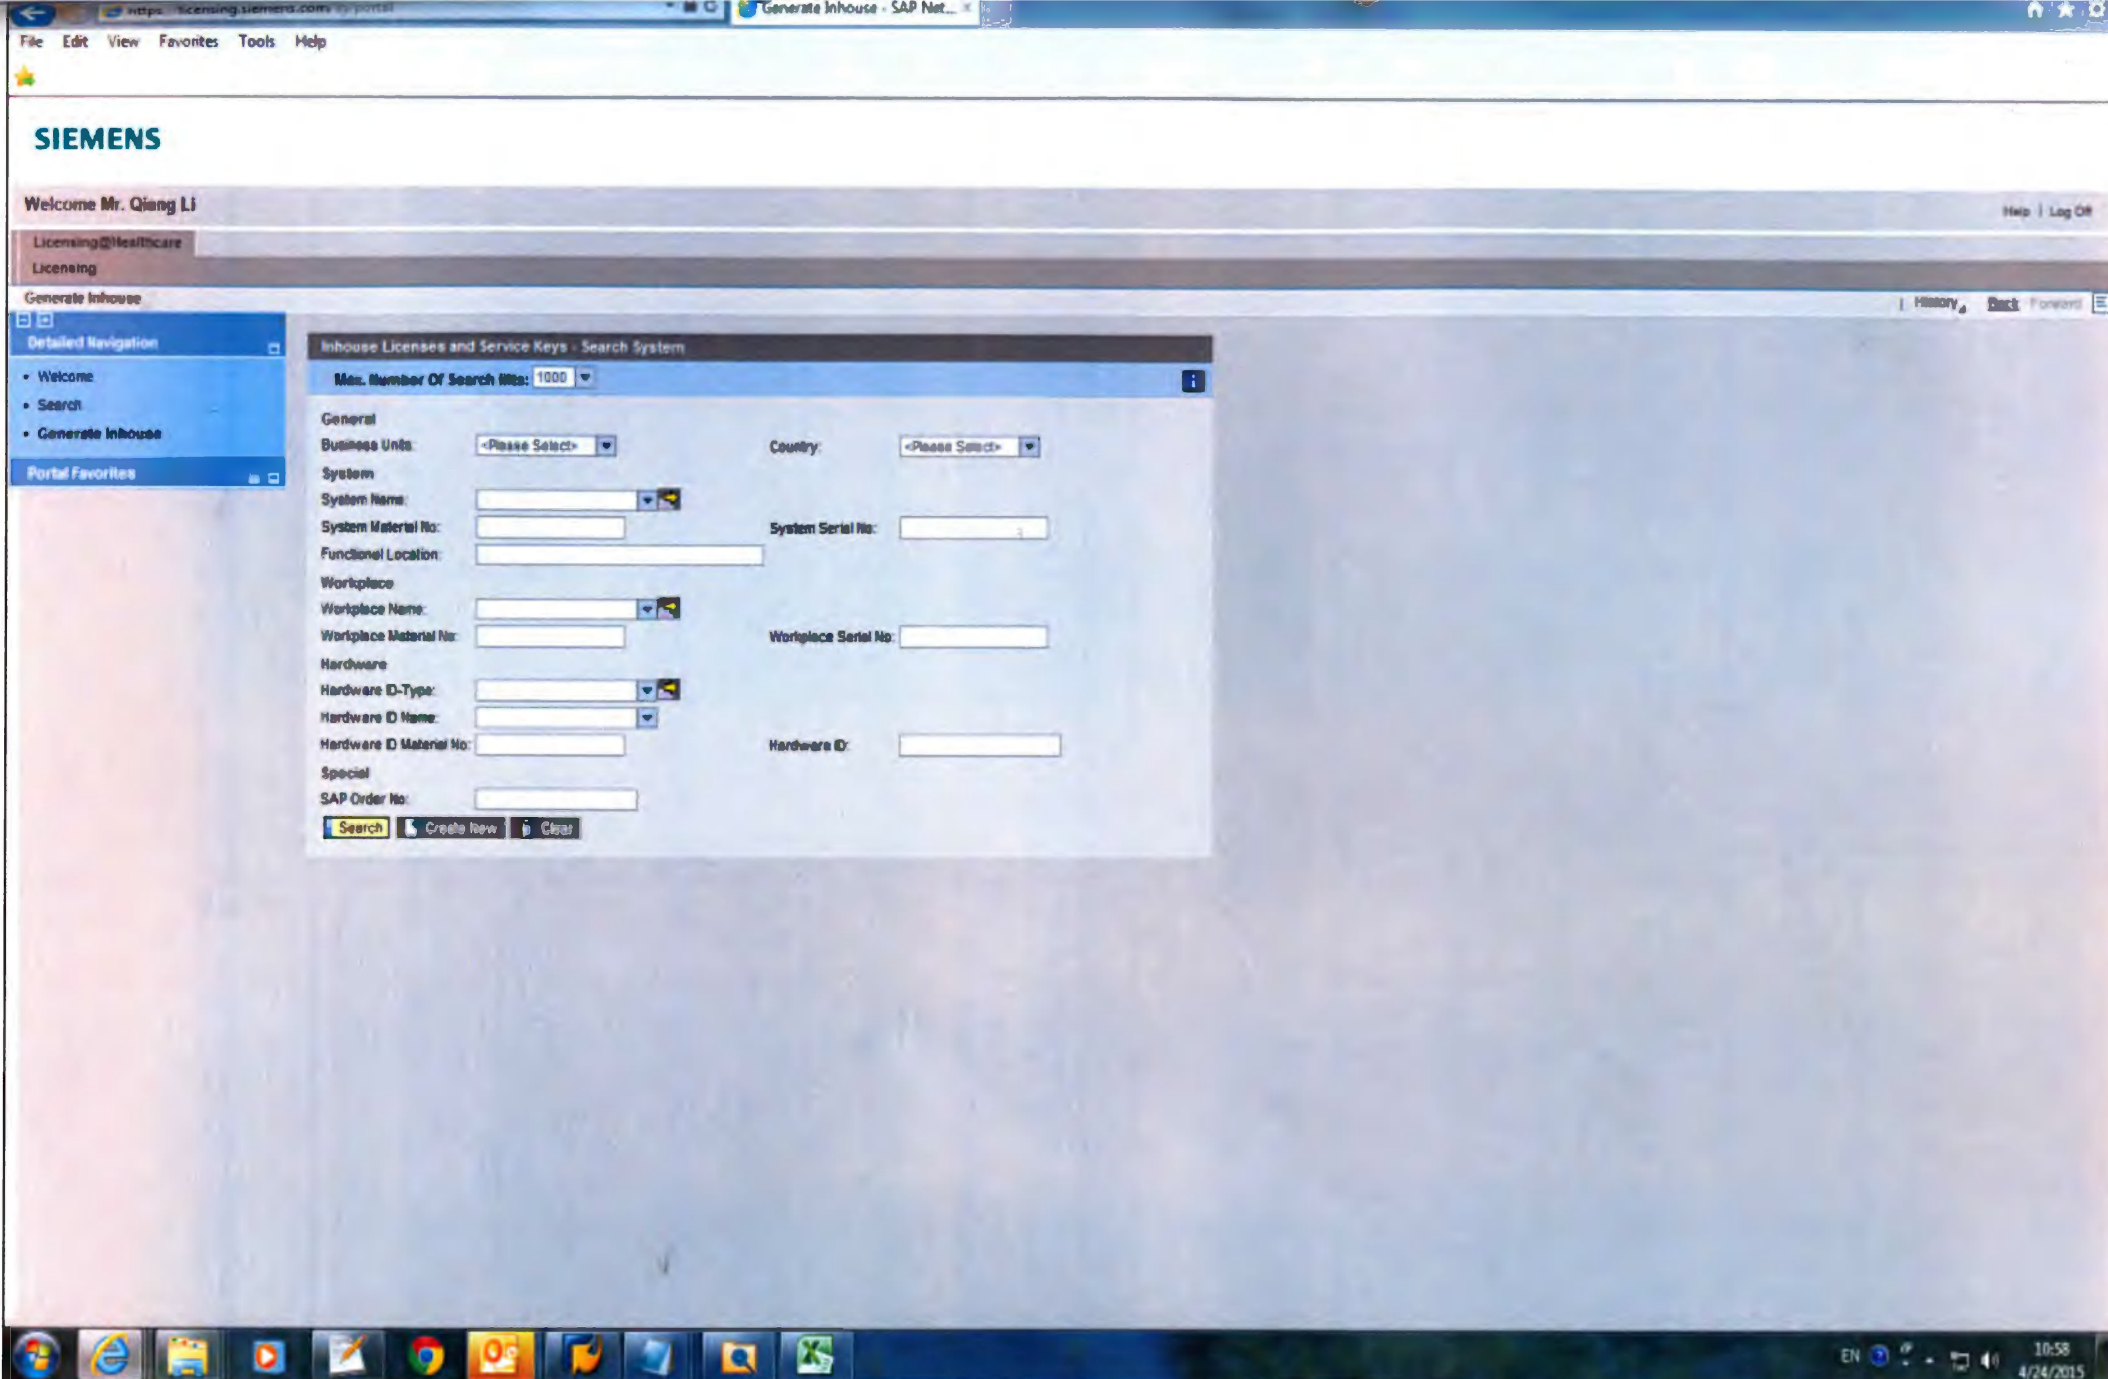


Рисунок 43. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений

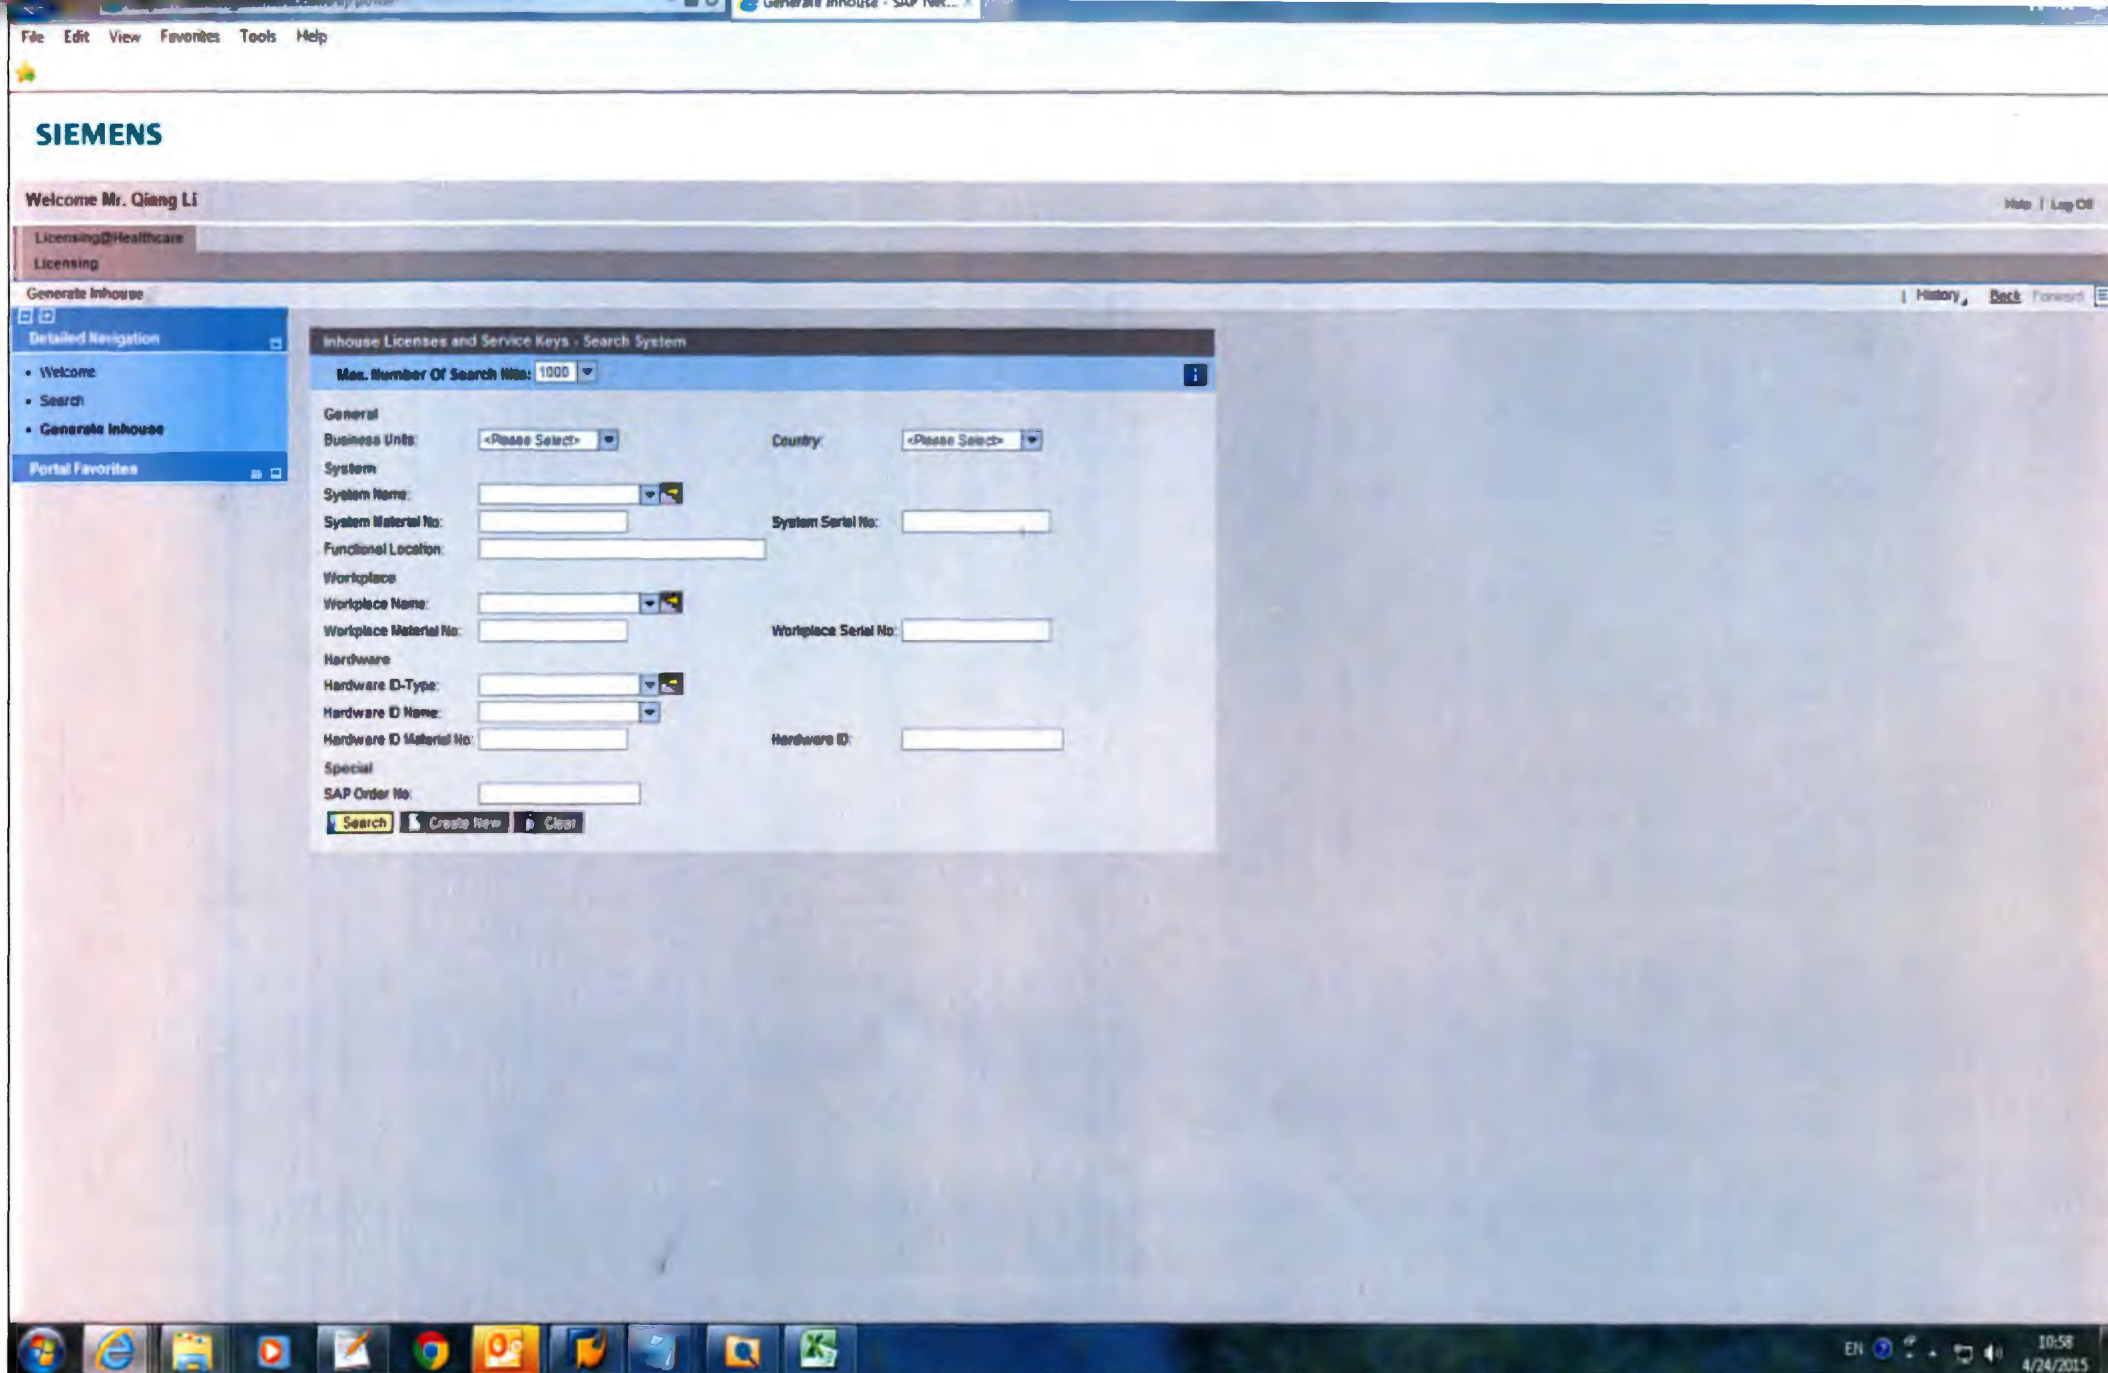


Рисунок 44. Ключи лицензионные для активации опций программных режимов для постобработки изображений

SIEMENS

www.siemens.com/healthcare

CT Examination (КТ- обследование)

Инструкции по эксплуатации – SOMATOM Scope
syngo CT VC30 - easyIQ version

Answers for life.

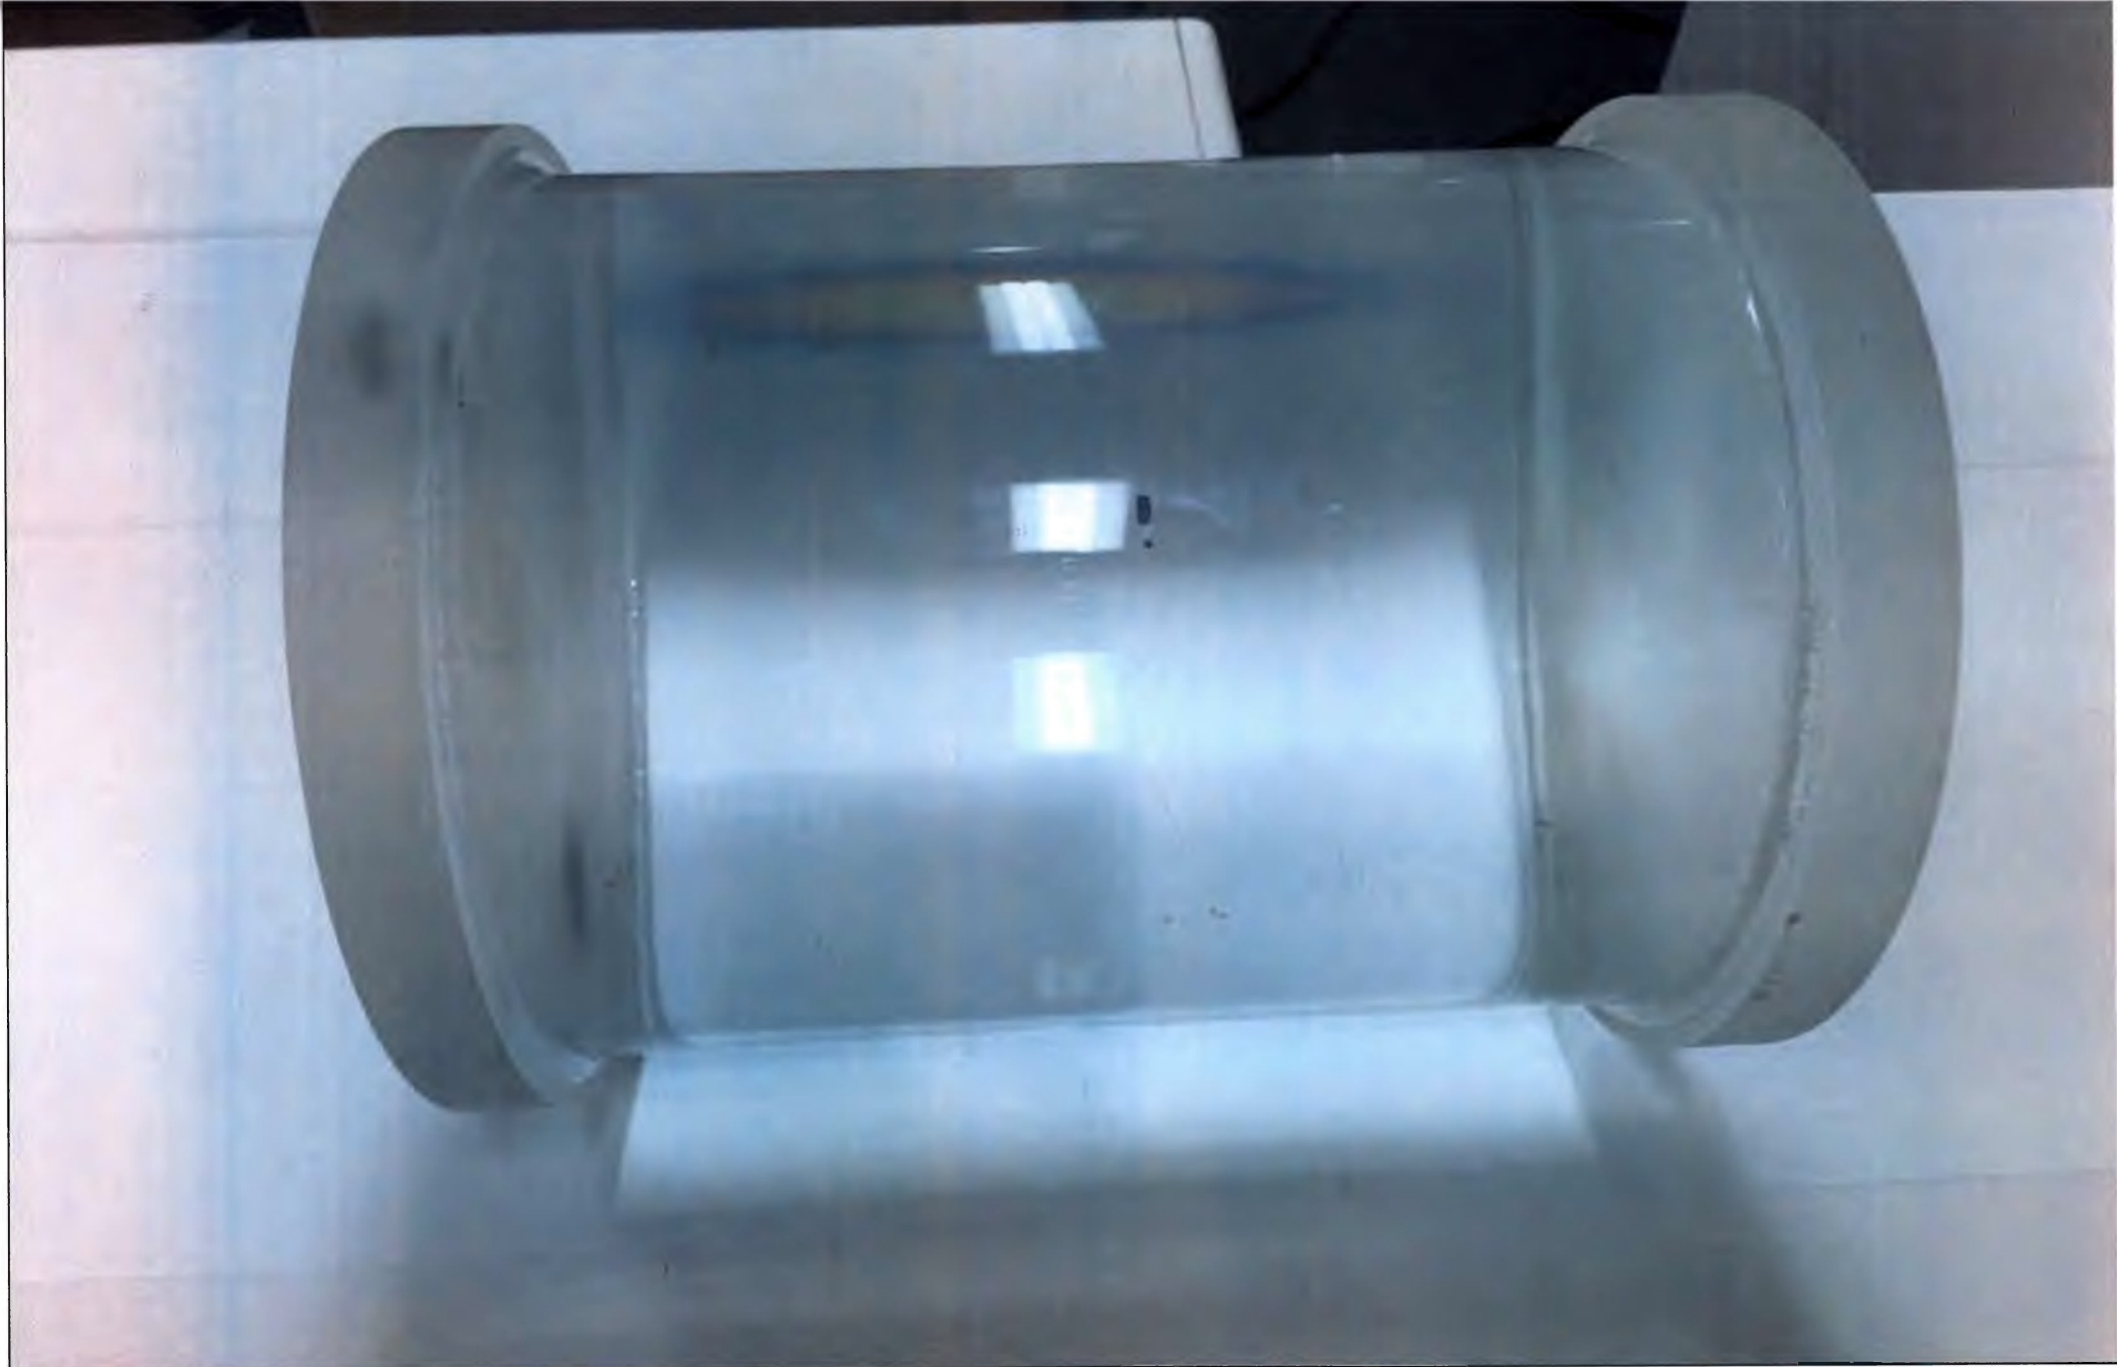


Рисунок 46. Фантомы

Рисунок 47. Держатели фантовых





Рисунок 48. ЭКГ-кабели

Всего прошито и
пронумеровано 71
листов.

Александр А.В.

