

Утверждаю

Генеральный директор



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Комплекс анестезиологический
«Фаза-23» по ТУ 9444-001-72602041-2006 с принадлежностями»
(согласно приложению)

Производство:

Акционерное общество «Уральский приборостроительный завод»


Юридический адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта

ПРИЛОЖЕНИЕ


«Комплекс анестезиологический

«Фаза-23» по ТУ 9444-001-72602041-2006 с принадлежностями»

- 1-клапан предохранительный РП23.00-05.330;
- 2-переходник навесной РП23.00-05.370;
- 3-трубка (4х6 L=1600 мм) РП23.00-05.303;
- 4-шланг кислорода РП23.00-05.410;
- 5-шланг закиси азота РП23.00-05.410-01;
- 6-шланг ксенона РП23.00-05.410-02;
- 7-датчик расхода РП23.00-05.610;
- 8-пружина РП23.00-05.304;
- 9-комплекс анестезиологический «Фаза-23» (базовый блок) РП23.01-05-000;
- 10-увлажнитель РП23.10-05.000;
- 11-испаритель галотана РП23.20-05.000;
- 12-отстойник (сборник конденсата) РП5.14-00.000;
- 13-адсорбер РП5.17-01.000;
- 14-коннектор прямой РП9.19-00.319-03;
- 15-угольник РП11.19-00.051;
- 16- угольник РП11.19-00.051-01;
- 17-тройник аспирационный ДВ5.894.011;
- 18-трубка соединительная с коннектором ДВ6.453.016;
- 19-тройник Y-образный с портами 601/5088 MALLINCKRODT DAR (Италия);
- 20-трубка дыхательная силиконовая с наконечником ТДС-2 ГАКЕ.943136.001-001 ТУ 9398-001-72474991 ОАО «Медсиликон»;
- 21-трубка дыхательная силиконовая с наконечником ТДС-1 ГАКЕ.943136.001 ТУ 9398-001-72474991 ОАО «Медсиликон»;
- 22-резервный мешок без латекса объемом 3 л 2830-004 фирмы INTERSURGICAL (Англия);
- 23-соединитель Y-образный 1927 фирмы INTERSURGICAL (Англия);
- 24-маска лицевая полимерная Б2-125 ТУ 3-2257-90 ЗАО НПКФ «МЕТОМ»;
- 25- маска лицевая полимерная Б2-145 ТУ 3-2257-90 ЗАО НПКФ «МЕТОМ»;
- 26-фильтр дыхательный Barrierbac «S» фирмы «Tyco Healthcare Group» 350/5879 MALLINCKRODT DAR (Италия);
- 27-испаритель севофлорана РП23.20-05.000-01;
- 28- испаритель изофлорана РП23.20-05.000-02;
- 29-газоанализатор бинарных вдыхаемых газовых смесей аппаратов ИН и ИВЛ «ГКМ-03-ИНCOBT» ЗАО «ИНCOBT»;
- 30-основной 22 мм анестезиологический реверсивный контур + лимб 0,8 2202 фирмы INTERSURGICAL (Англия);
- 31-монитор МПР6/2-03 – «Тритон» (с модулями каналов капнометрии и пульсоксиметрии) производства ООО «Тритон электроникс»;
- 32-датчик расхода РП23.00-05.610;
- 33-вставка плавкая ВП1-5А-250В АГО.481.303ТУ;
- 34- вставка плавкая ВП2Б-10А-250В АГО.481.303ТУ.

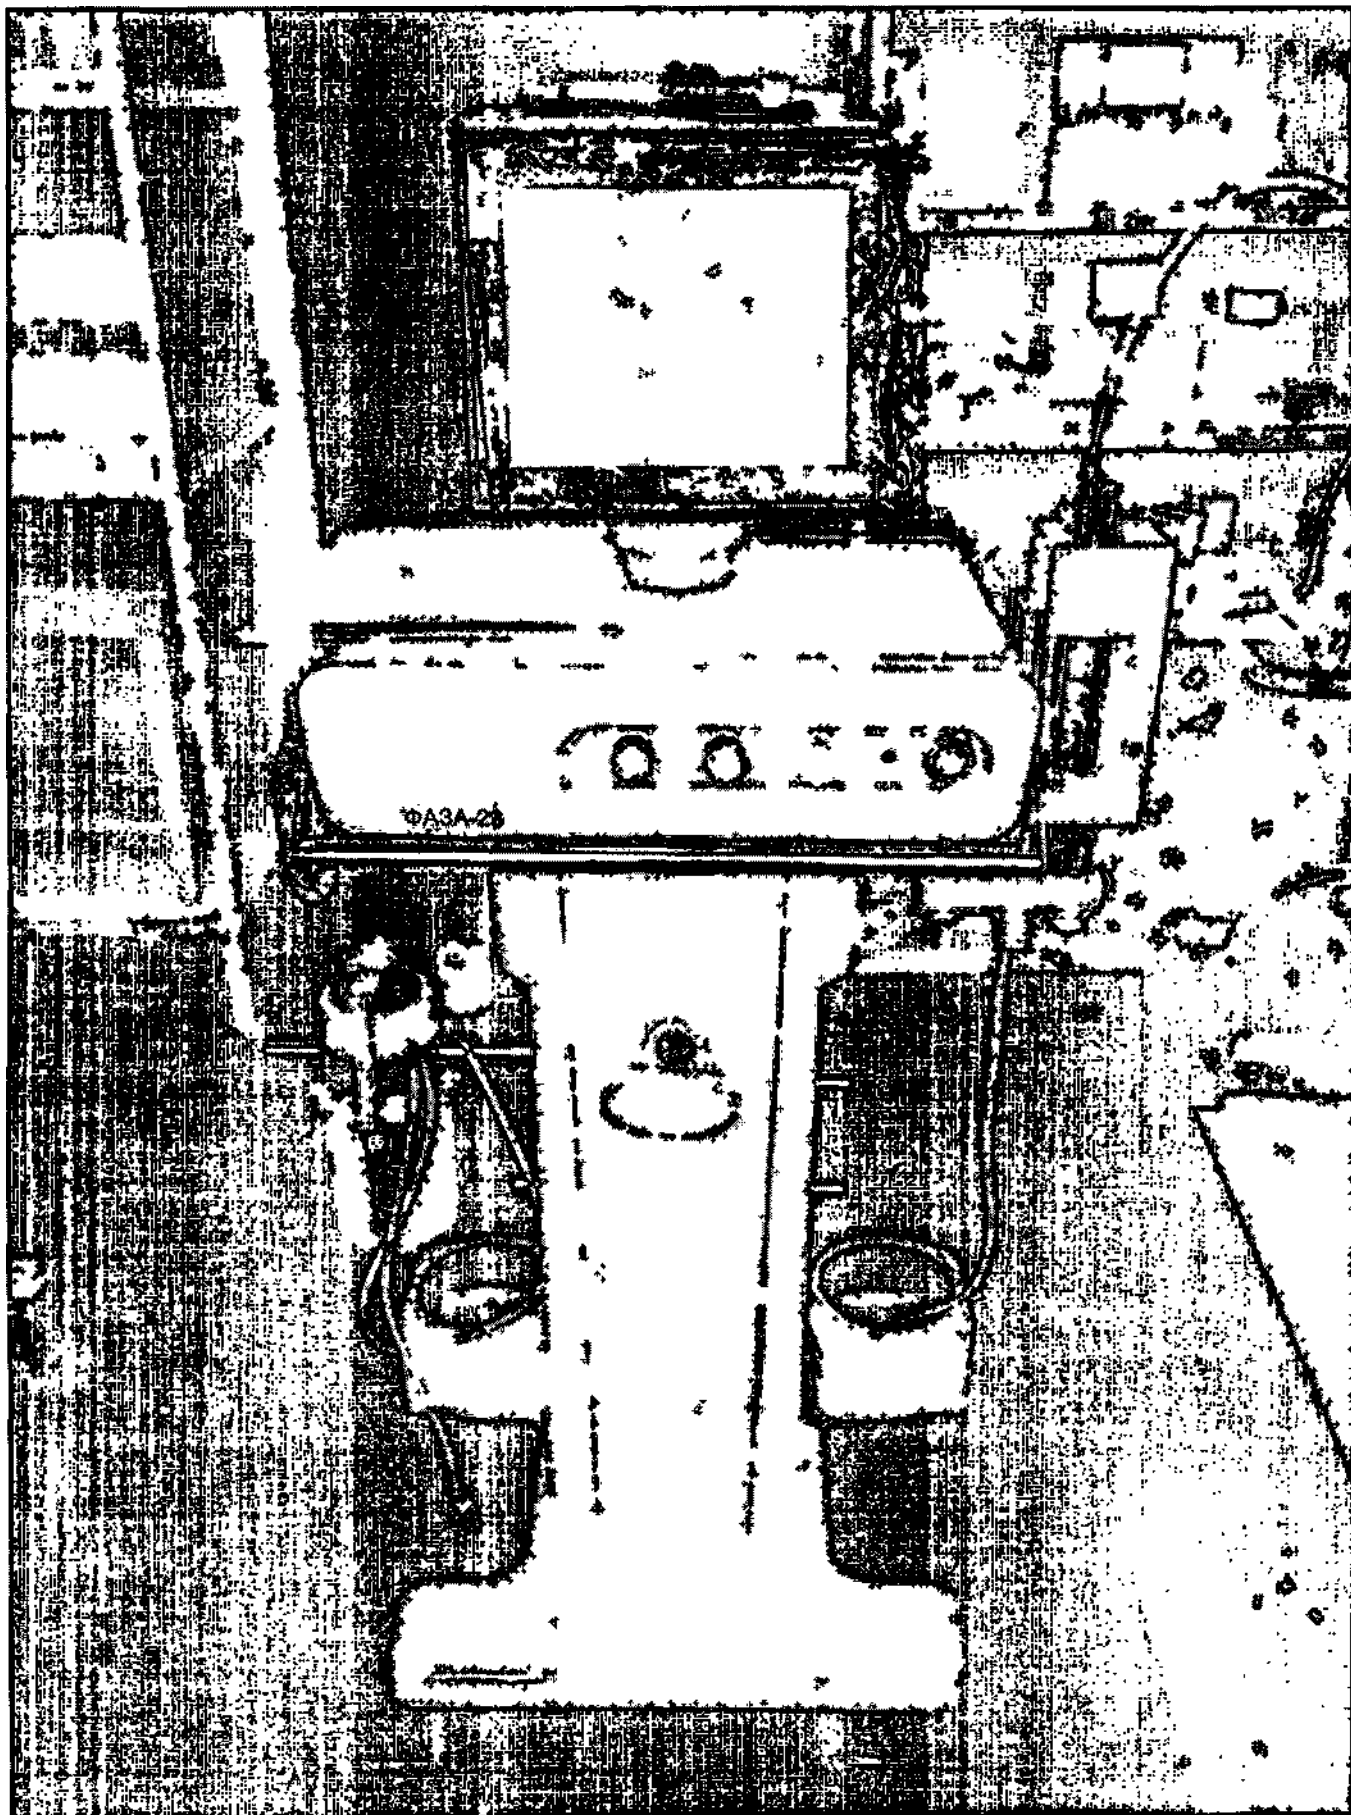


I – Анестезиологический комплекс «Фаза-23»

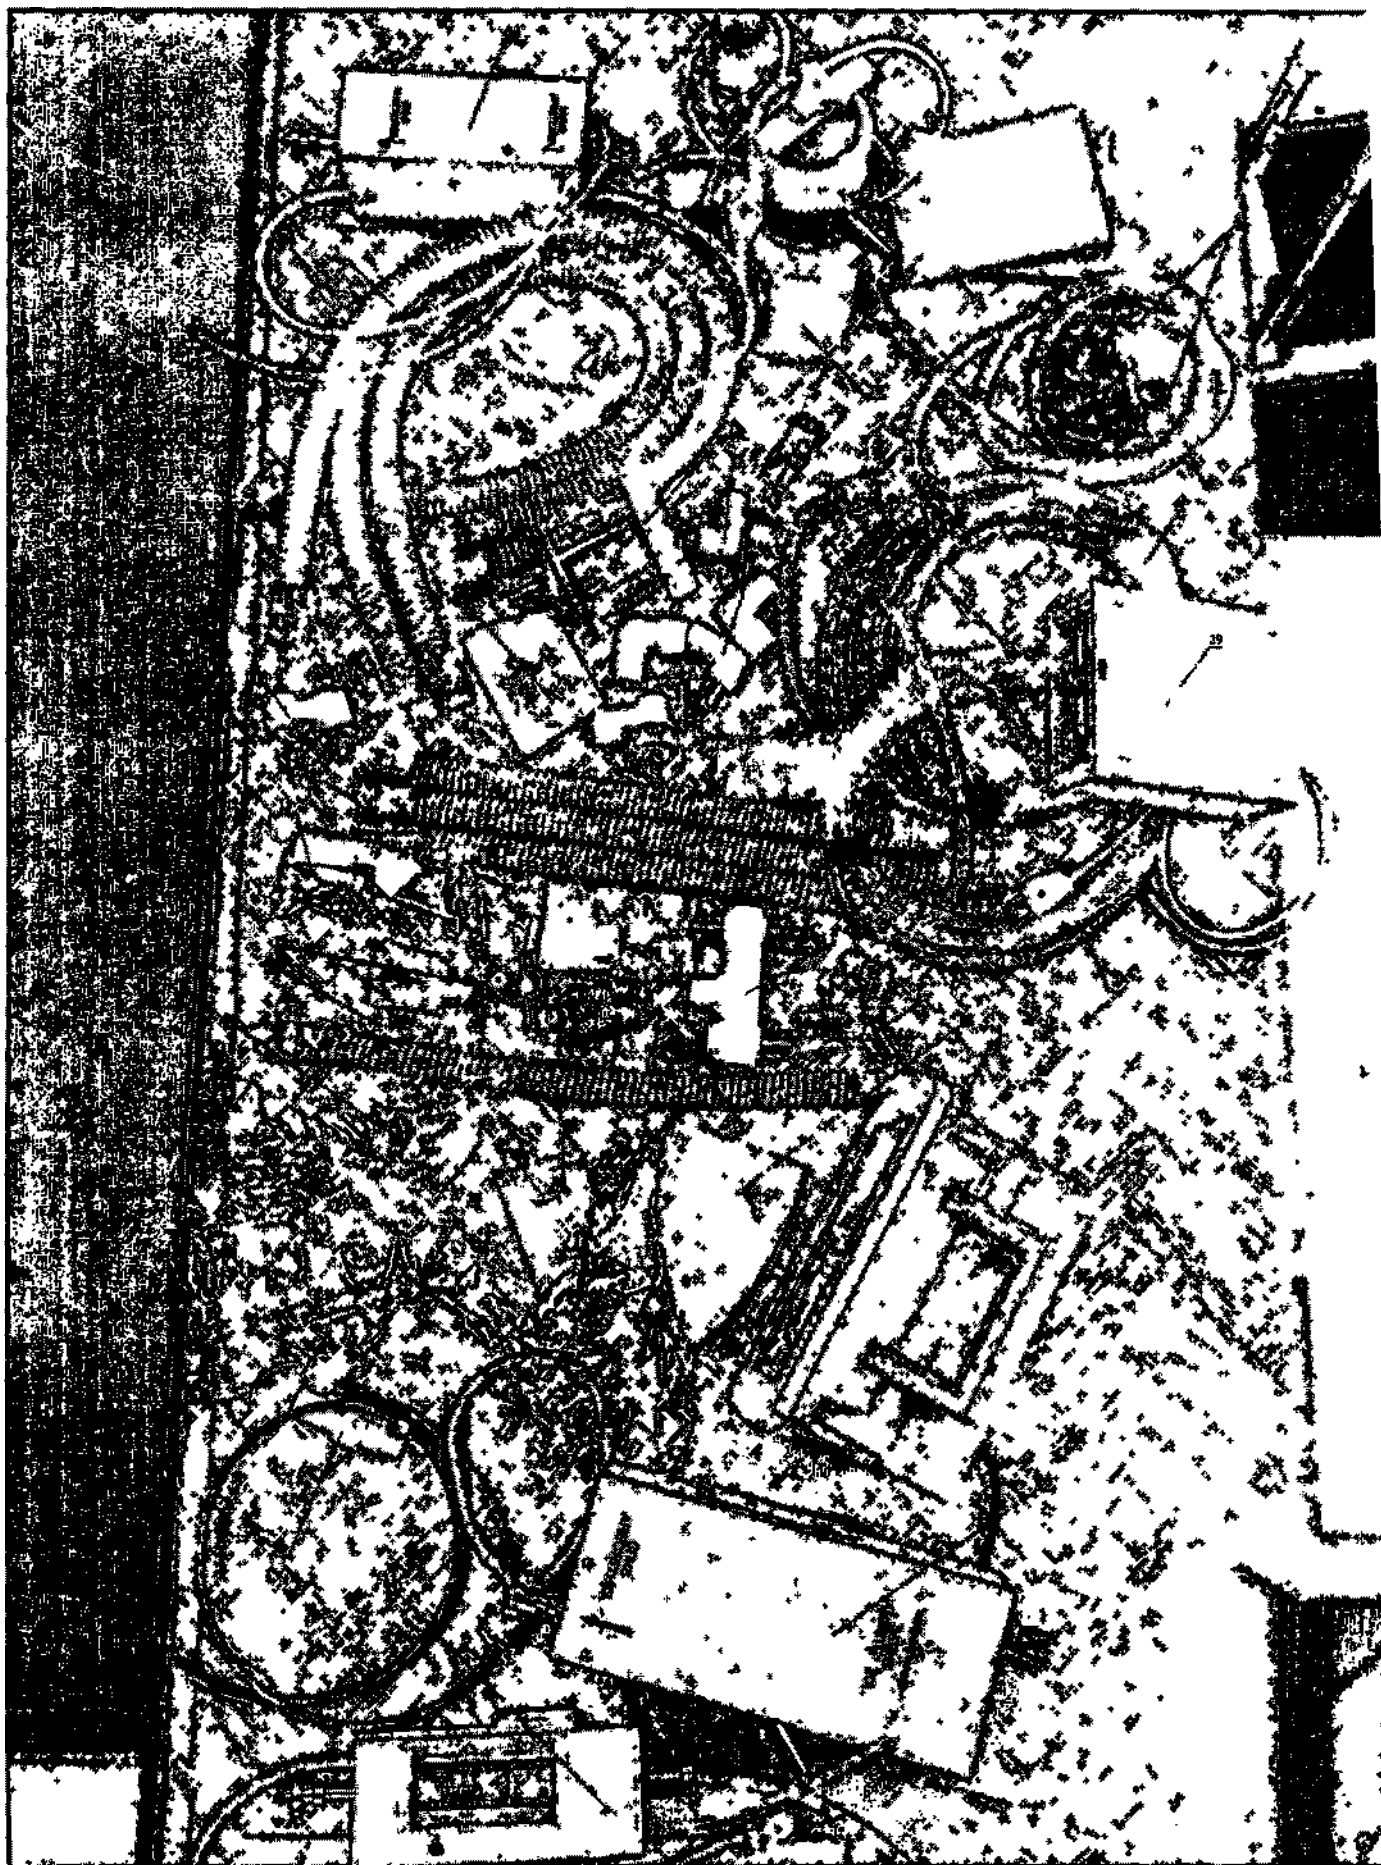

- 1-клапан предохранительный РП23.00-05.330;
2-переходник навесной РП23.00-05.370;
3-трубка (4x6 L=1600 мм) РП23.00-05.303;
4-шланг кислорода РП23.00-05.410;

- 5-шланг закиси азота РП23.00-05.410-01;
- 6-шланг ксенона РП23.00-05.410-02;
- 8-пружина РП23.00-05.304;
- 10-увлажнитель РП23.10-05.000;
- 11-испаритель галотана РП23.20-05.000;
- 12-отстойник (сборник конденсата) РП5.14-00.000;
- 13-адсорбер РП5.17-01.000;
- 14-коннектор прямой РП9.19-00.319-03;
- 15-угольник РП11.19-00.051;
- 16- угольник РП11.19-00.051-01;
- 17-тройник аспирационный ДВ5.894.011;
- 18-трубка соединительная с коннектором ДВ6.453.016;
- 19-тройник Y-образный с портами 601/5088 MALLINCKRODT DAR (Италия);
- 20-трубка дыхательная силиконовая с наконечником ТДС-2 ГАКЕ.943136.001-001 ТУ 9398-001-72474991 ОАО «Медсиликон»;
- 21-трубка дыхательная силиконовая с наконечником ТДС-1 ГАКЕ.943136.001 ТУ 9398-001-72474991 ОАО «Медсиликон»;
- 22-резервный мешок без латекса объемом 3 л 2830-004 фирмы INTERSURGICAL (Англия);
- 23-соединитель Y-образный 1927 фирмы INTERSURGICAL (Англия);
- 24-маска лицевая полимерная Б2-125 ТУ 3-2257-90 ЗАО НПКФ «МЕТОМ»;
- 25- маска лицевая полимерная Б2-145 ТУ 3-2257-90 ЗАО НПКФ «МЕТОМ»;
- 26-фильтр дыхательный Barrierbac «S» фирмы «Tyco Healthcare Group» 350/5879 MALLINCKRODT DAR (Италия);
- 27-испаритель севофлурана РП23.20-05.000-01;
- 28- испаритель изофлурана РП23.20-05.000-02;
- 29-газоанализатор бинарных вдыхаемых газовых смесей аппаратов ИН и ИВЛ «ГКМ-03-ИНCOBT» ЗАО «ИНCOBT»;
- 30-основной 22 мм анестезиологический реверсивный контур + лимб 0,8 2202 фирмы INTERSURGICAL (Англия);
- 31-монитор МПР6/2-03 – «Тритон» (с модулями каналов капнометрии и пульсоксиметрии) производства ООО «Тритон электроникс»;
- 32-датчик расхода РП23.00-05.610;
- 33-вставка плавкая ВП1-5А-250В АГО.481.303ТУ;
- 34- вставка плавкая ВП2Б-10А-250В АГО.481.303ТУ.

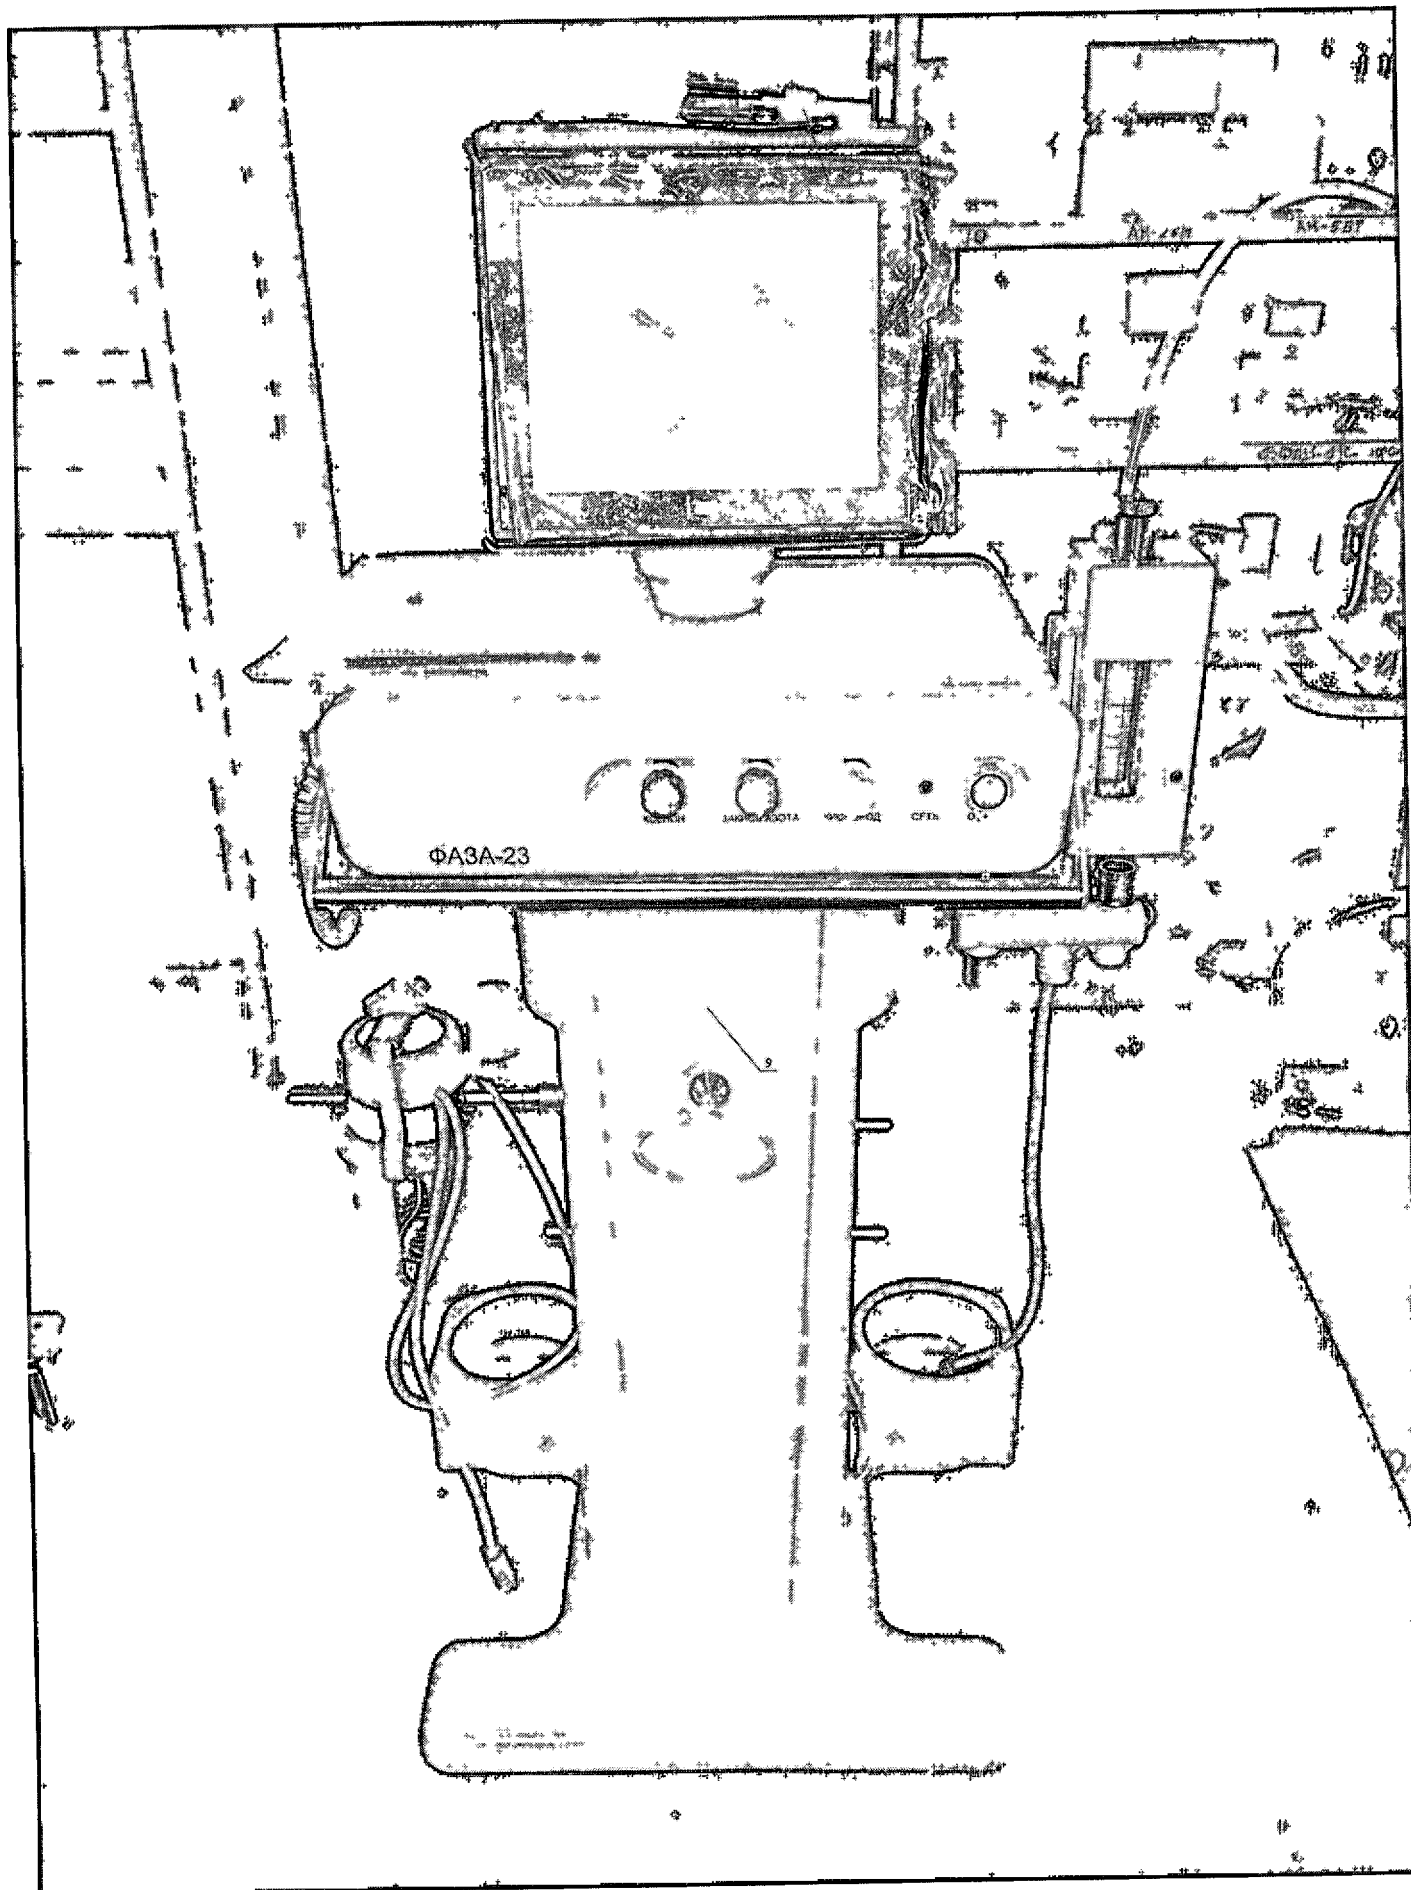

7 – датчик расхода РП РП23.00-05.610;

9 – комплекс анестезиологический «Фаза-23» (базовый блок) РП23.01-05-000.