

ООО «Медтроник»
Башня на Набережной
ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская наб., д10, стр. С
123317, Москва, Россия

tel (+7 495) 580 73 77
fax (+7 495) 580 73 78
www.medtronic.ru


ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Медтроник»
Плясунова Е.В.



Фотографические изображения медицинского изделия:

«Инструменты хирургические электрические для универсальной консоли ИРС с принадлежностями»

производства: Медтроник Пауэд Серджикал Солюшнз (Medtronic Powered Surgical Solutions), США

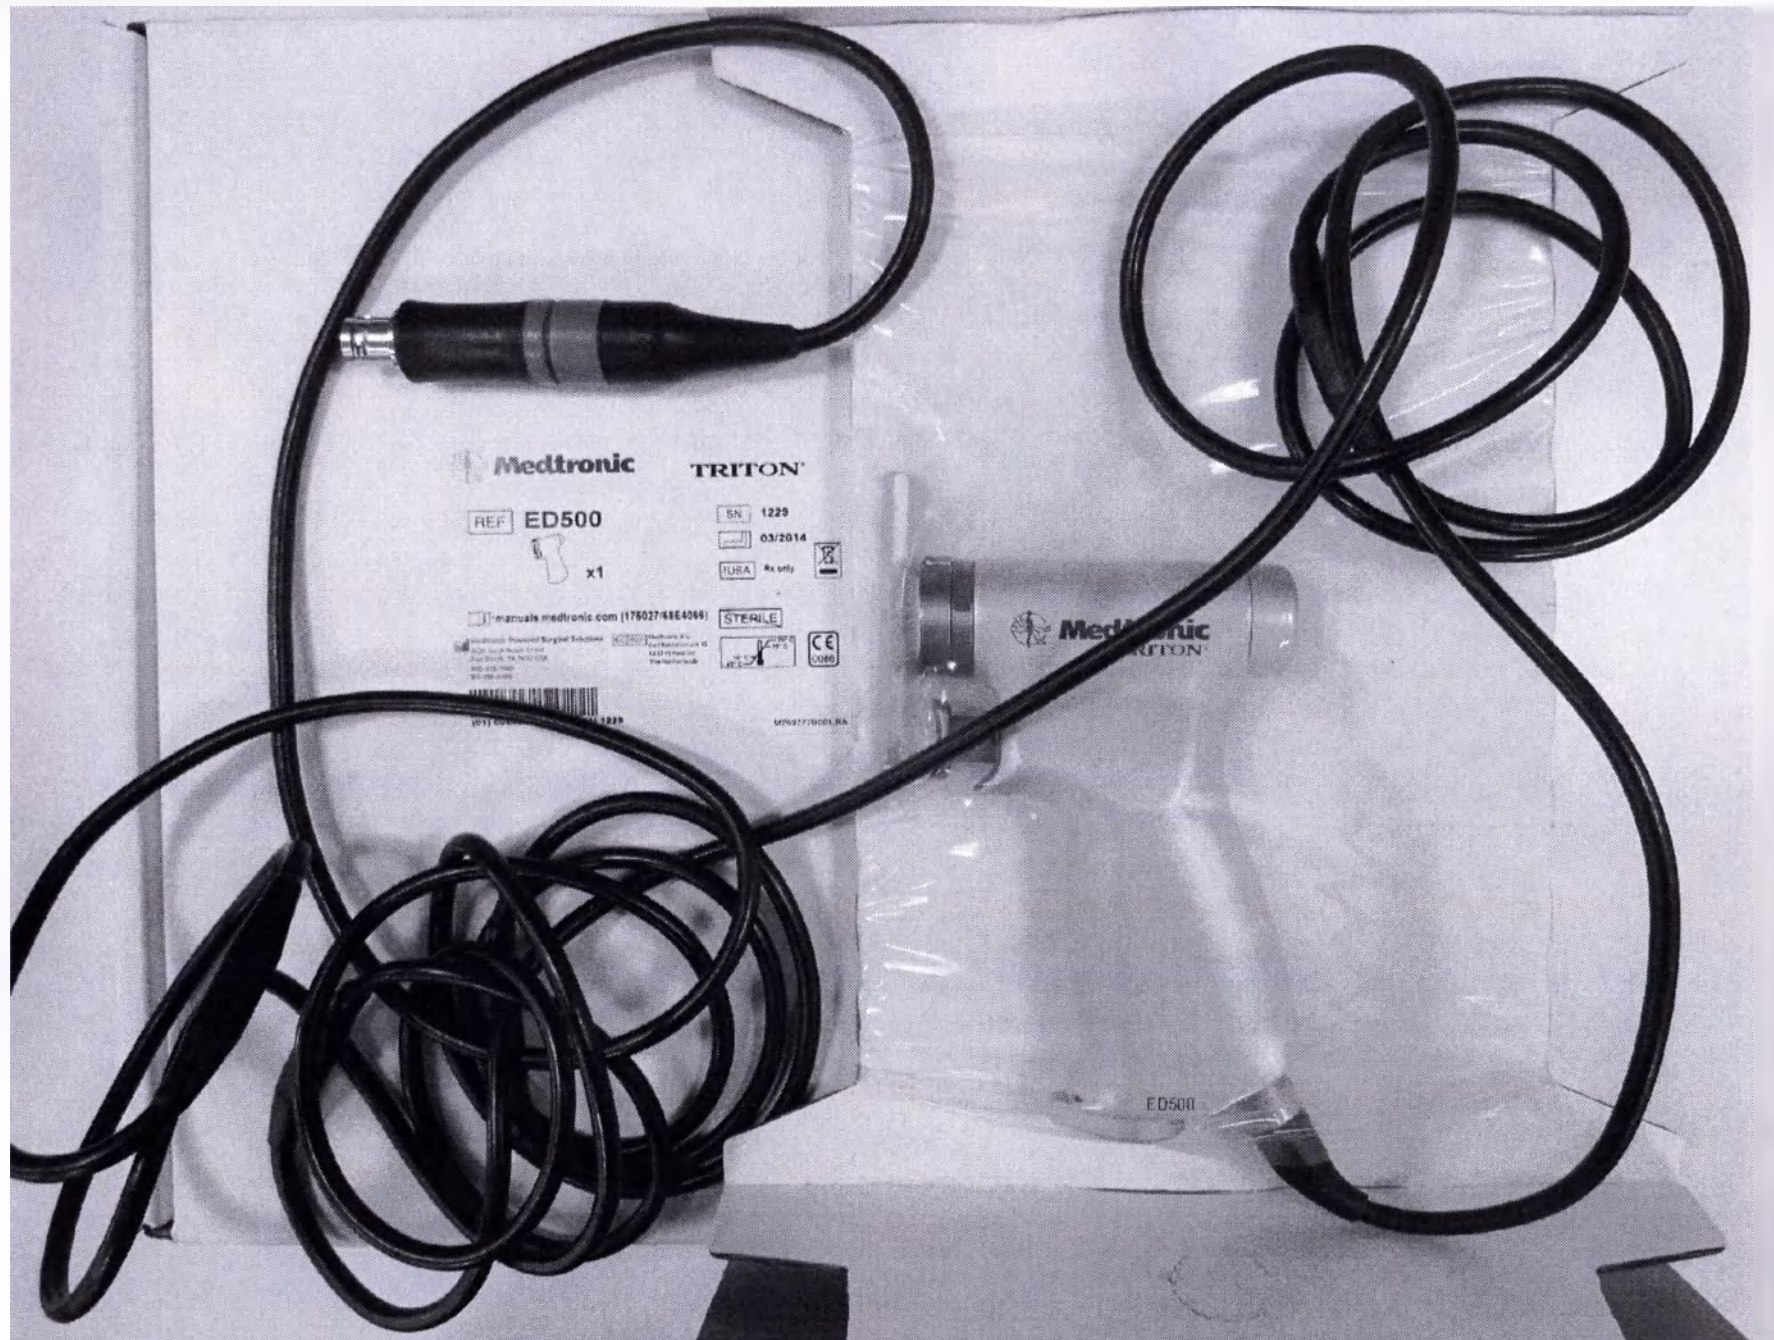

Внешний вид и упаковка медицинского изделия - Электрорукоятка TRITON с высоким крутящим моментом, модель ED500



Внешний вид и упаковка изделия - Микропила Midas Rex с ножным управлением, модель: ES100



Внешний вид и упаковка изделия - Микропила Midas Rex с ножным управлением, модель: ES200





Внешний вид и упаковка изделия - Микропила Midas Rex с пальцевым управлением, модель: ES110



Внешний вид и упаковка изделия - Микропила Midas Rex с пальцевым управлением, модель: ES210

Medtronic

MIDAS REX® SC1 REF ED100

Medtronic Xomed, Inc.
6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, FL 32216-0980 USA

STERILE 2014-04-08 **LOT** 208228522

15 C - 30 C
59 F - 86 F


CE **0123** Attention: See instruction for use. **SN: HP-18524** SC1

EC REP
Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
THE NETHERLANDS


U.S.A. Rx Only

UCC (01)00613994424136(21)HP-18524

7110079 D 0002

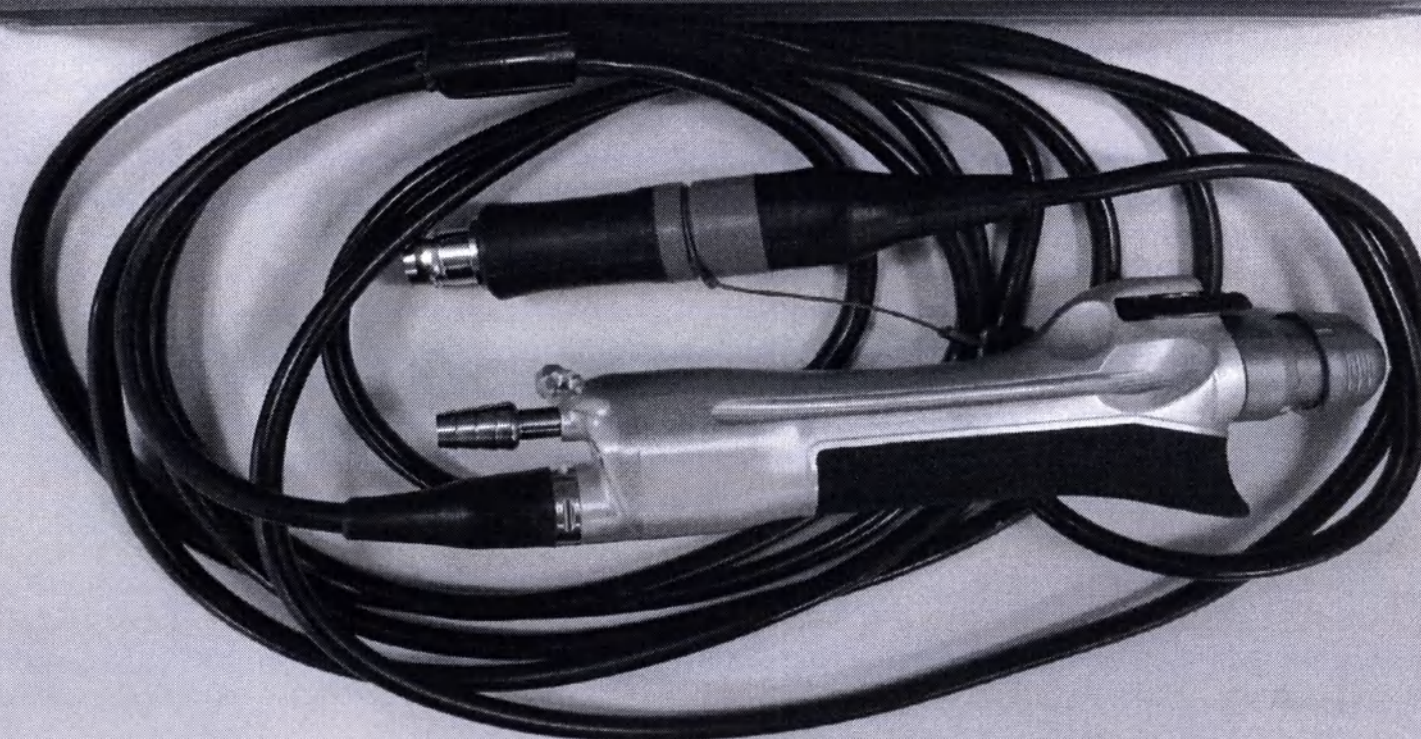

Внешний вид изделия - Рукоятка спинального шейвера Midas Rex (SC1), модель ED100

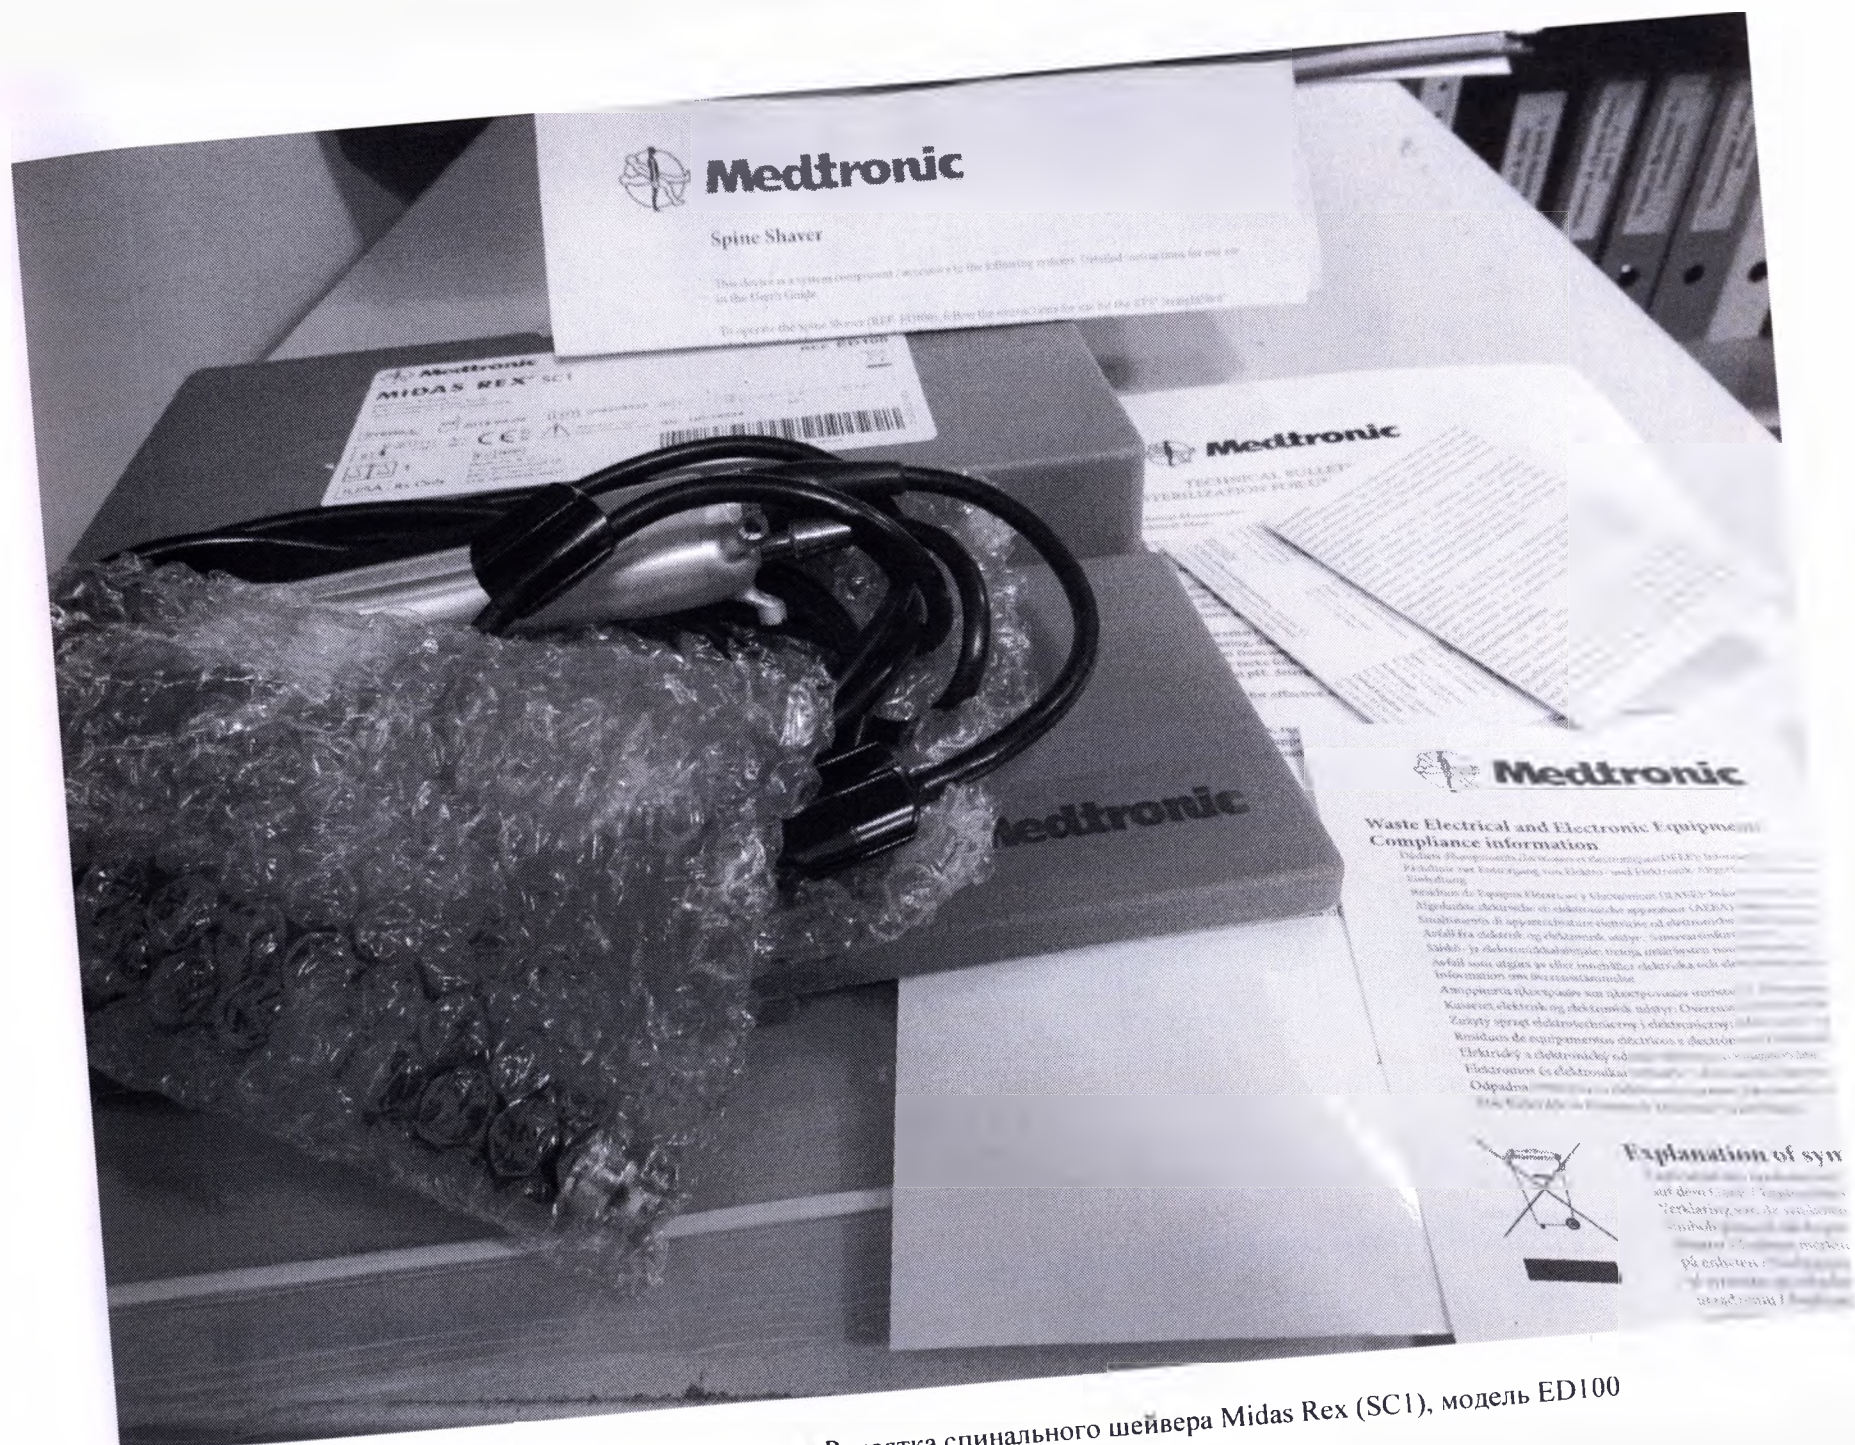

Внешний вид упаковки изделия - Рукоятка спинального шейвера Midas Rex (SCI), модель ED100



CLEANING AND STERILIZATION TECHNIQUE

REFERENCE: U.K. Health Technical Memorandum 21

EQUIPMENT: Landmar Rex ED100 Image Guided System
Cable and Neurology Stimulator Disposition (ED100)

ACCESSORIES: Instrument Sterilization Tray
The following guidelines have been compiled for cleaning and accessories referenced above. These guidelines are original and provided with the product for cleaning and sterilization instructions.

CLEANING: (Do NOT use ultrasonic washer)

1. Treat all devices produced for cleaning.
2. Remove instrument and equipment from tray.
3. Clean surfaces in warm soapy water.
4. Use low pressure water to remove all debris.
5. These products have been designed for effective cleaning.

STERILIZATION:

6. After completion of the cleaning steps, remove any debris.
7. Return instruments and equipment to appropriate tray.
8. Sterilize using the following Porous Load Cycle for reference.

POROUS LOAD CYCLE

Cycle:	Porous Load (Pre-wash)
Temperature:	134°C (273°F)
Time:	3.5 hours
Drying:	3 hours at 121°C (250°F)

Instrument Case



1/2 DIN

Medtronic Powered Surgical Solutions
4620 Monte Neach Drive
Fort Worth, TX 76137 USA
800-477-1090
817-486-6100

Medtronic B.V.
Egal 16A Spoorstraat 10
5427 AJ Roermond
The Netherlands



(01) 0 0613994 85498 8 (10) 2841308

REF EA120

LOT 2841308

10/2013

1


175027/88E4086


USA Pk Only


STERILE

M709777B001 HA



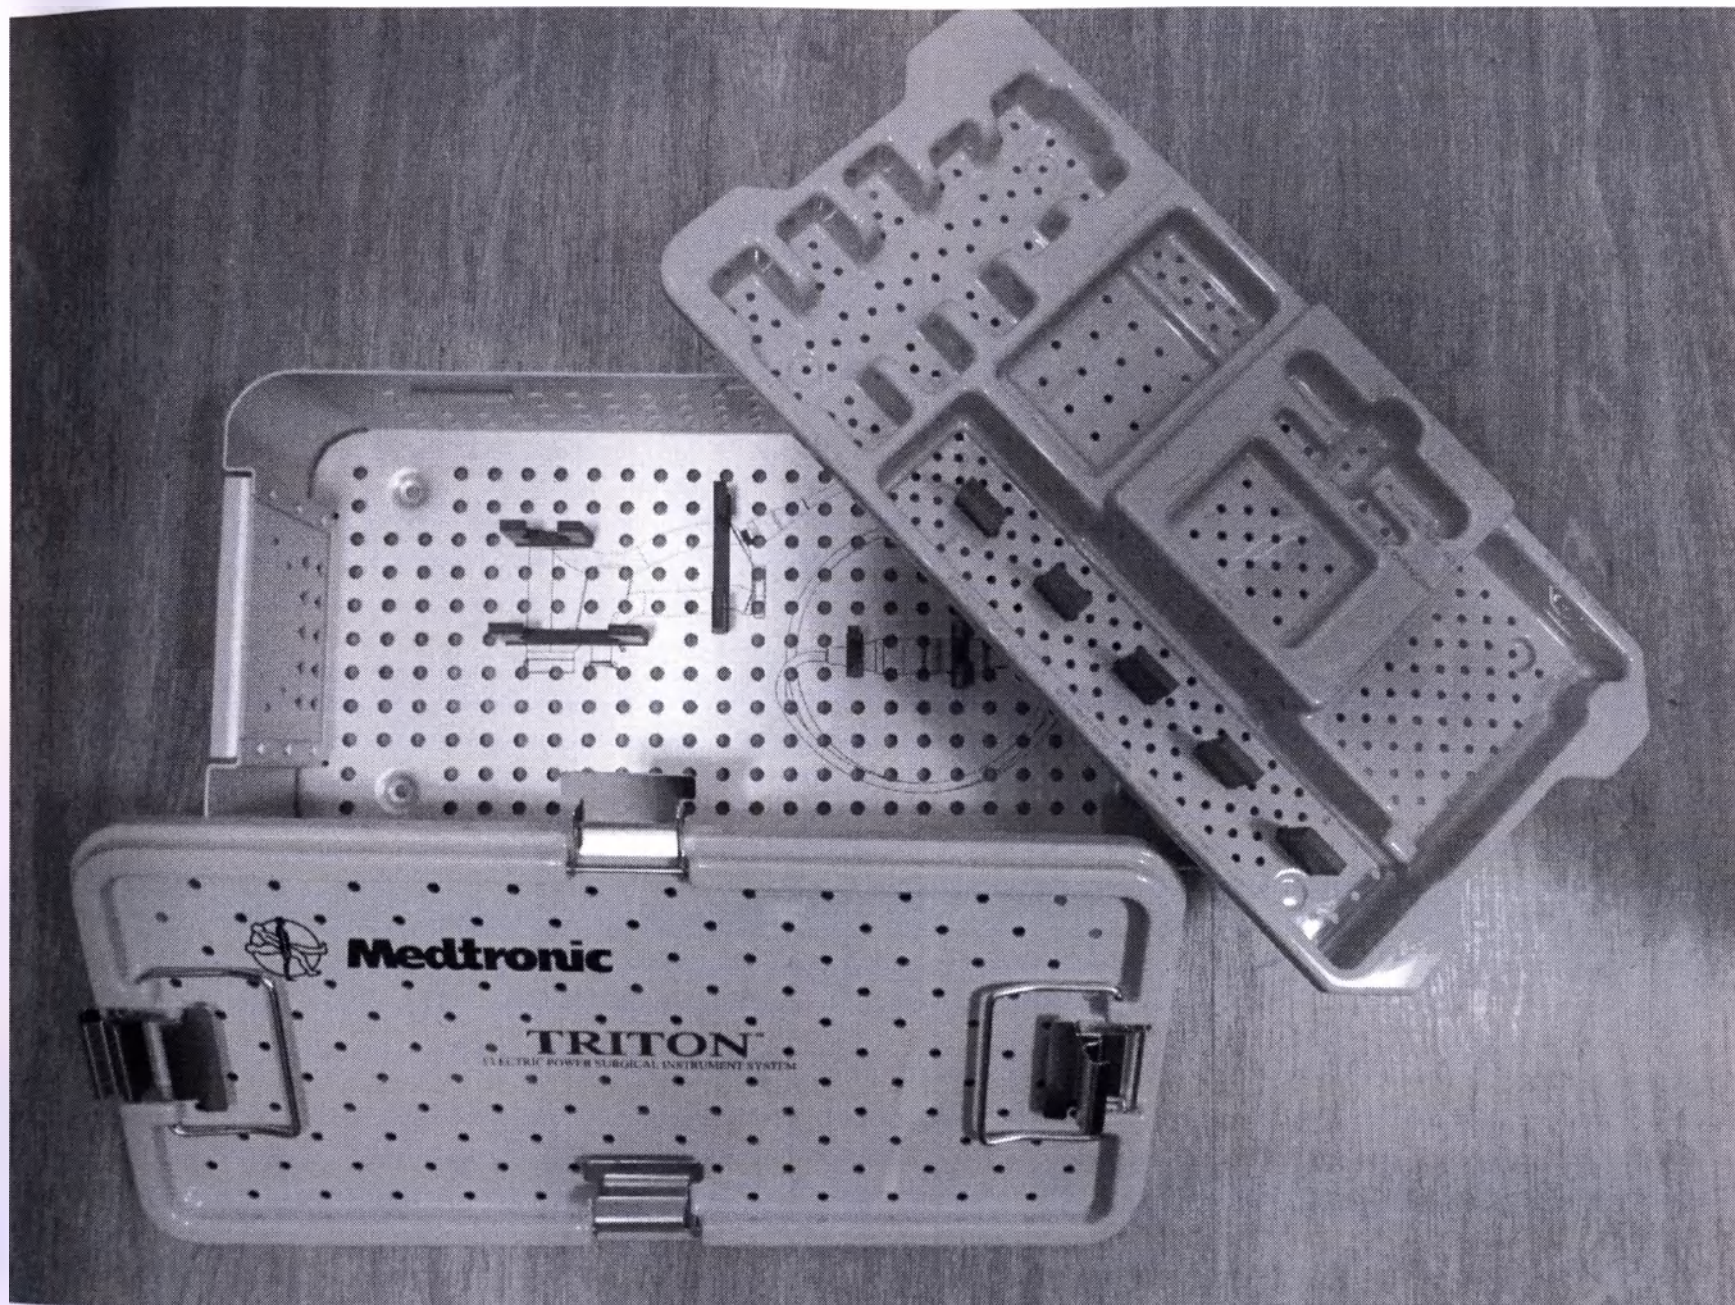

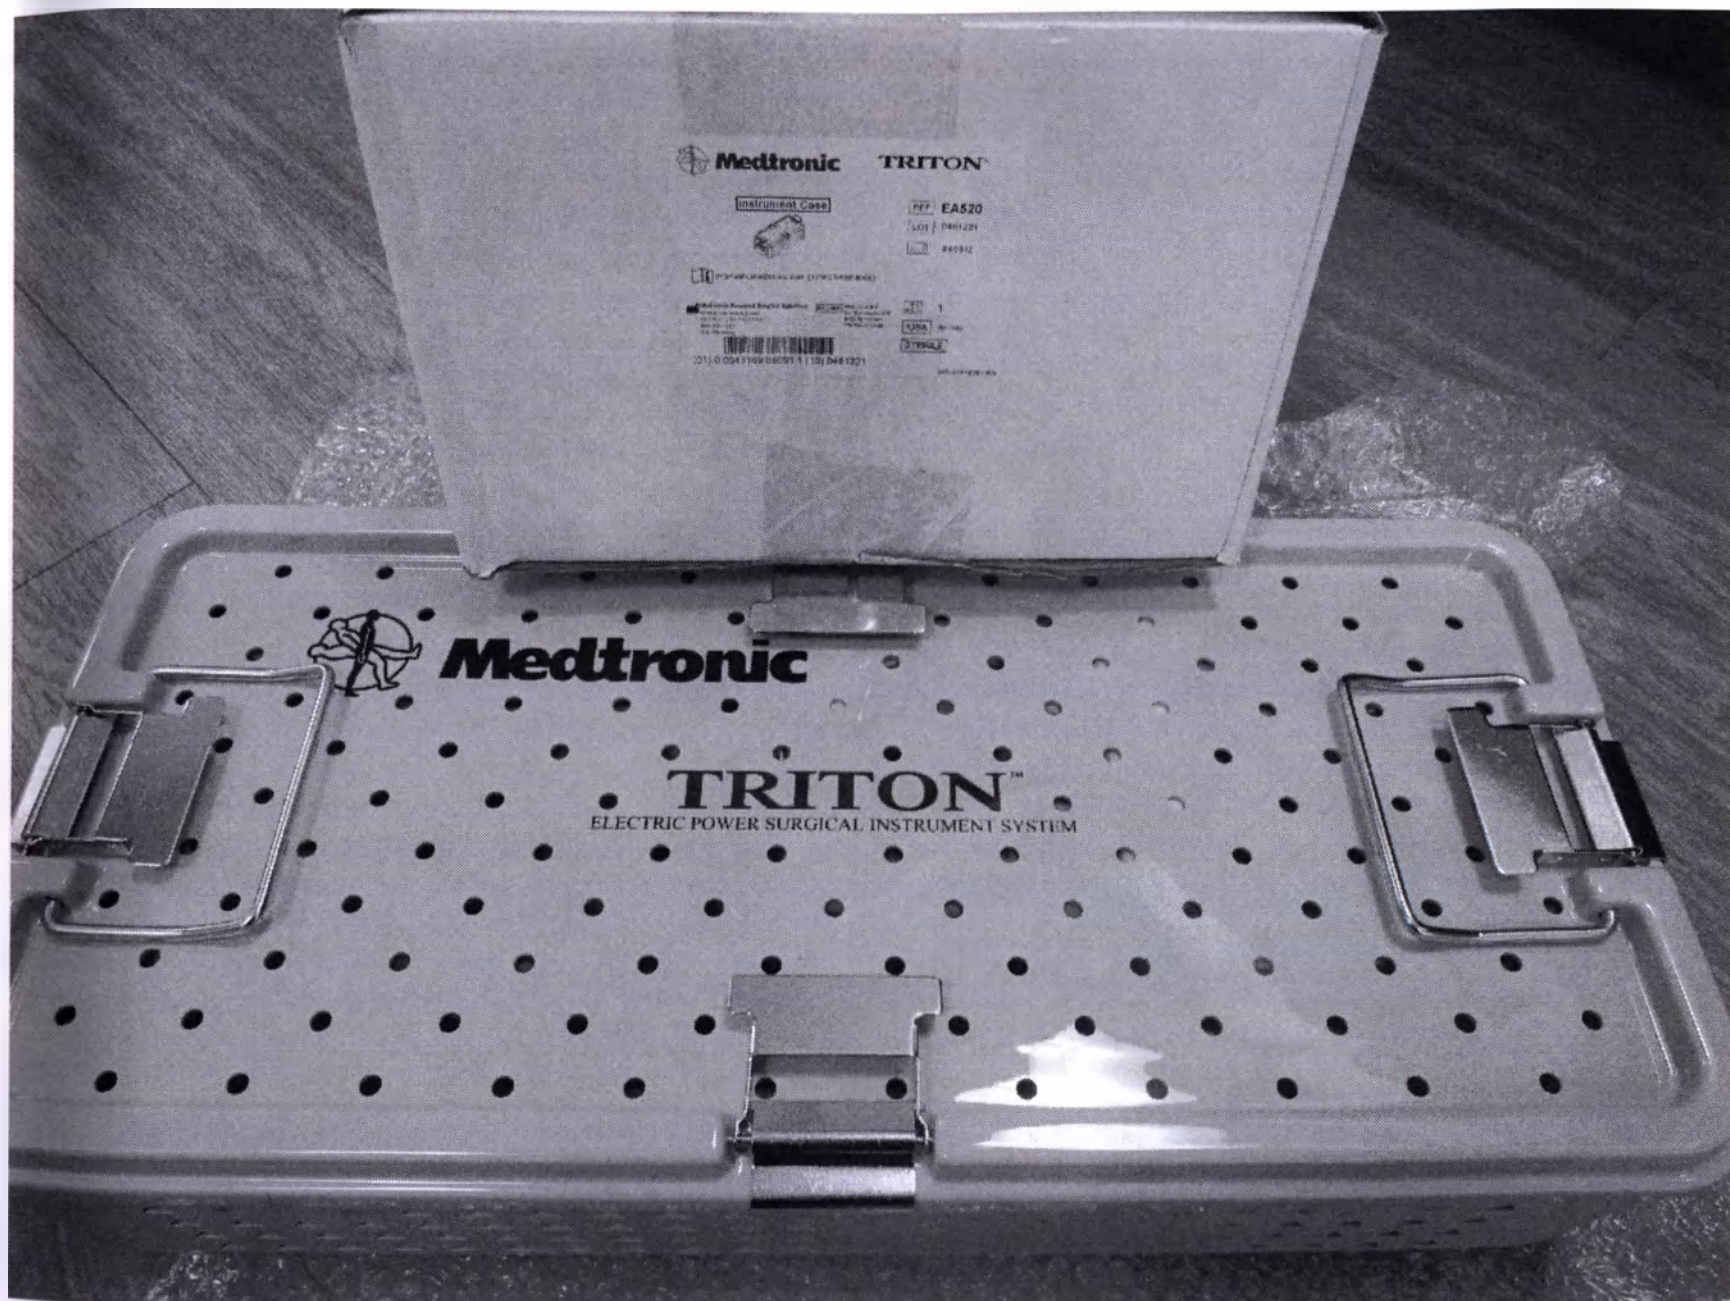


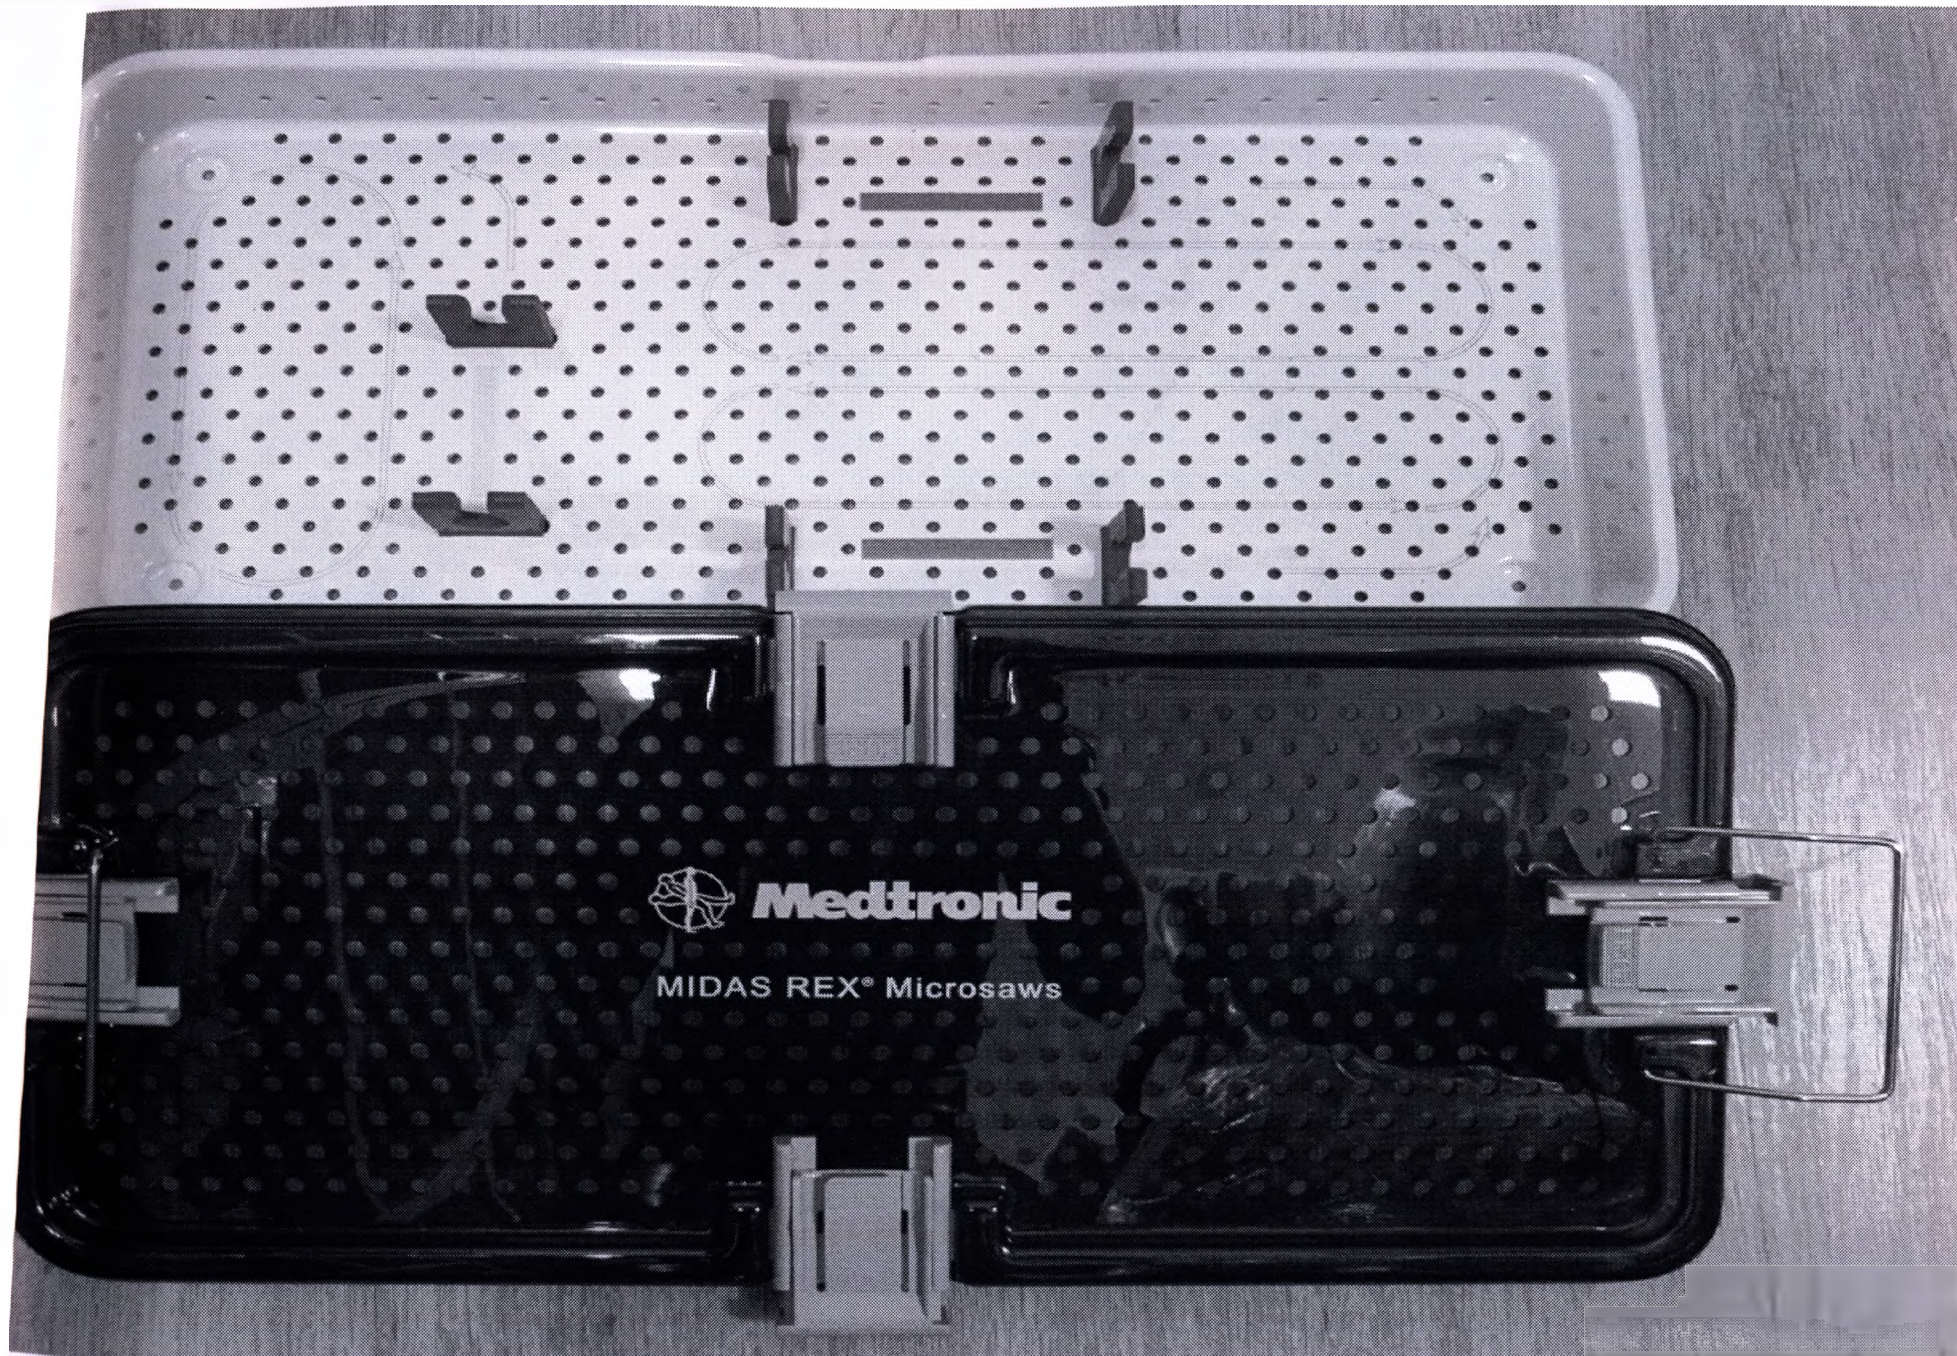


Внешний вид принадлежности - Контейнер инструментальный, модель: EA130



Внешний вид и упаковка принадлежности - Контейнер инструментальный, модель: EA130

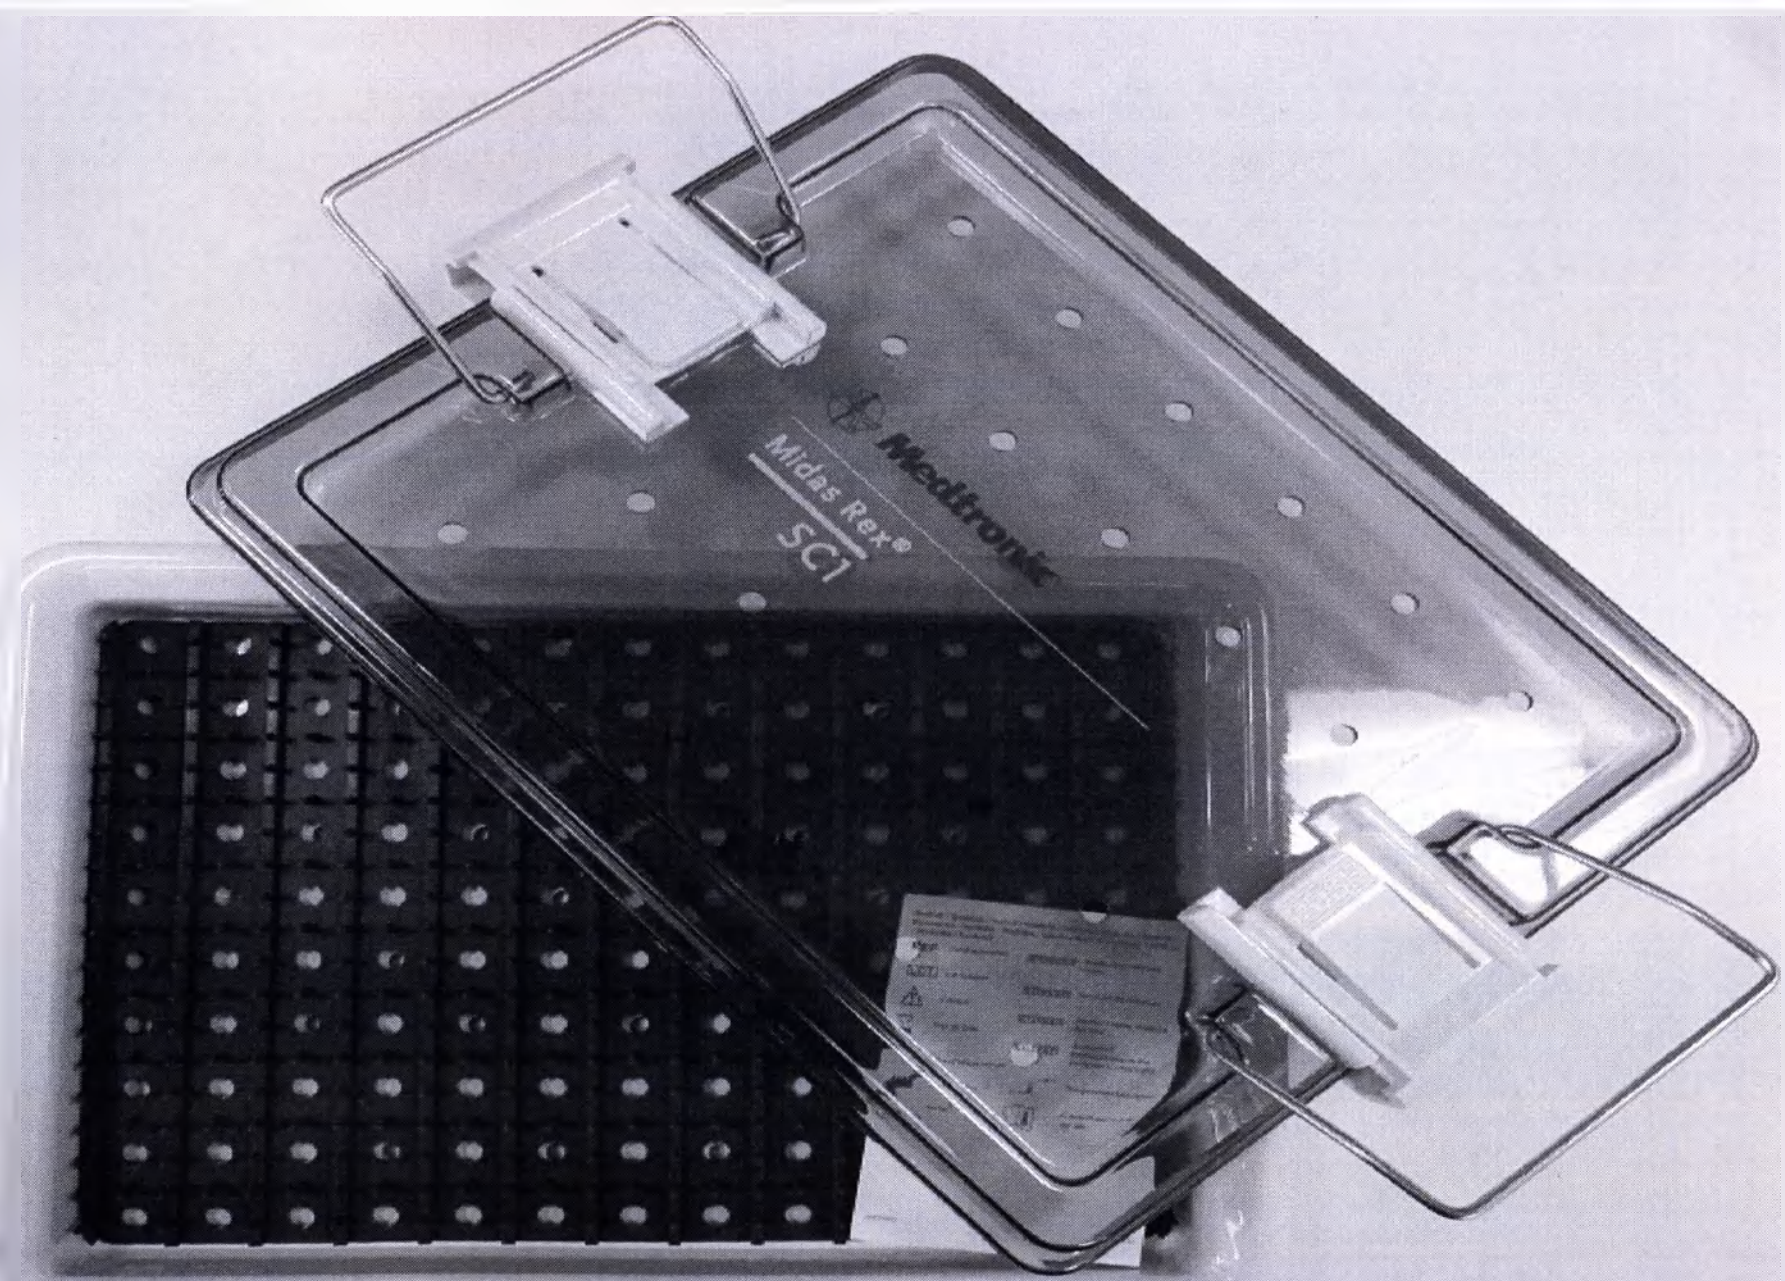

Внешний вид принадлежности - Контейнер инструментальный, модель: EDT200

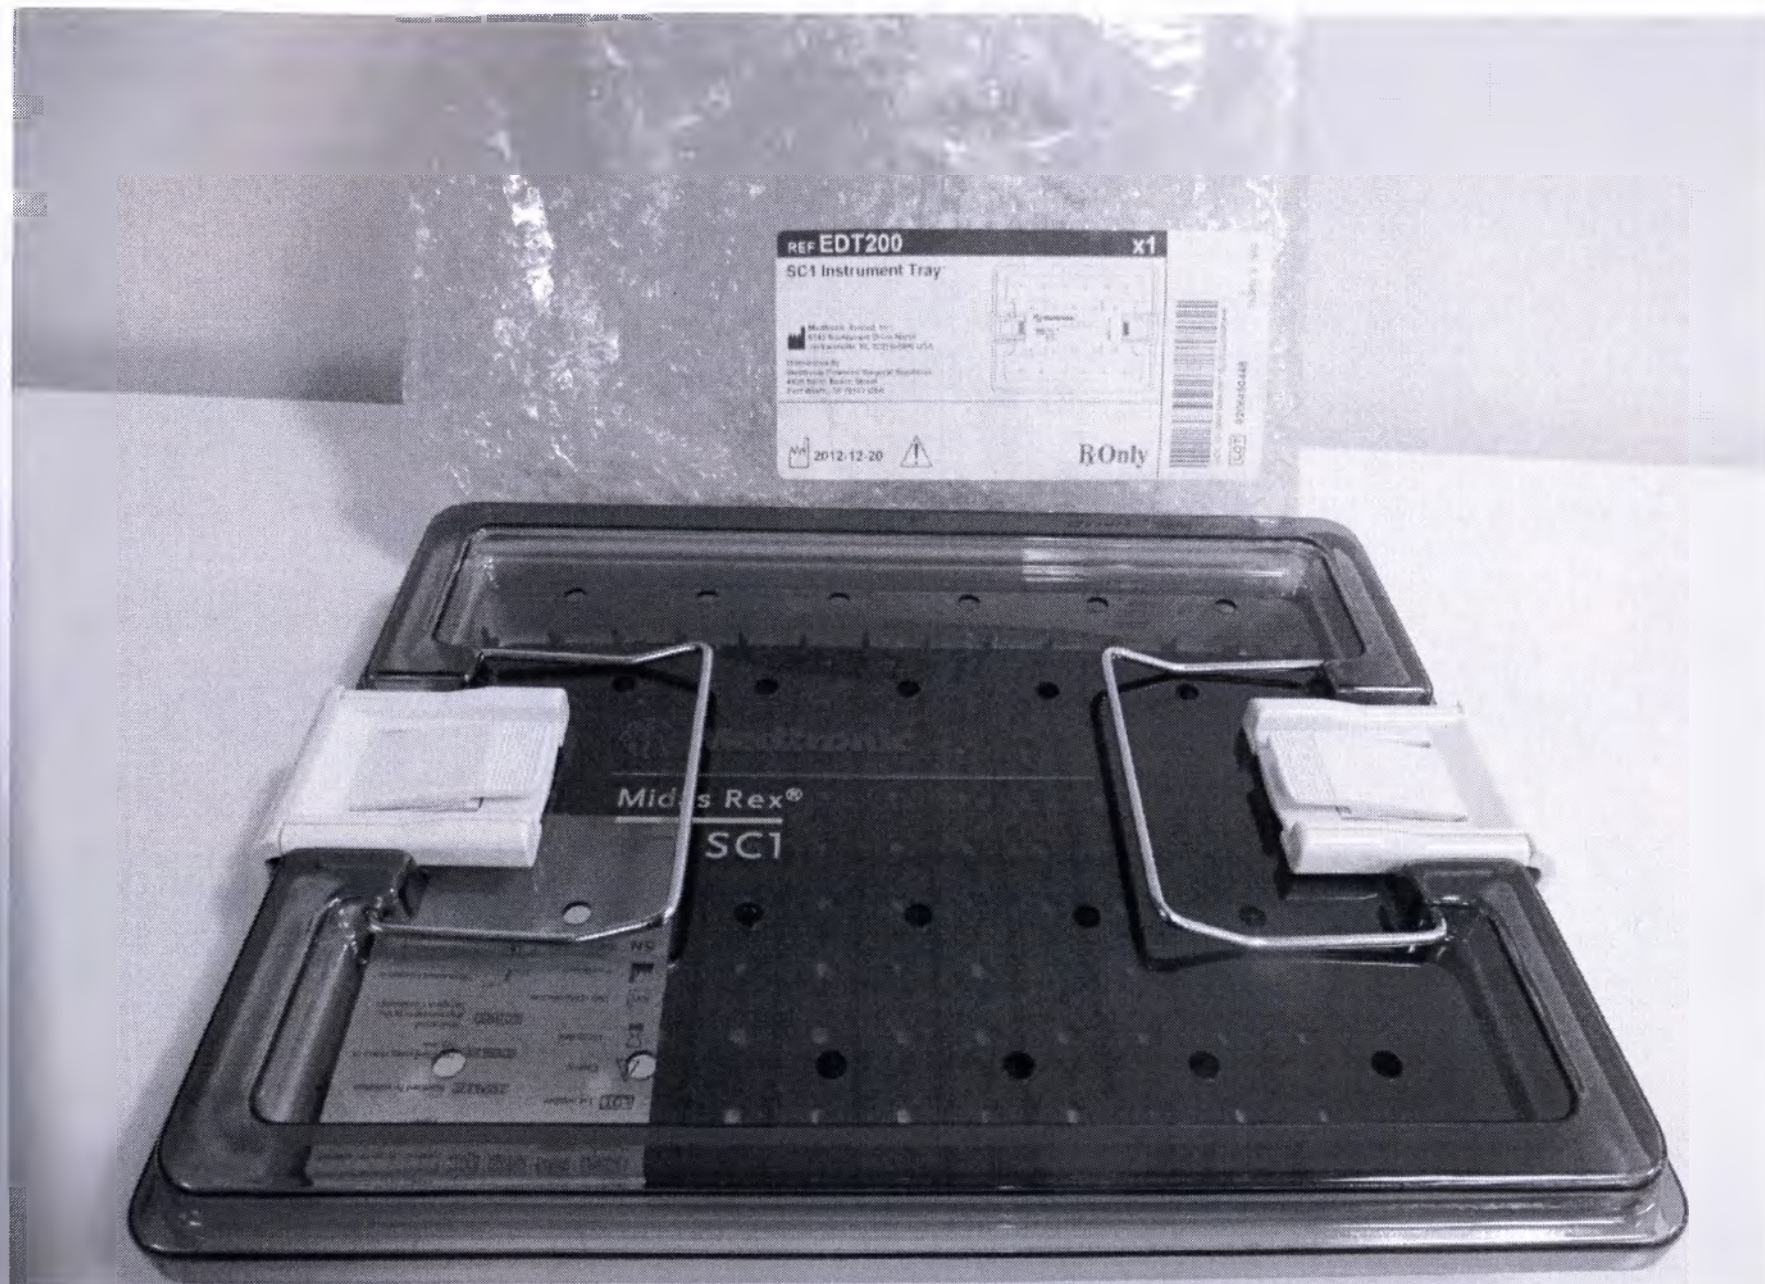

Внешний вид и упаковка принадлежности - Контейнер инструментальный, модель: EDT200



720205
0513220838
05/2013



only



LOT

Внешний вид принадлежности - Ключ фиксирующий для замены насадки Якобса, модель: 720205

korai / Acetabulá / Acetabulá /
Tábor / Tábor / Tábor /
Tábor / Tábor / Tábor /
Tábor

REF 720206

Key 1/4 HT




10/2011



1011192198

200016ML.RA

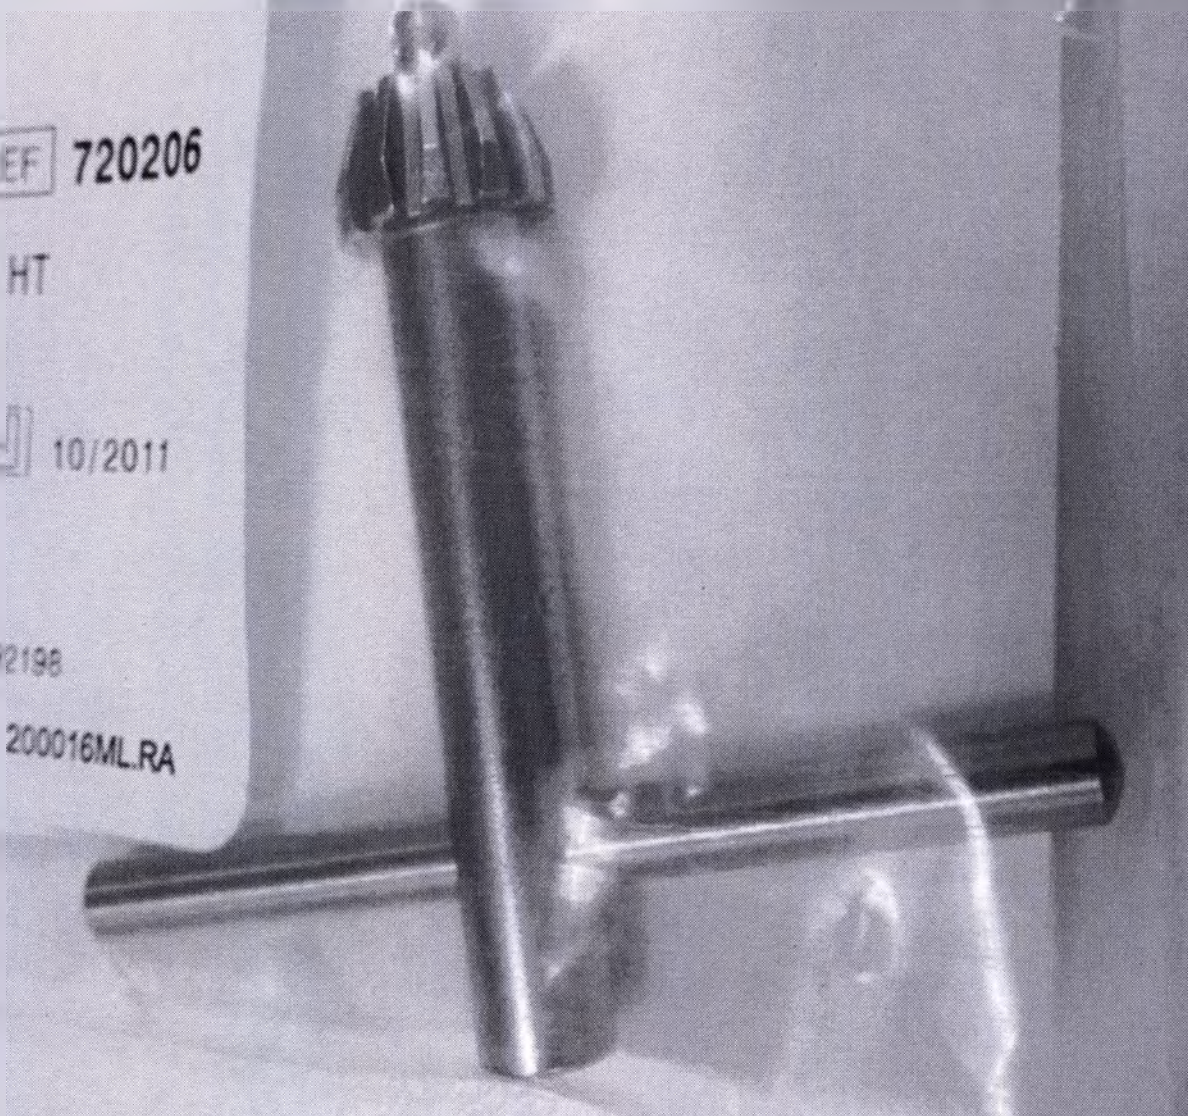

Внешний вид принадлежности - Ключ фиксирующий для замены насадки Якобса, модель: 720206




Внешний вид принадлежности - Ключ для замены лезвий саггитальных, модель 720121



Medtronic

TRITON



REF 720122

LOT 09122091

09/2012

manuals.medtronic.com (175027/68E4066/913004)

1



Medtronic Powered Surgical Solutions

4620 North Beach Street
Fort Worth, TX 76137 USA

800-433-7080

817-788-6400

EC REP


Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands

USA

STER




(01) 00673978033921 (10) 0912209131

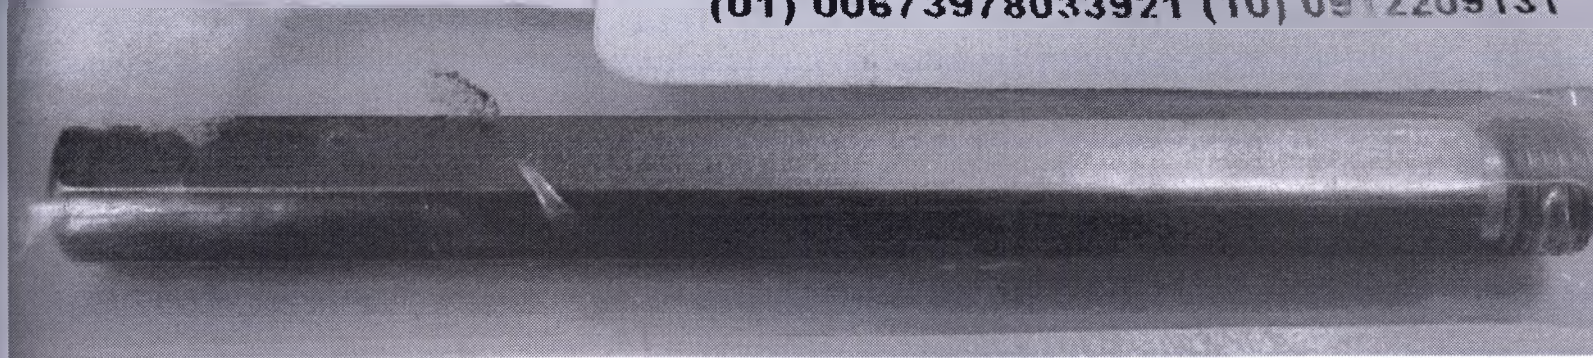

Внешний вид принадлежности - Удлинитель канюлированный для электрорукоятки TRITON с высоким крутящим моментом, модель 720122



Внешний вид принадлежности - Трубки ирригационные для микропил Midas Rex, модель: IRD410

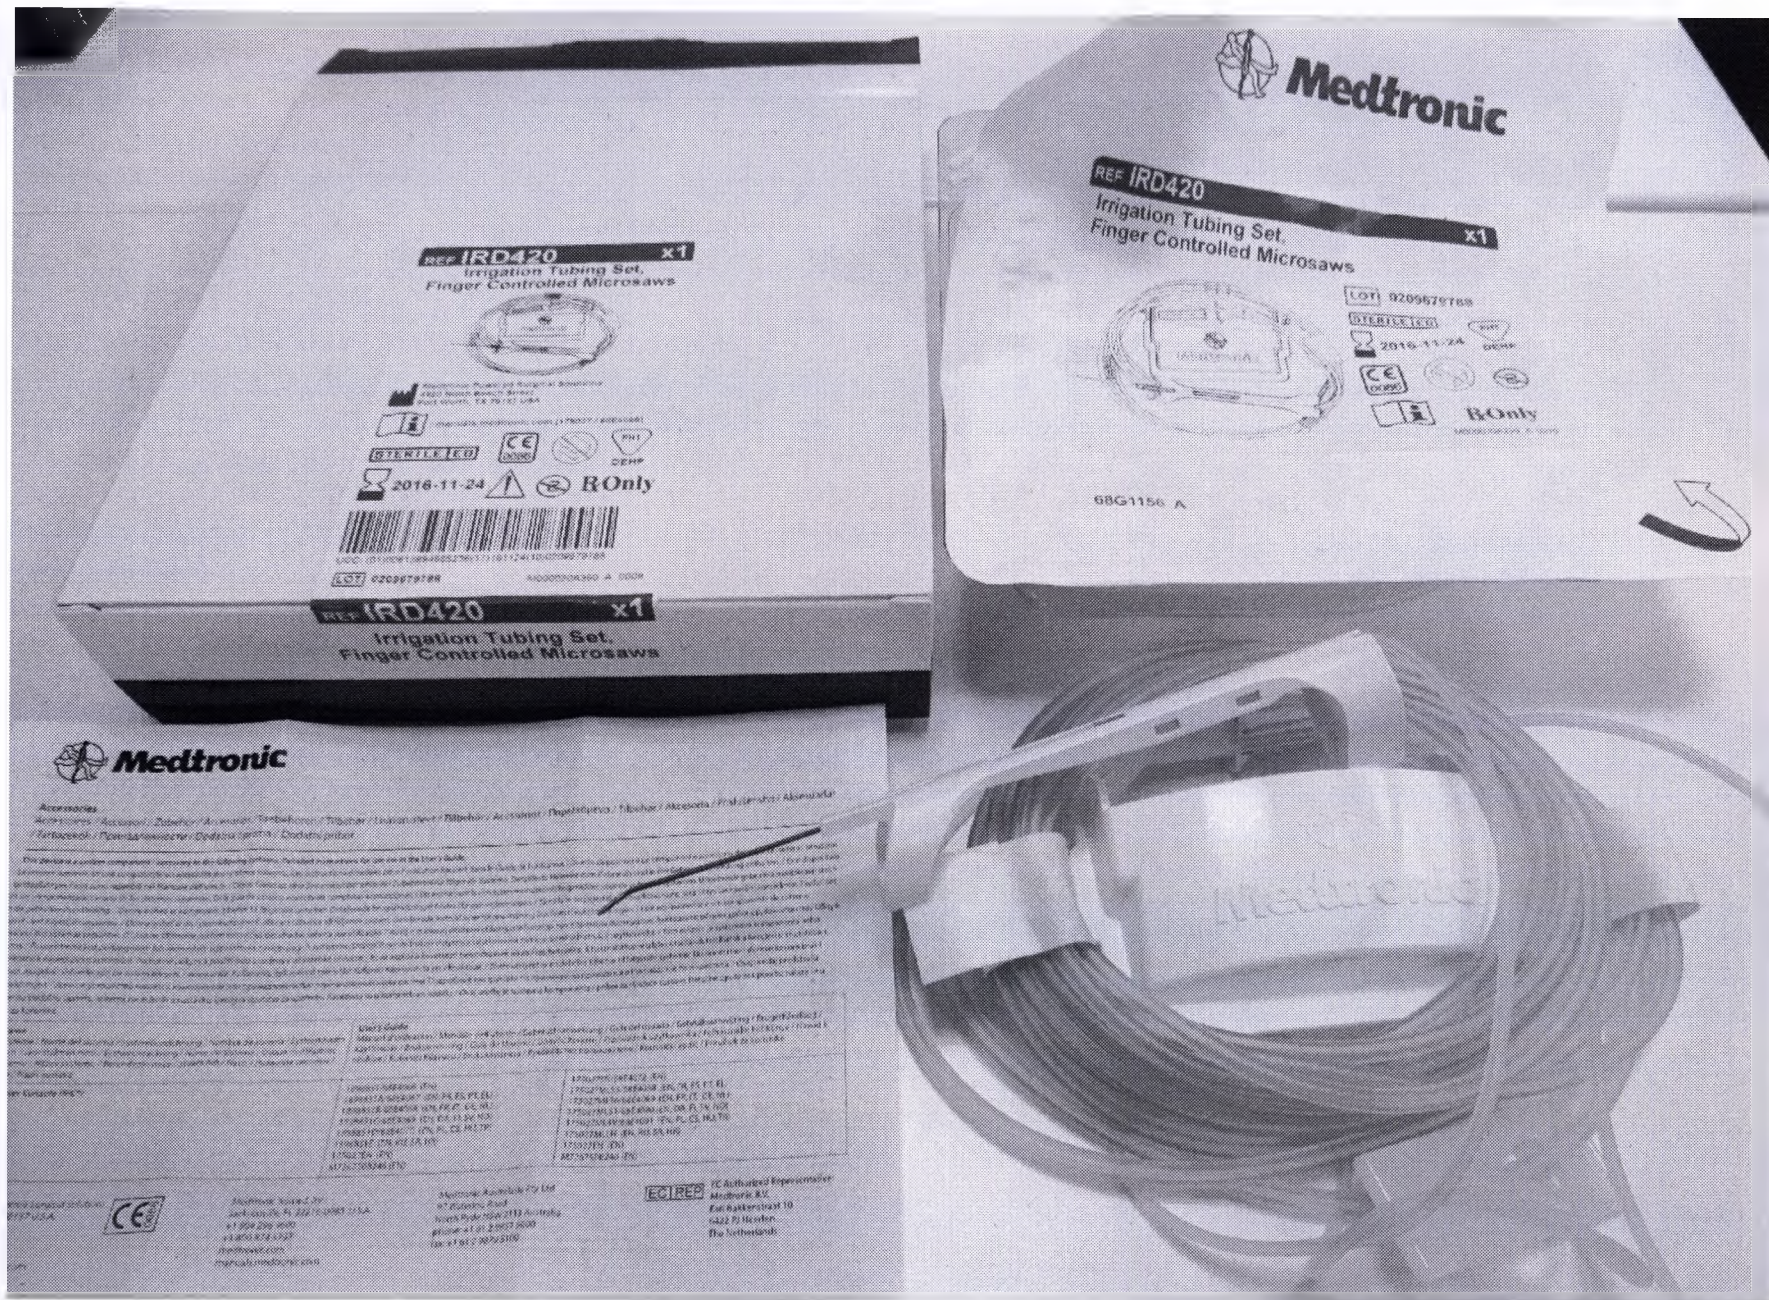

Внешний вид принадлежности - Трубки ирригационные для микропил Midas Rex, модель: IRD420

Medtronic



Adjustment Tool

Outil de réglage / Strumento di regolazione
 / Regulevskoye / Instrument de réglage
 / Regulierinstrument / Insturment de réglage
 / Strumento di regolazione / Regulierinstrument
 / Strumento di regolazione / Regulierinstrument
 / Strumento di regolazione / Regulierinstrument
 / Strumento di regolazione / Regulierinstrument
 / Strumento di regolazione / Regulierinstrument

Product Information and Instructions
 Informations et instructions concernant
 le produit / Informationen und Produkt-
 strationen per User / Produktinforma-
 tion und Gebrauchsanweisungen / Instru-
 ctions sobre el producto / Produktinfor-
 mationen / Produktanweisungen /
 Informationen da prodotto /
 Informationen da prodotto /
 Informationen da prodotto /
 o výrobku a pokyny /
 o výrobku a pokyny /
 o výrobku a pokyny /
 o výrobku a pokyny

REF 45RAD45
Adjustment Tool, 4.5 mm

x1

Instrumento de ajuste 4,5 mm / Strumento di regolazione 4,5 mm
 / Regulevskoye 4,5 mm / Instrument de réglage 4,5 mm
 / Regulierinstrument 4,5 mm / Insturment de réglage 4,5 mm
 / Strumento di regolazione 4,5 mm / Regulierinstrument 4,5 mm
 / Strumento di regolazione 4,5 mm / Regulierinstrument 4,5 mm
 / Strumento di regolazione 4,5 mm / Regulierinstrument 4,5 mm
 / Strumento di regolazione 4,5 mm / Regulierinstrument 4,5 mm

Medtronic

Medtronic
 6743 Buckhorn Drive S.
 Jacksonville, FL 32216 USA



Medtronic
 Medtronic Power-Surge Solution
 Medtronic Power-Surge Solution
 Medtronic Power-Surge Solution

3018-06 **STERILE**



LOT: 0208717222 R Only

REF 45RAD45
Adjustment Tool, 4.5 mm

x1

Instrumento de ajuste 4,5 mm / Strumento di regolazione 4,5 mm
 / Regulevskoye 4,5 mm / Instrument de réglage 4,5 mm
 / Regulierinstrument 4,5 mm / Insturment de réglage 4,5 mm
 / Strumento di regolazione 4,5 mm / Regulierinstrument 4,5 mm
 / Strumento di regolazione 4,5 mm / Regulierinstrument 4,5 mm
 / Strumento di regolazione 4,5 mm / Regulierinstrument 4,5 mm
 / Strumento di regolazione 4,5 mm / Regulierinstrument 4,5 mm

Medtronic

Medtronic
 6743 Buckhorn Drive S.
 Jacksonville, FL 32216 USA



Medtronic
 Medtronic Power-Surge Solution
 Medtronic Power-Surge Solution
 Medtronic Power-Surge Solution

3018-06 **STERILE**

LOT: 0208717222 R Only

Внешний вид принадлежности - Инструменты корректирующие Adjustment Tool, модель 45RAD45

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Медтроник»

26 листа(ов)

