

Основной Блок 3D OCT-1




Кабель питания



LAN кабель




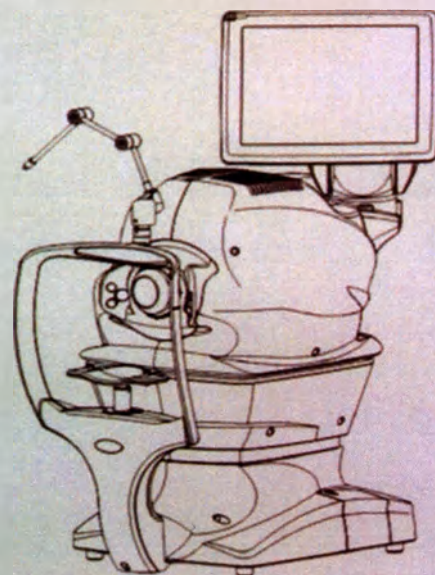


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (для прибора)
Офтальмологический трехмерный
оптический когерентный томограф 3D OCT

3D OCT-1

Салфетки для упора подбородка, 500 шт. в 1 уп.

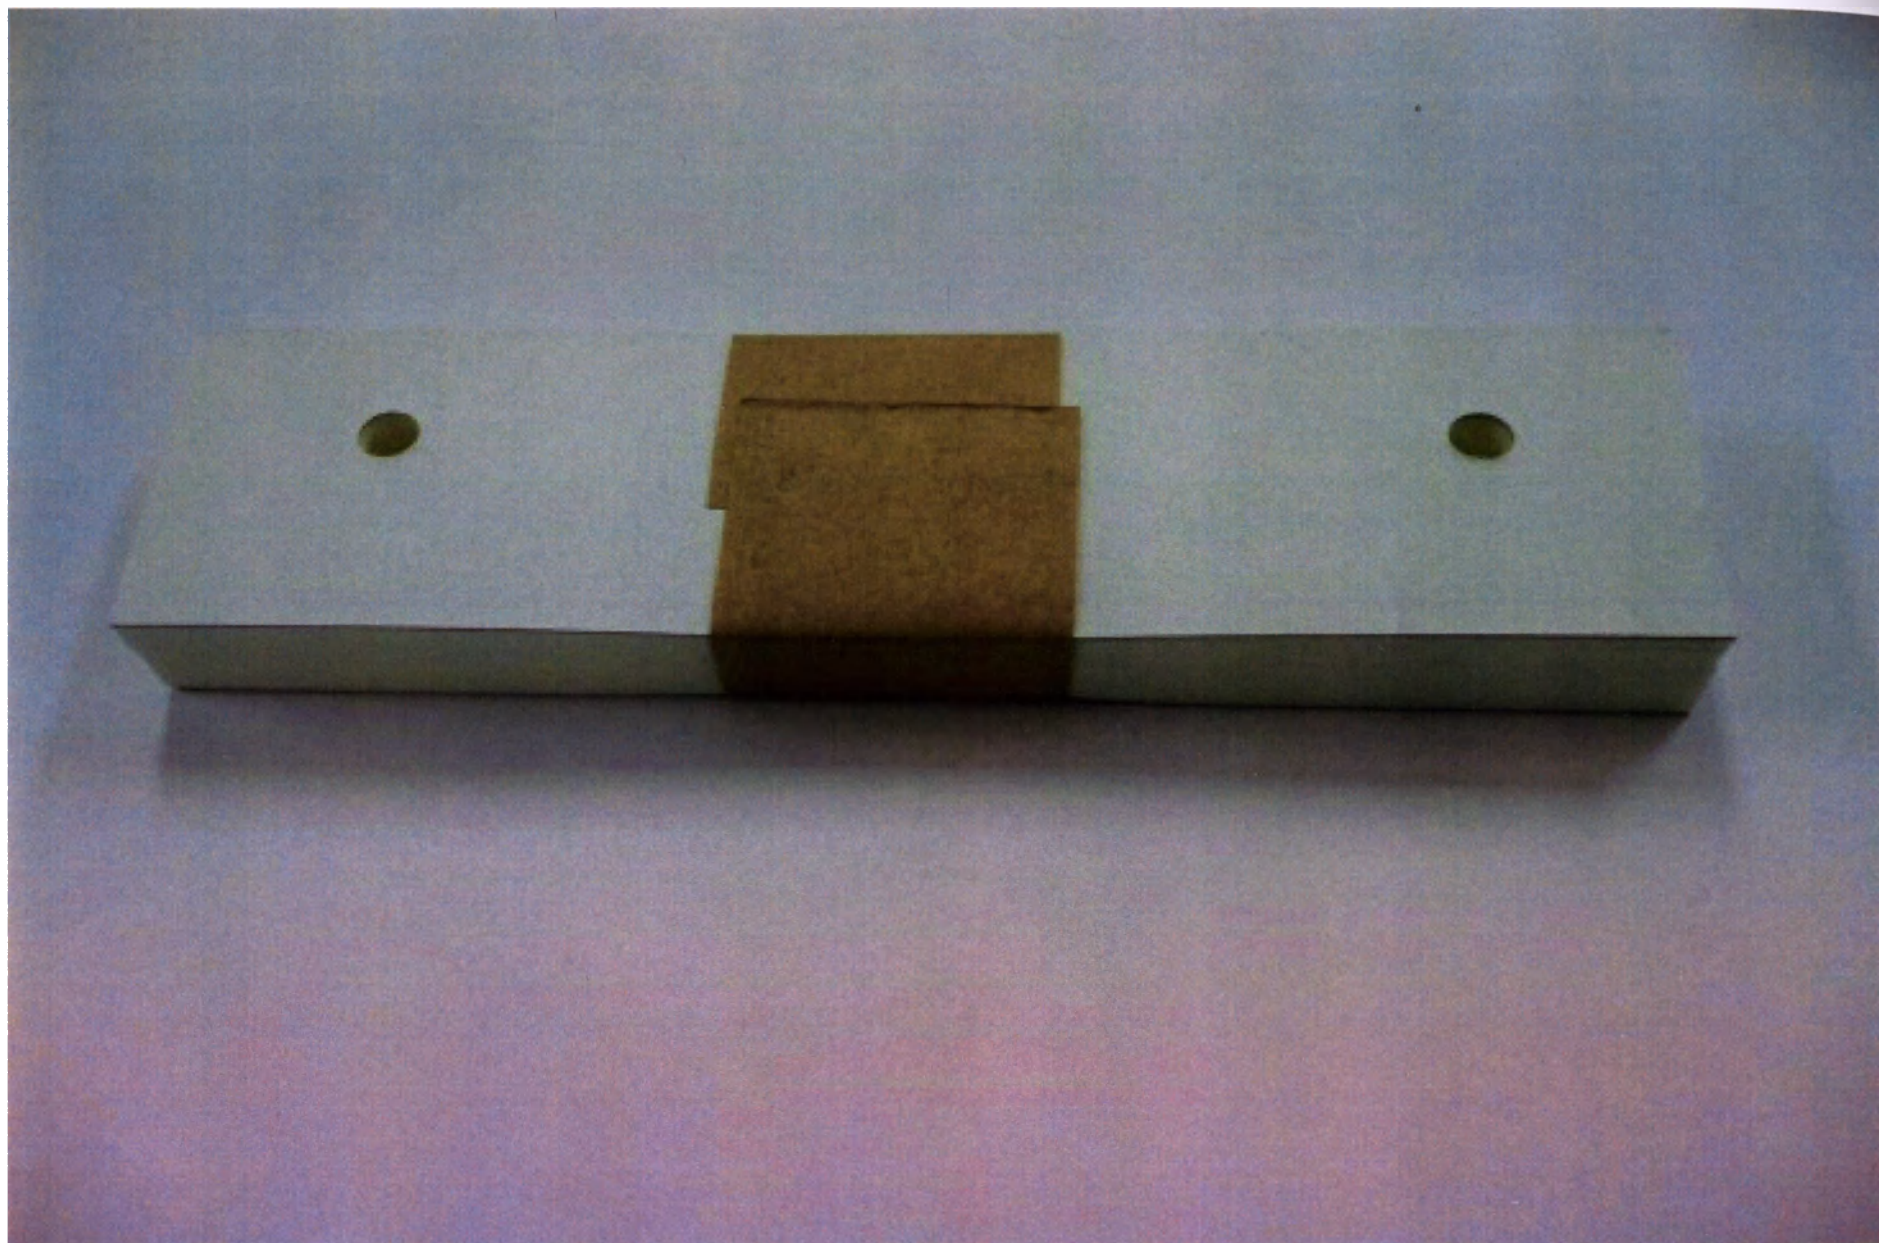


Пластиковые держатели салфеток для упора подбородка

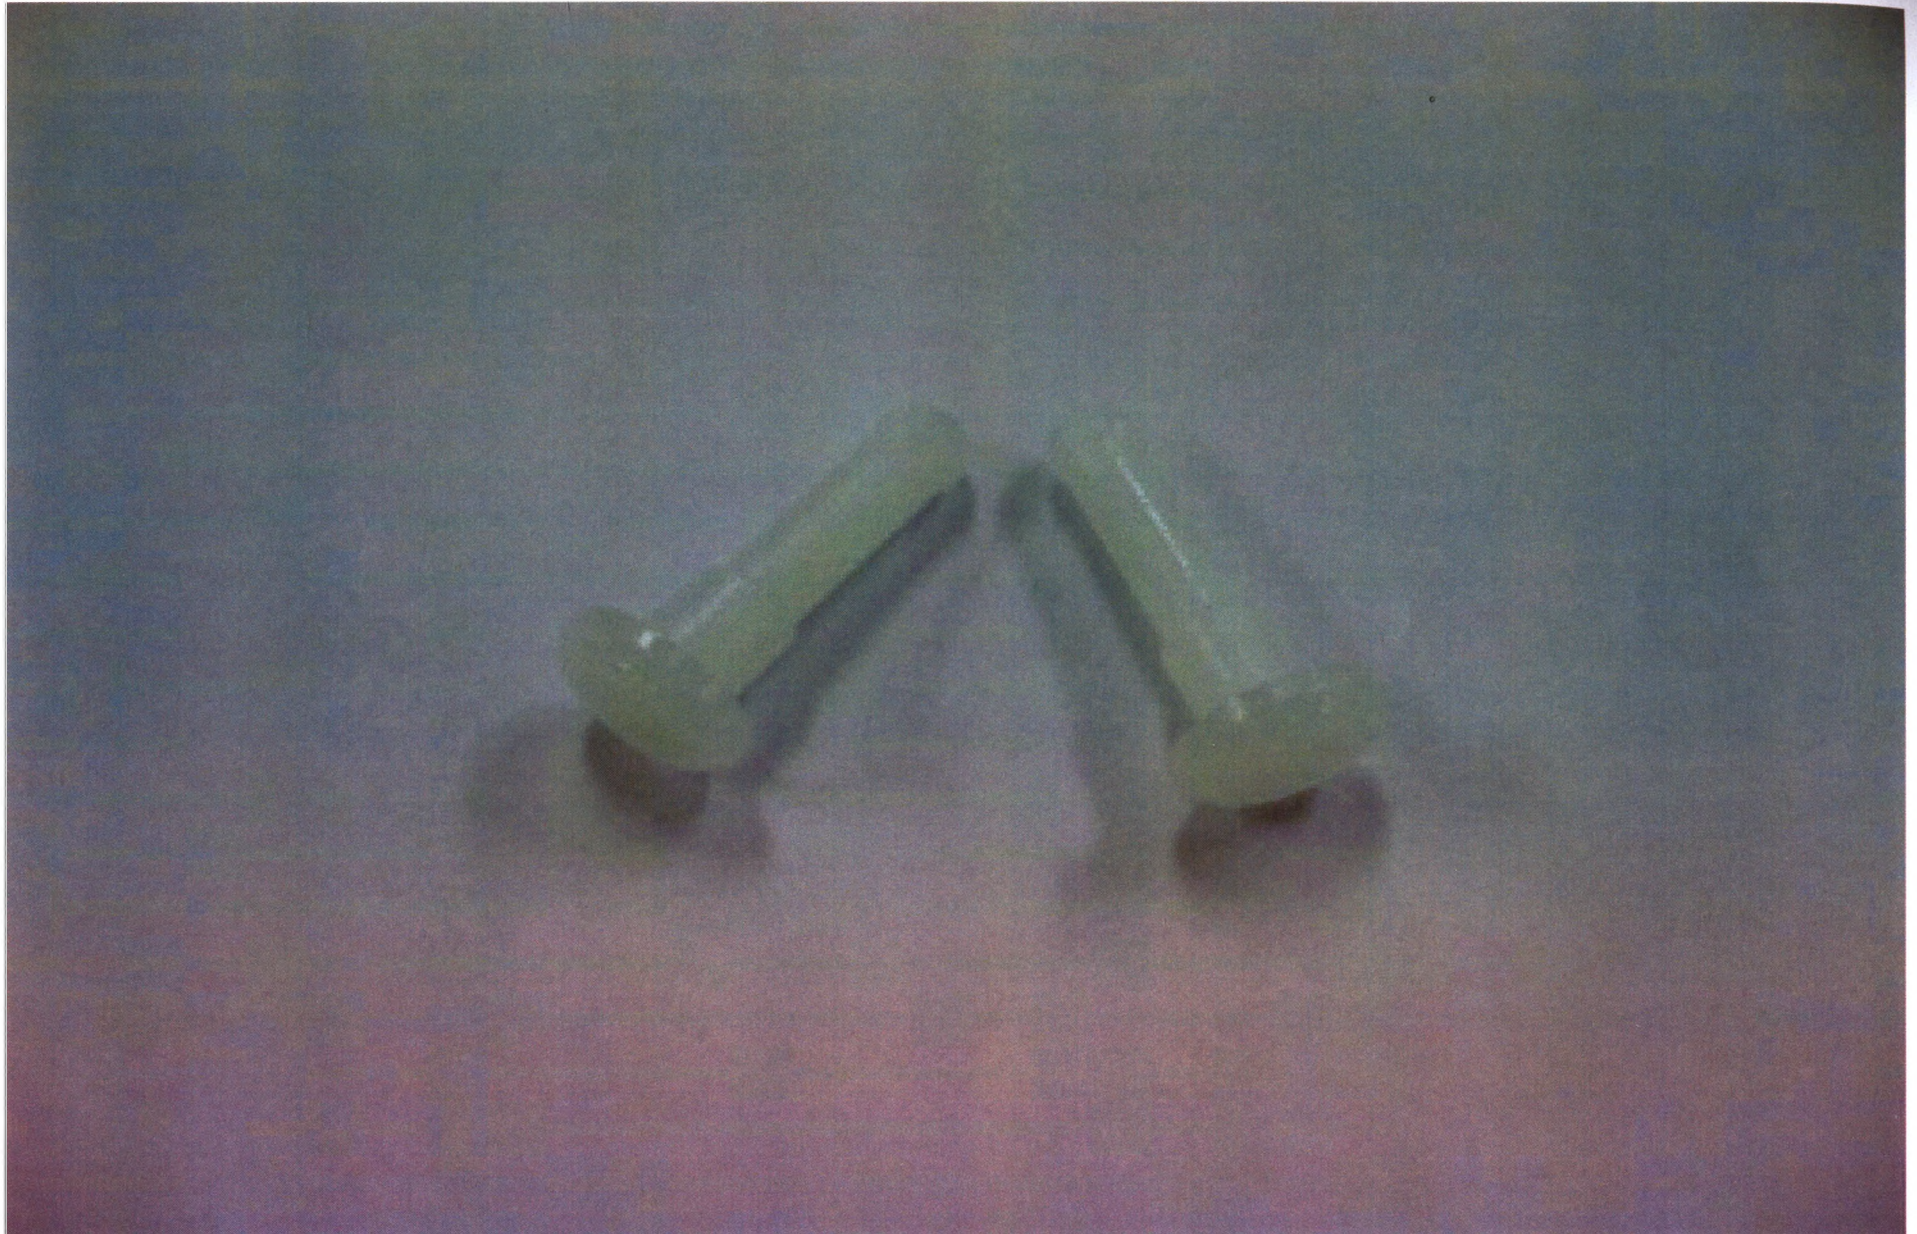

Стилус для сенсорного монитора



Насадка на упор для лба

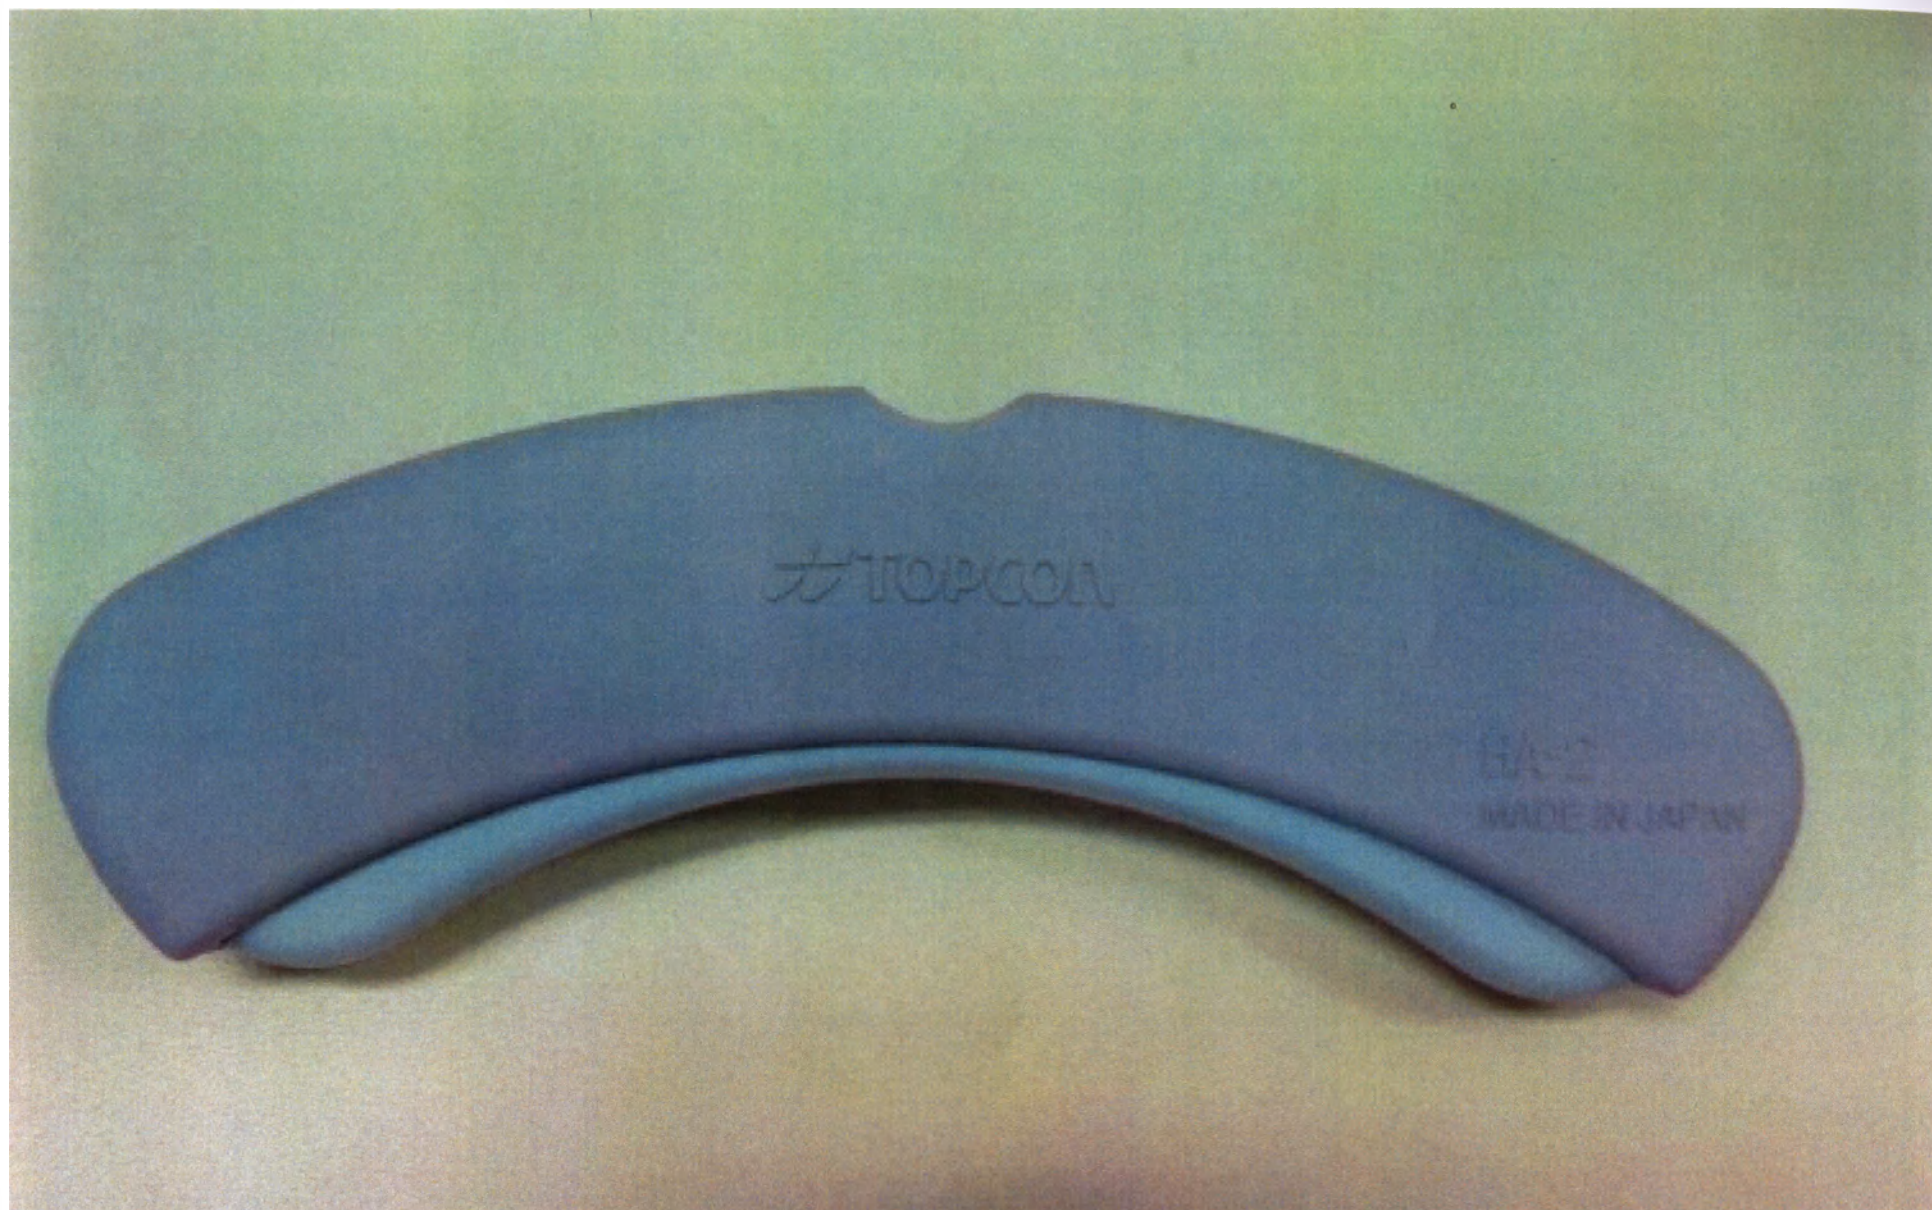

Метка внешняя фиксационная




Кейс для принадлежностей



Чехол противопыльный



Салфетка для протирки оптики

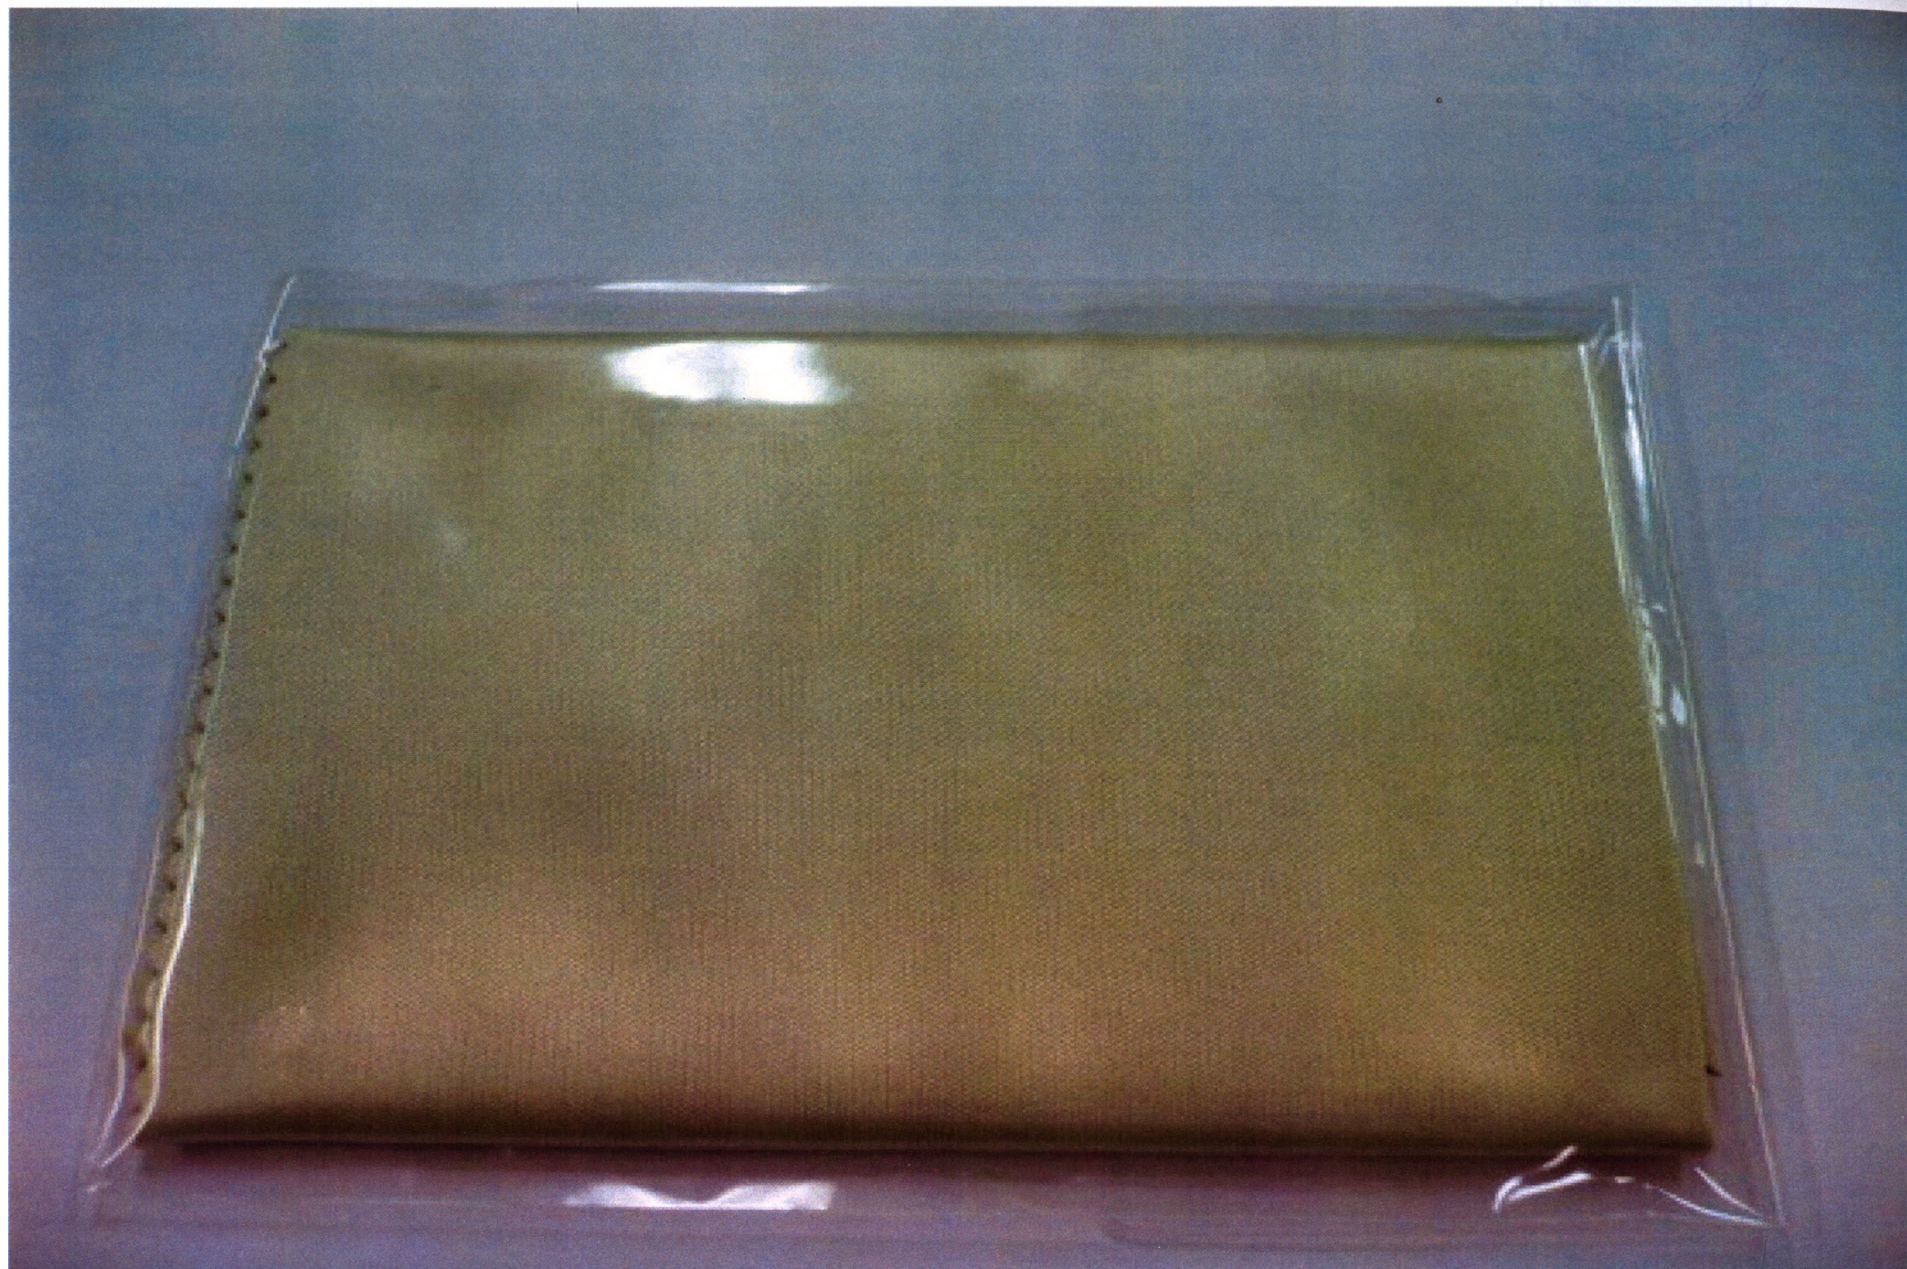

Принято
принято
12 (декабрь)
мск





Маркировка салфеток для упора подбородка



Макет маркировки на медицинское изделие
«Офтальмологический трехмерный оптический когерентный томограф 3D OCT-1 с
принадлежностями»



TOPCON

Офтальмологический трехмерный оптический
когерентный томограф 3D OCT-1

НАПРЯЖЕНИЕ 100-240 В
МОЩНОСТЬ 70-150 ВА
ЧАСТОТА 50-60 Гц

МАКС. ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 650 мВт
ДЛИНА ВОЛНЫ 840 нм
КЛАСС ЛАЗЕРА 3В



523005



Topcon Corporation, 75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku,
Tokyo, 174-8580, Japan (Топкон Корпорейшн, 75-1,
Хасунума-гё, Итабаси-ку, Токио, 174-8580, Япония);

Примечание
примечание
3(1/4) листа

