










тав:
Визуализационная консоль: головка блока визуализации.


5



1. Визуализационная консоль: дуга артикуляционная

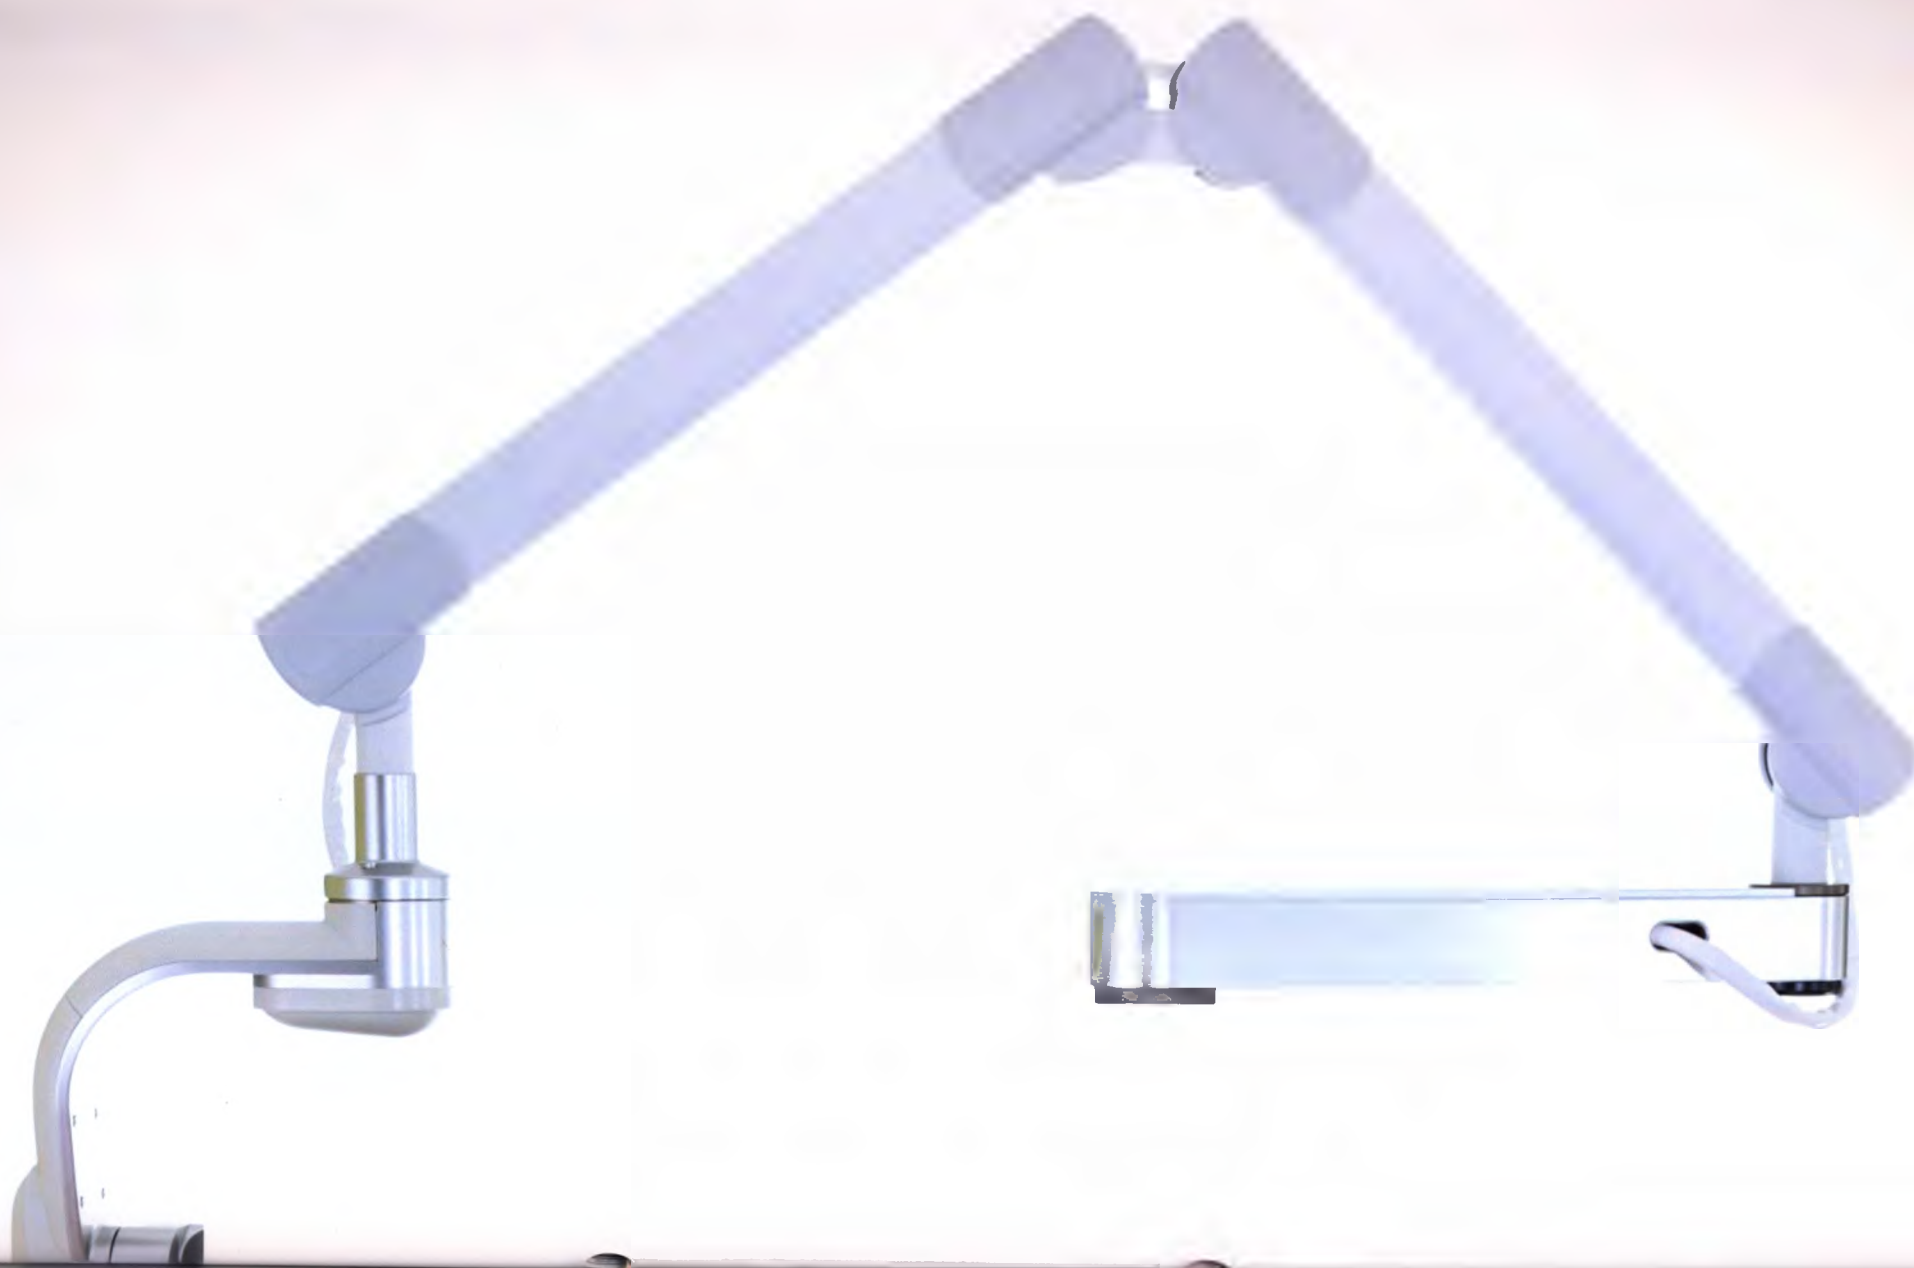

визуализационная консоль: модуль оператора клавиатурный

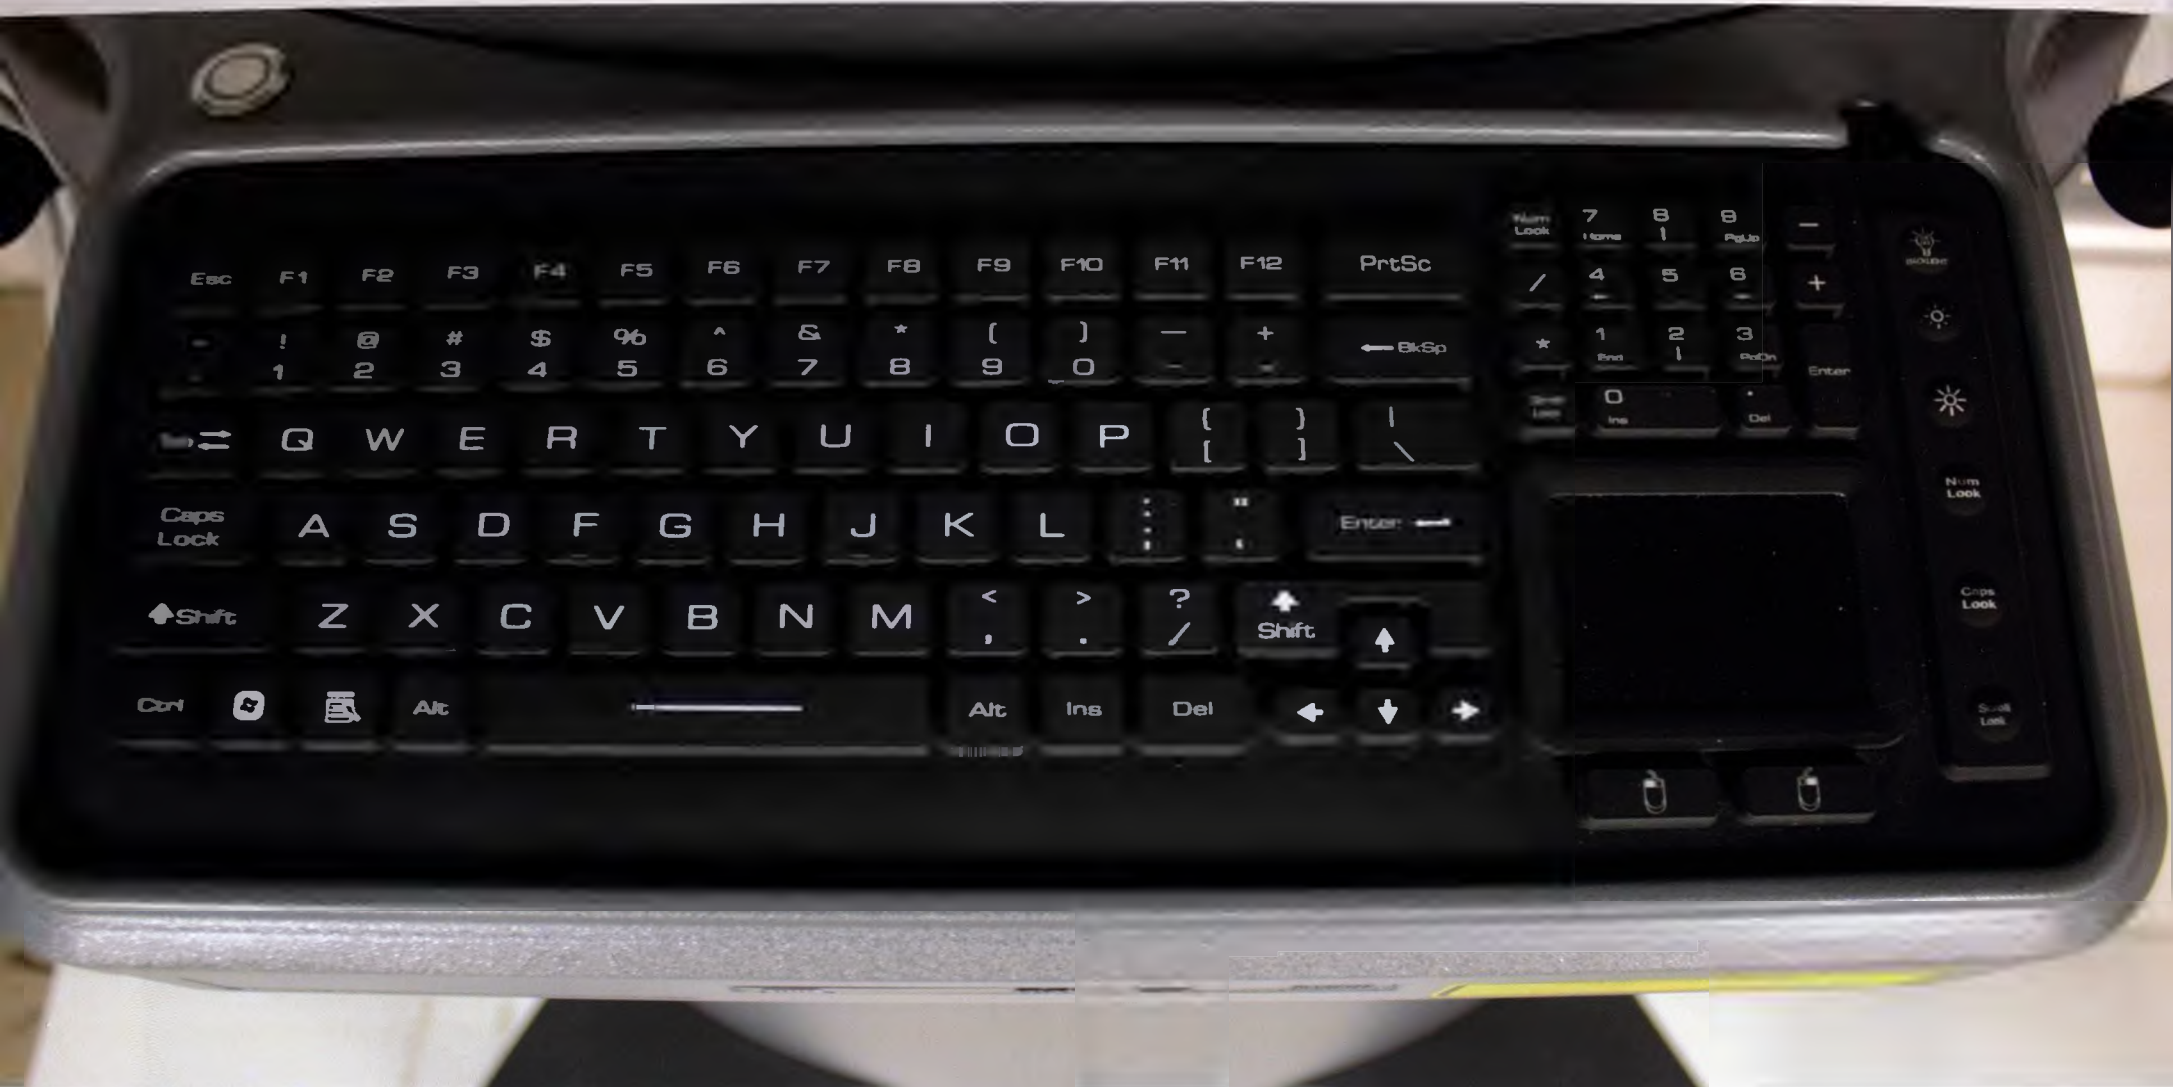

1. Визуализационная консоль: ЖК-дисплей оператора сенсорный для ввода информации



1. Визуализационная консоль: ЖК-дисплей для просмотра и анализа клинических данных





программное обеспечение CINEVAQ для обеспечения функционирования системы.




программное обеспечения SPY-Q для анализа и хранения полученных данных.



кабель сетевой.

13

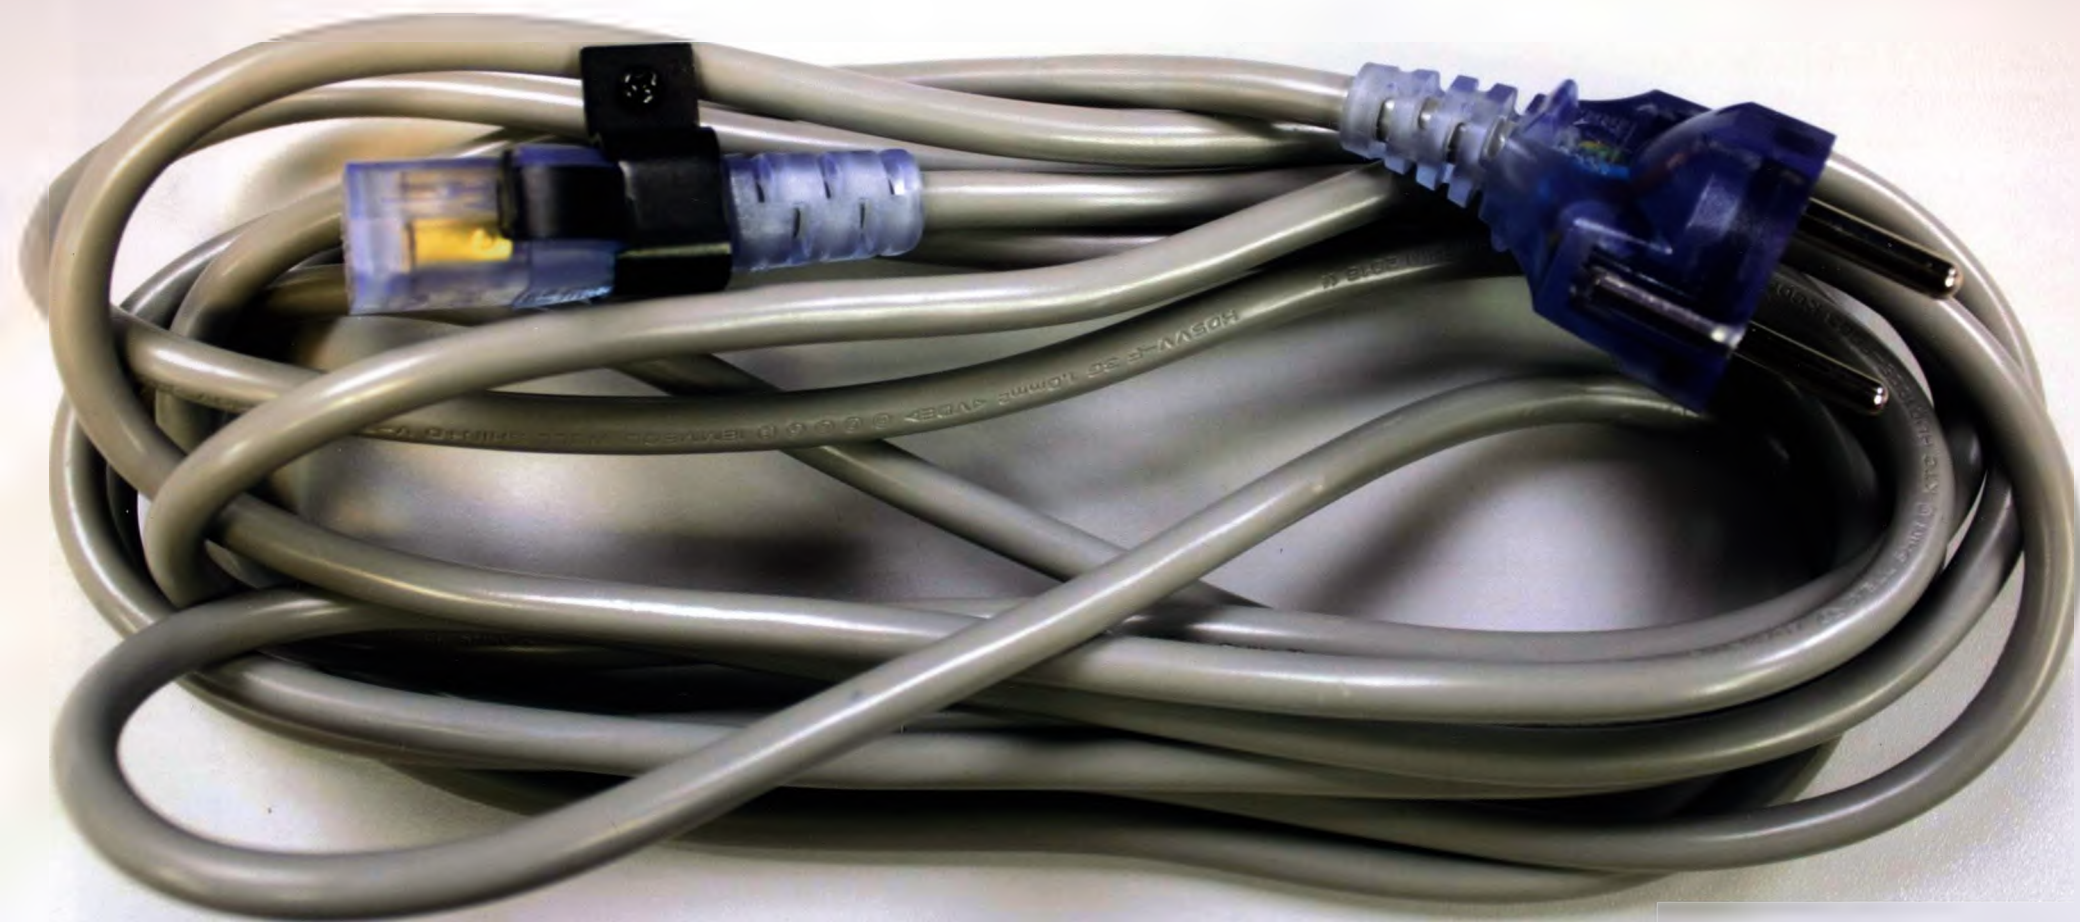

NOVADAQ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМА ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ SPY
SP3055

CE
0120

СТРАНА
РЕВ. А, 2016
Документ 013-50001-XXX

адлежности:

стерильный NOVADRAPE 8000, тип упаковки ND 8000.




стерильный NOVADRAPE 8000, тип упаковки ND 8010.



STERILE

ПРОШТО. ПРОНУМЕРОВАНО.

СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
14 ЛИСТОВ

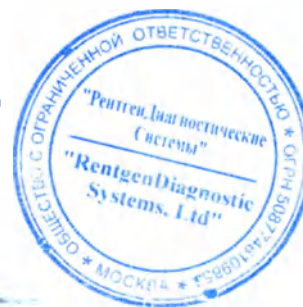

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Г.И. КОВАЛЕВА

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ковалева".