

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «ДЕТА Инжиниринг»

Загуменов Е.С.

«01» марта 2017 г.



Фотографии медицинского изделия:

**«Комплекс низкотемпературного хранения на базе холодильной машины
воздушного цикла (Комплекс ДЕТА-БИО) с принадлежностями**

по ТУ 9452-002-46786098-2016 г»,

производства ООО «ДЕТА Инжиниринг»

Список фотографий

на медицинское изделие: «Комплекс низкотемпературного хранения на базе холодильной машины воздушного цикла (Комплекс ДЕТА-БИО) с принадлежностями по ТУ 9452-002-46786098-2016 г», производства ООО «ДЕТА Инжиниринг»:

1. Машина холодильная воздушная ВХМ-20-07.
2. Влагоотделитель.
3. Шкаф силового тока и управления.
4. Камера теплоизолированная.
5. Воздуховод, диаметр 200 мм.
6. Клапан запорный, диаметр проходного сечения 200 мм.
7. Клапан регулирующий, диаметр проходного сечения 200 мм.
8. Комплект монтажный.
9. Дизель-генератор, мощность 70 кВт.
10. Стеллаж для хранения.
11. Система роботизированная адресного хранения.
12. Отделение скоростного домораживания.



Рис. 1 - Машина холодильная воздушная ВХМ-20-07

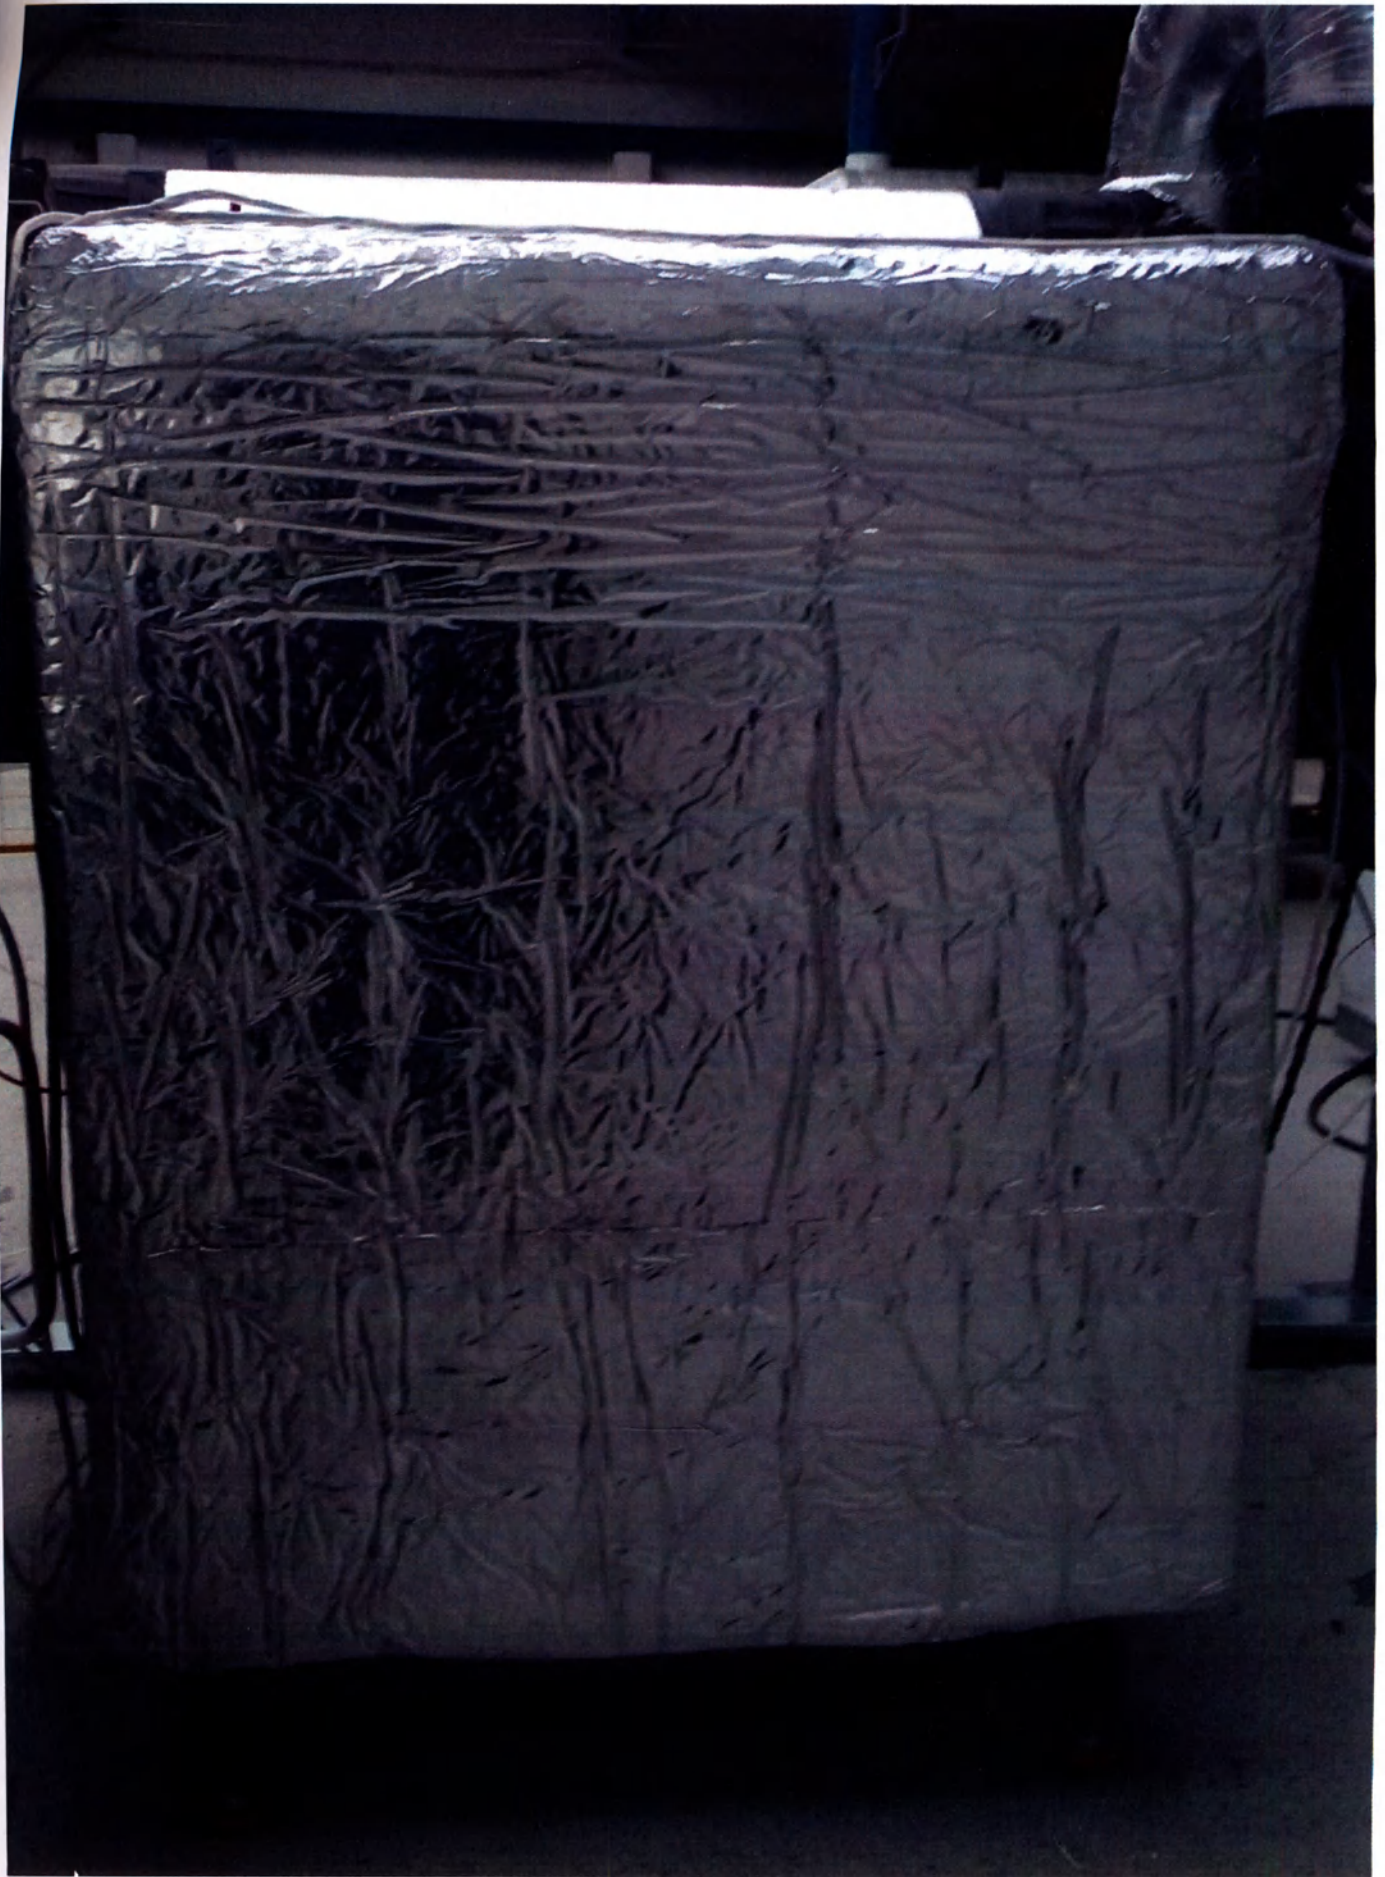


Рис. 2 - Влагоотделитель



Рис. 3 - Шкаф силового тока и управления, в составе:



Рис. 4 - Камера теплоизолированная

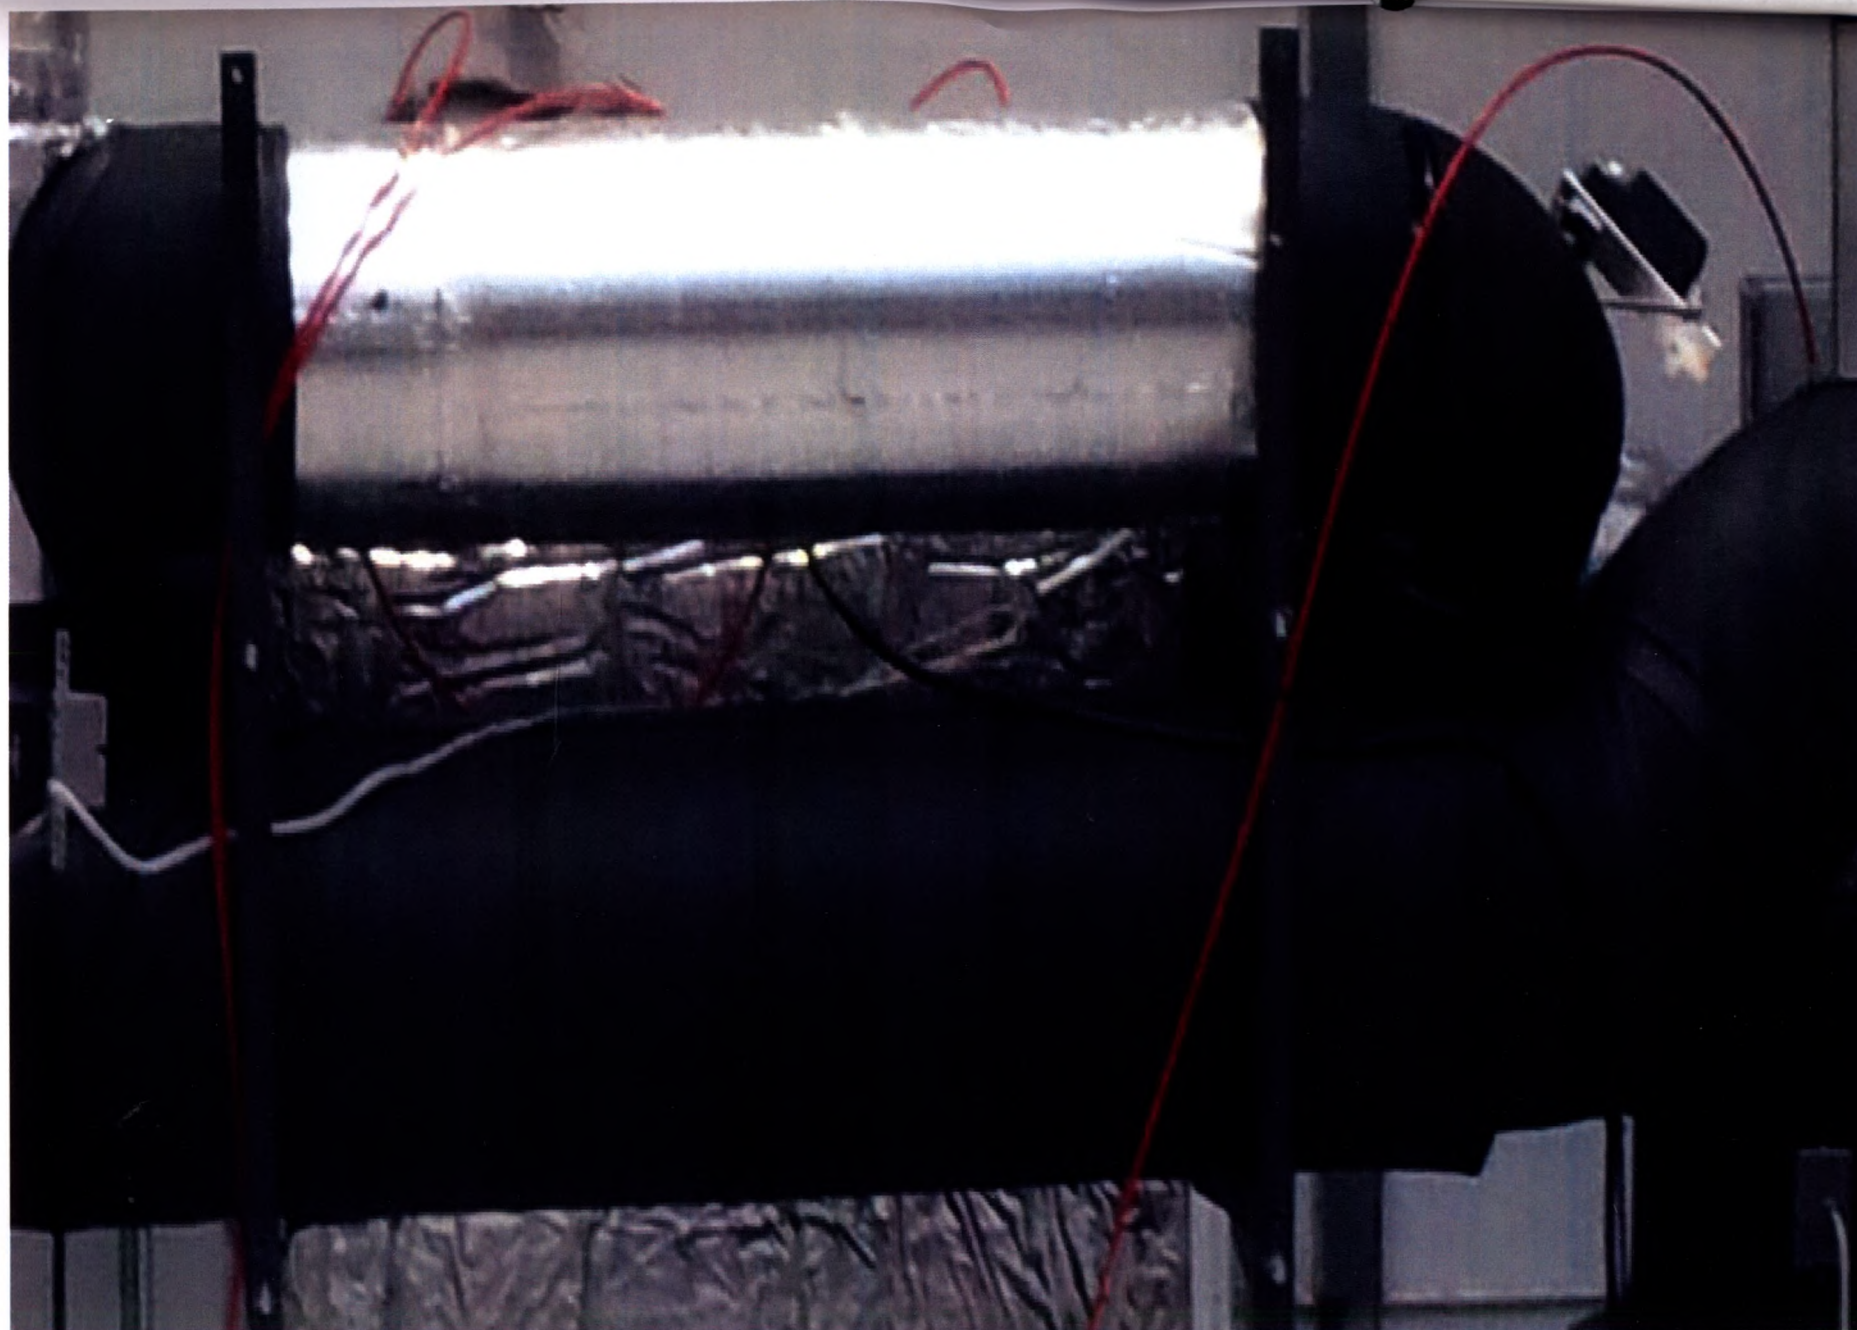


Рис. 5 – Воздуховод. диаметр 240 мм.



Рис. 6 - Клапан запорный, диаметр проходного сечения 240 мм

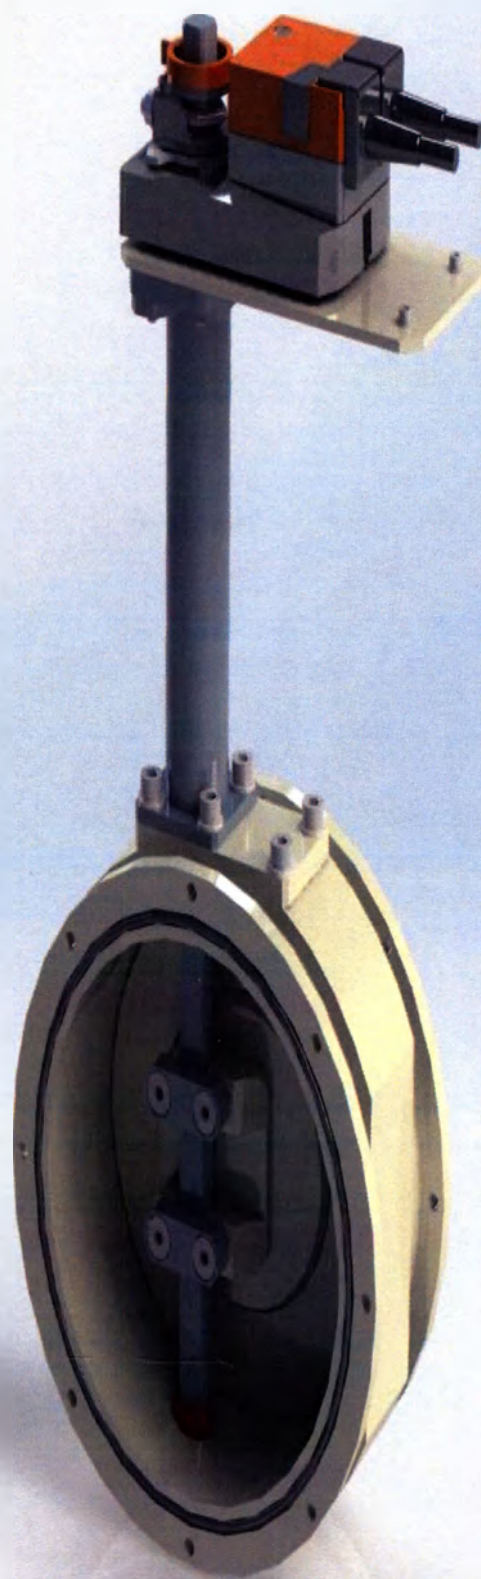


Рис. 7 - Клапан регулировочный диаметр проходного сечения 240 мм



Рис. 8 - Комплект монтажный

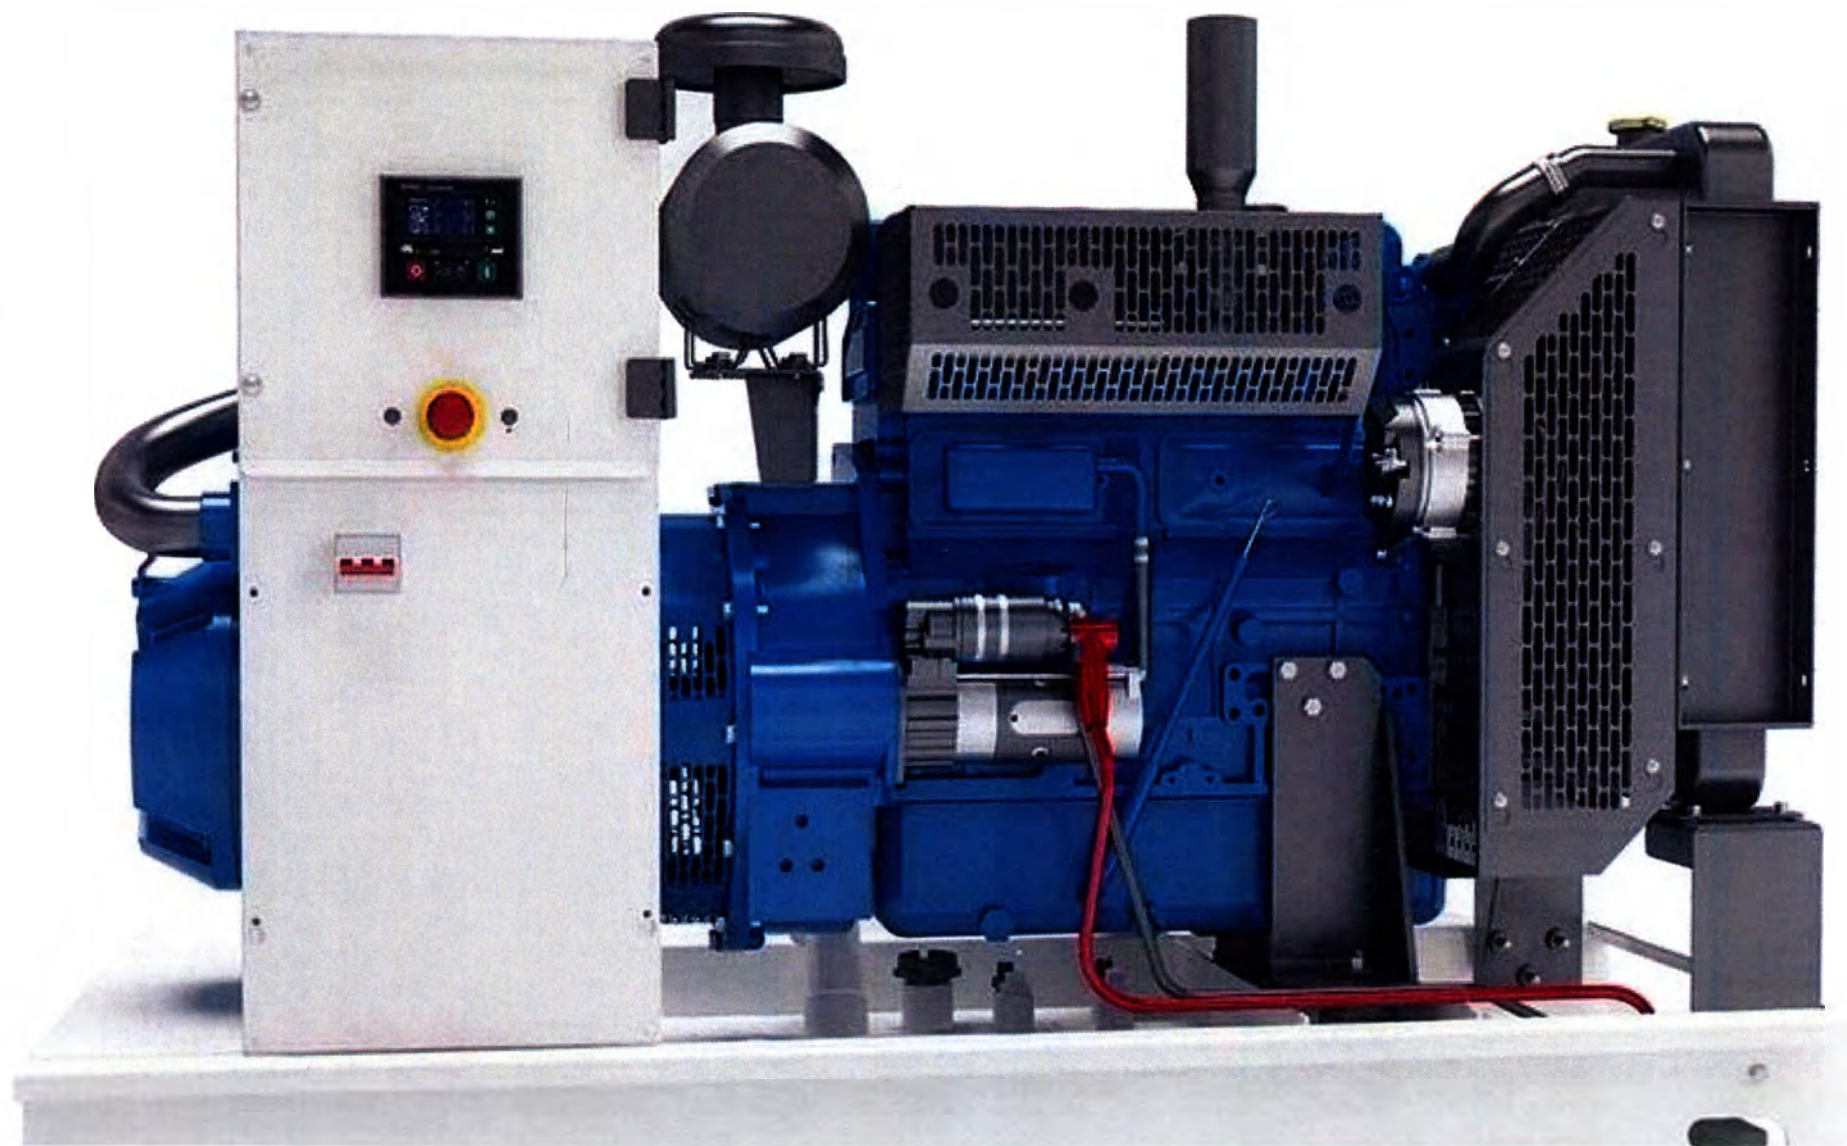


Рис. 9 - Дизель генератор, мощностью 70 кВт.



Рис. 10 Стеллаж для хранения



Рис. 11 – Система роботизированная адресного хранения.



Рис. 12 - Отделение скоростного домораживания

Генеральный директор
ООО «ДЕТА Инжиниринг»

/ Загуменов Е.С.

