



Фотографическое изображение медицинского изделия:
 Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации «ФлоуФикс ДУО» со вспомогательными материалами и принадлежностями Универсальный набор

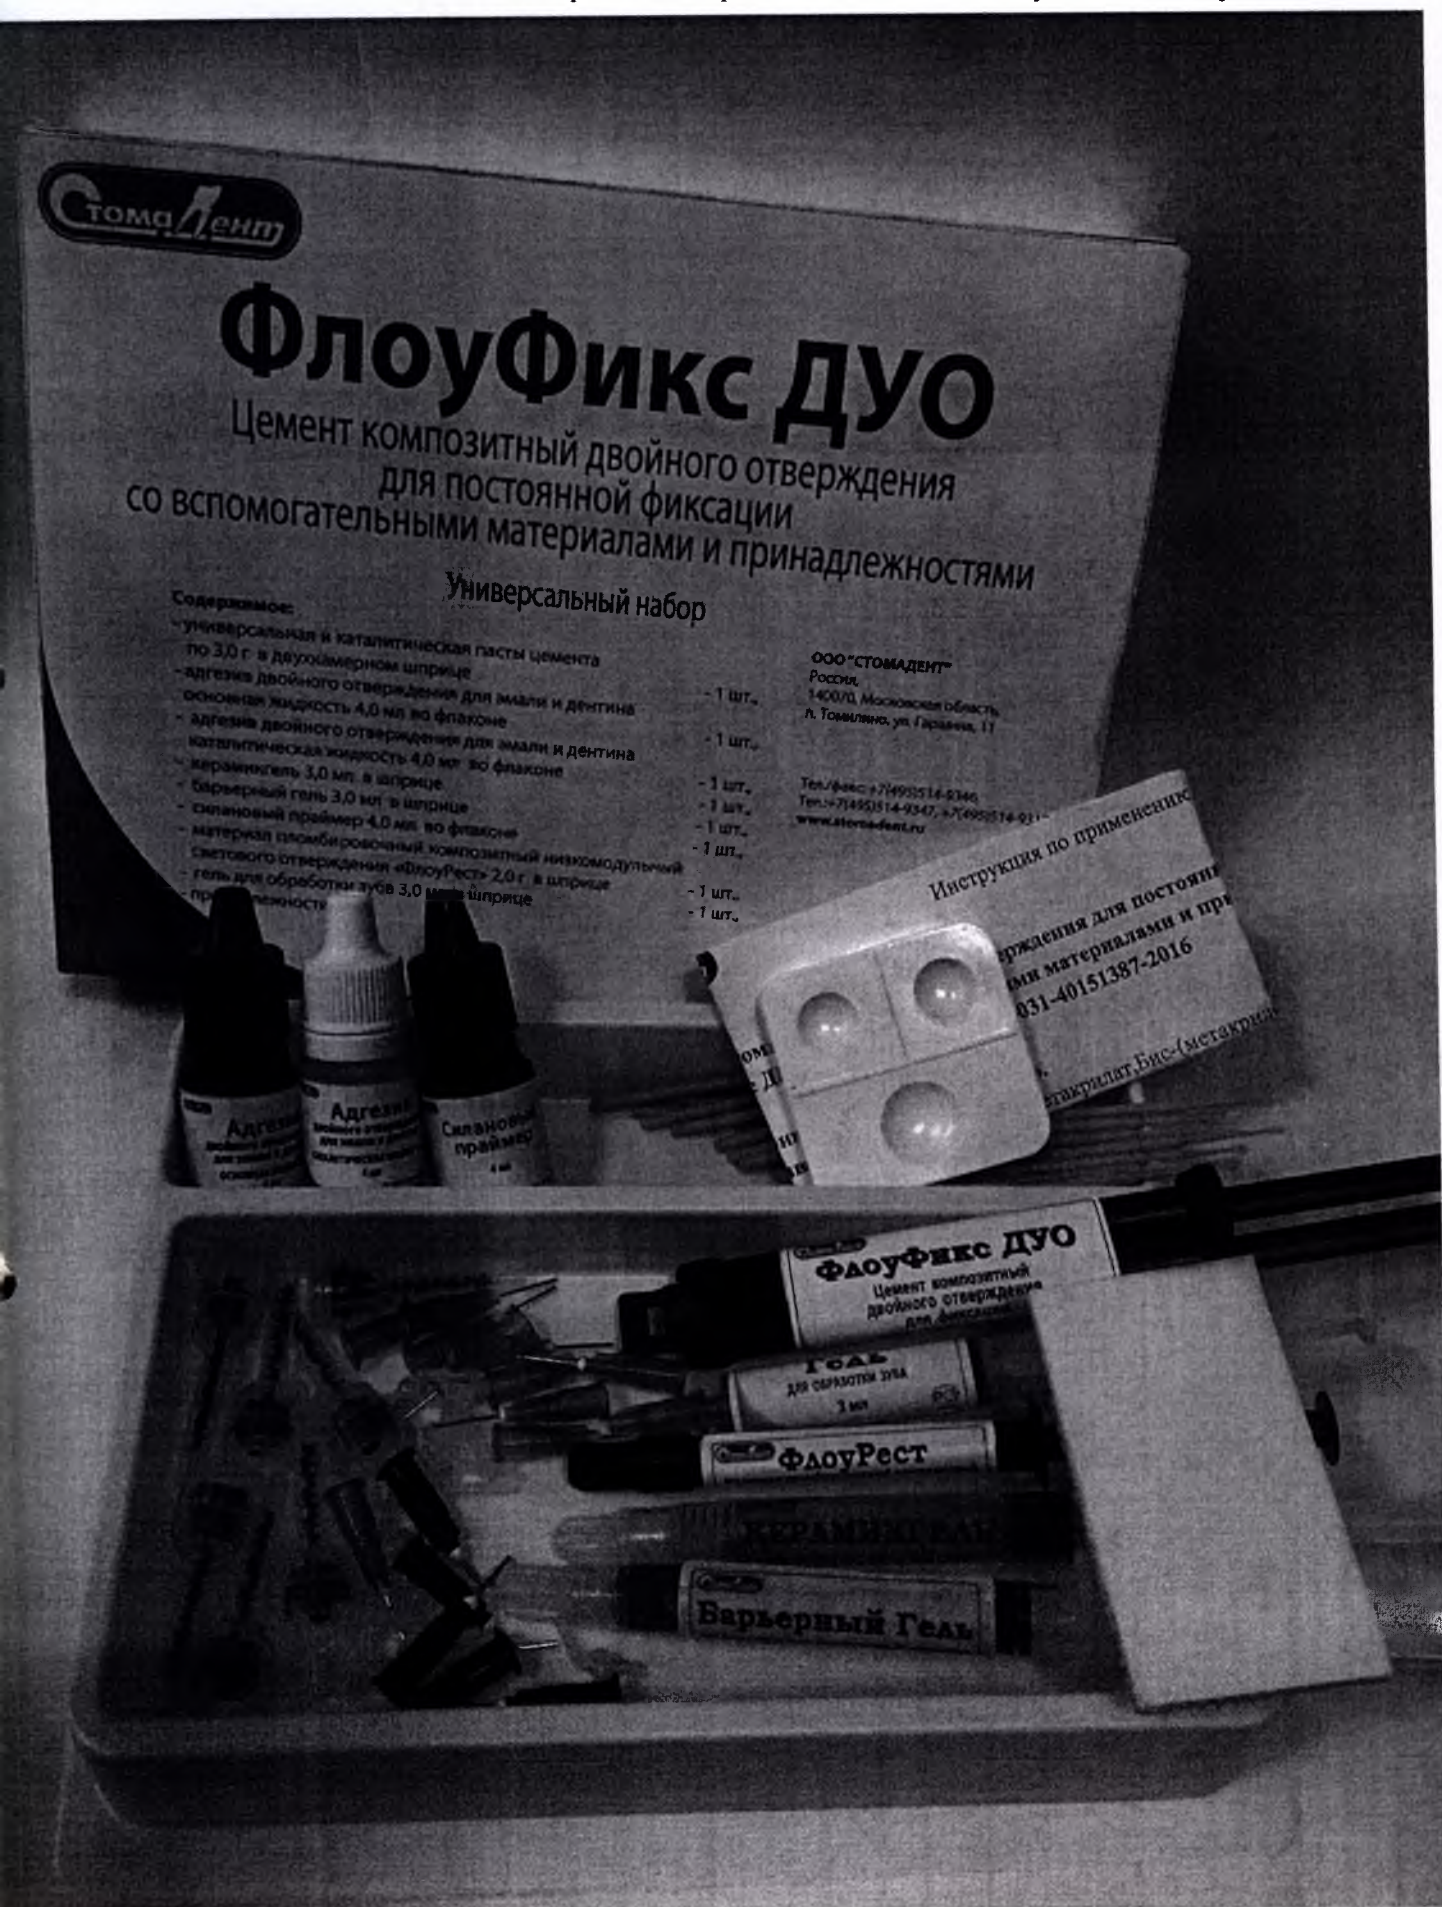

Фотографическое изображение медицинского изделия: Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации «ФлоуФикс ДУО» со вспомогательными материалами и принадлежностями Базовый набор

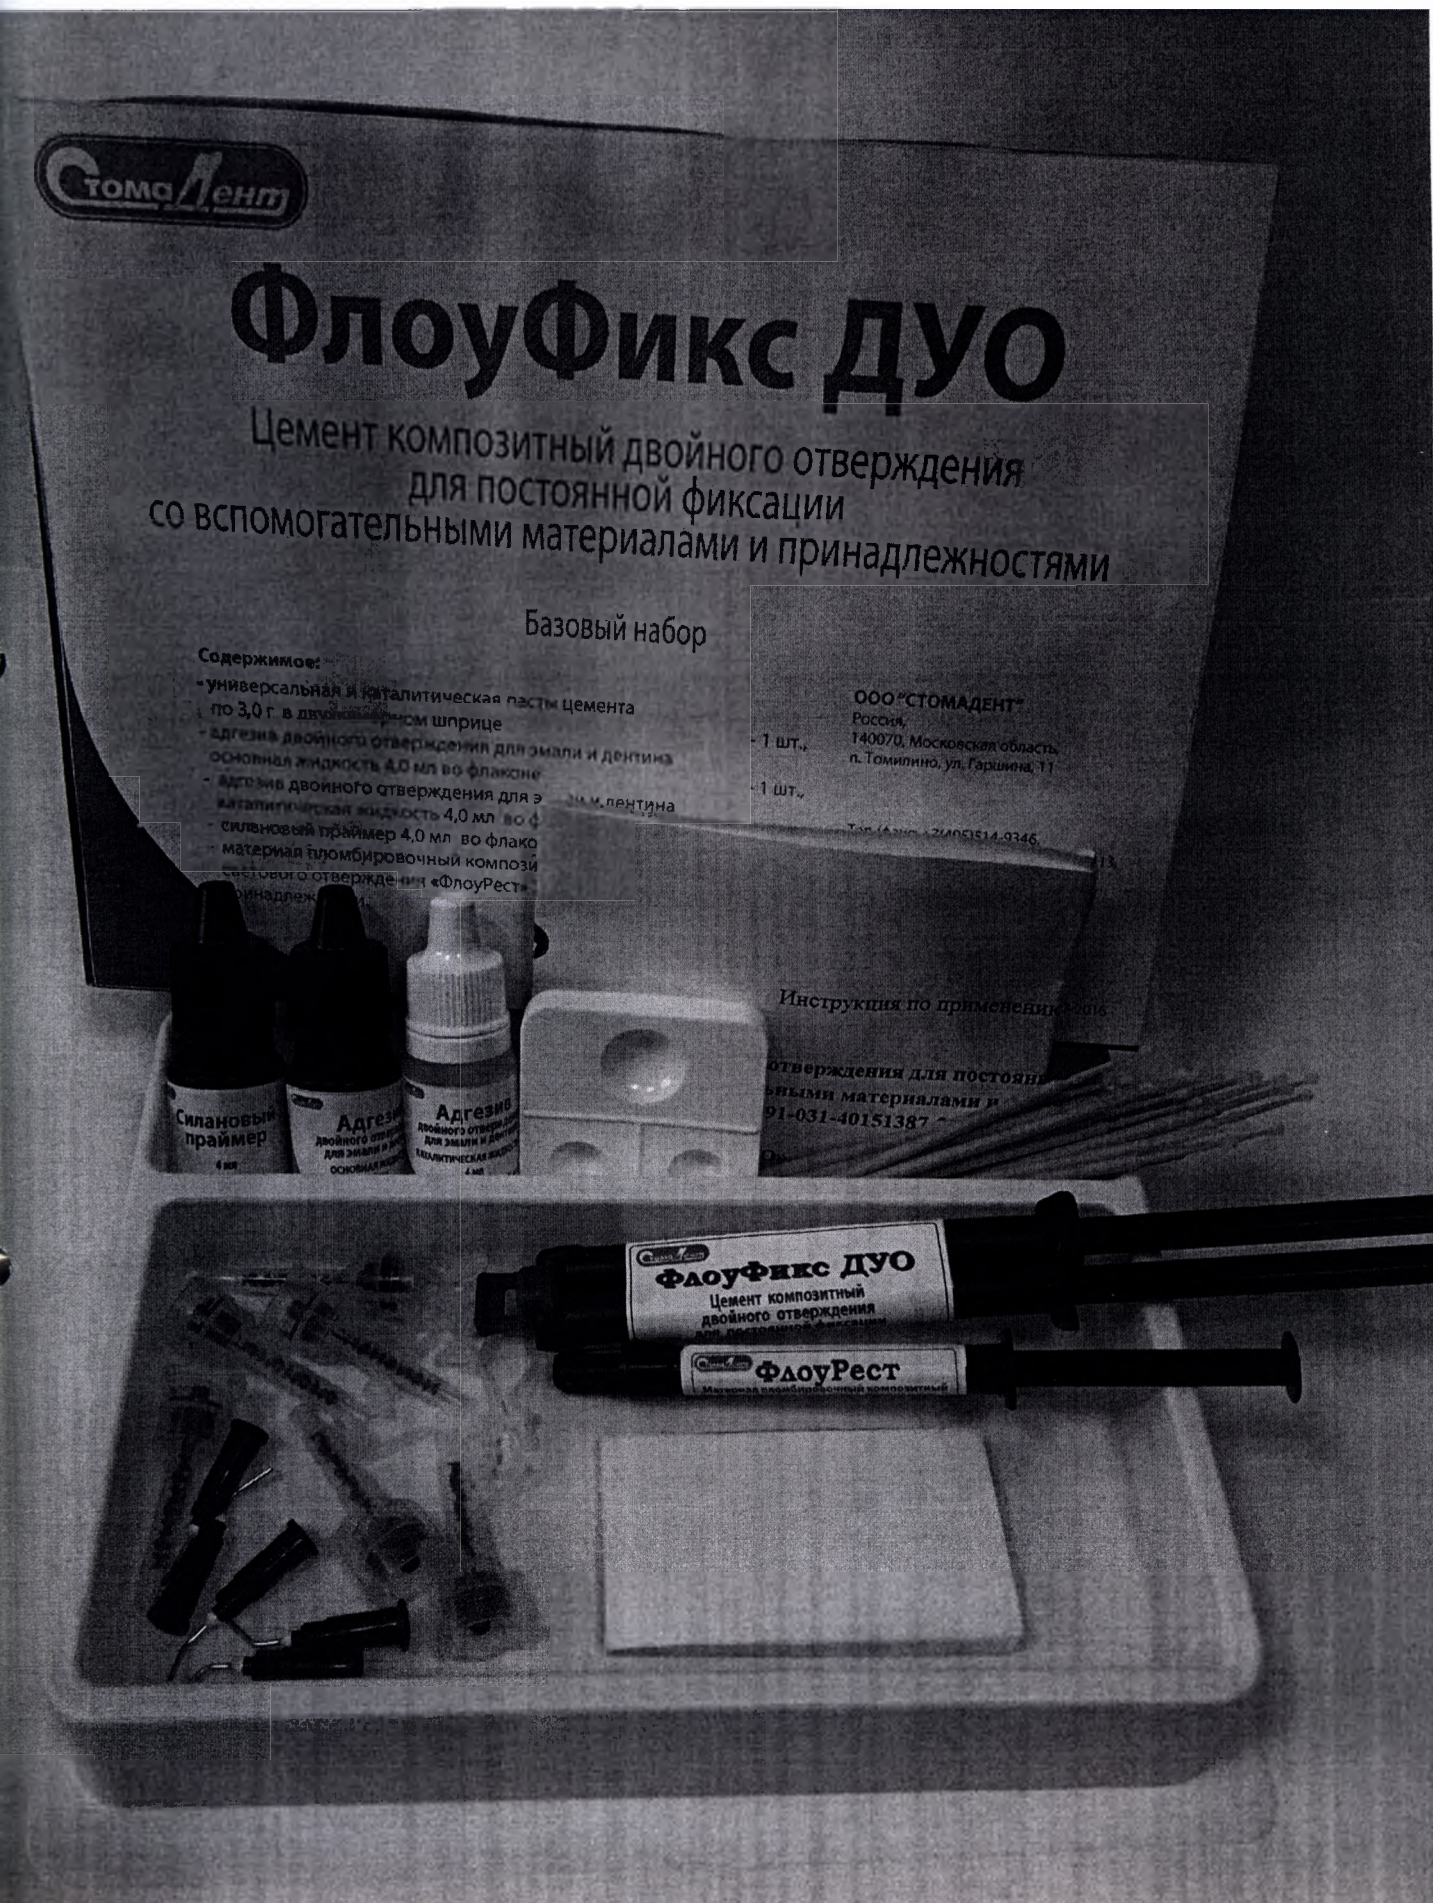

Фотографическое изображение медицинского изделия: Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации «ФлоуФикс ДУО» со вспомогательными материалами и принадлежностями Малый набор



ФлоуФикс ДУО

Цемент композитный двойного отверждения
для постоянной фиксации
со вспомогательными материалами
и принадлежностями

Малый набор

ТУ 9391-031-40151387-2016
Только для стоматологии

Содержимое:

- каталитическая и универсальная пасты цемента по
в двухкамерном шприце - 2 шт.,
- принадлежности.

ООО «СТОМАДЕНТ»

Россия,
140070, Московская область, п. Томилино, ул. Гаршина, 17

Тел./факс: +7(495)514-9346,
Тел.: +7(495)514-9347, +7(495)514-9313,
www.stomadent.ru



Инструкция по применению

Композитный двойного отверждения для постоянной
«ФлоуФикс ДУО» со вспомогательными материалами и при
номер: ТУ 9391-031-40151387-2016

вание: «ФлоуФикс ДУО».
Гма, диакрил, уретан диметакрилат, Бис-(метакрил

Фотографическое изображение медицинского изделия: Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации «ФлоуФикс ДУО» со вспомогательными материалами и принадлежностями Шприц.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«ФлоуФикс ДУО»
Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации

ФлоуФикс ДУО
Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации со вспомогательными материалами и принадлежностями

каталитическая паста - 3 г
универсальная паста - 3 г
прозрачный

ТУ 9391-031-40151387-2016

Дата: 050916
Вендо: 09 2018
Хранить при температуре: $+(5 \pm 12)^{\circ}\text{C}$ - 2 года

ПРОИЗВЕДЕНО:
ООО «СТОМАДЕНТ»
Новосибирская область
Тел. факс: +7 (383) 4-14-347,
+7 (383) 95)514-9313,
www.stomadent.ru

ФлоуФикс ДУО
Цемент композитный двойного отверждения

Фотографическое изображение медицинского изделия:
Адгезив двойного отверждения для эмали и дентина. Набор

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

АДГЕЗИВ

двойного отверждения для эмали и дентина

ТУ 9391-031-40151387-2016

дентина для эмали и дентина предназначен для
соединения материала двойного



Адгезив
двойного отверждения
для эмали и дентина
Набор


ТУ 9391-031-40151387-2016
только для стоматологии

Содержимое:

- адгезив двойного отверждения для эмали и дентина основная жидкость 4,0 мл во флаконе - 1 шт.,
- адгезив двойного отверждения для эмали и дентина каталитическая жидкость 4,0 мл во флаконе - 1 шт.,
- гель для обработки зуба 6,0 мл во флаконе - 1 шт.,
- принадлежность.

ООО "СТОМАДЕНТ"

Россия,
140070, Московская область,
п. Томшино, ул. Гаршина, 11
Тел./факс: +7(495)514-9346,
Тел.: +7(495)514-9347, +7(495)514-9313,
www.stomadent.ru

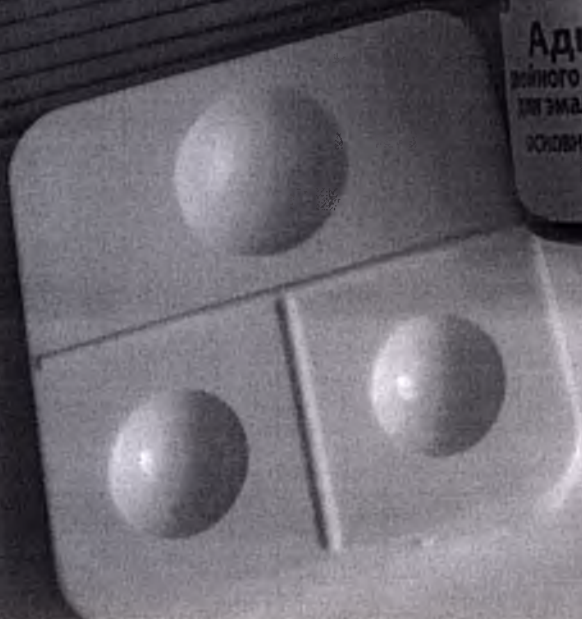



КЕРАМИКГЕЛЬ НАБОР

Содержимое:

- Керамикгель 3 мл - 2 шприца
(9% буферизованный гель плавиковой кислоты)

Партия: 060916
Годен до: 09 2018



- Барьерный гель 3 мл - 1 шприц
(нейтрализатор плавиковой кислоты)

Партия: 060916
Годен до: 09 2018

ТУ 9391-031-40151387-2016

Хранить при температуре $+(18 \div 29)^\circ\text{C}$

ПРОИЗВЕДЕНО:

ООО "СТОМАДЕНТ"

Россия,

140070, Московская область,

п. Томилино, ул. Гаршина, 11

Тел./факс: +7(495)514-9346,

Тел.: +7(495)514-9347,

+7(495)514-9313.

www.stomadent.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КЕРАМИКГЕЛЬ

Гель плавиковой кислоты

для реставрации конструкций из керамики в
желтого цвета, со-
держивающей буфером.

нанести ровный слой геля

нанести на его по-
верхность и аккурат-
но нанести нейтрализо-
ванный барьерный ге-
ль.

Фотографическое изображение медицинского изделия:
Силановый праймер. Набор




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Силановый праймер

ТУ 9391-031-40151387-2016

НАЗНАЧЕНИЕ



Силановый праймер

Набор

ТУ 9391-031-40151387-2016

Только для стоматологии

Содержимое:

- силановый праймер 4,0 мл во флаконе
- принадлежности.

- 1 шт.

ООО "СТОМАДЕНТ"

Россия,
140070, Московская область,
п. Томилино, ул. Гаршина, 11

Тел./факс: +7(495)514-9346,

Тел.: +7(495)514-9347, +7(495)514-9313,

www.stomadent.ru

Материал хранить в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучей помещении.
Гарантийный срок хранения
при температуре $+(-5-12)^{\circ}\text{C}$ - 2 года.

Keep in dry place, protected from direct sunlight.
Storing at temperature of $+(-5-12)^{\circ}\text{C}$ - 2 years.

Партнер / Partner
Годен до / Valid until



Фотографическое изображение медицинского изделия: Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации «ФлоуФикс ДУО» со вспомогательными материалами и принадлежностями.




Фотографическое изображение медицинского изделия:

Материал пломбировочный композитный низкомолекулярный светового отверждения «ФлоуРест»





Фотографическое изображение медицинского изделия:
Гель для обработки зуба.

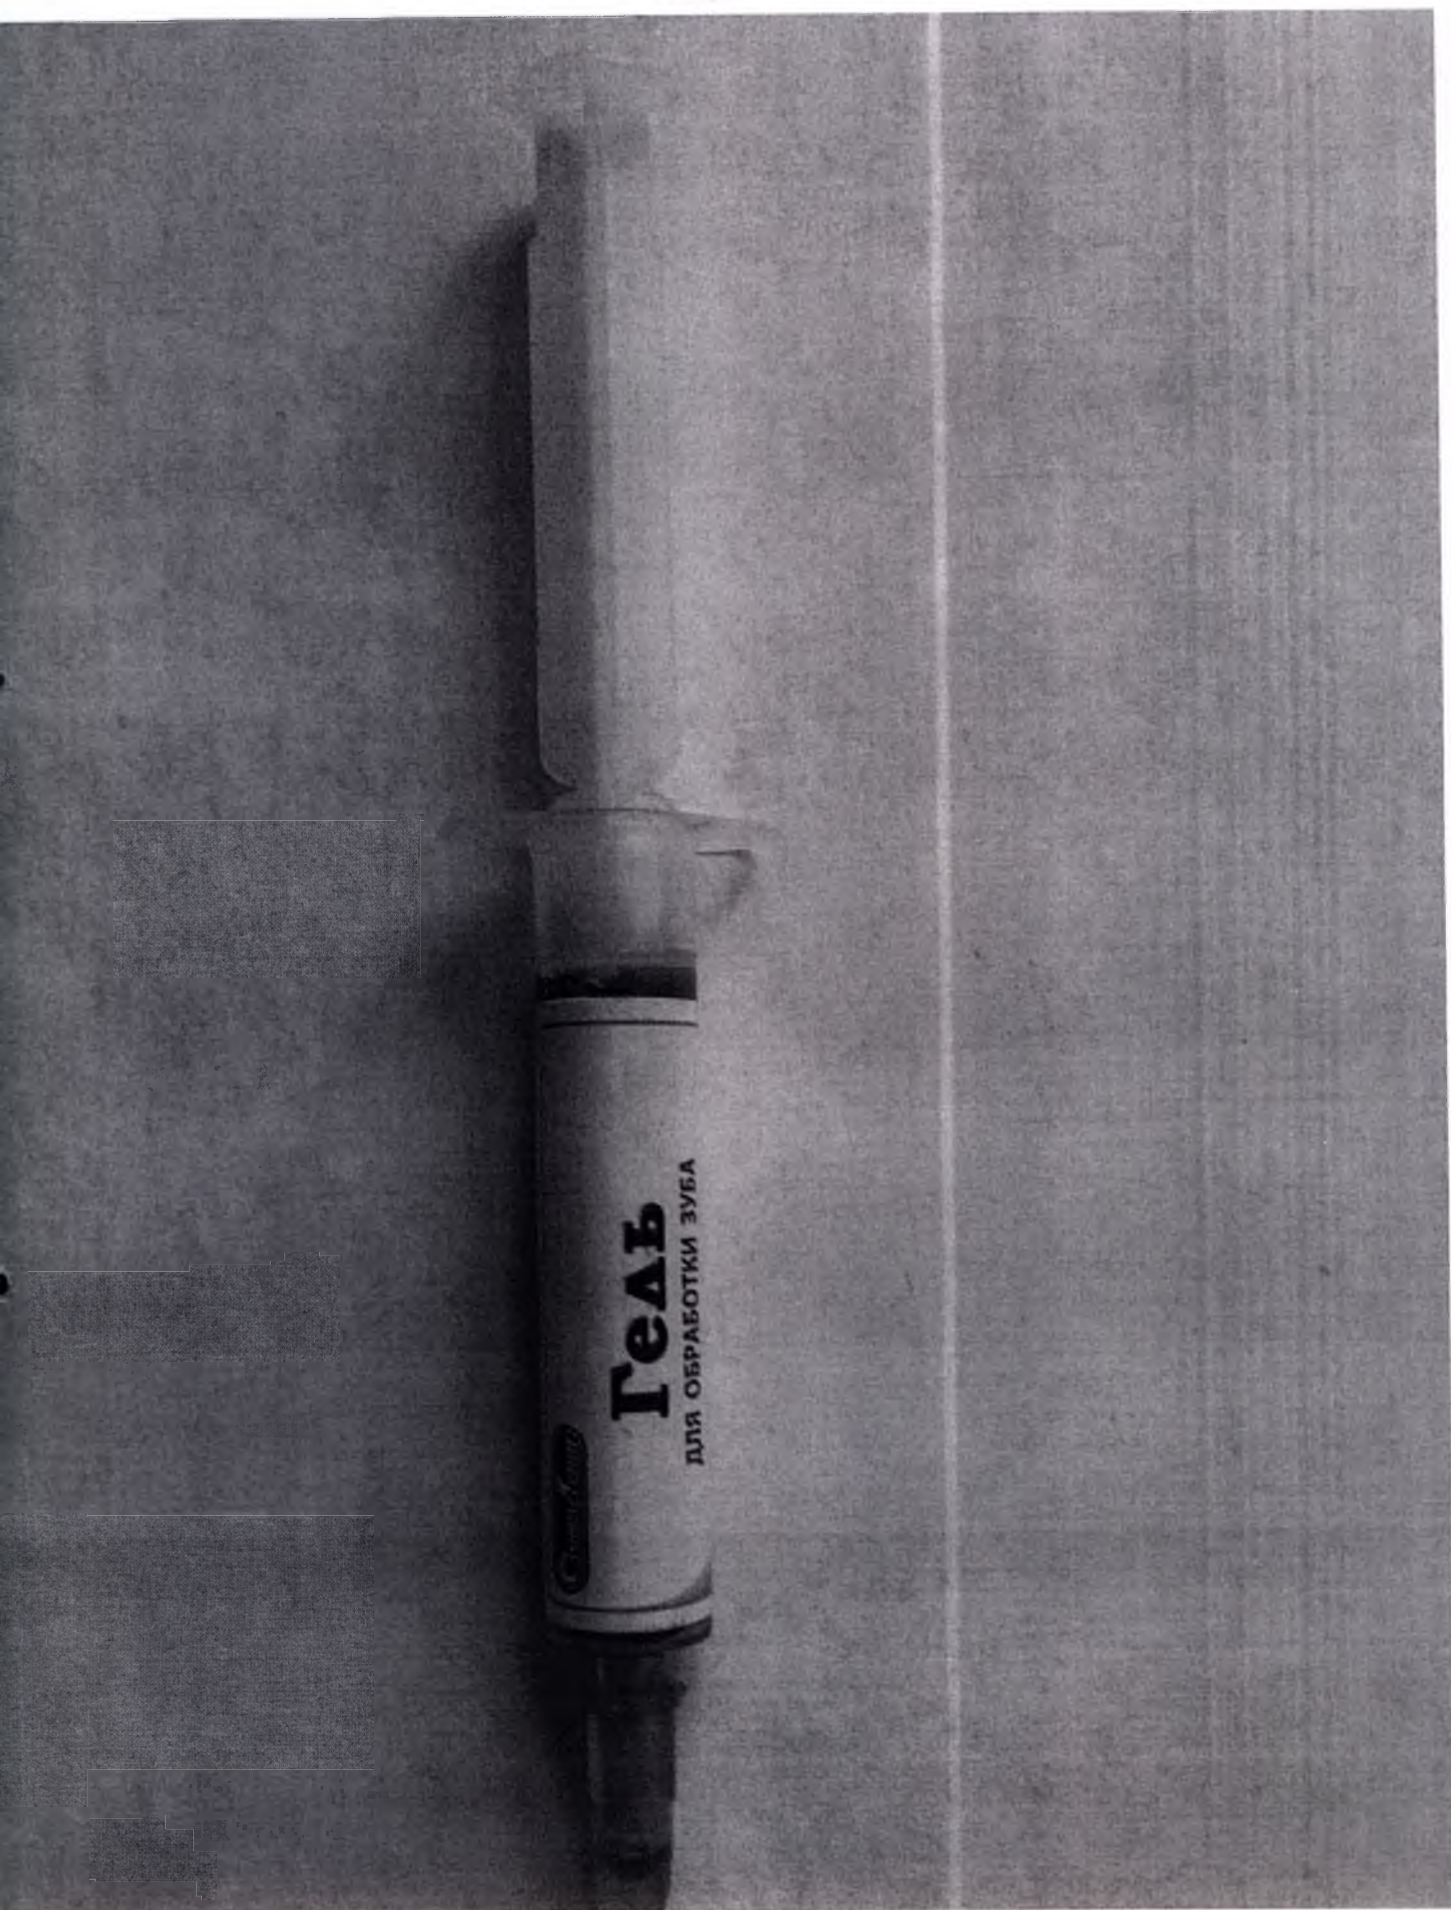




Фотографическое изображение медицинского изделия: Керамикгель

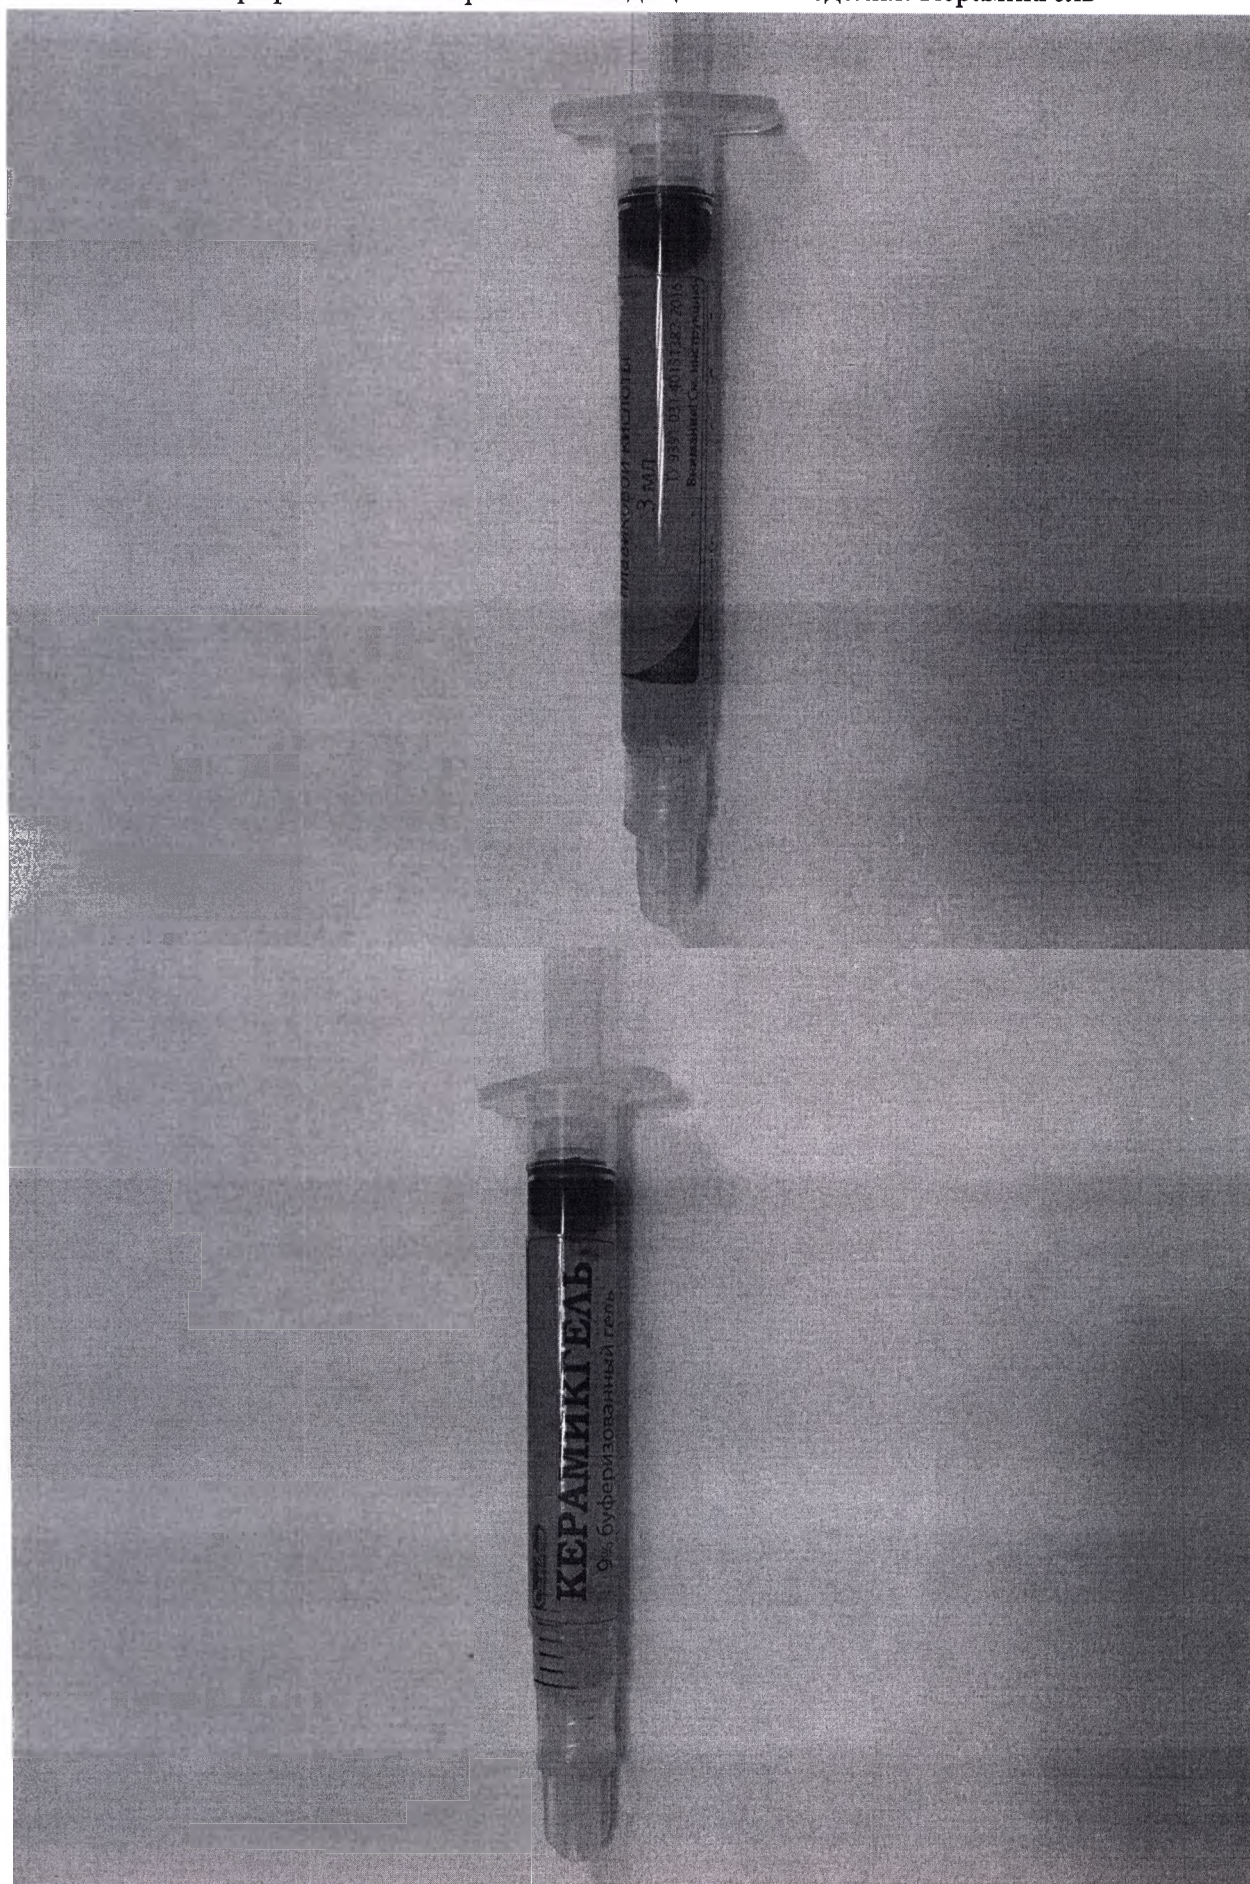


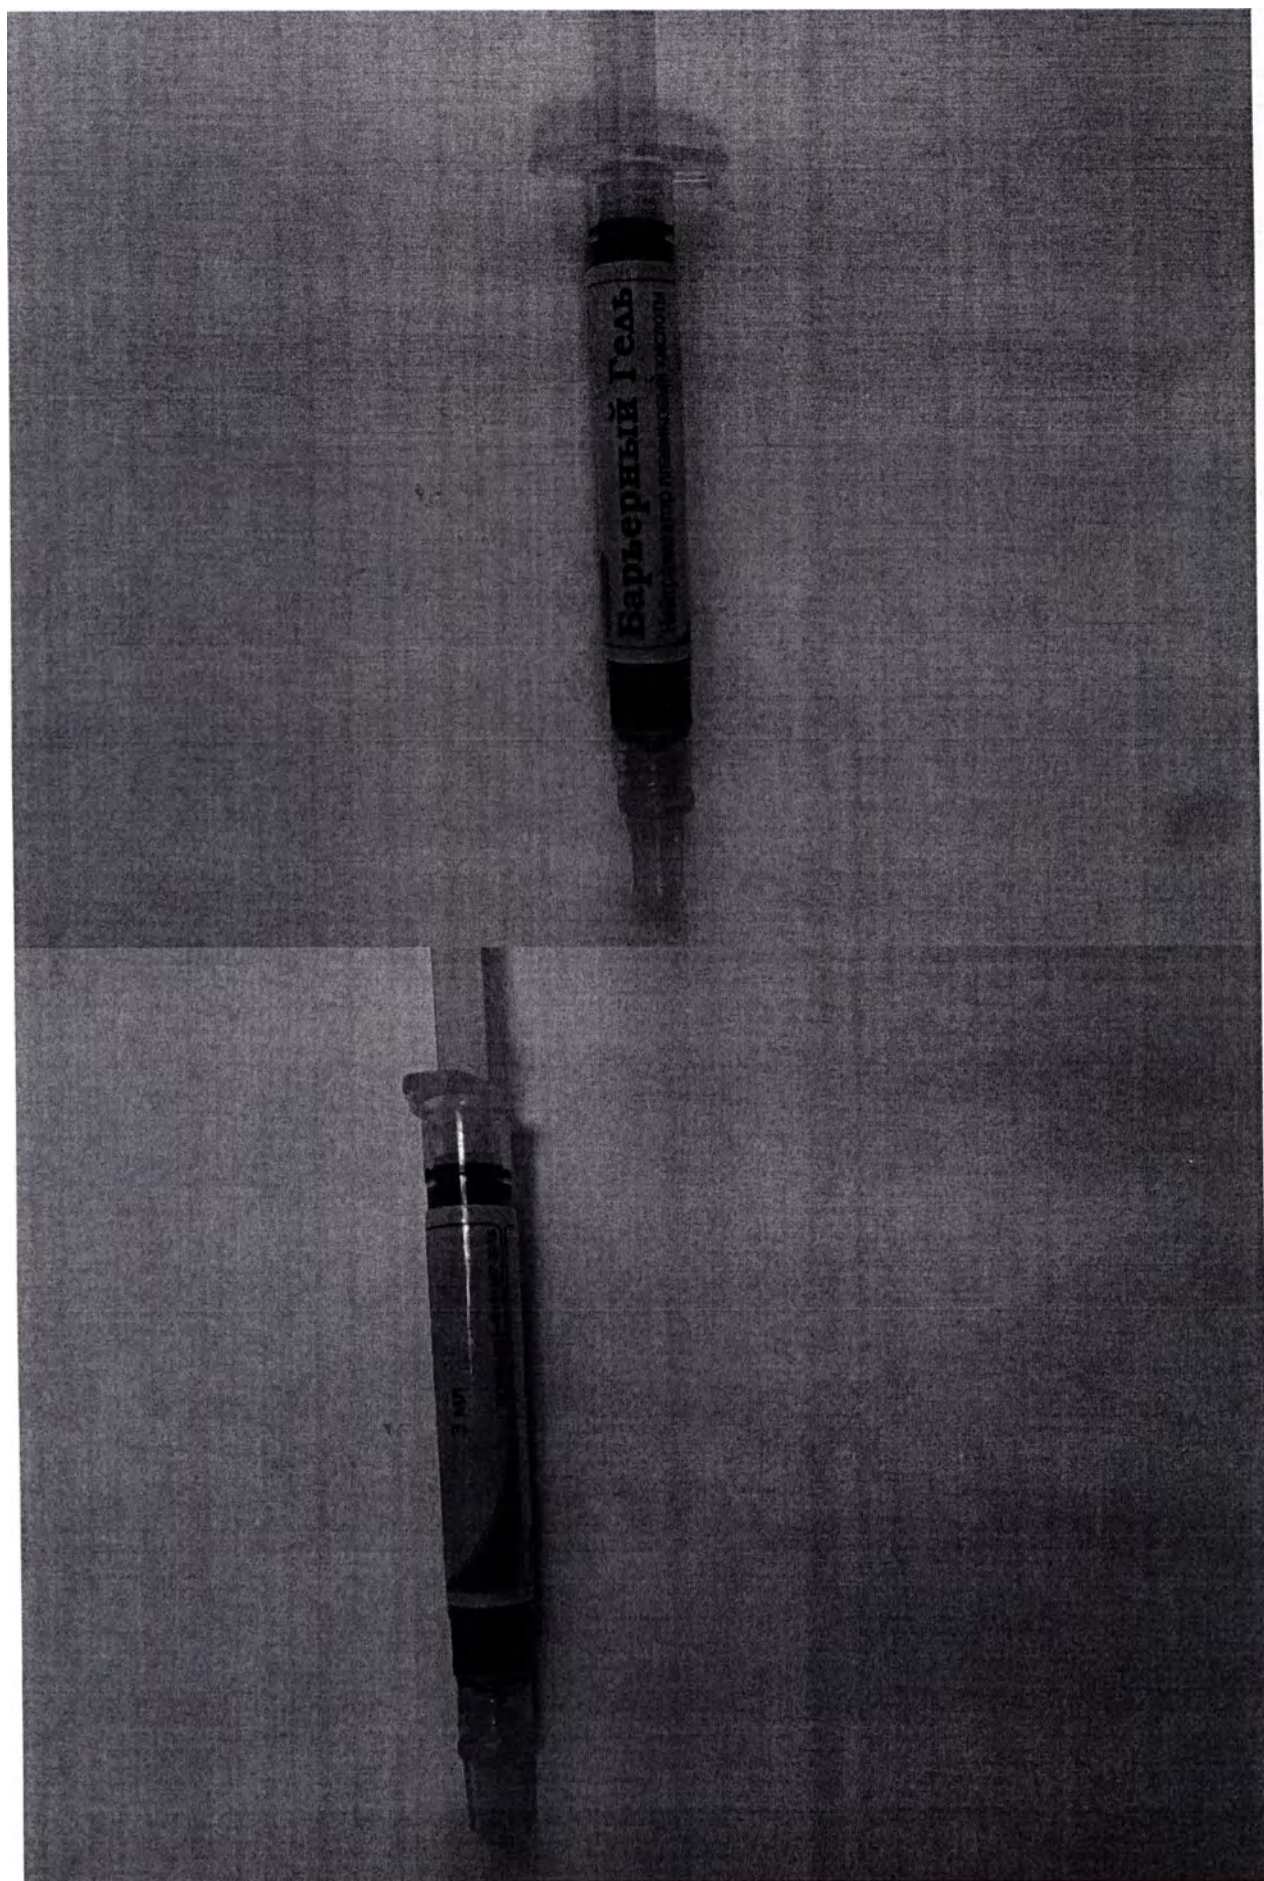


Фотографическое изображение флакона с силиновым праймером

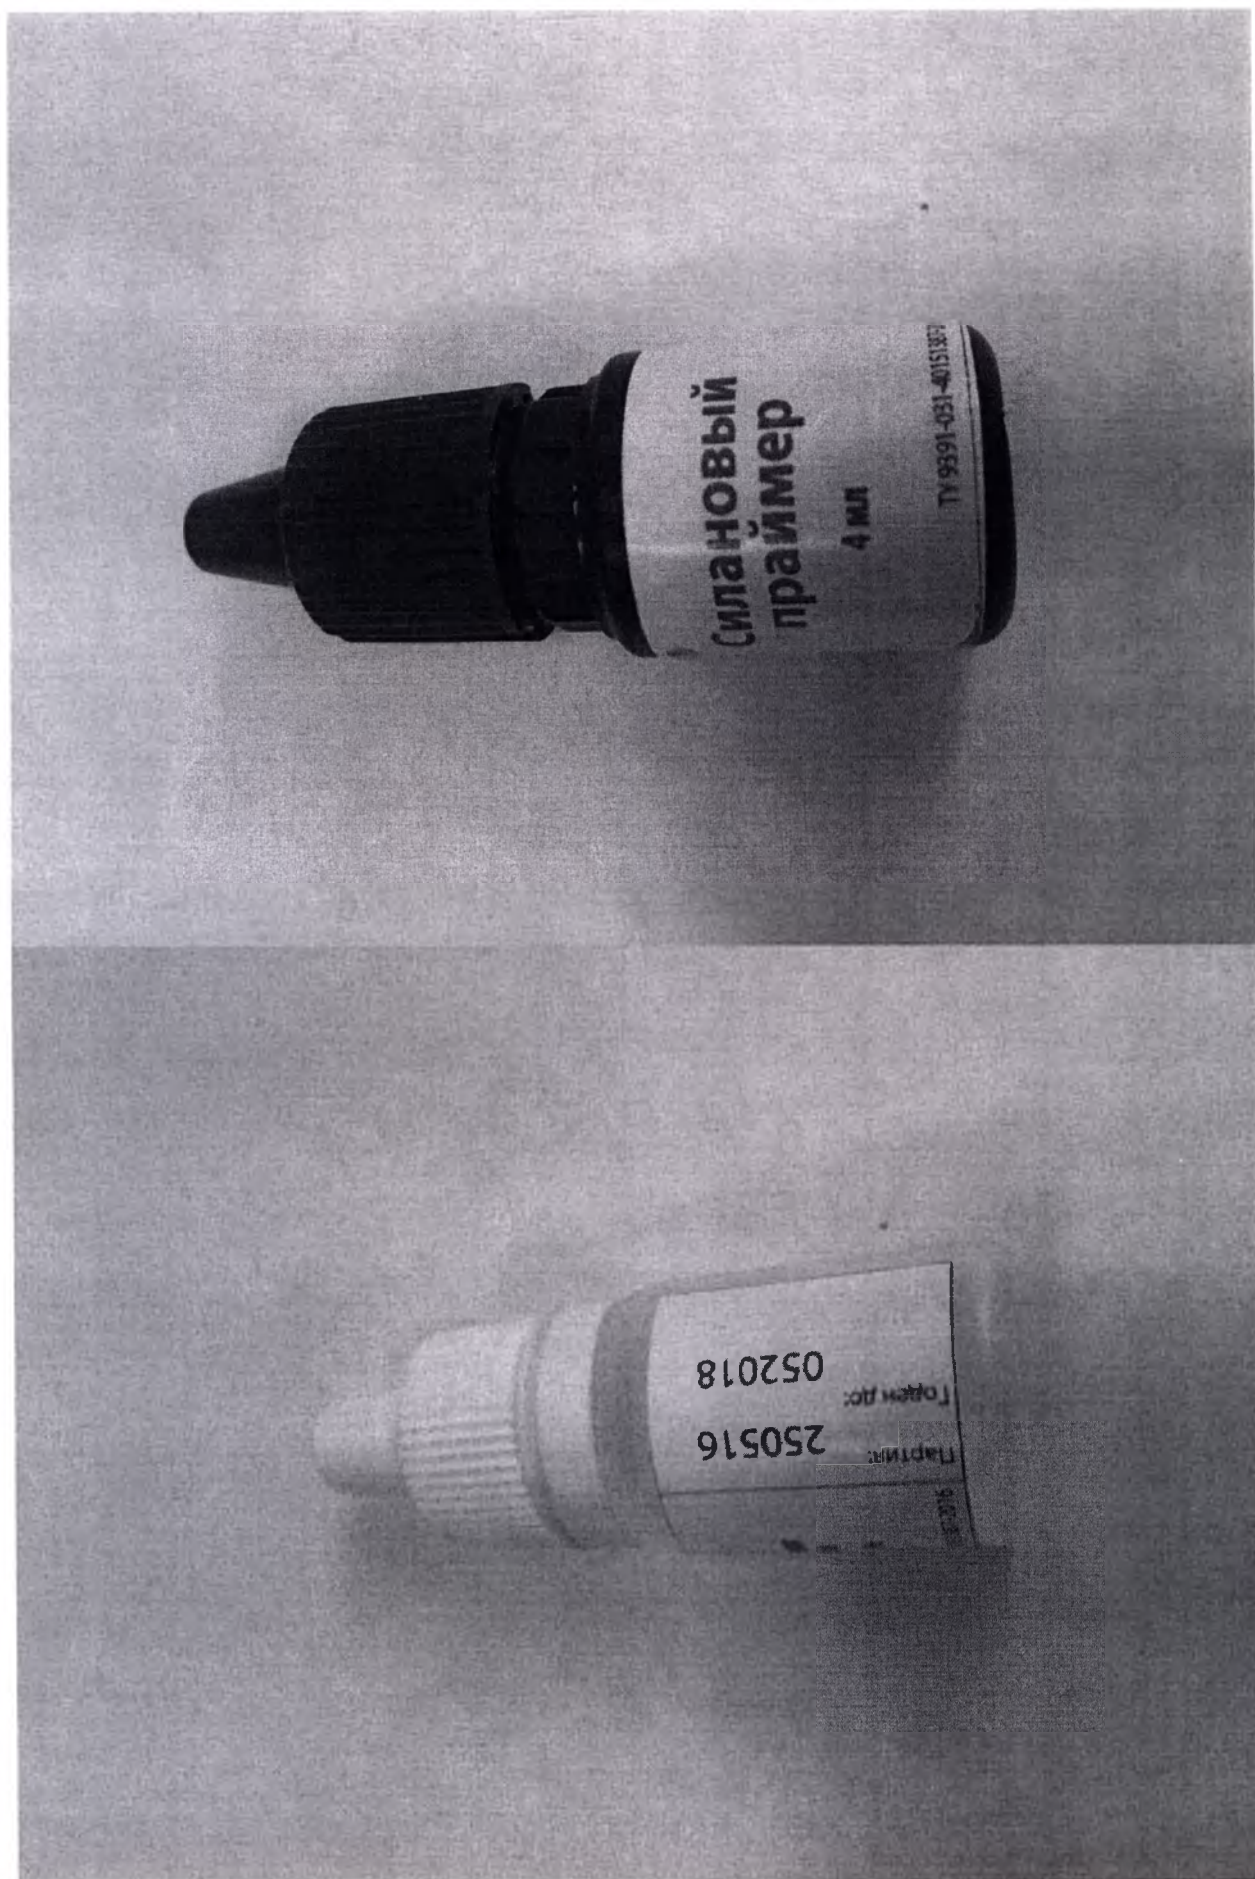



Фотографическое изображение флакона с каталитической жидкостью адгезива двойного отверждения для эмали и дентина

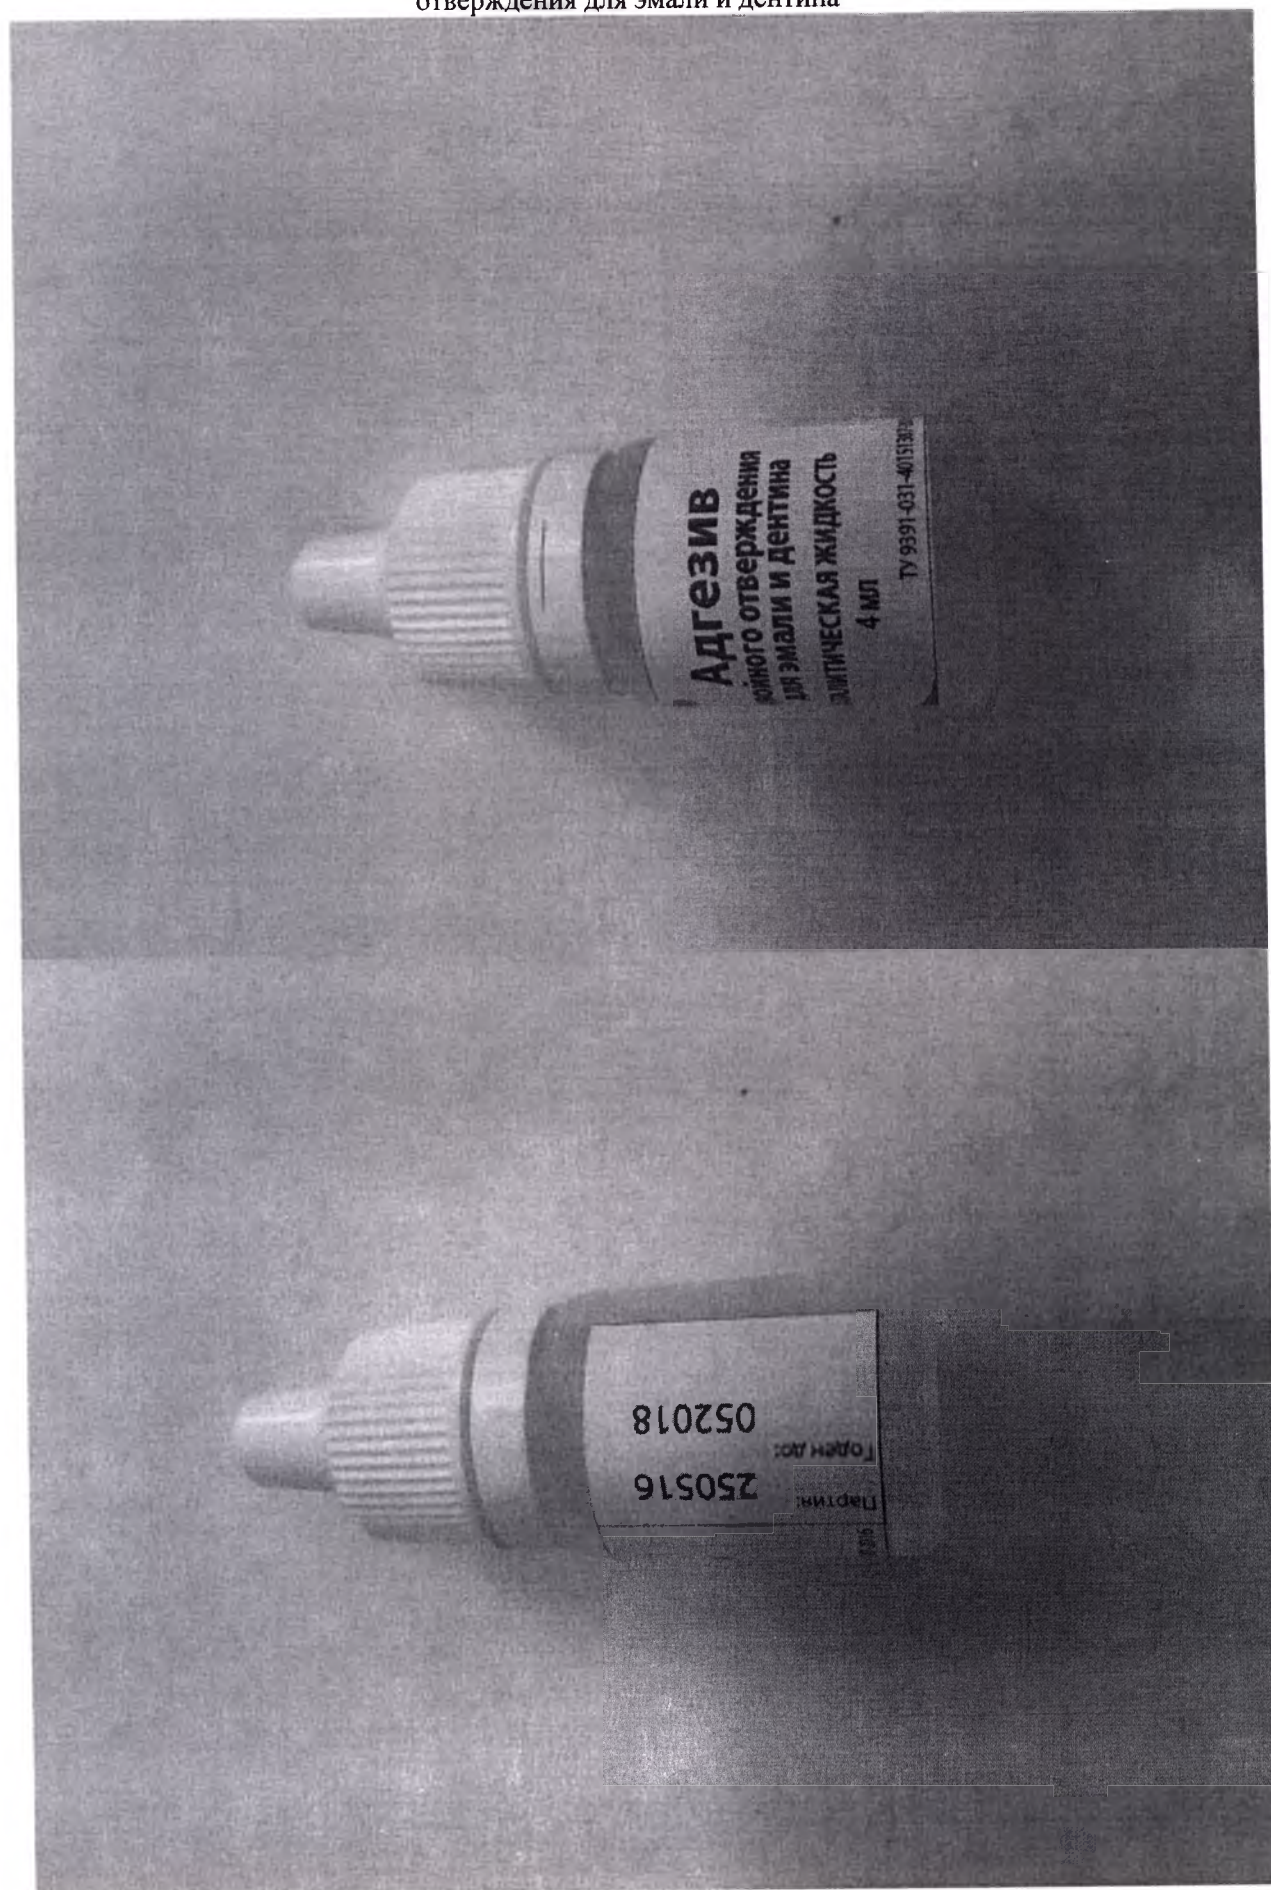

Фотографическое изображение флакона с основной жидкостью адгезива двойного отверждения для эмали и дентина

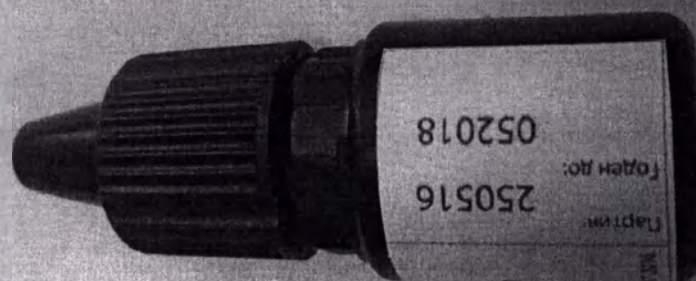


Фотографическое изображение принадлежности «Кювета» к медицинскому изделию: Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации со вспомогательными материалами и принадлежностями «ФлоуФикс» ДУО»

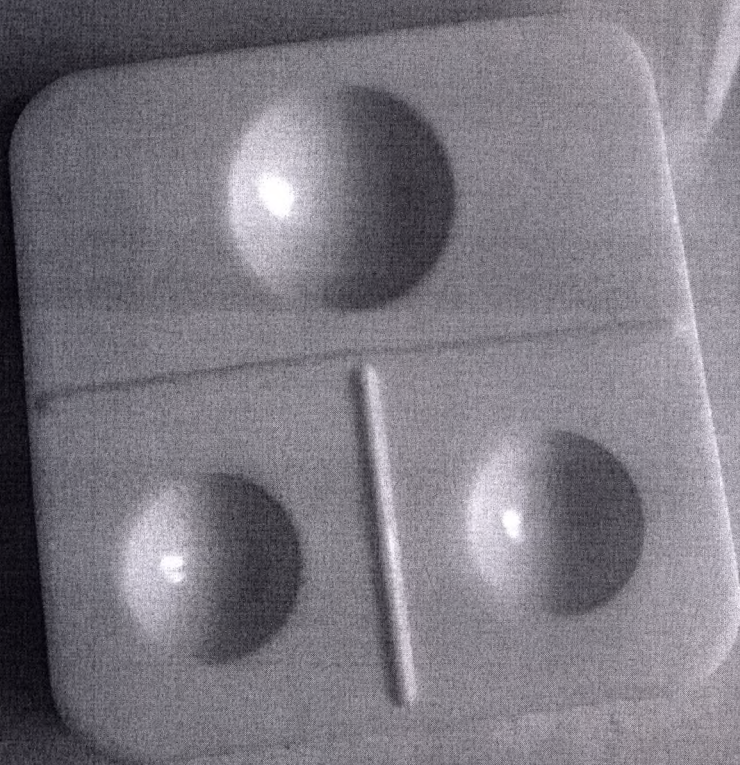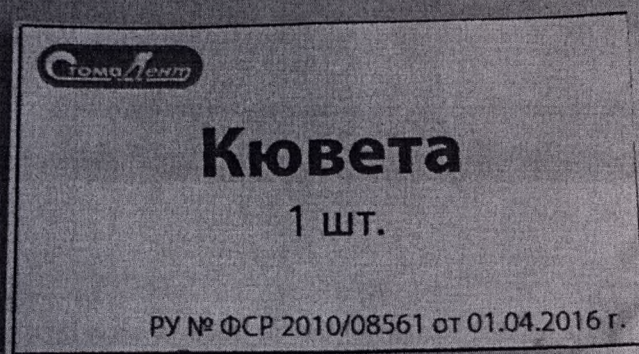


Фотографическое изображение принадлежности «Микроаппликаторы стоматологические» к медицинскому изделию: Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации со вспомогательными материалами и принадлежностями «ФлоуФикс» ДУО»





Фотографическое изображение принадлежности «Одноразовые насадки для внесения смешанного материала» к медицинскому изделию: Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации со вспомогательными материалами и принадлежностями «ФлоуФикс ДУО»

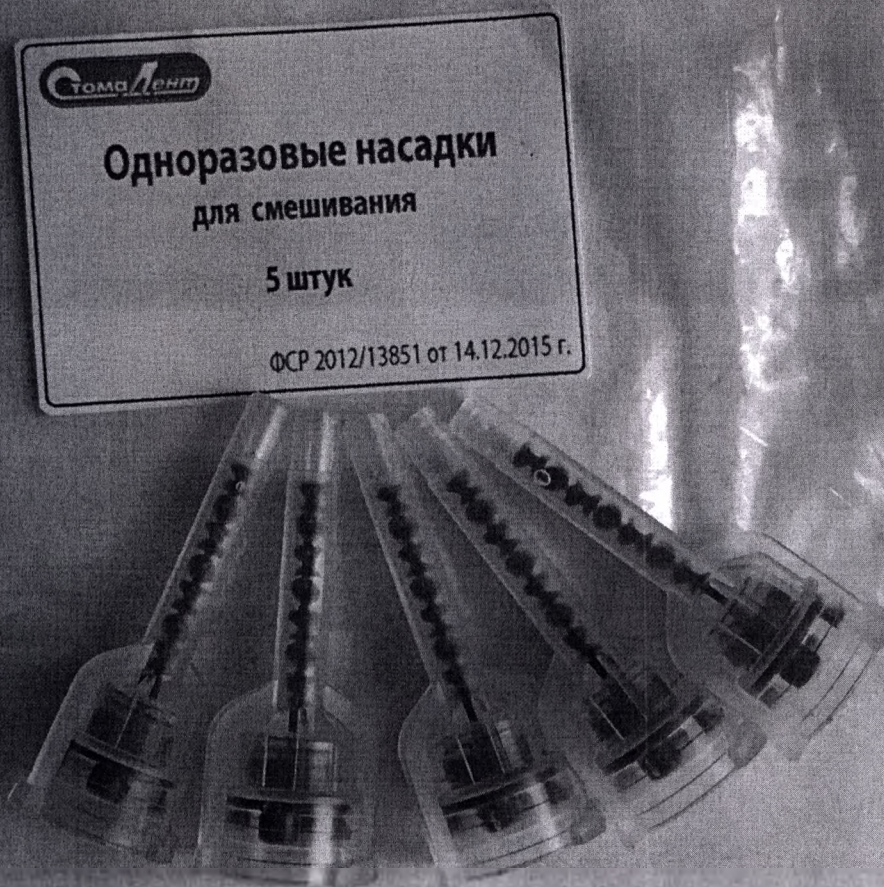

Фотографическое изображение принадлежности к медицинскому изделию:
Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации «ФлоуФикс ДУО» со
вспомогательными материалами и принадлежностями. Одноразовые насадки для внесения
смешанного материала

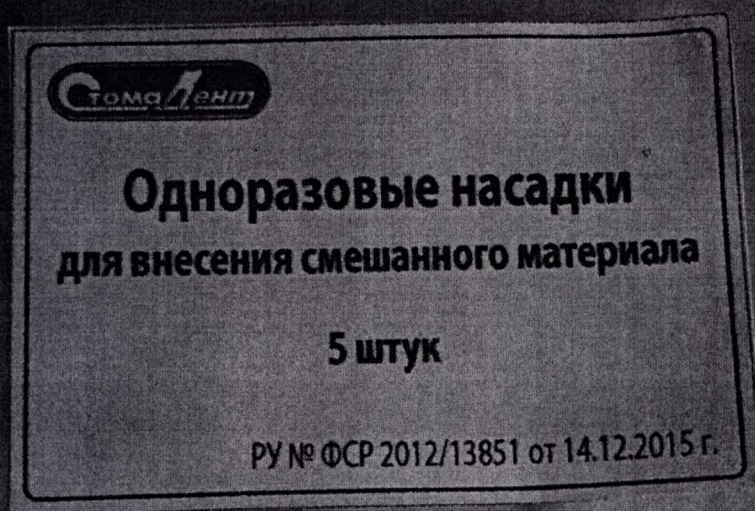

Фотографическое изображение принадлежности «Игла-насадка» к медицинскому изделию:
Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации со вспомогательными
материалами и принадлежностями «ФлоуФикс» ДУО»

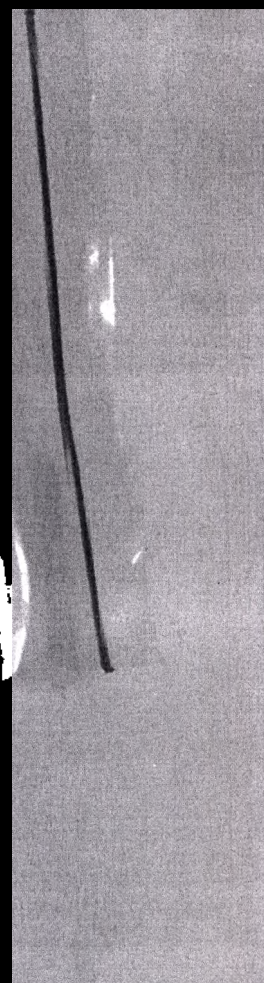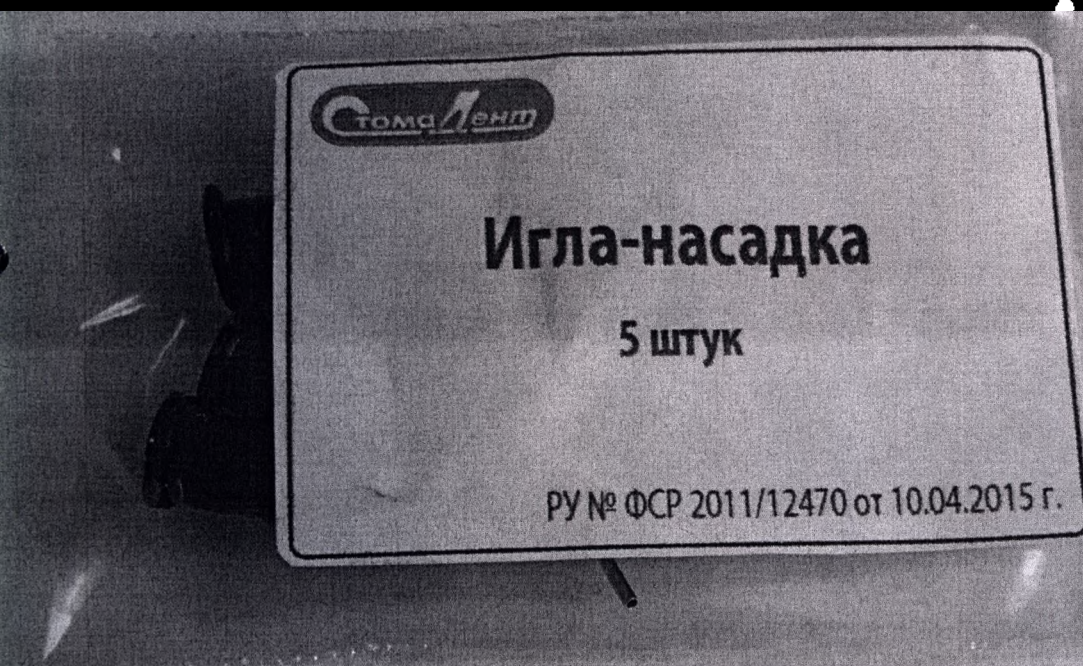

Фотографическое изображение принадлежности «Игла одноразовая» к медицинскому изделию:
Цемент композитный двойного отверждения для постоянной фиксации со вспомогательными
материалами и принадлежностями «ФлоуФикс» ДУО»



Игла одноразовая
5 штук

РУ № ФСР 2010/08204



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 22 лист.

Генеральный директор
ООО «СТОМАДЕНТ»

Ю.В.Кузовков

