

УТВЕРЖДАЮ
ООО «Вива Виктория»
Генеральный директор



Р.Р. Обуханич

«15» января 2017 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор для измерения стабильности дентальных имплантатов
Penguin RFA (Implant Stability Meter Instrument Penguin RFA) с принадлежностями**

Рис. 1 Аппарат для измерения стабильности дентальных имплантатов Penguin RFA



Рис. 2 Отвертка для штифтов MulTireg

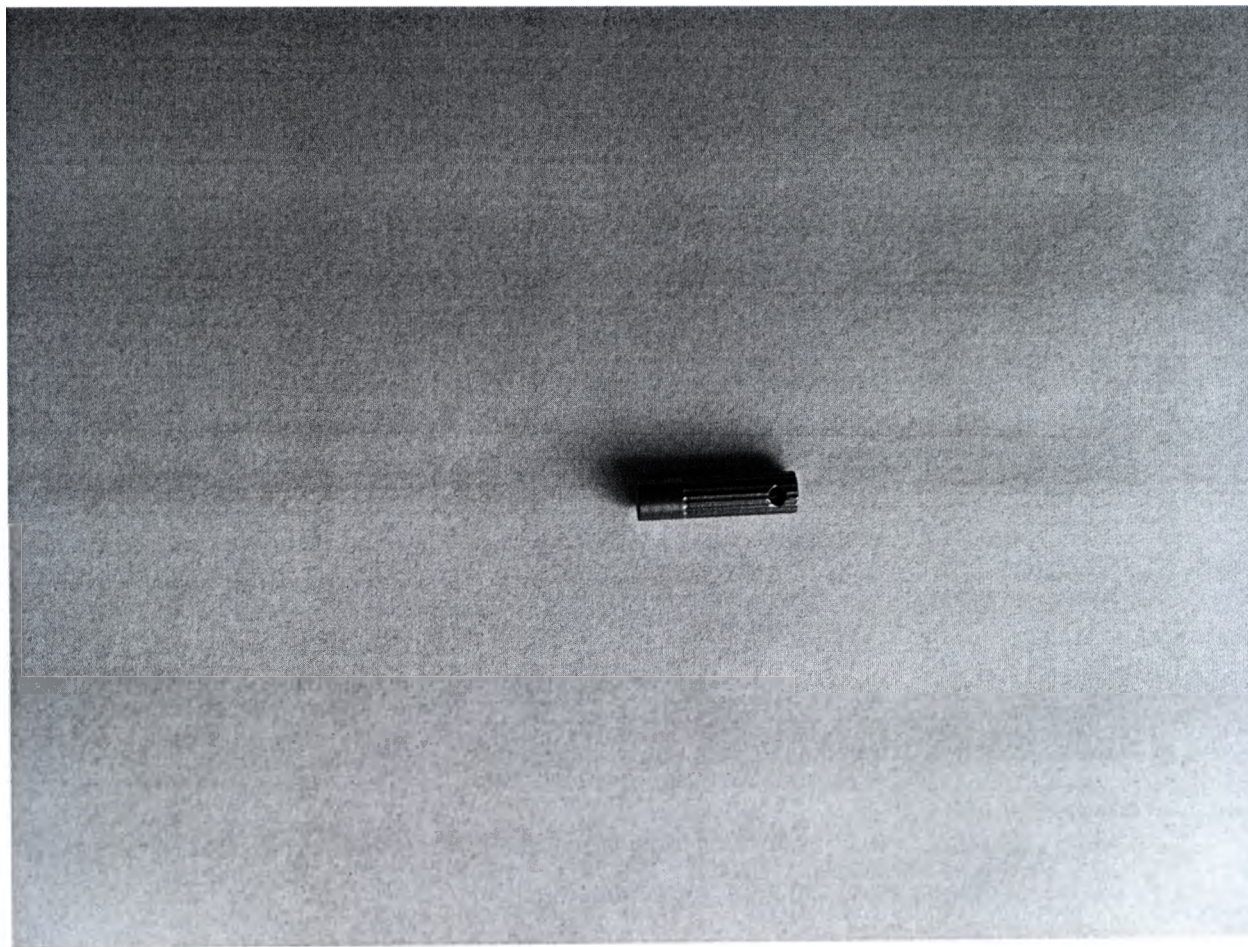


Рис. 3 Сетевой адаптер/зарядной устройство

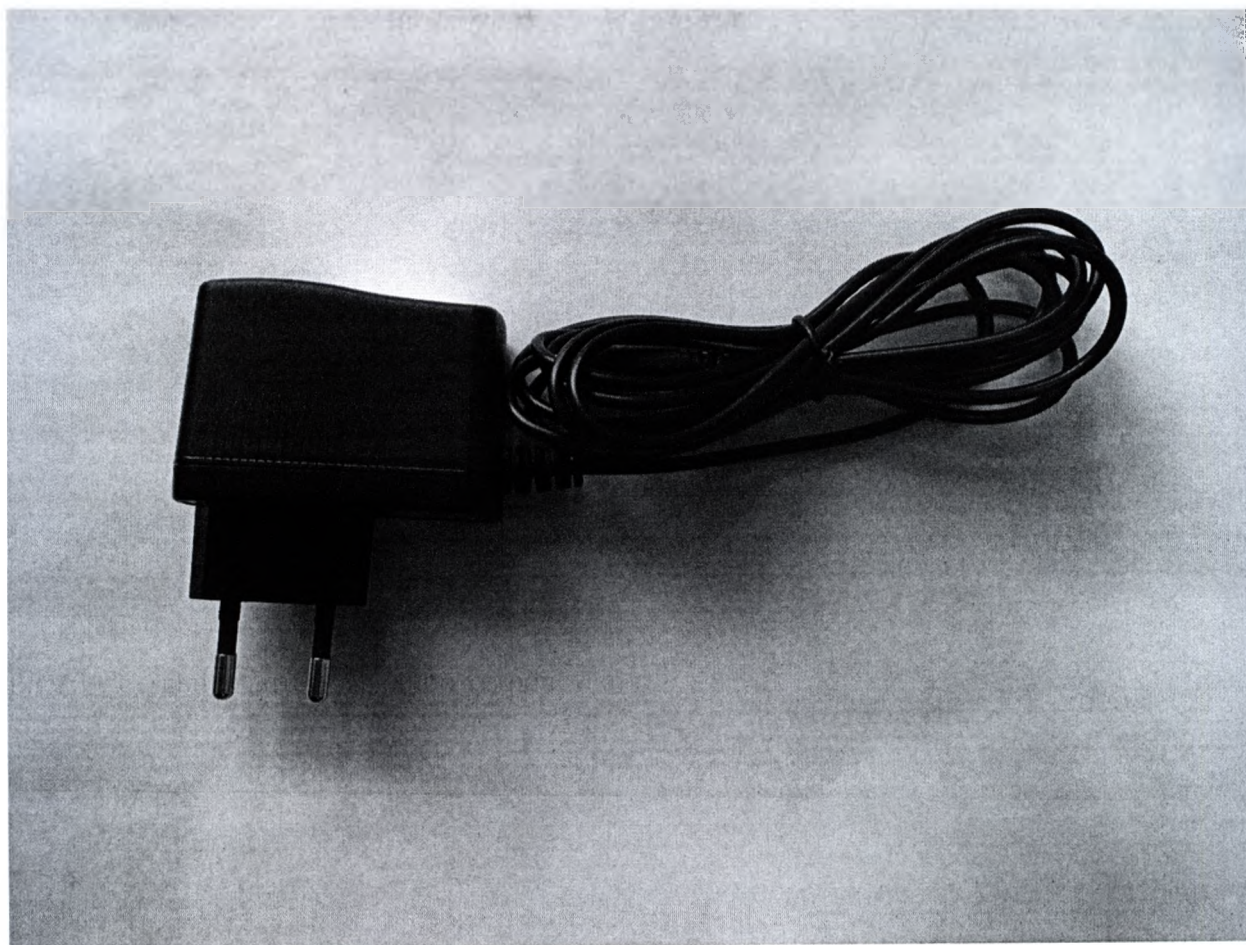


Рис. 4 Штифт MulTipeg 1



Рис. 5 Штифт MultiPeg 2

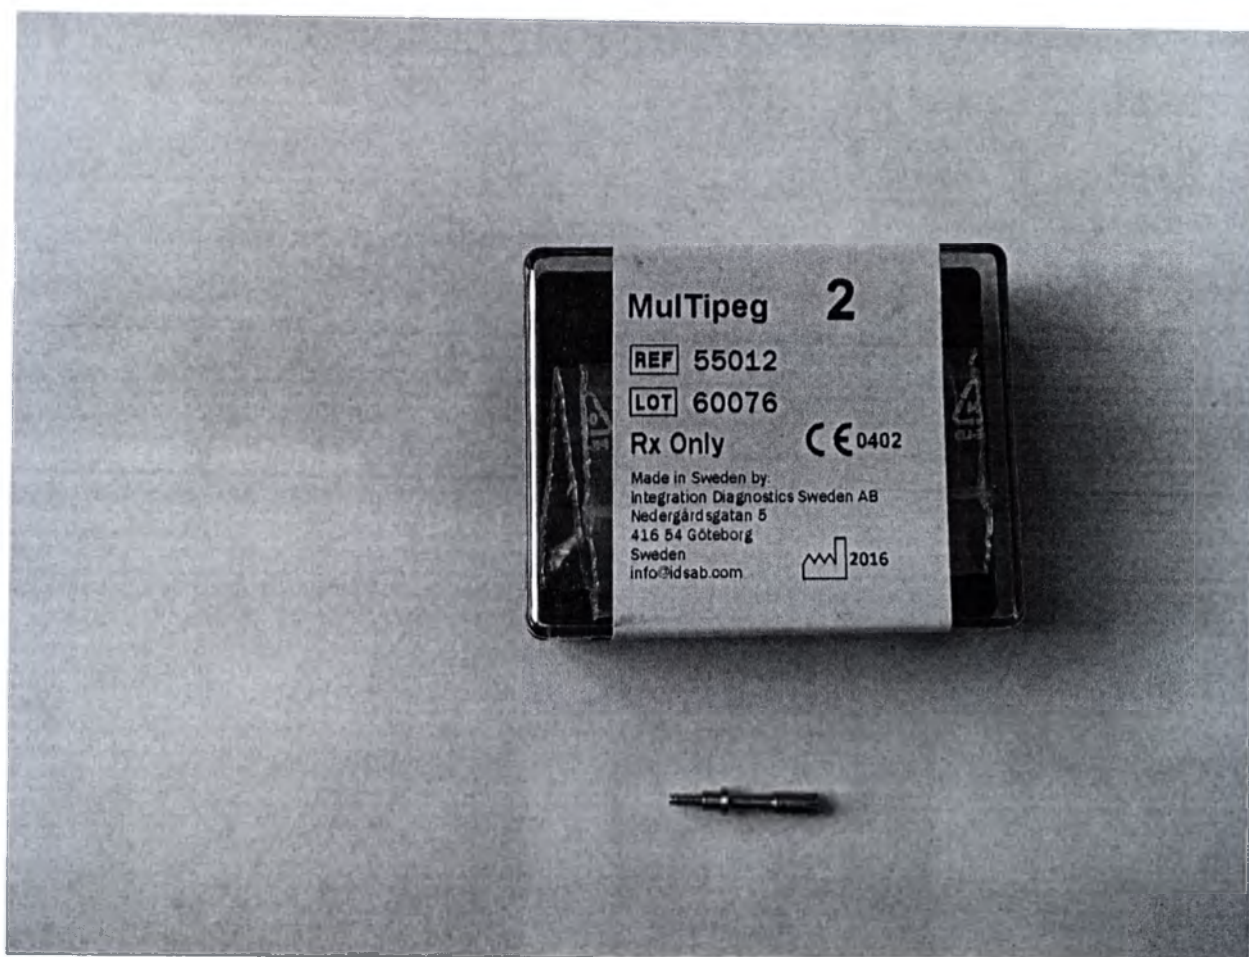


Рис. 6 Штифт MulTipeg 3

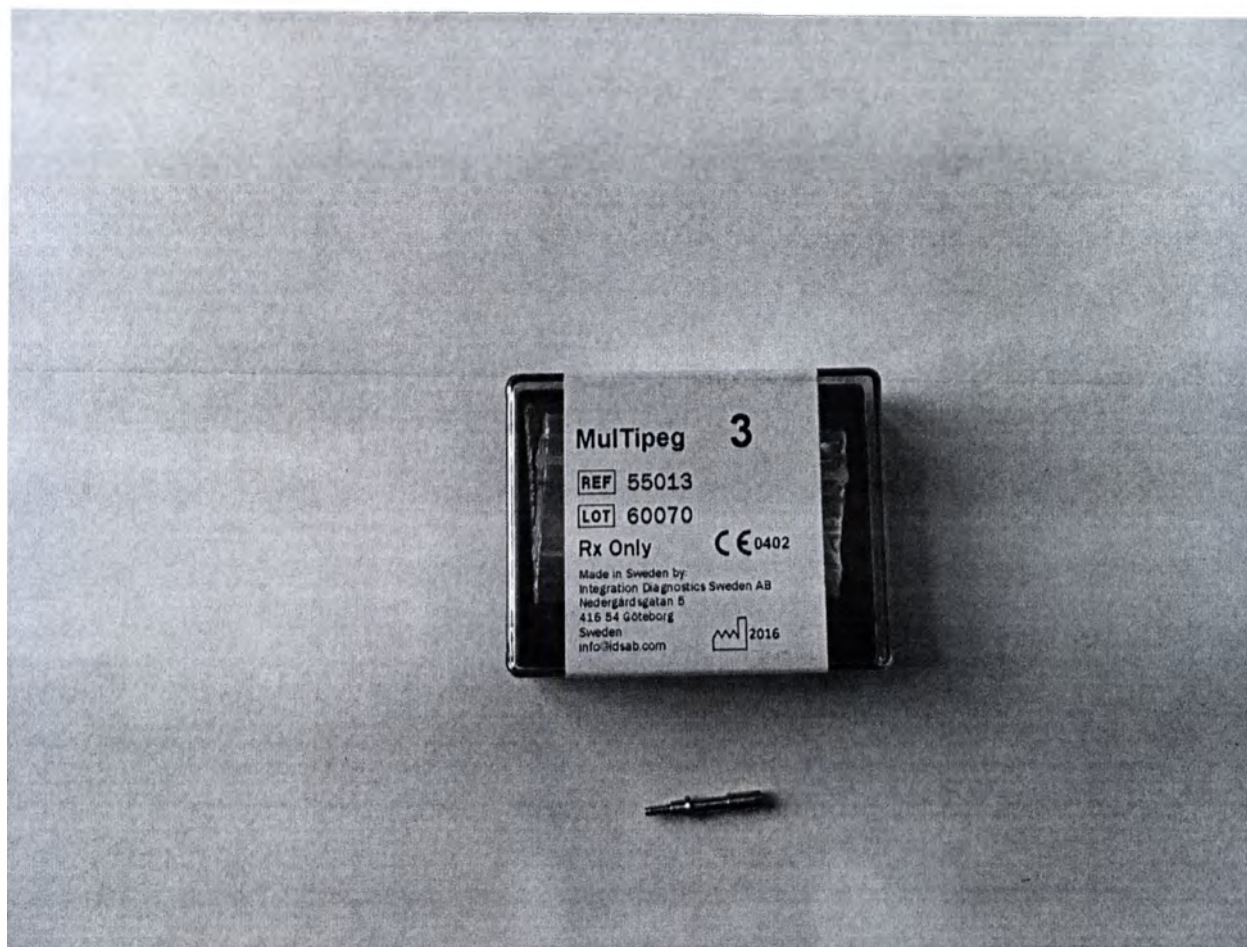


Рис. 7 Штифт MulTipeg 4



Рис. 8 Штифт MultiPeg 5

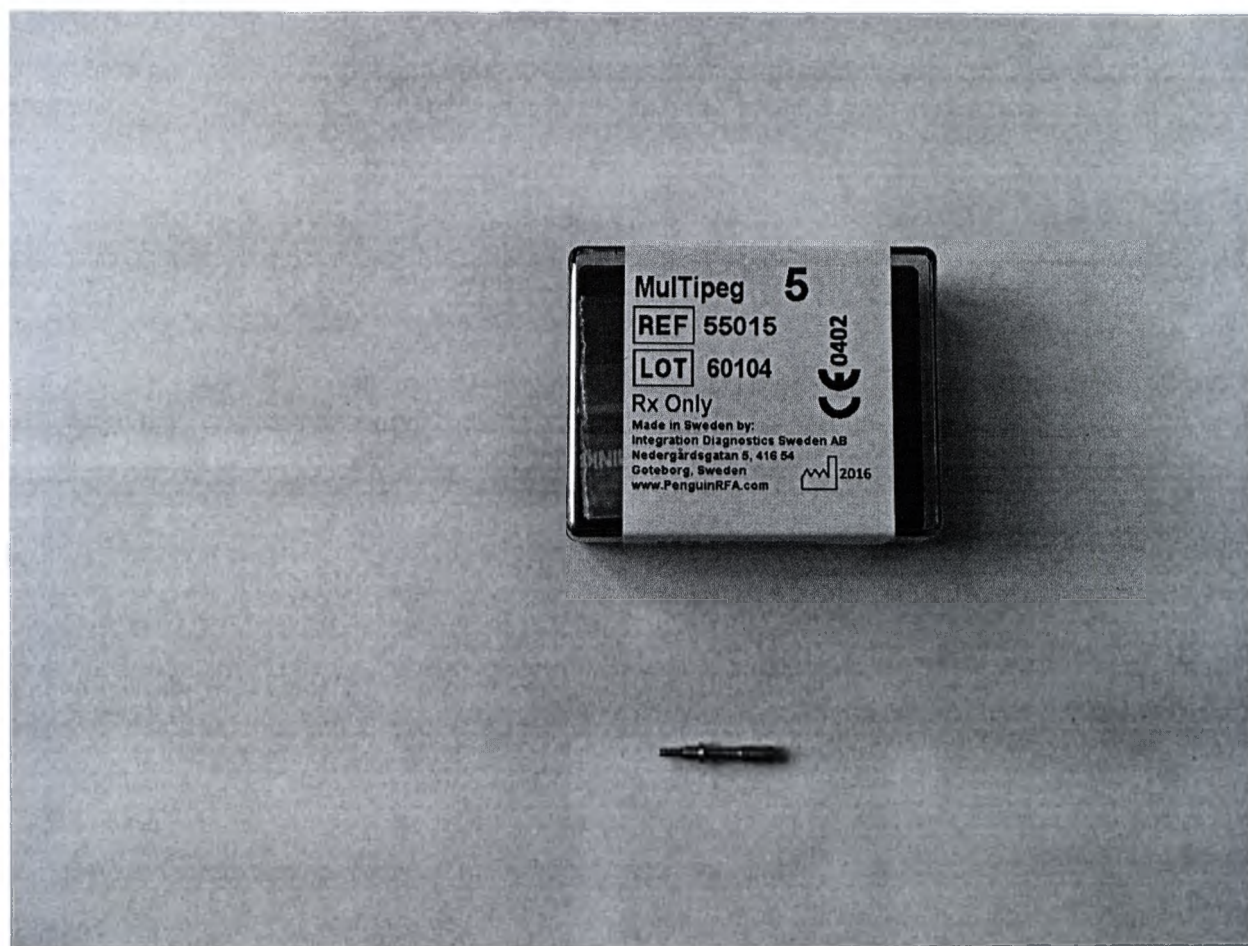


Рис. 9 Штифт MulTipeg 6

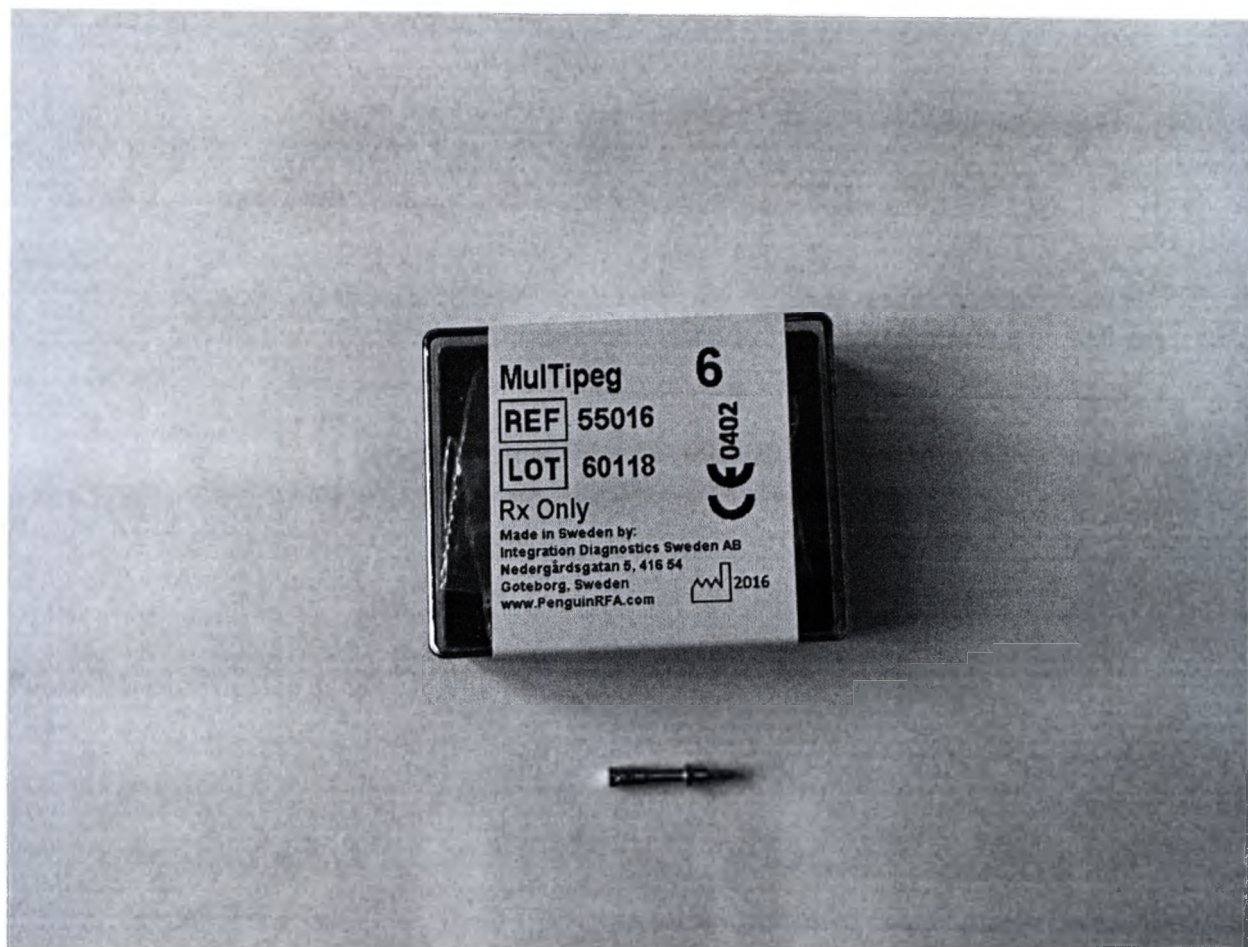


Рис. 10 Штифт MulTipeg 7



Рис. 11 Штифт MulTipeg 8

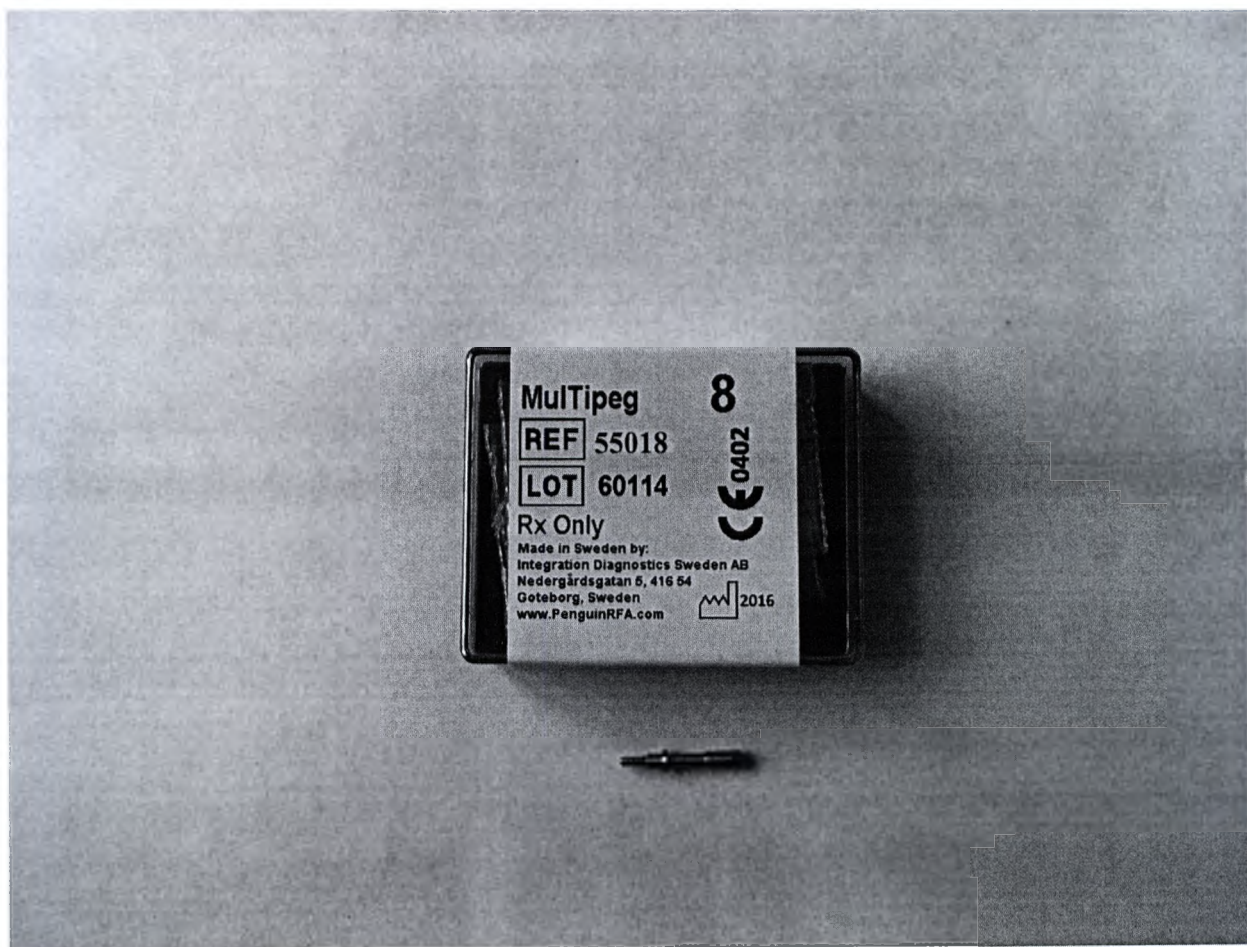


Рис. 12 Штифт MulTipeg 9



Рис. 13 Штифт MultiPeg 10

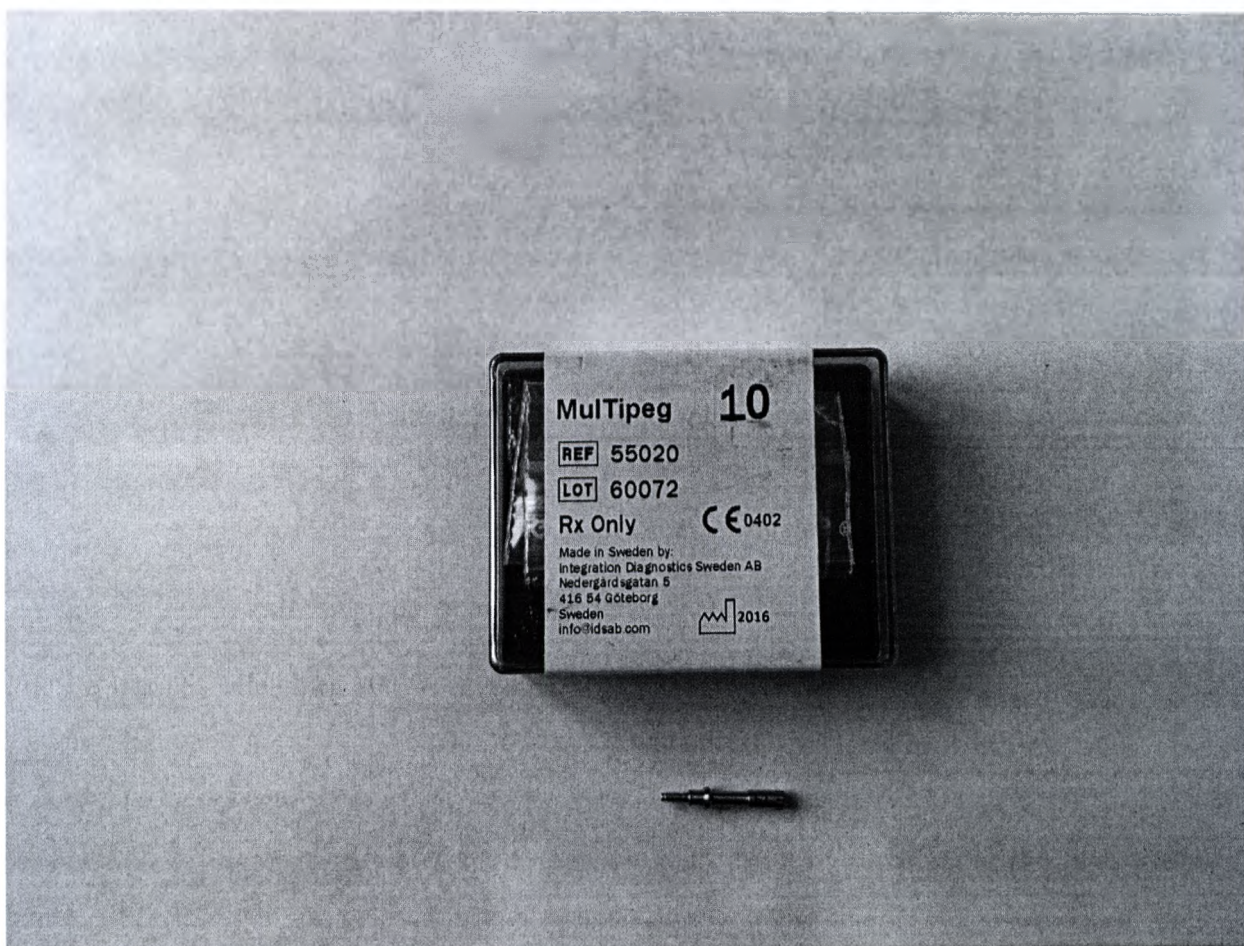


Рис. 14 Штифт MulTipeg 11



Рис. 15 Штифт MulTipeg 12

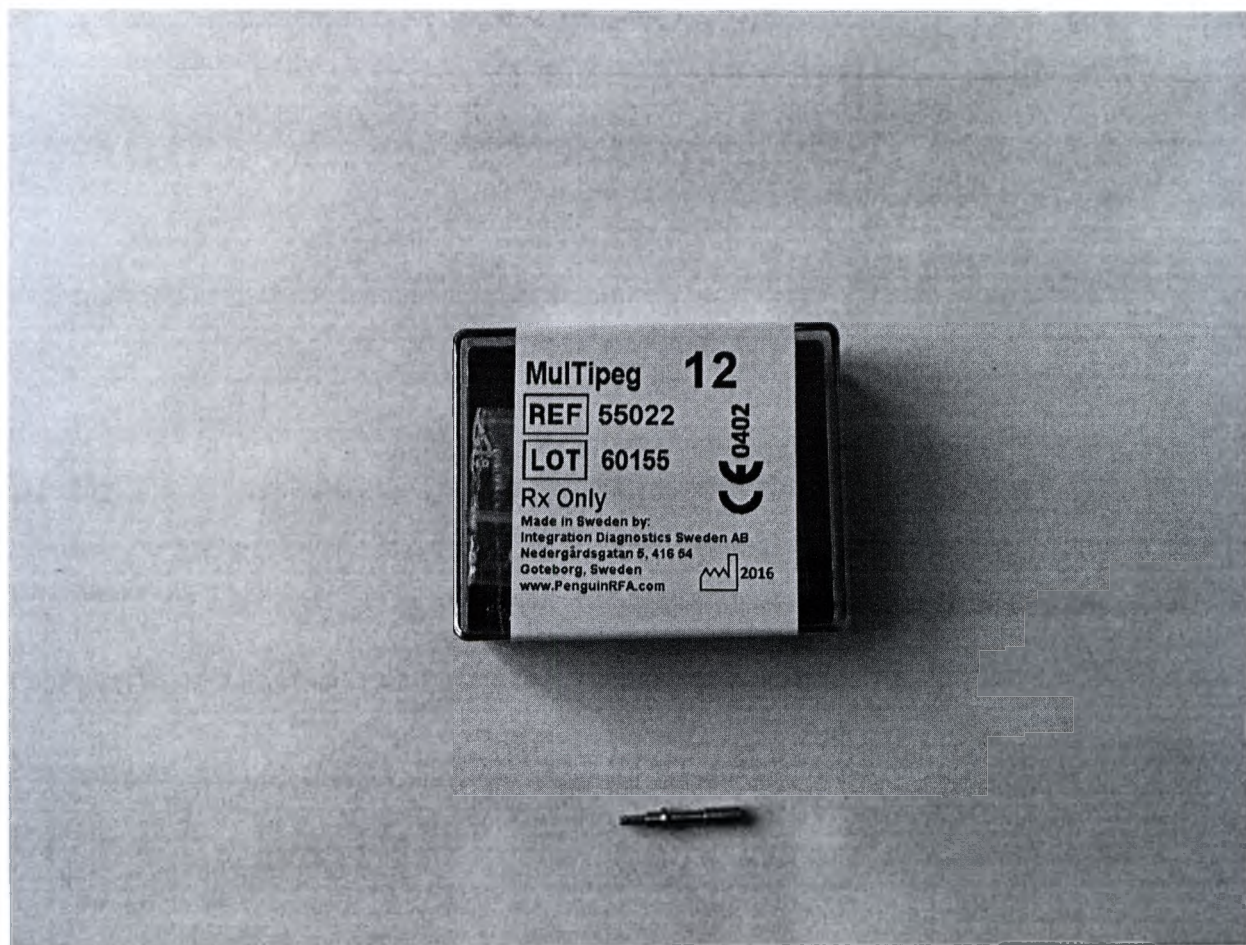


Рис. 16 Штифт Multipeg 13

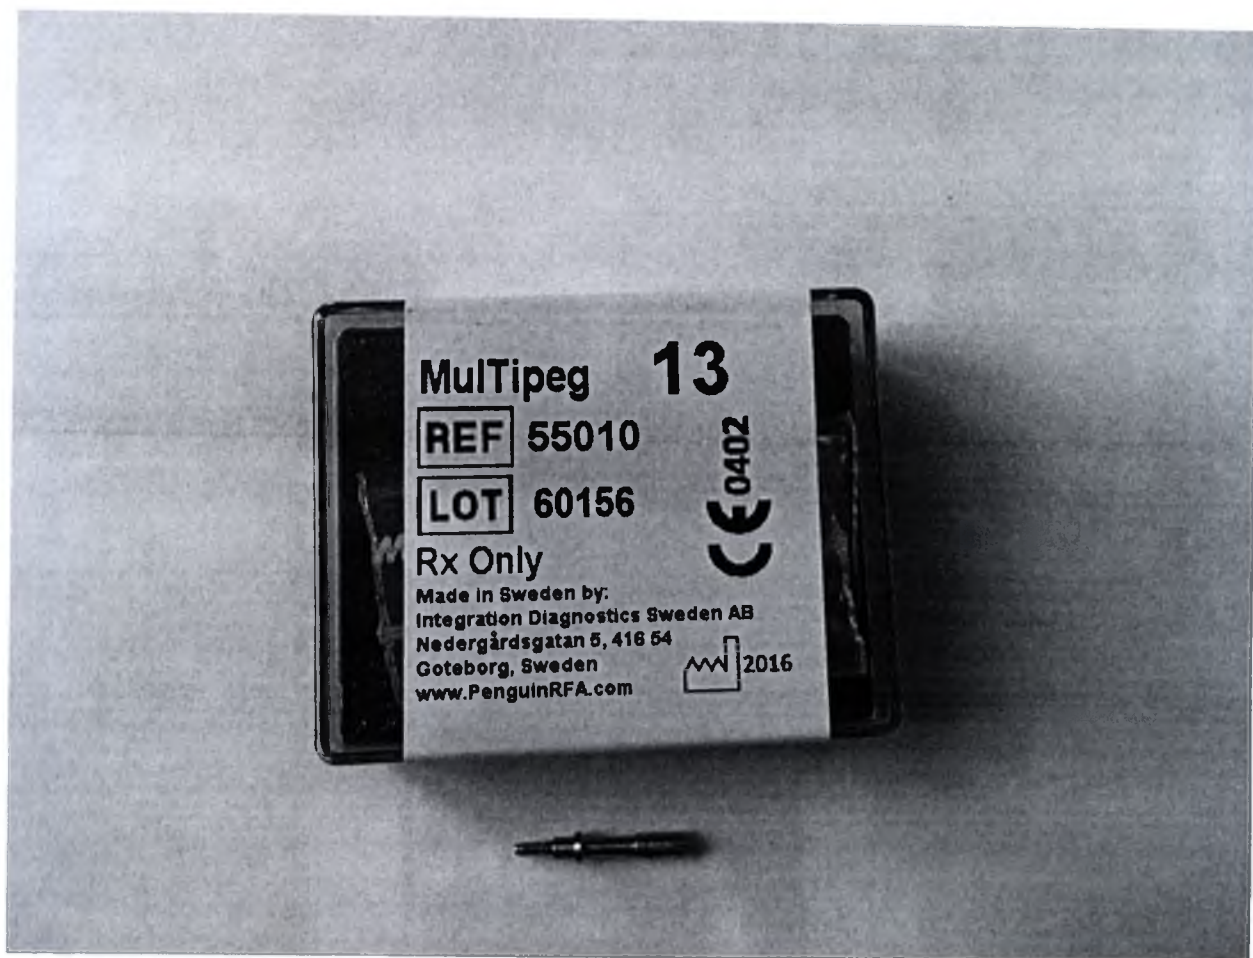


Рис. 17 Штифт MulTipeg 14

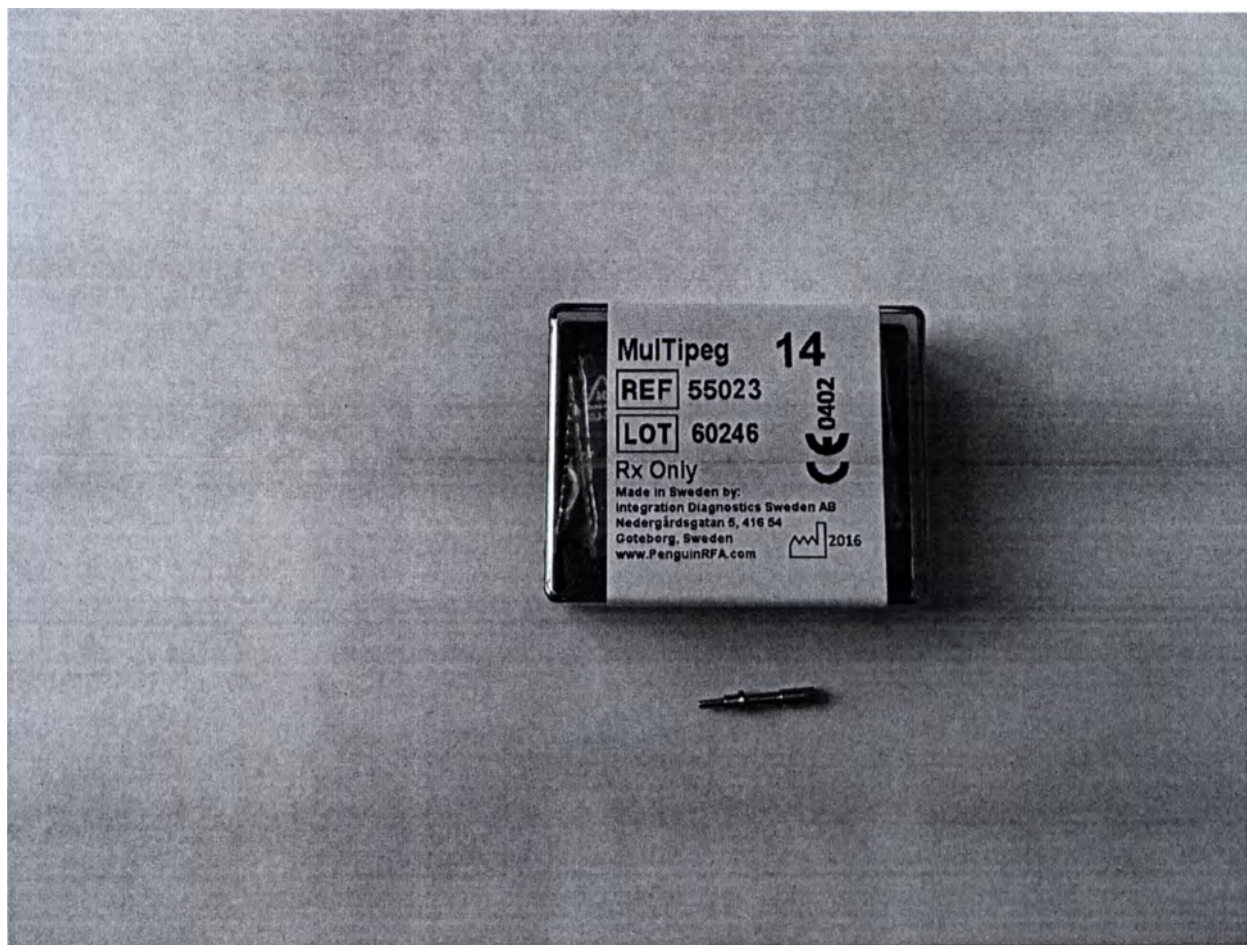


Рис. 18 Штифт MulTipeg 15

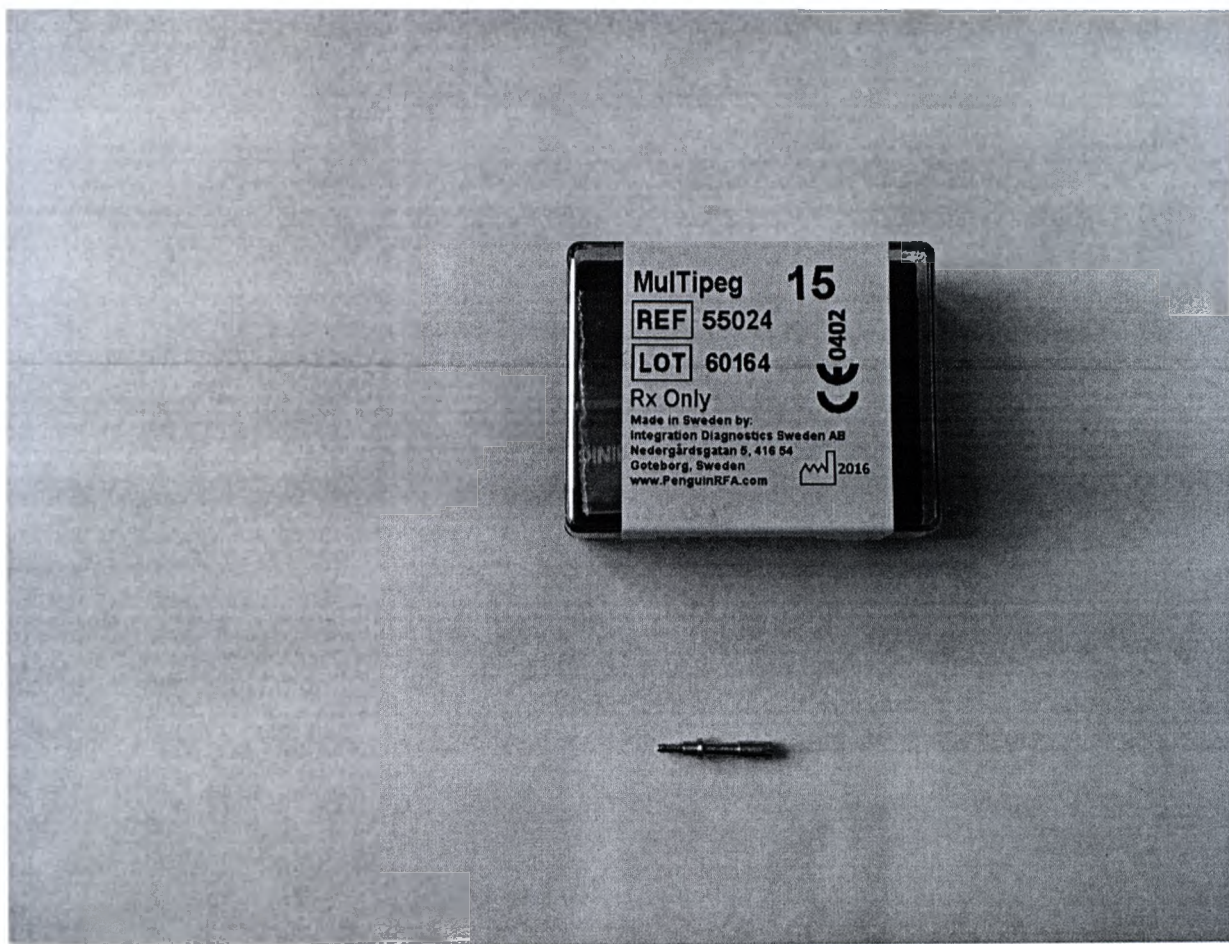


Рис. 19 Штифт MulTipeg 16



Рис. 20 Штифт MulTipeg 17

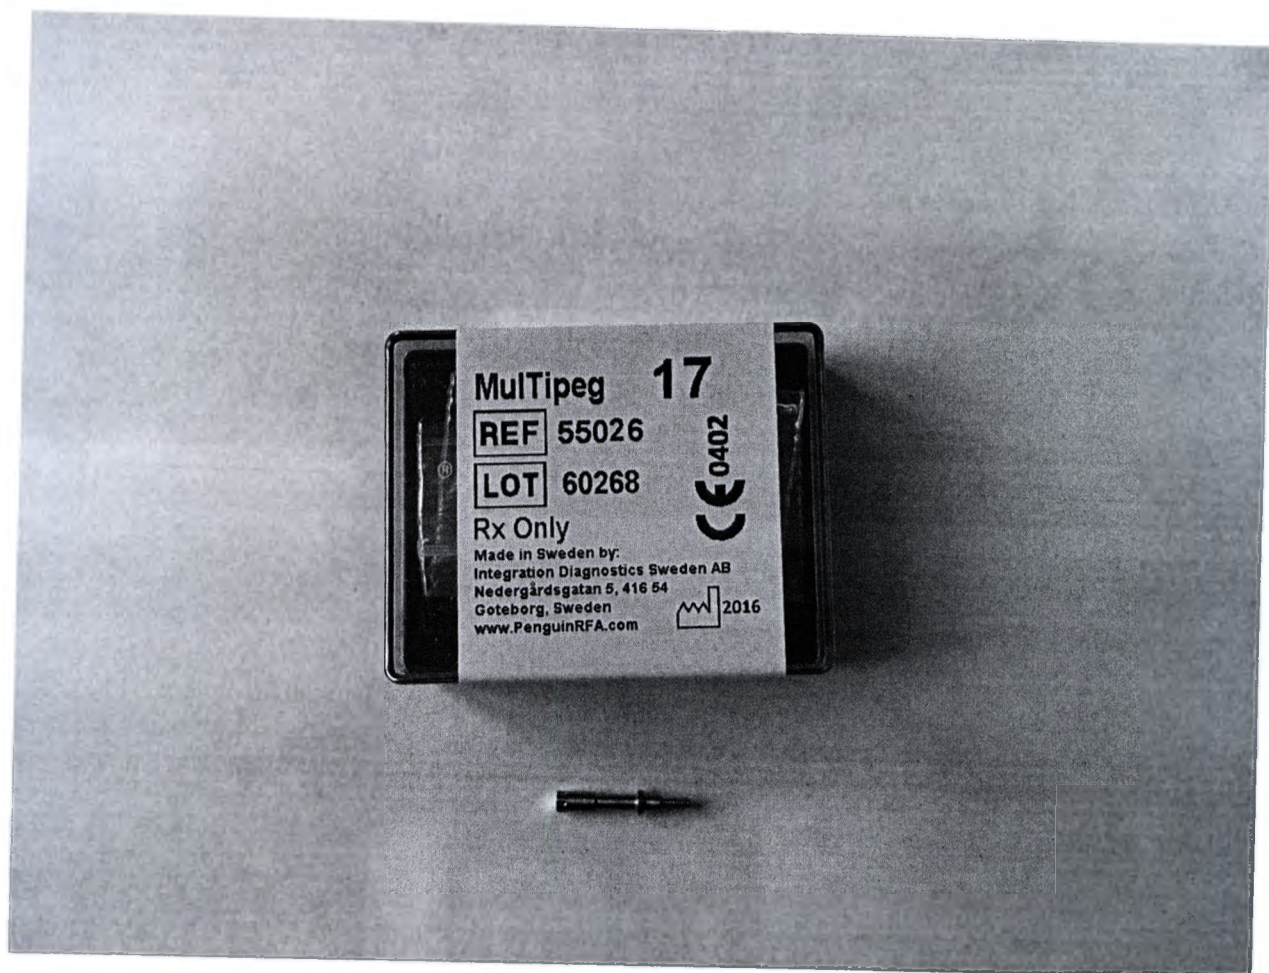


Рис. 21 Штифт MulTipeg 18



Рис. 22 Штифт MulTipeg 19

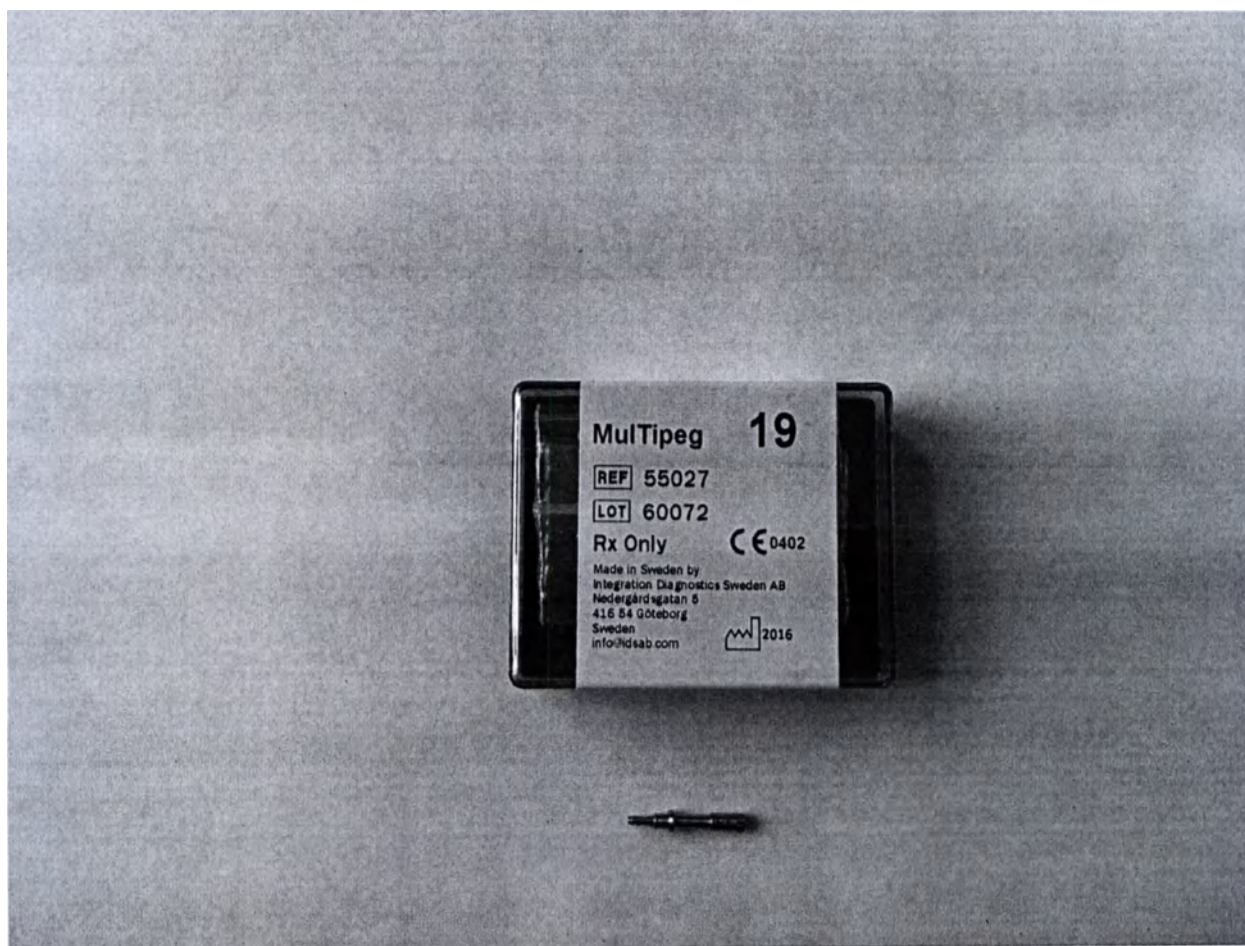


Рис. 23 Штифт MulTipeg 20

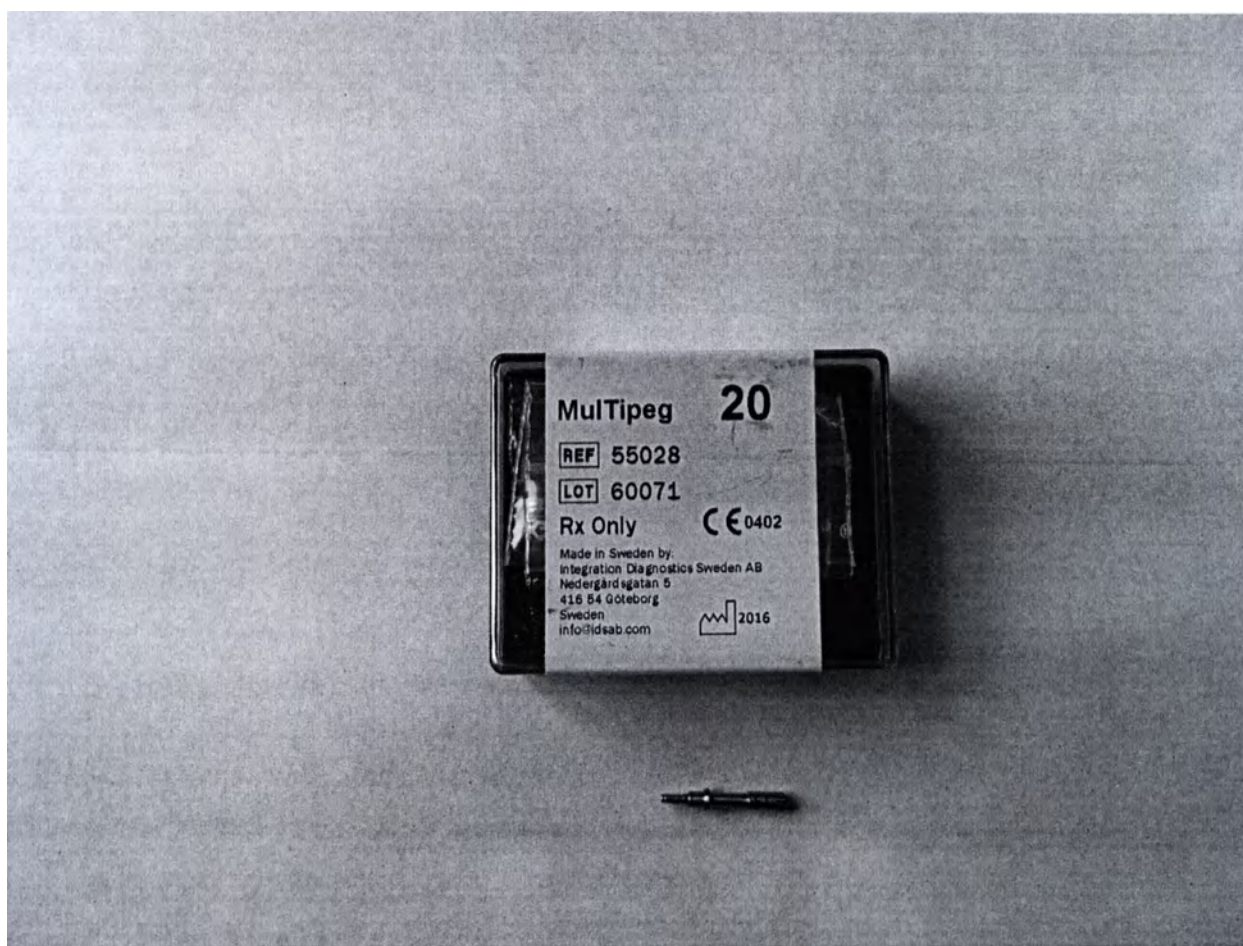


Рис. 24 Штифт MultiPeg 21



Рис. 25 Штифт MultiPeg 22

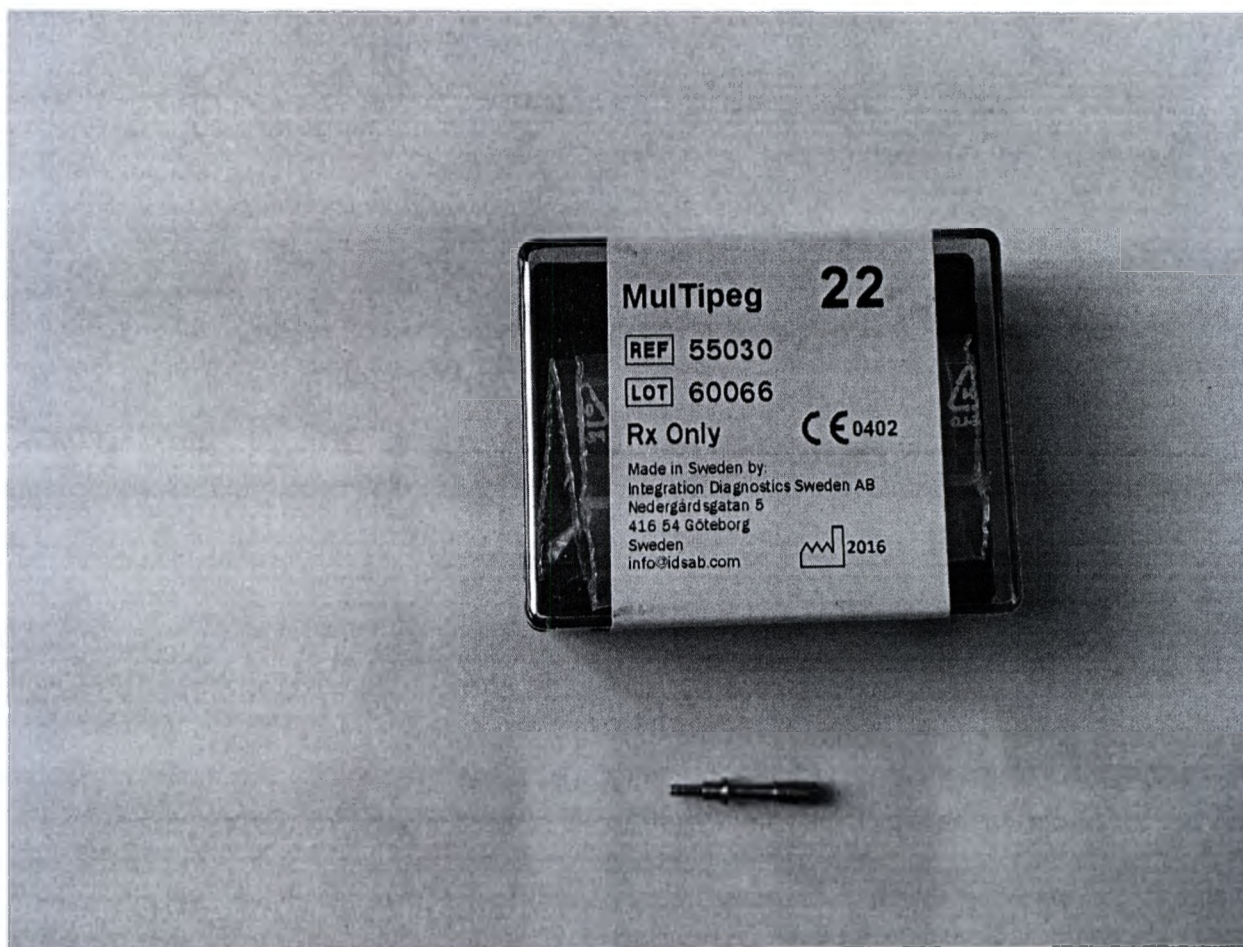


Рис. 26 Штифт MulTipeg 23



Рис. 27 Штифт MulTipeg 24

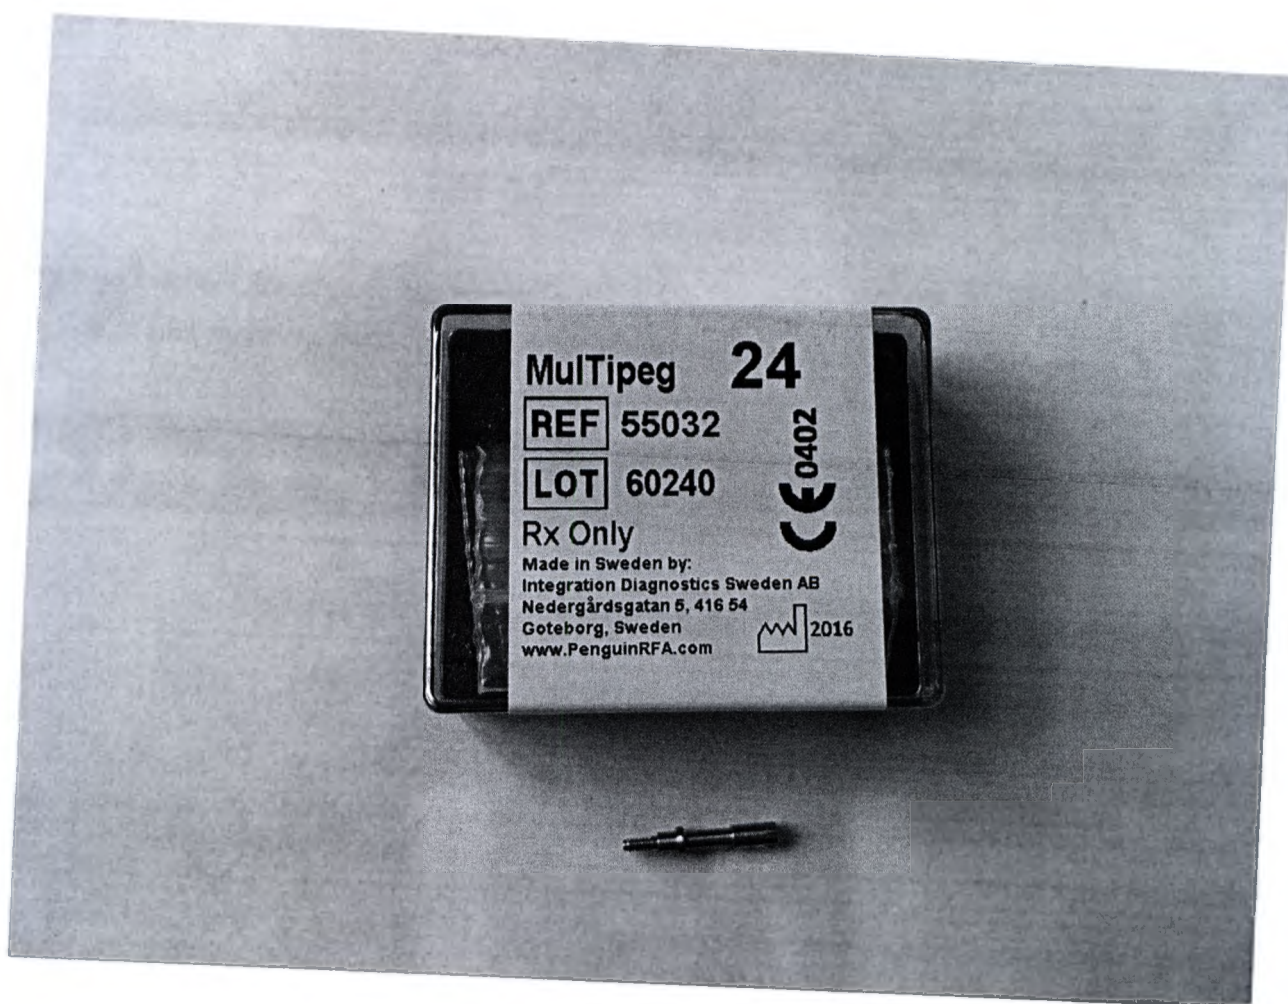


Рис. 28 Штифт MulTipeg 25

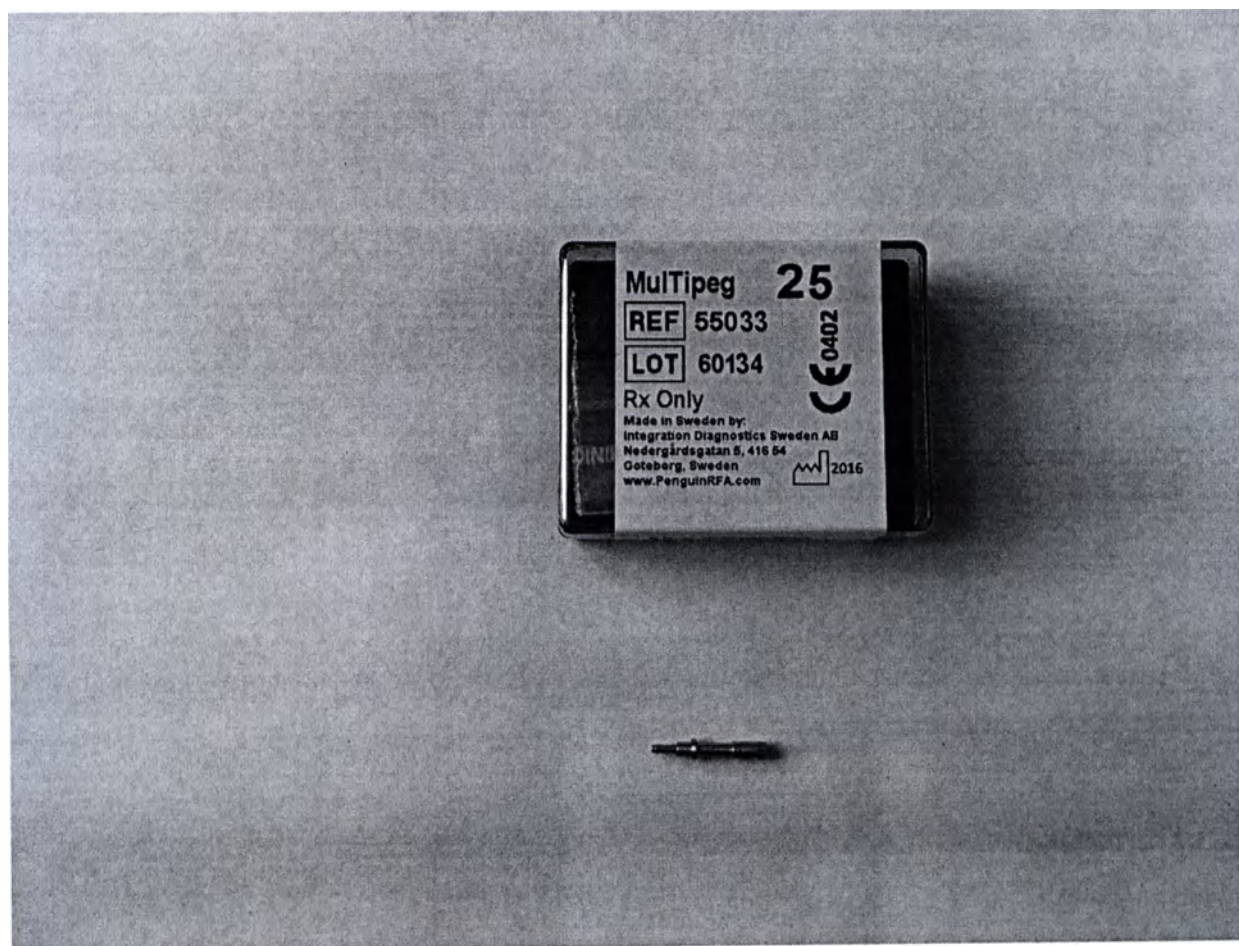


Рис. 29 Штифт MultiPeg 26

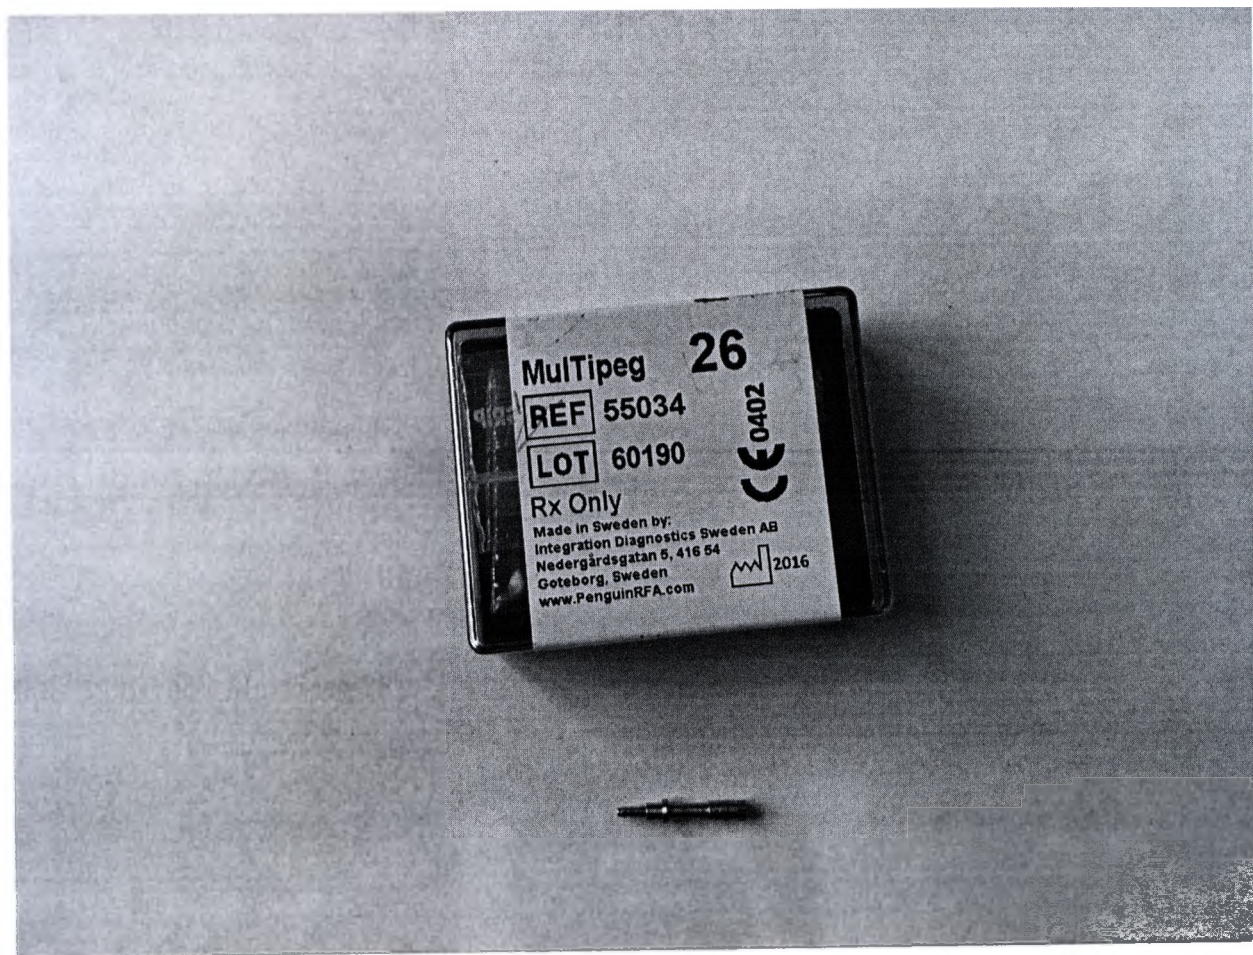


Рис. 30 Штифт MulTipeg 27

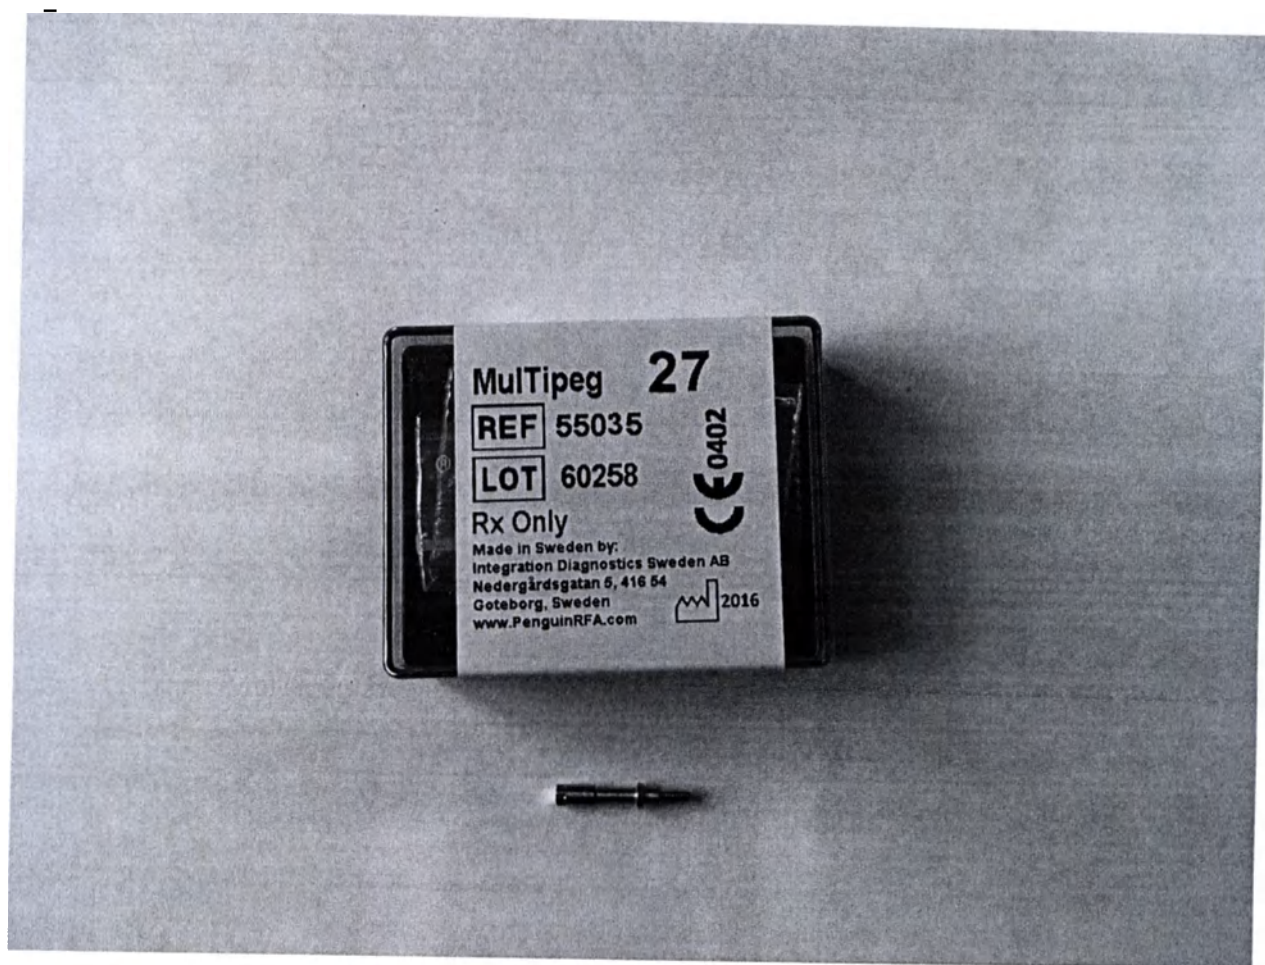


Рис. 31 Штифт MulTipeg 28



Рис. 32 Штифт MulTipeg 29



Рис. 33 Штифт MulTipeg 30

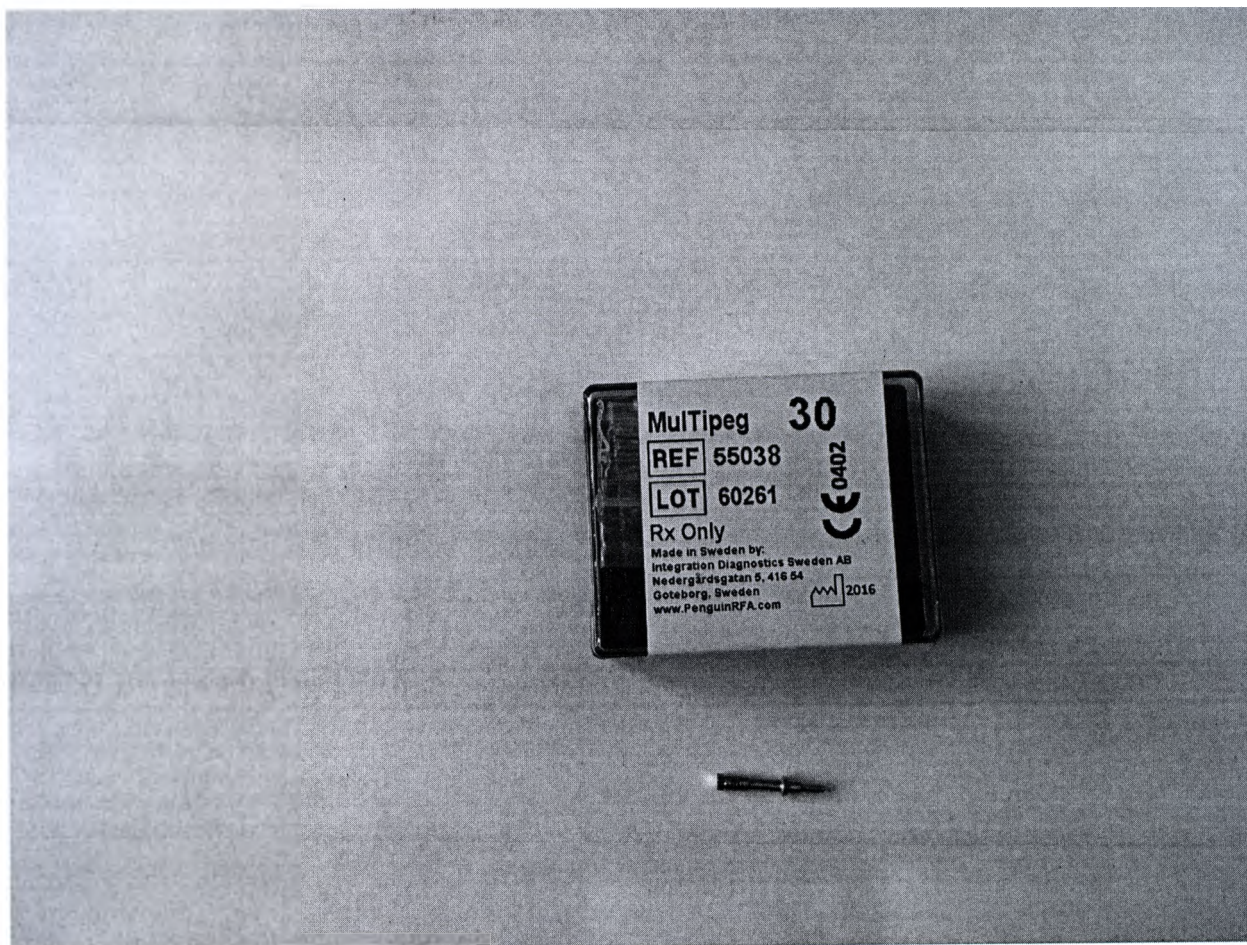


Рис. 34 Штифт MulTipeg 31



Рис. 35 Штифт MulTipeg 32

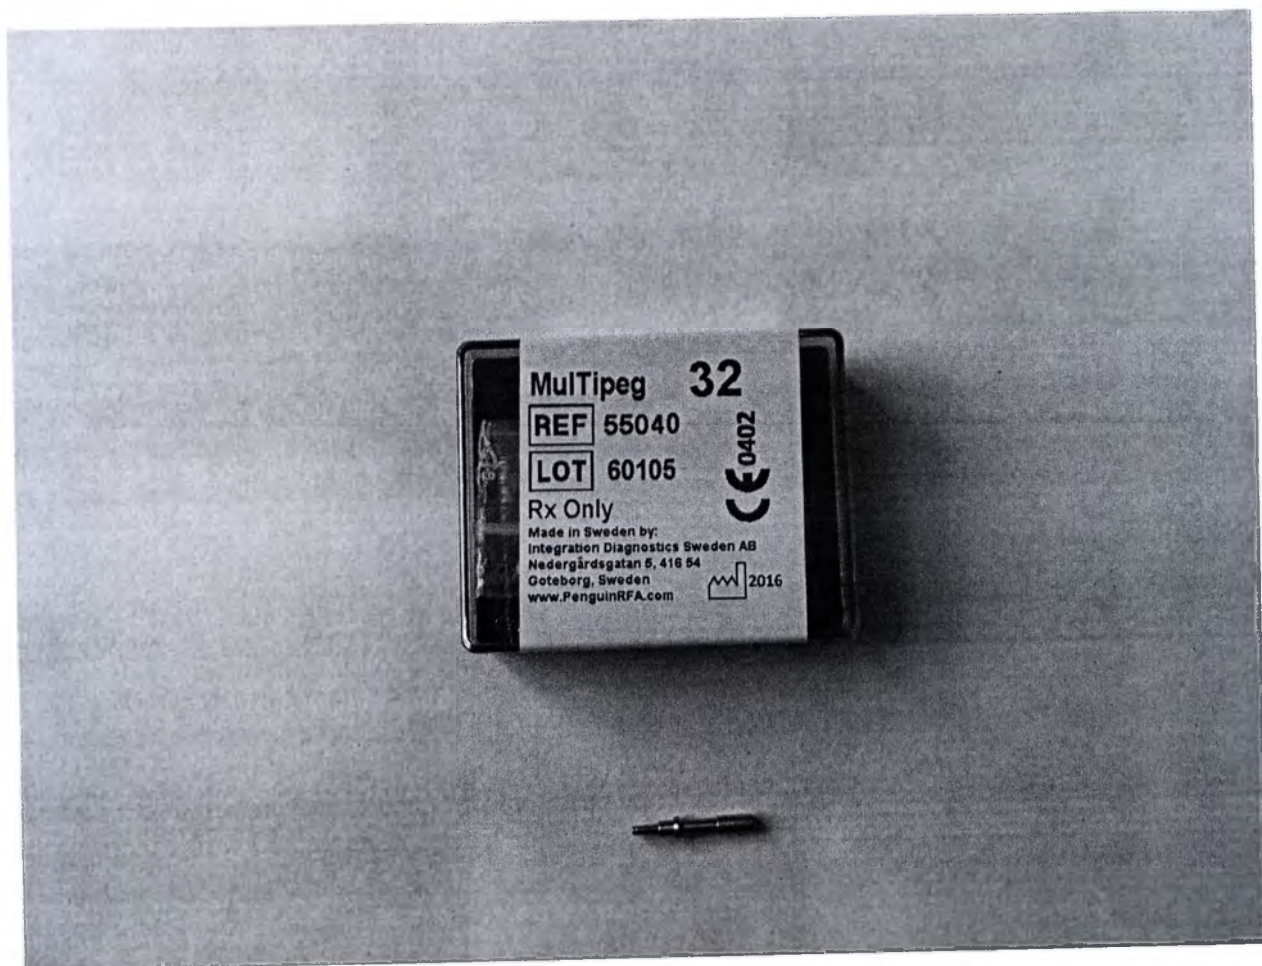


Рис. 36 Штифт MulTipeg 33

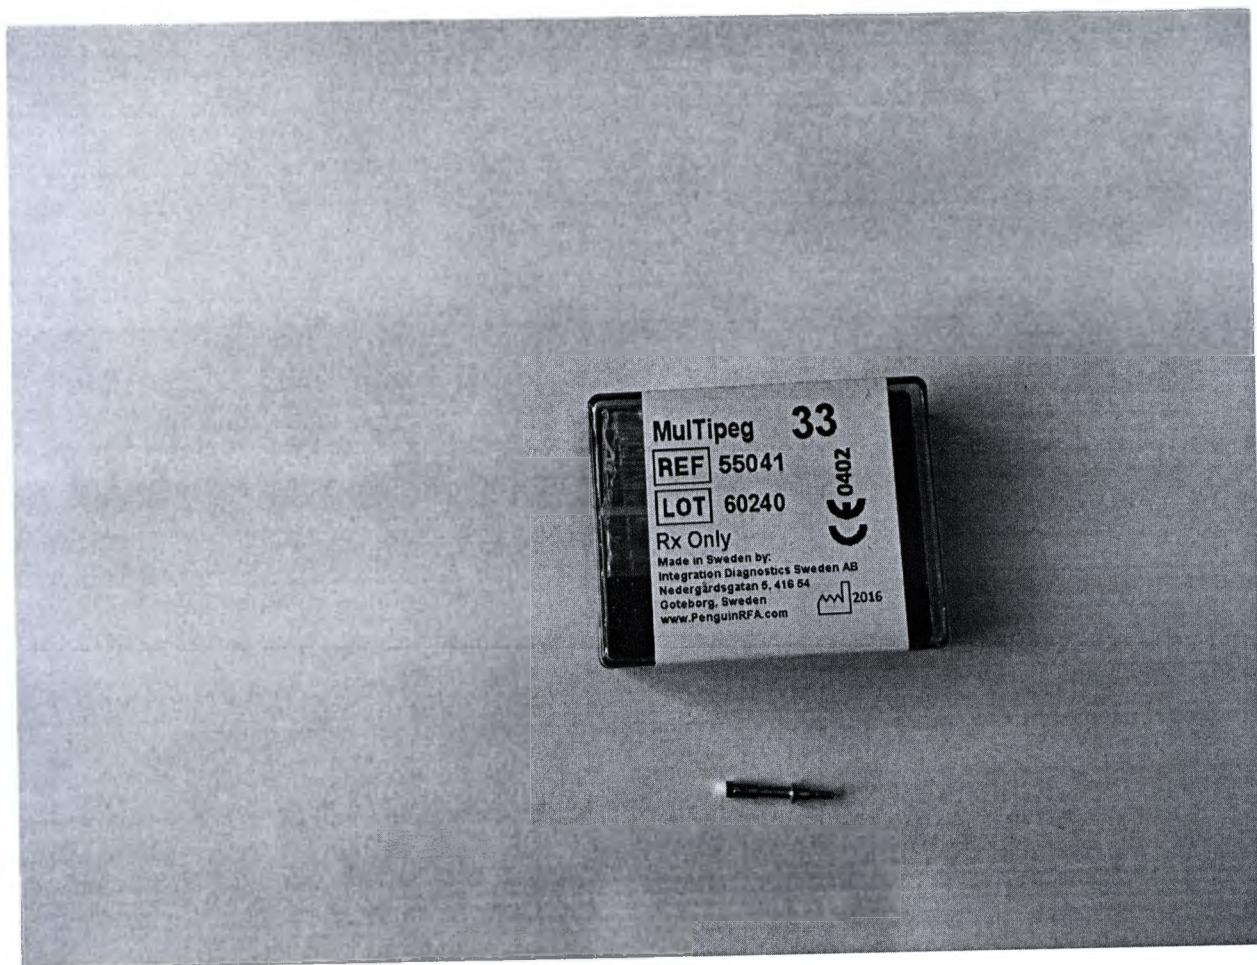


Рис. 37 Штифт MulTipeg 34



Рис. 38 Штифт MulTipeg 35

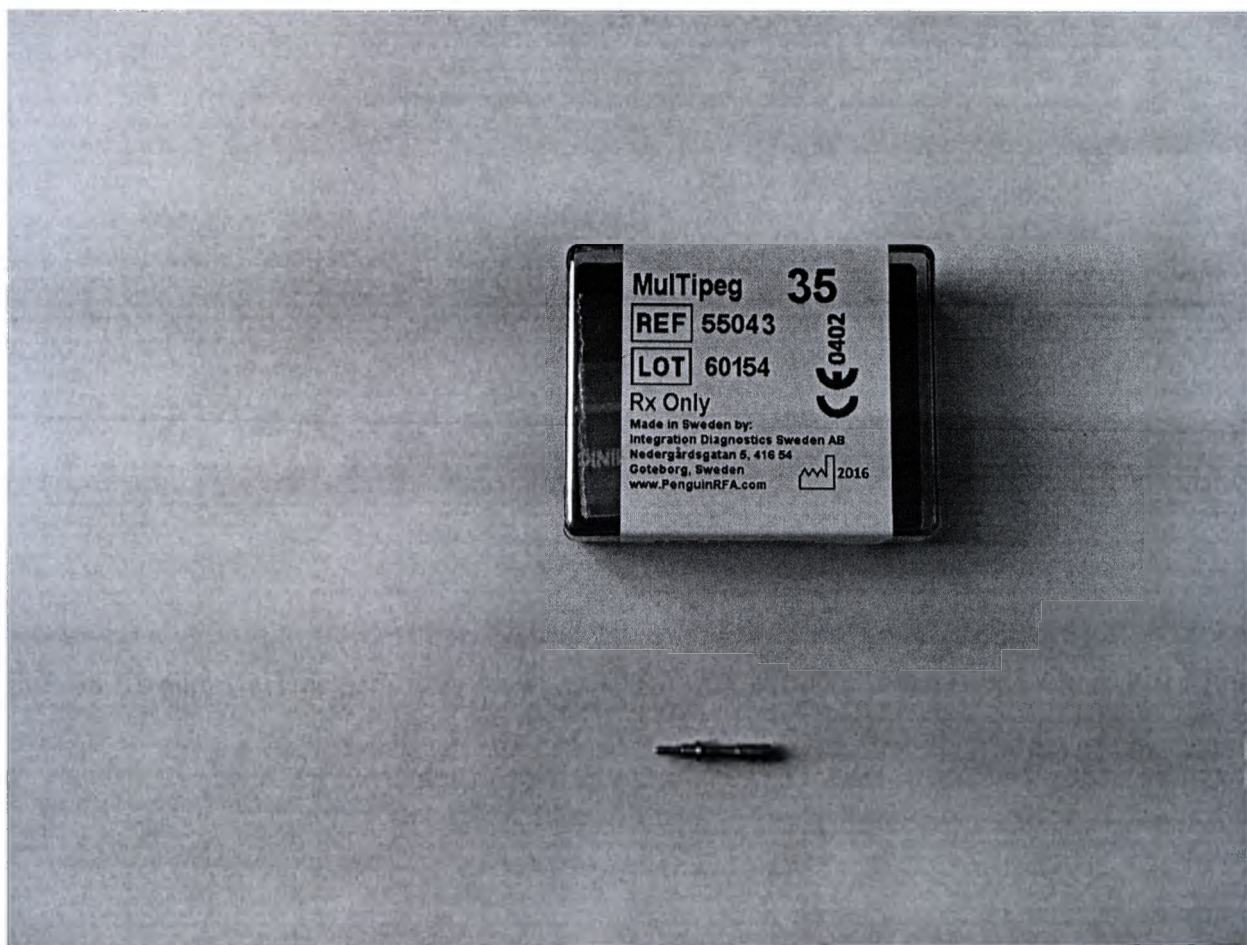


Рис. 39 Штифт MulTipeg 36

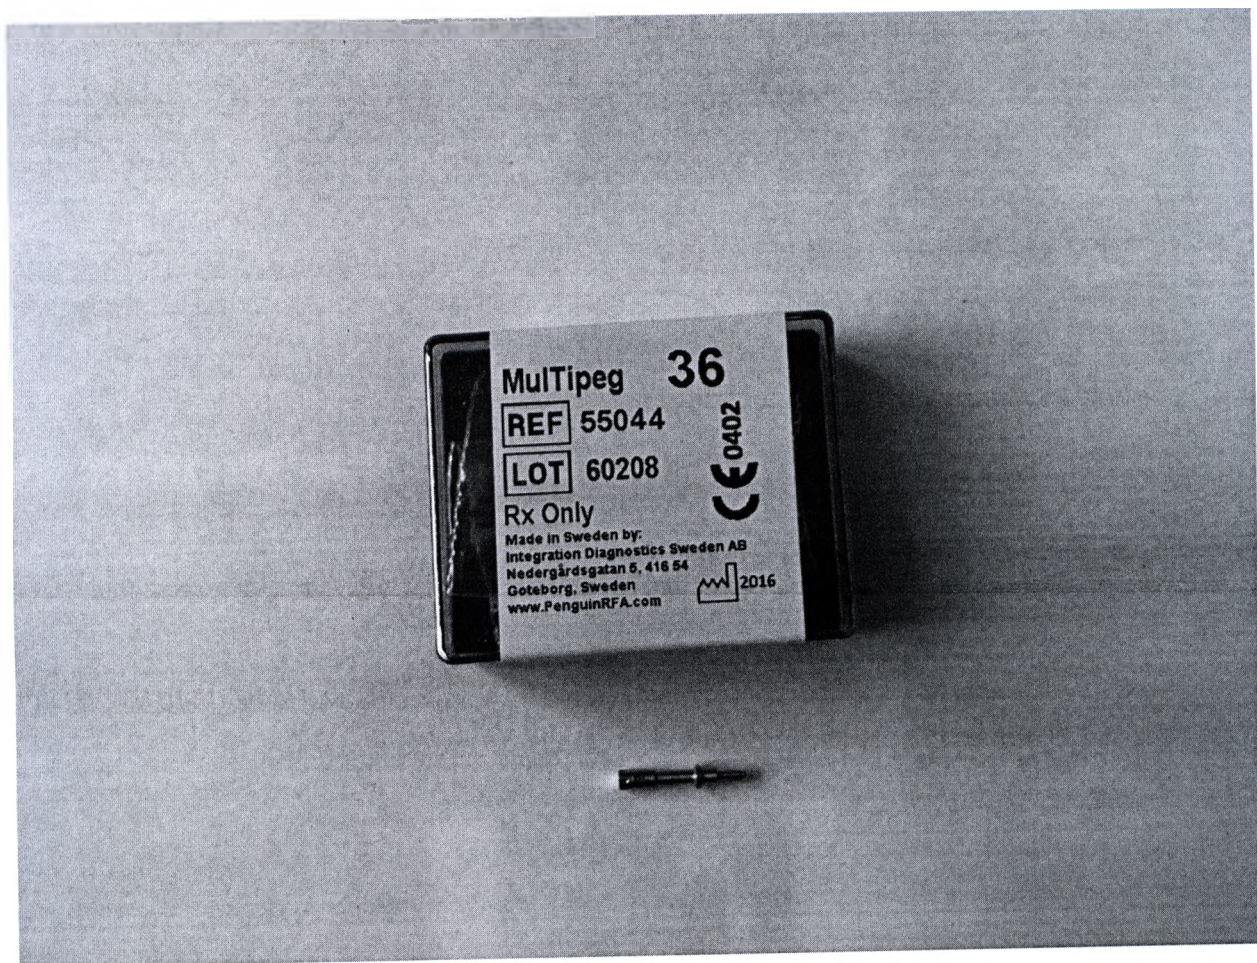


Рис. 40 Штифт MulTipeg 37



Рис. 41 Штифт MulTipeg 38

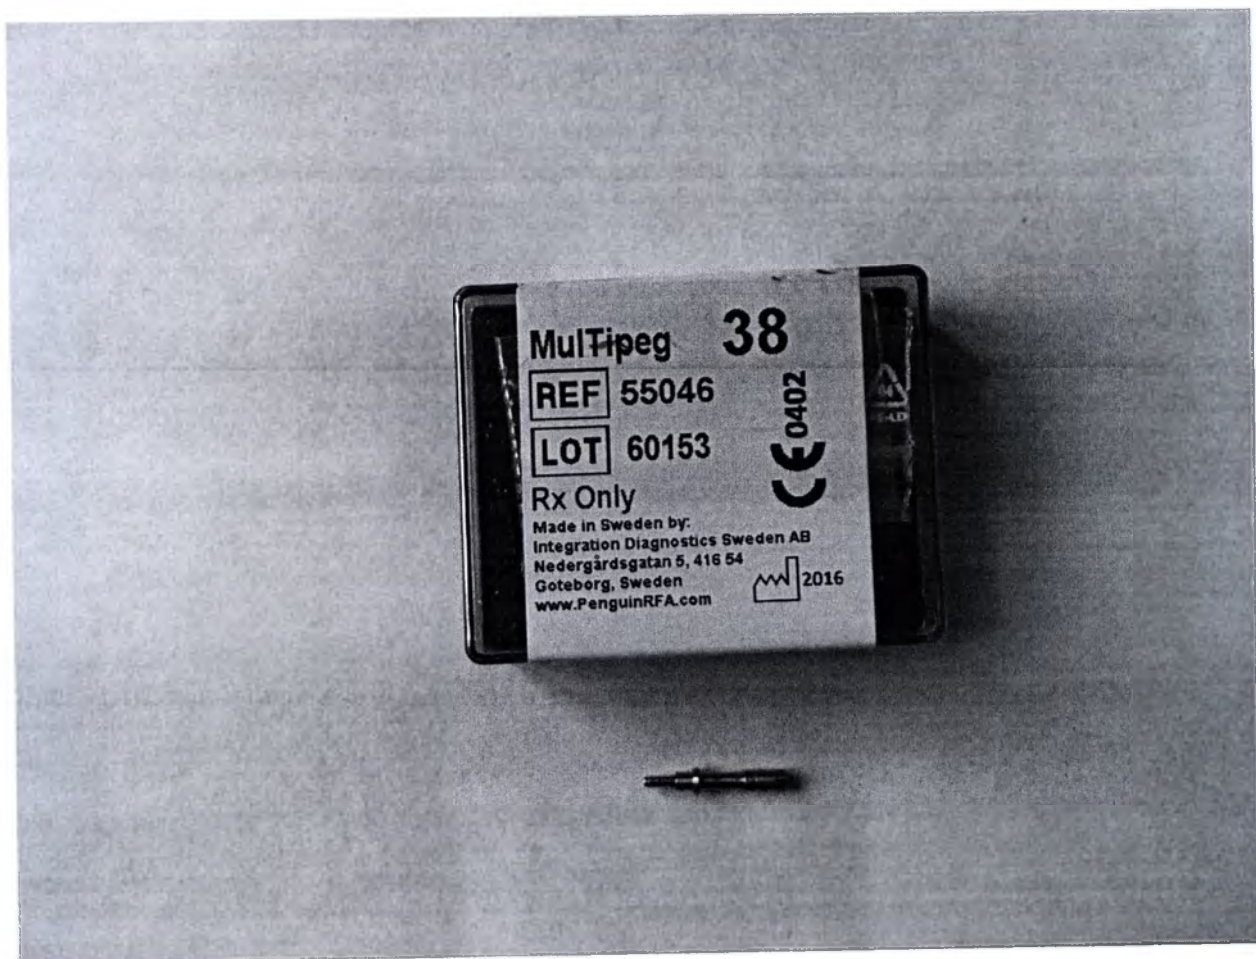


Рис. 42 Штифт MulTipeg 39

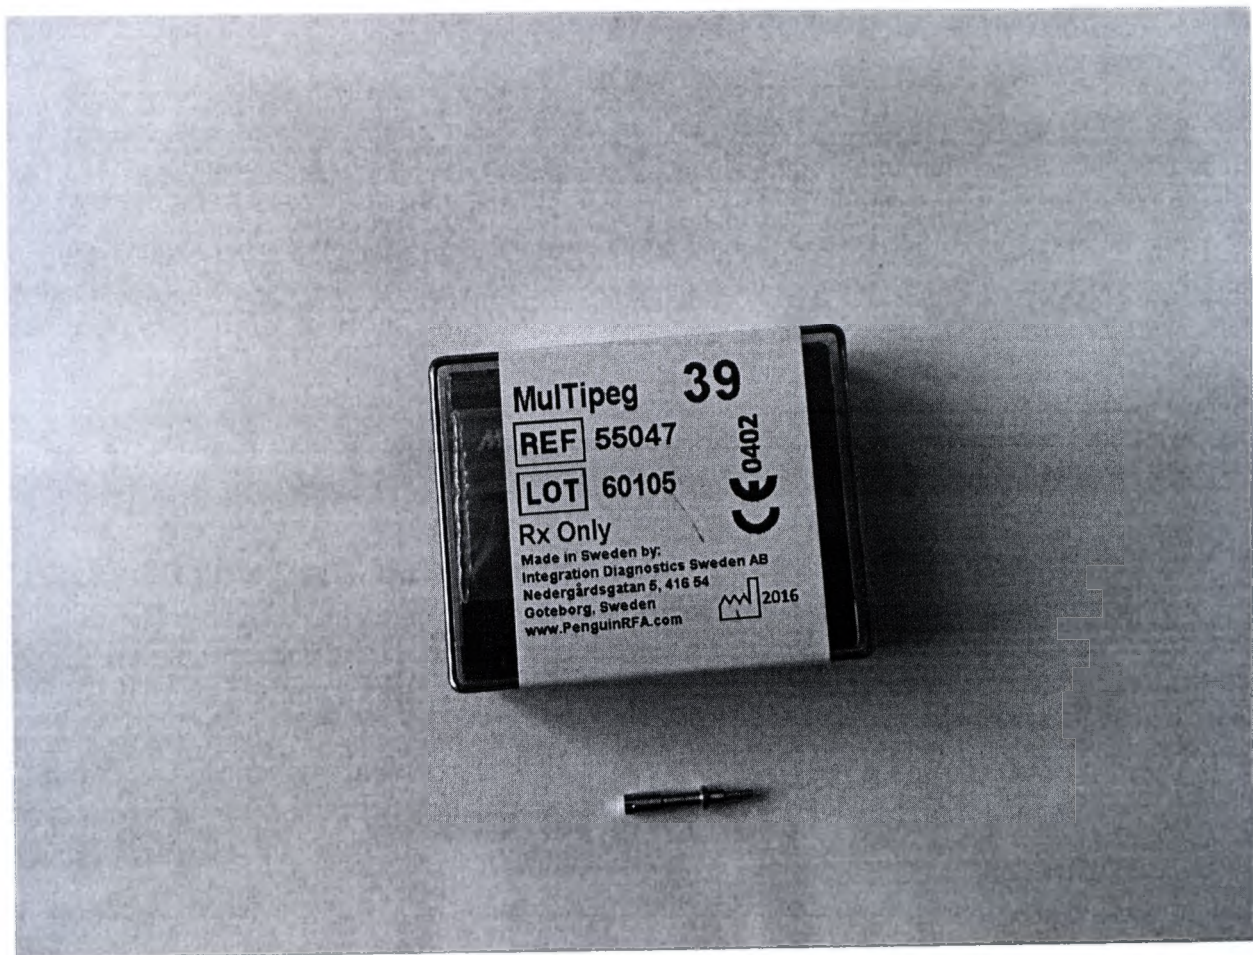


Рис. 43 Штифт MulTipeg 40

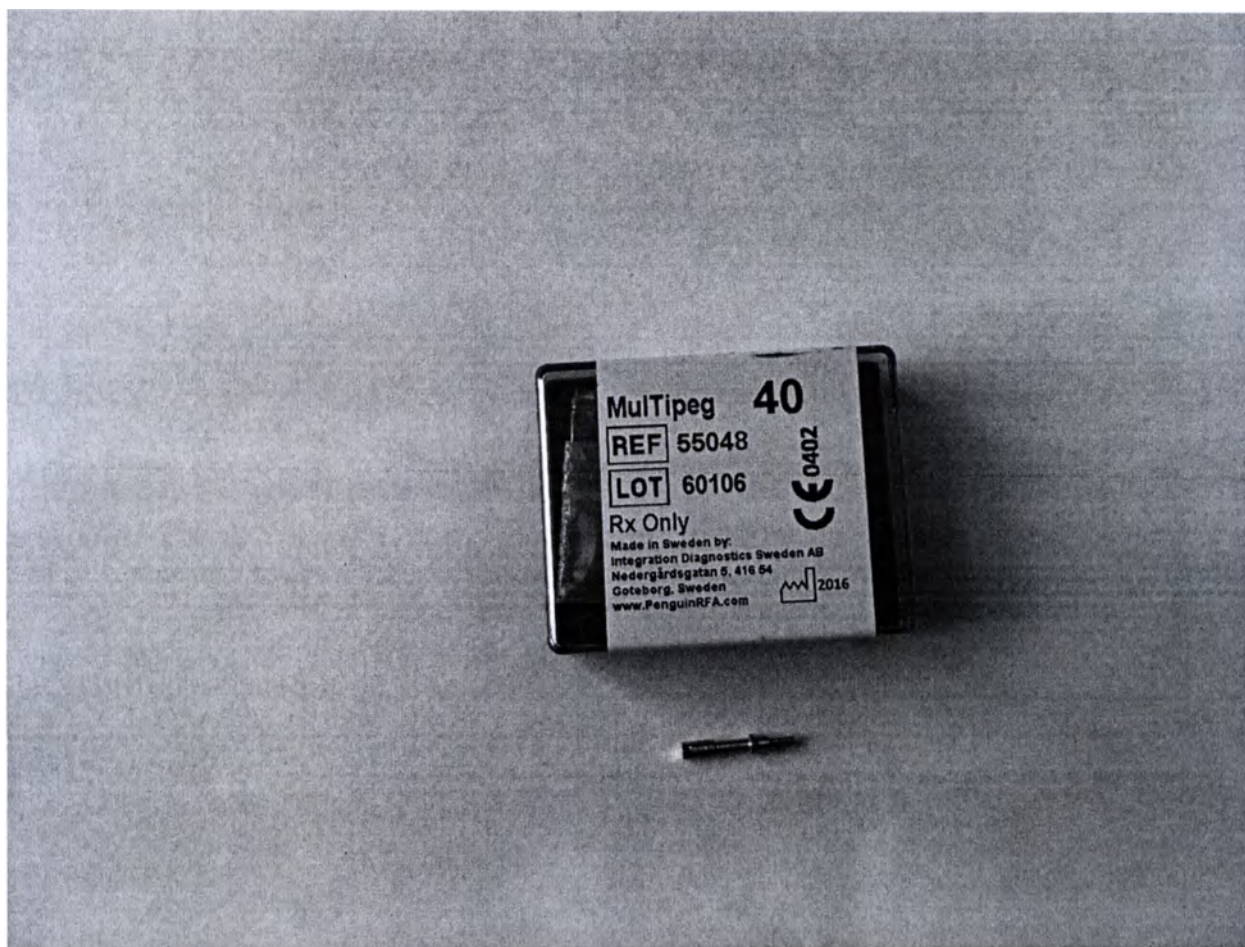


Рис. 44 Штифт MultiPeg 41

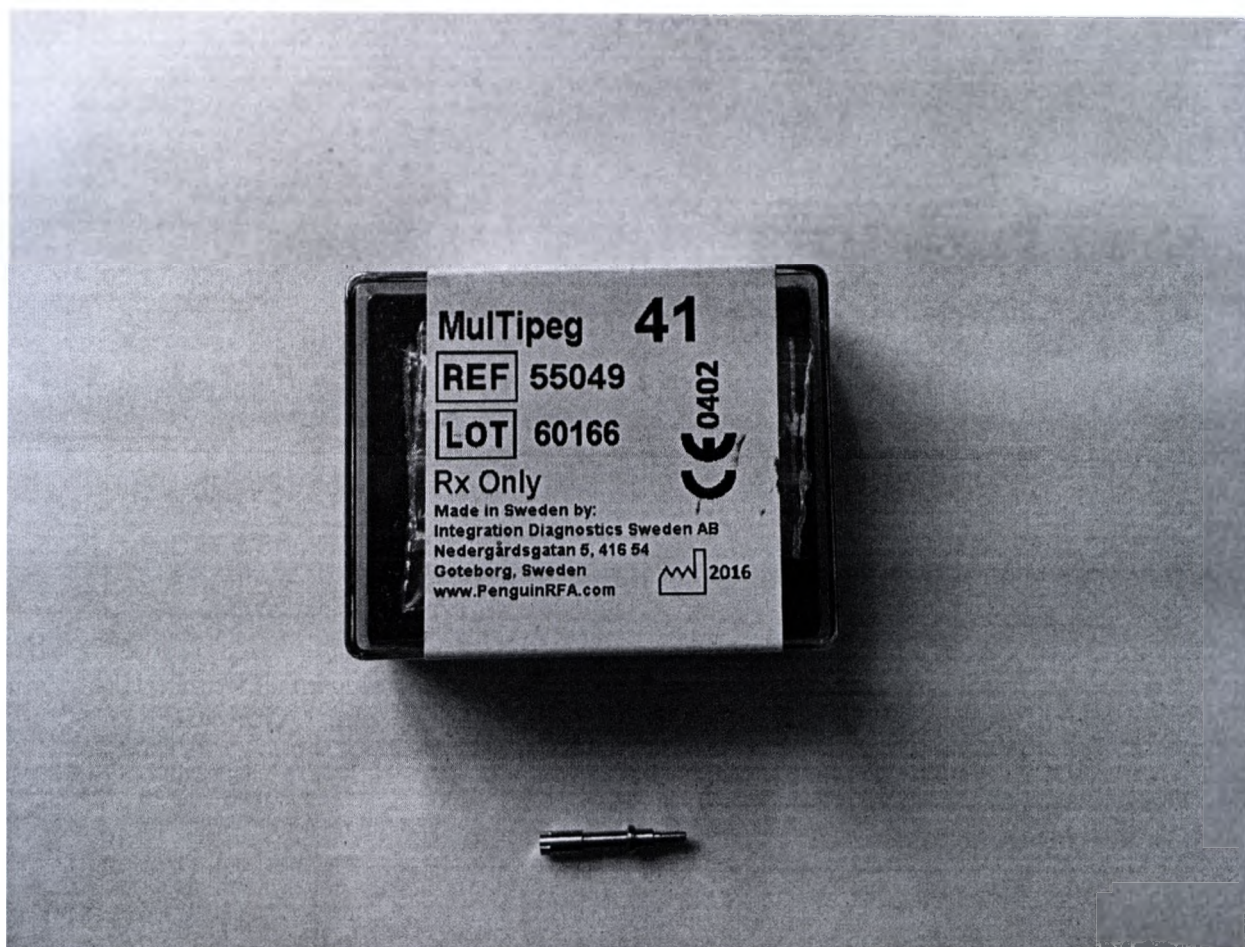


Рис. 45 Штифт MultiPeg 42

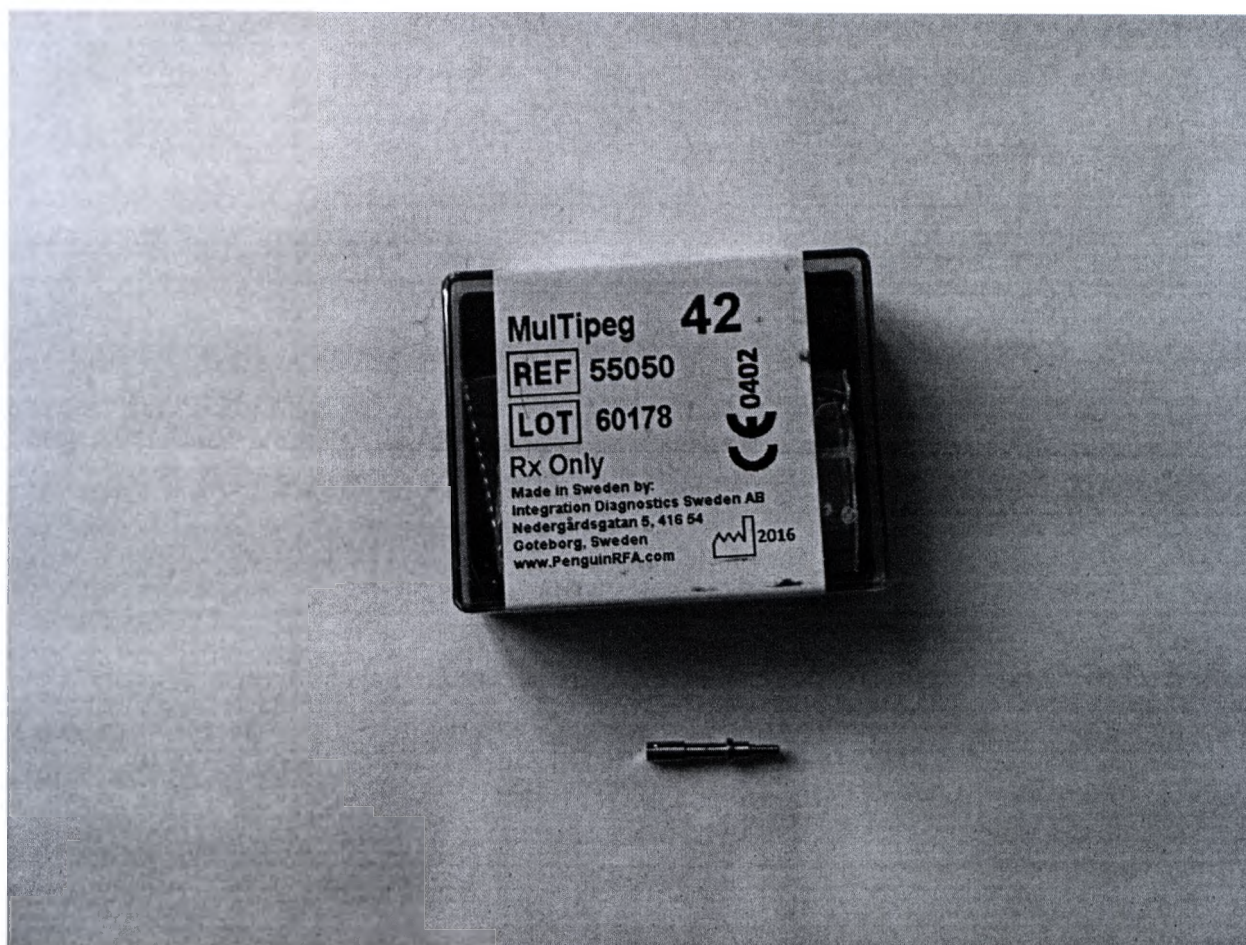


Рис. 46 Штифт MulTipeg 43

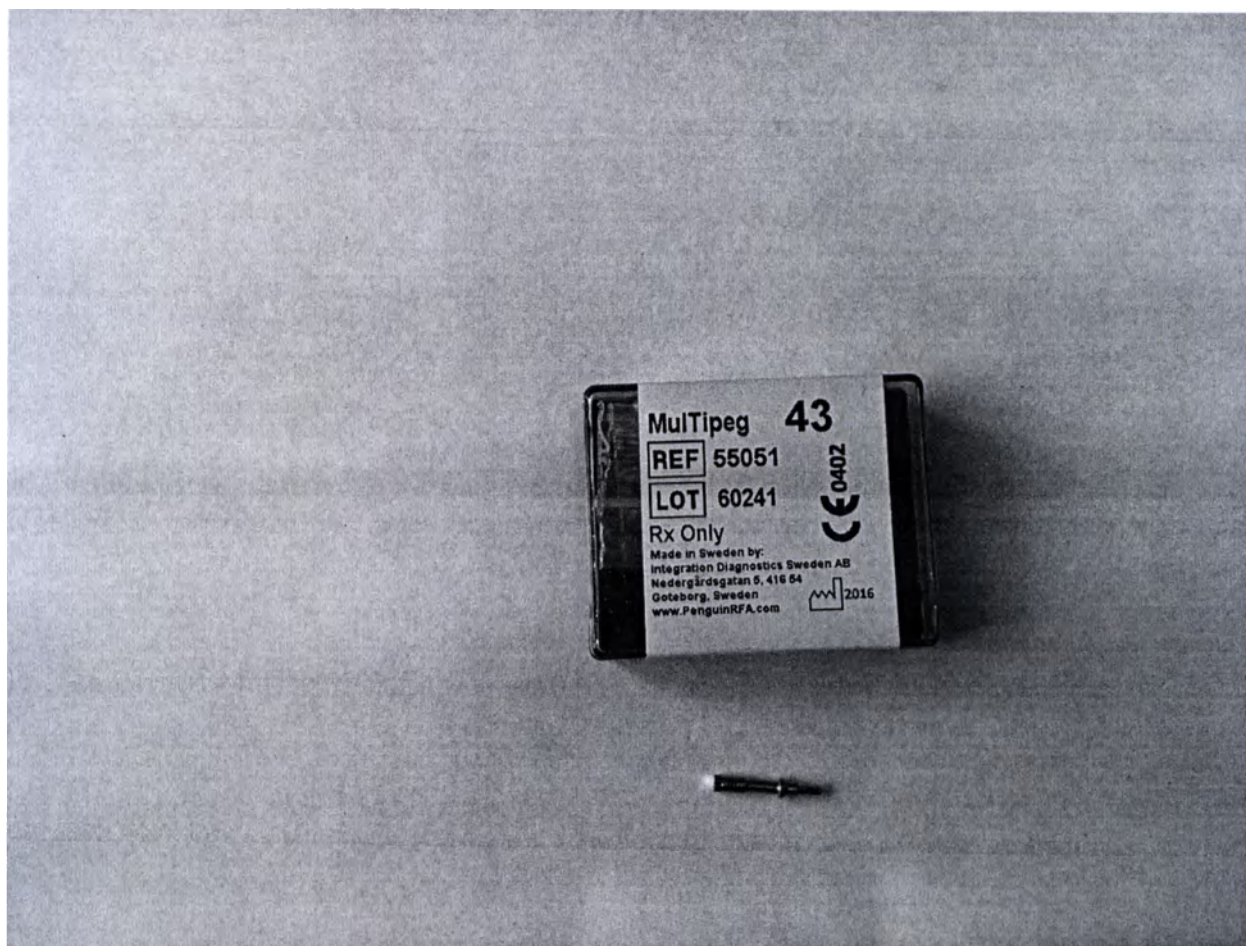


Рис. 47 Штифт MulTipeg 44

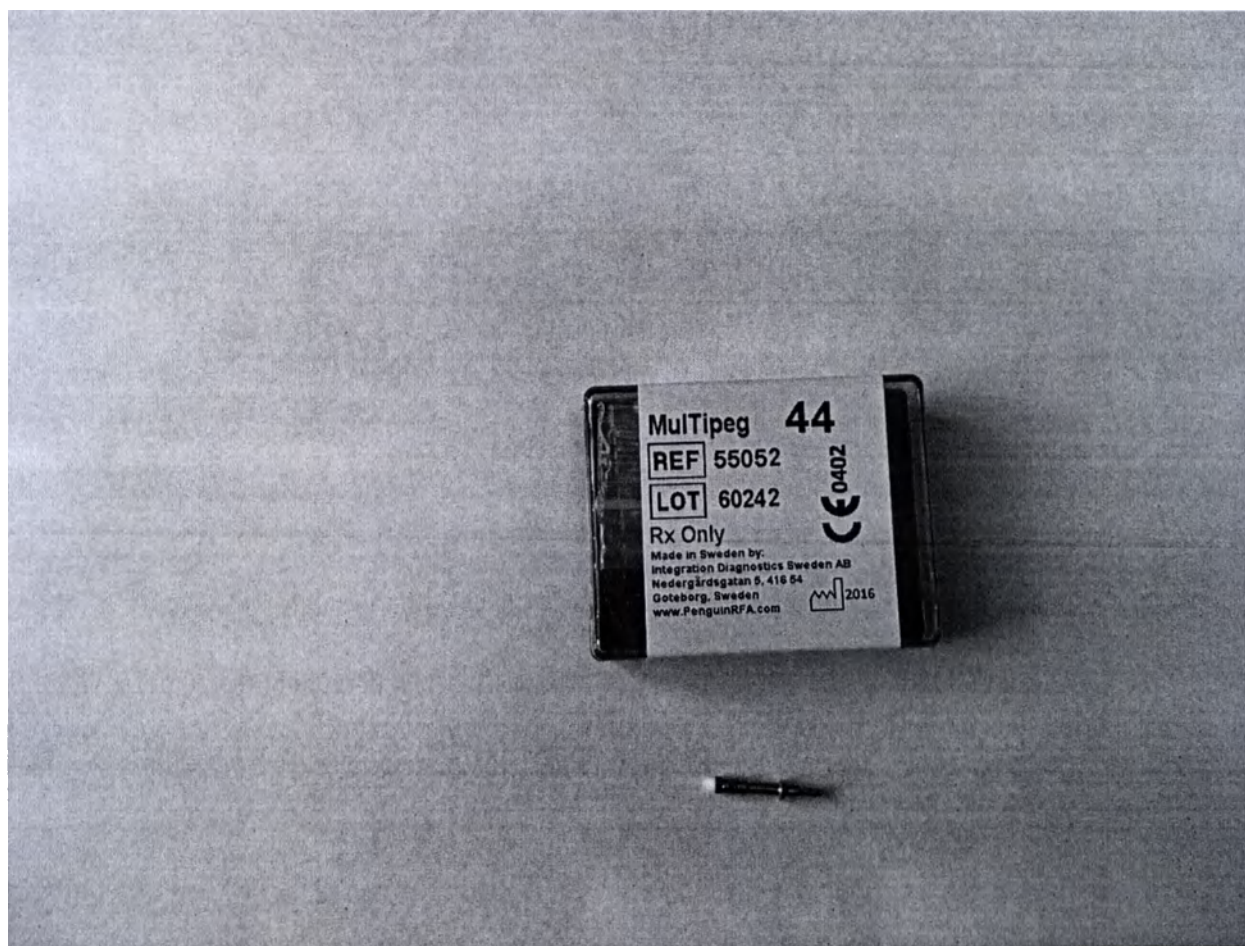


Рис. 48 Штифт MulTipeg 45

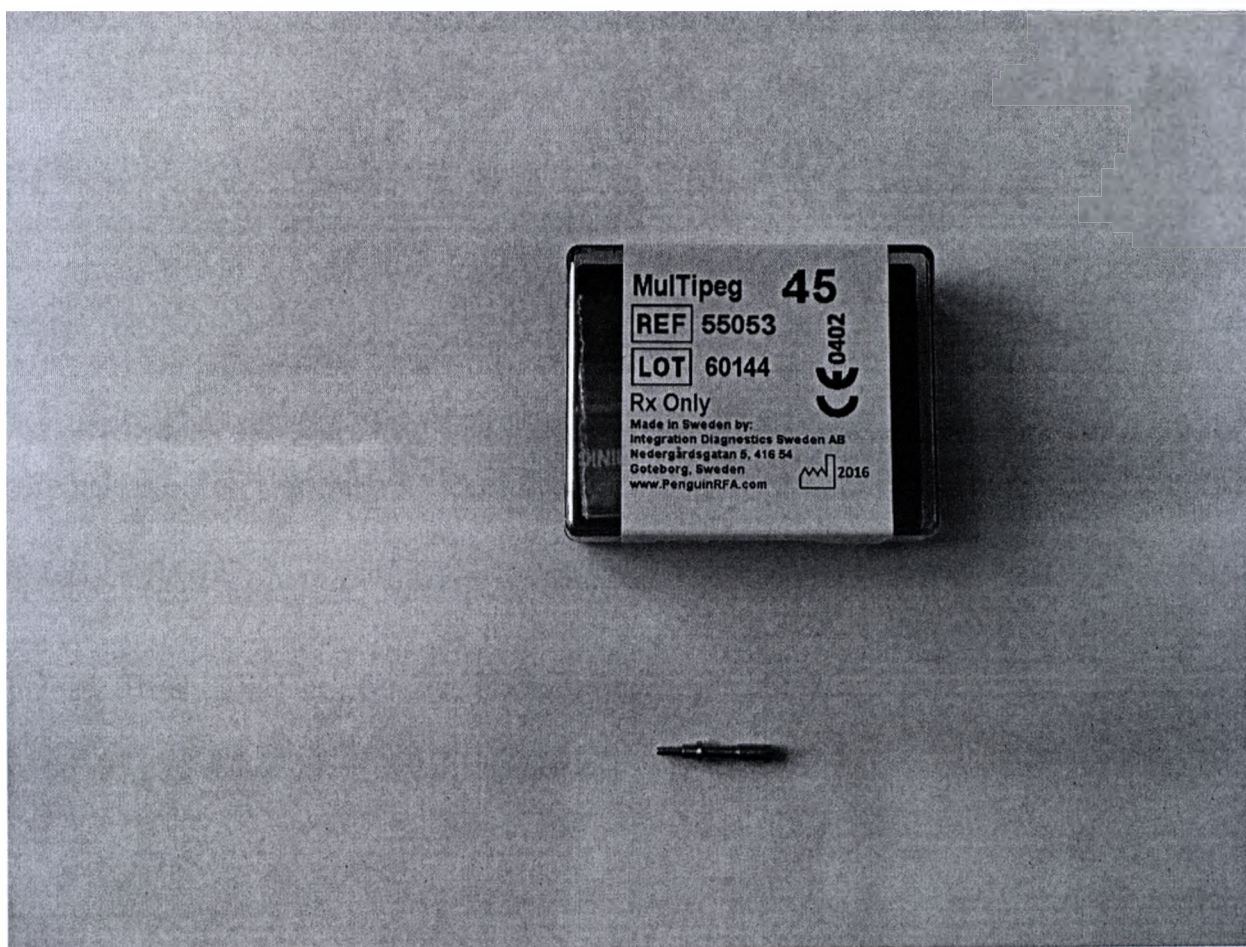


Рис. 49 Штифт MulTipeg 46

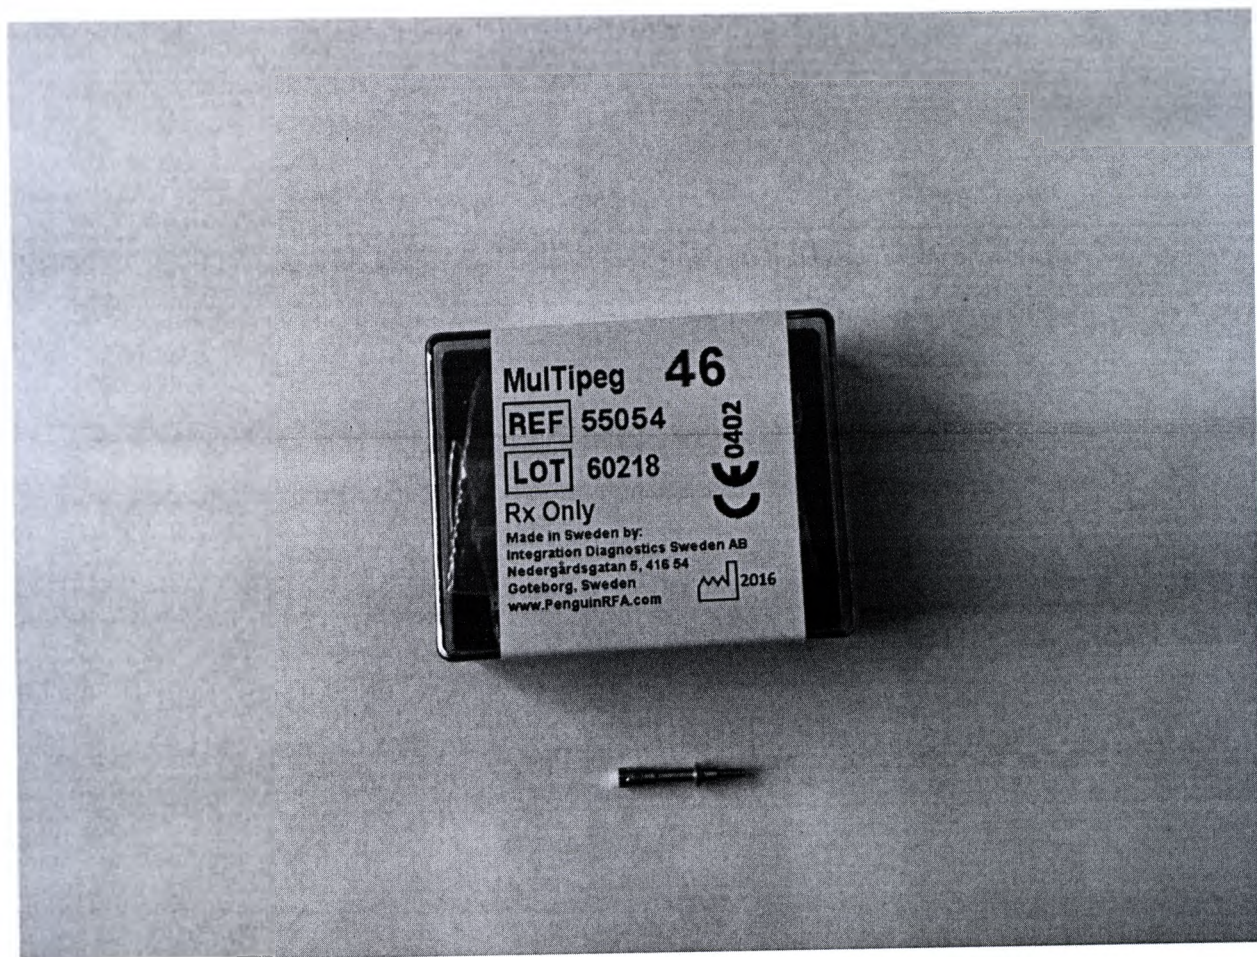


Рис. 50 Штифт MulTipeg 47

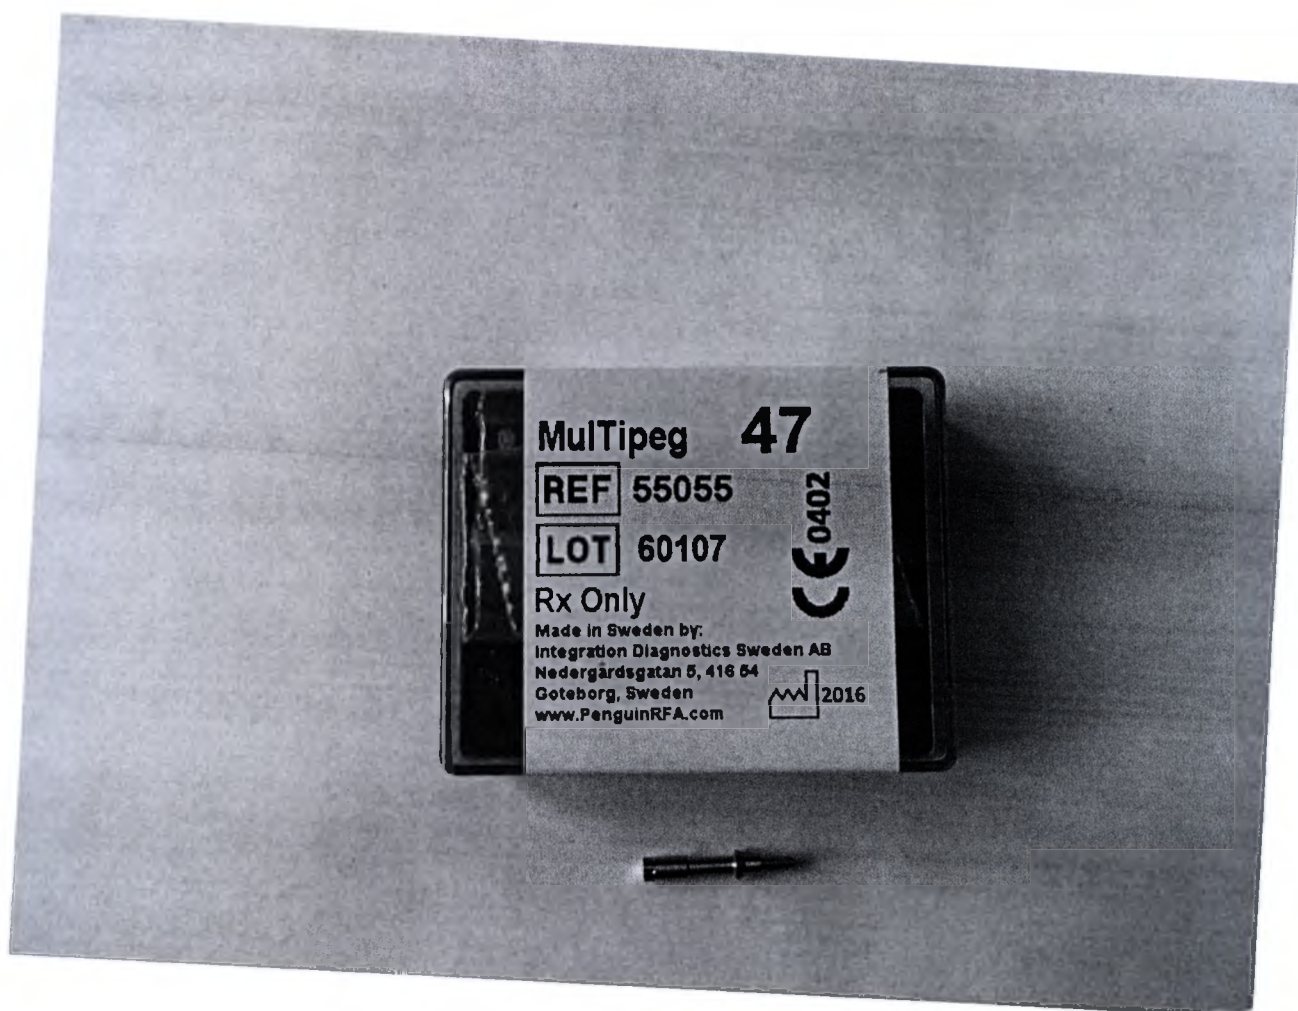


Рис. 51 Штифт MulTipeg 48

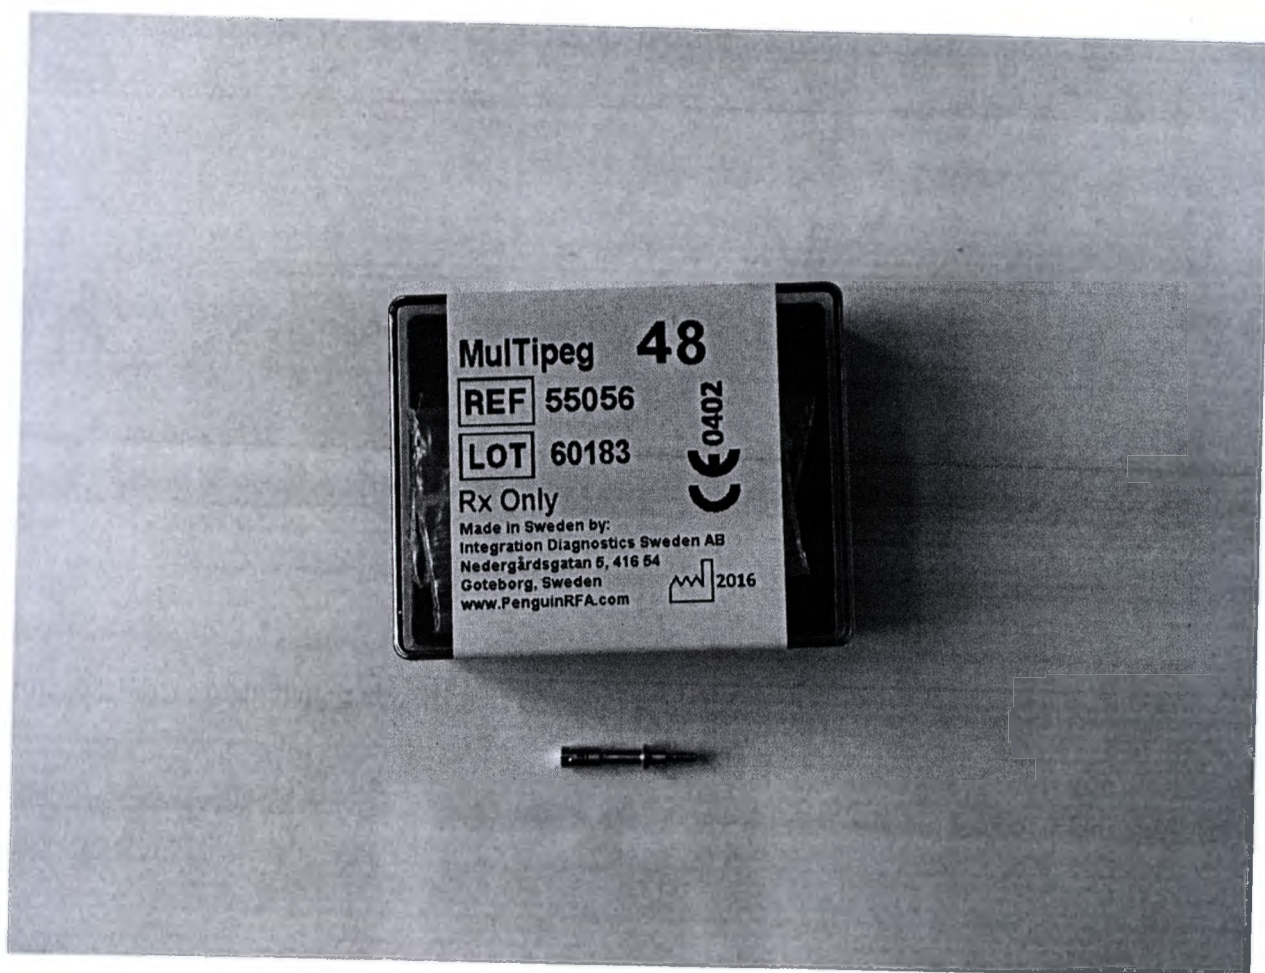


Рис. 52 Штифт MulTipeg 49

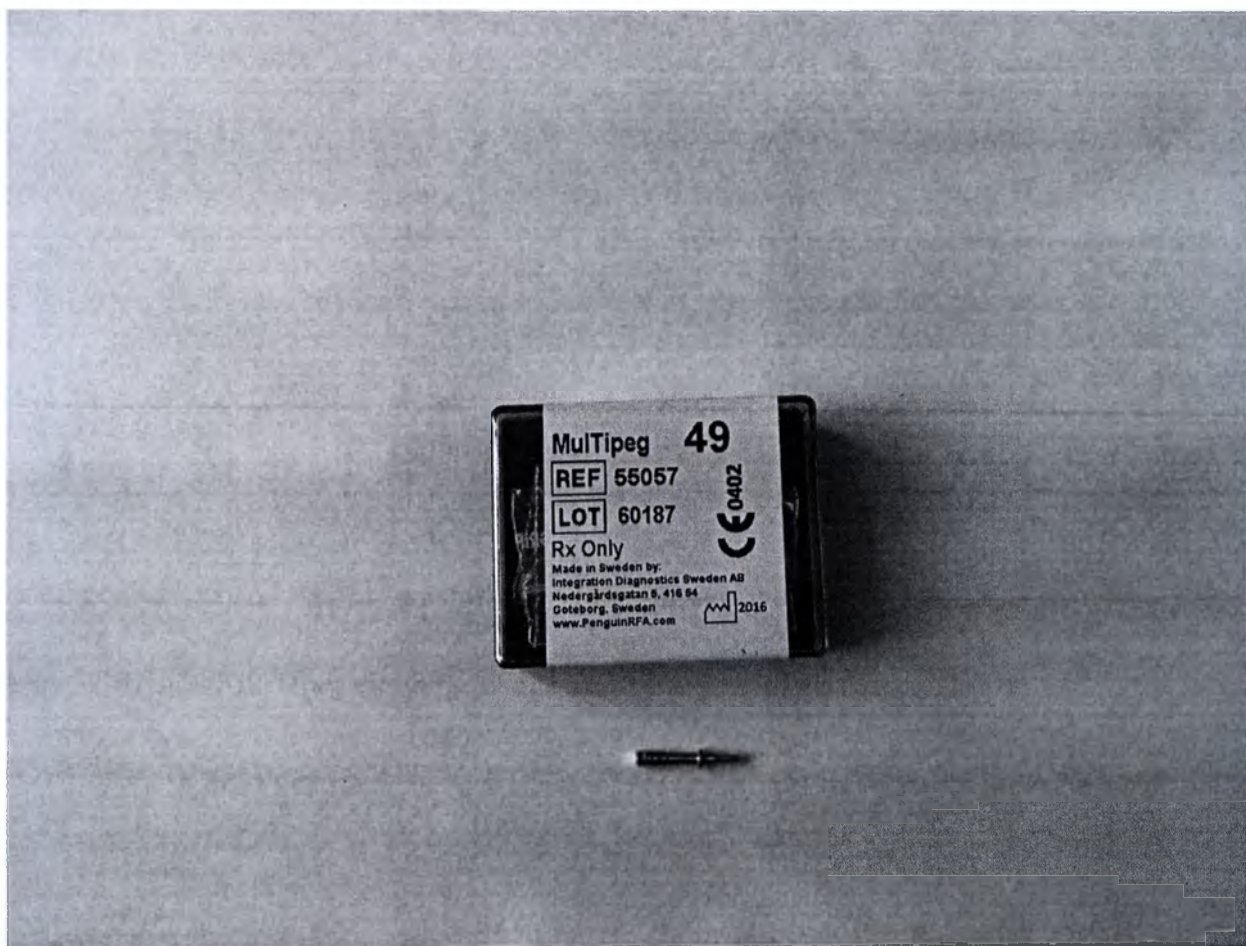


Рис. 53 Штифт Multipeg 50

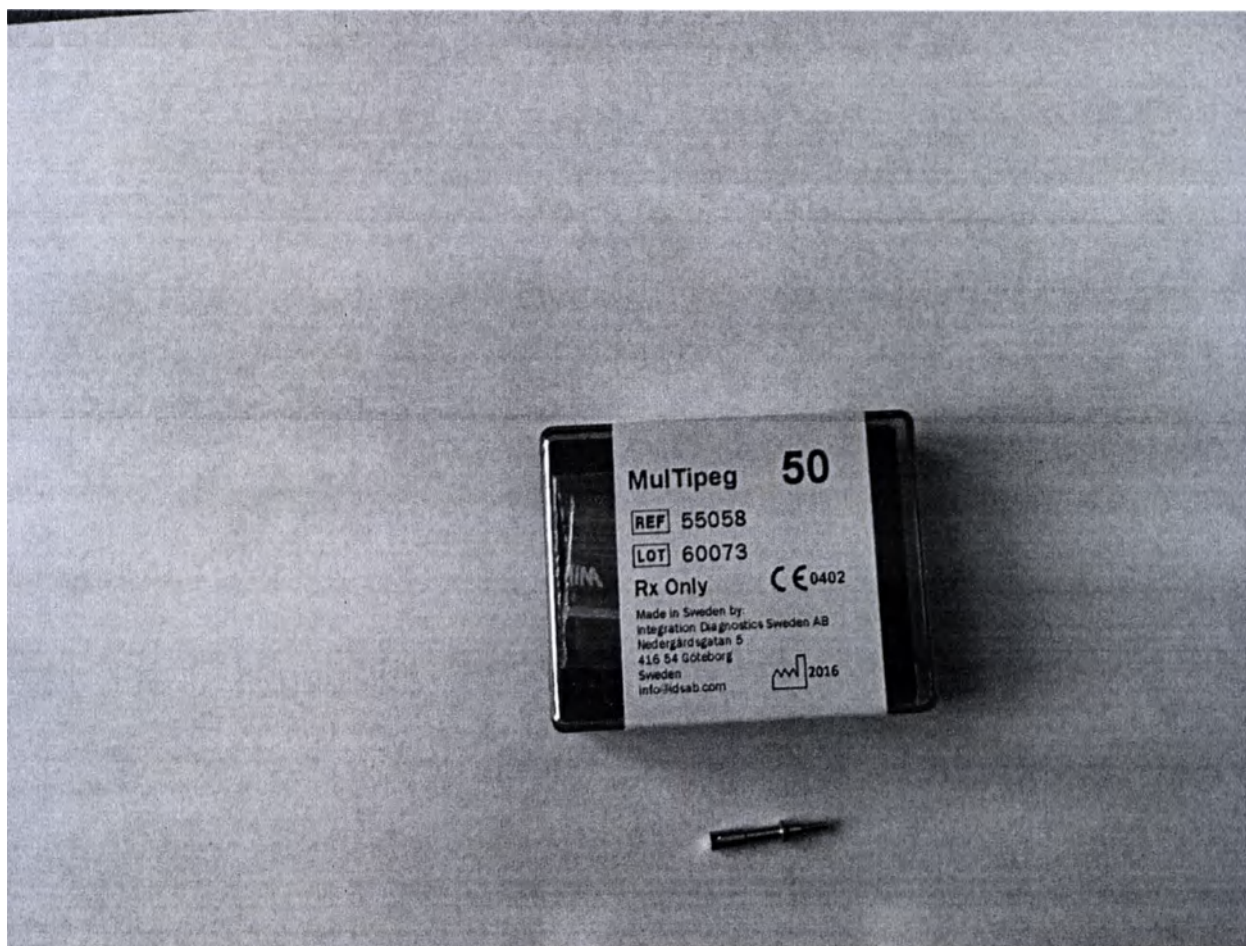


Рис. 54 Штифт MulTipeg 51

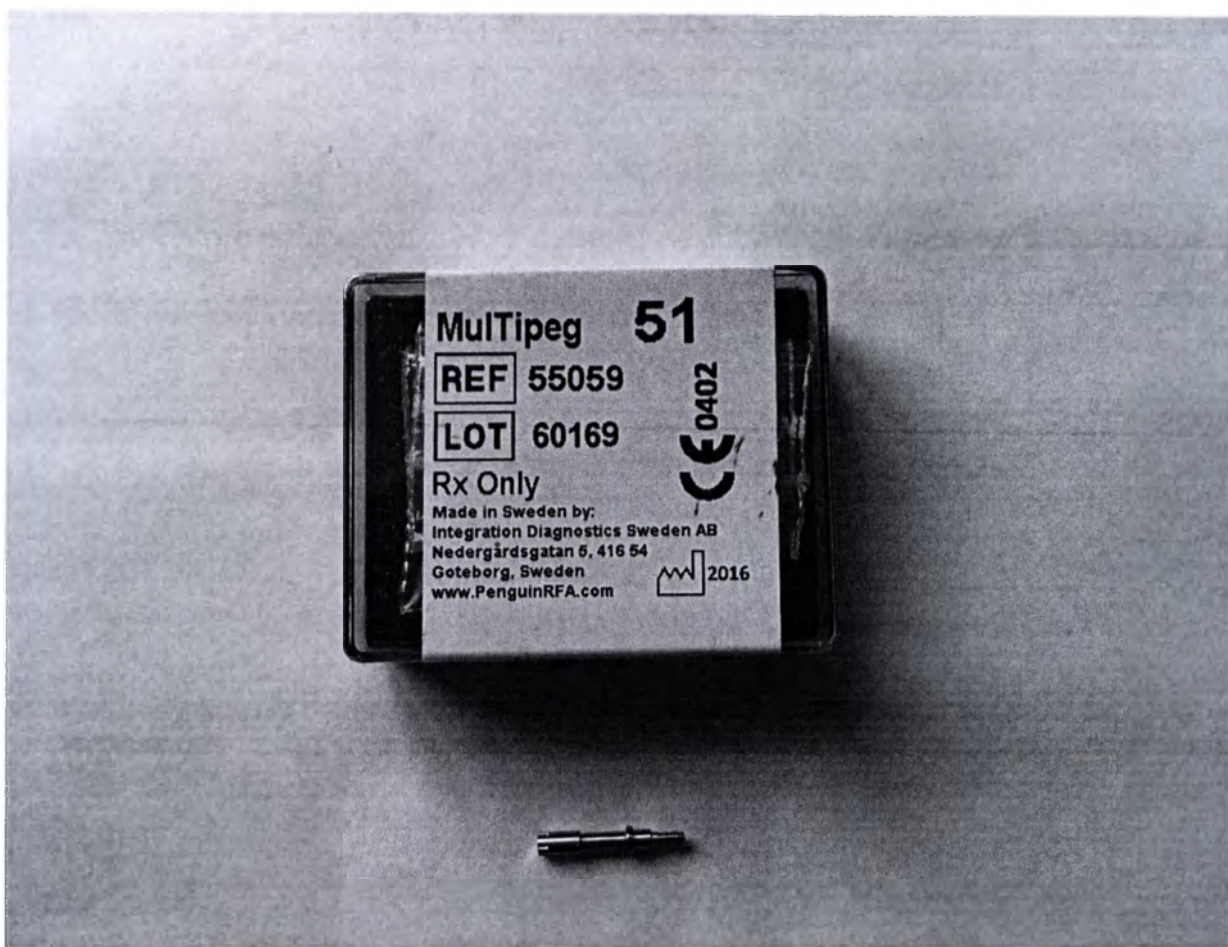


Рис. 55 Штифт MultiPeg 52

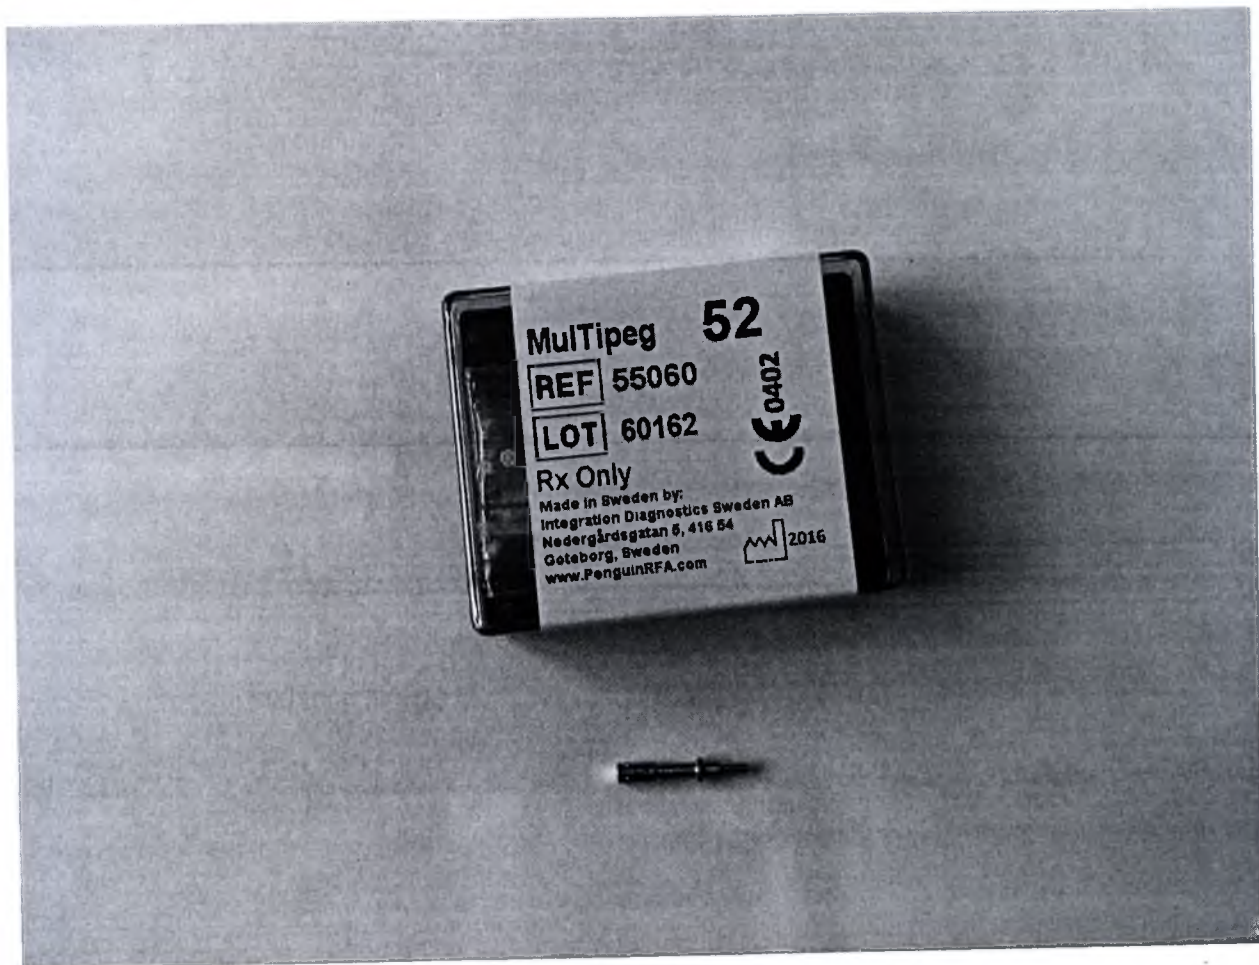


Рис. 56 Штифт MultiPeg 53

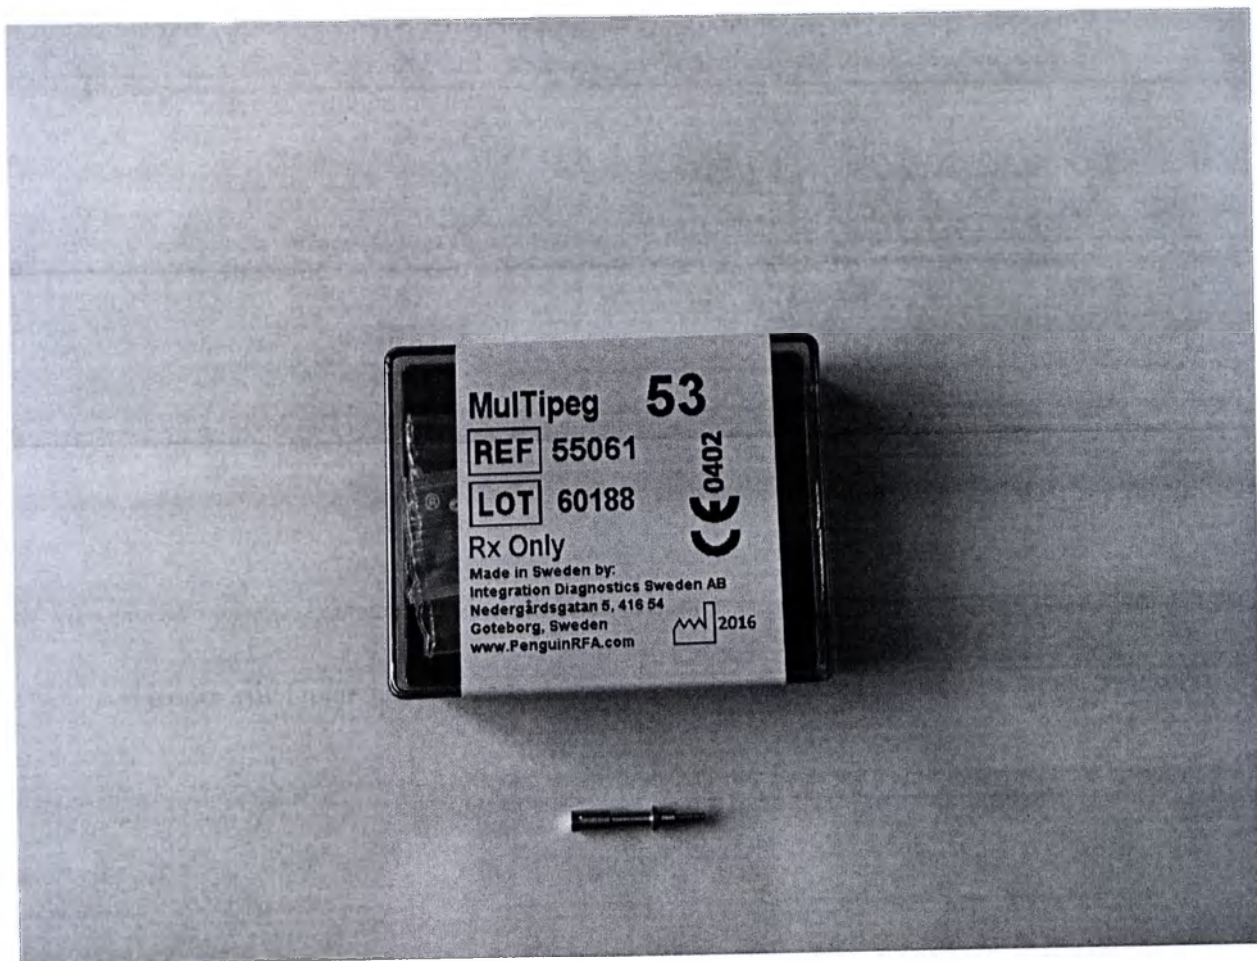


Рис. 57 Штифт MulTipeg 54

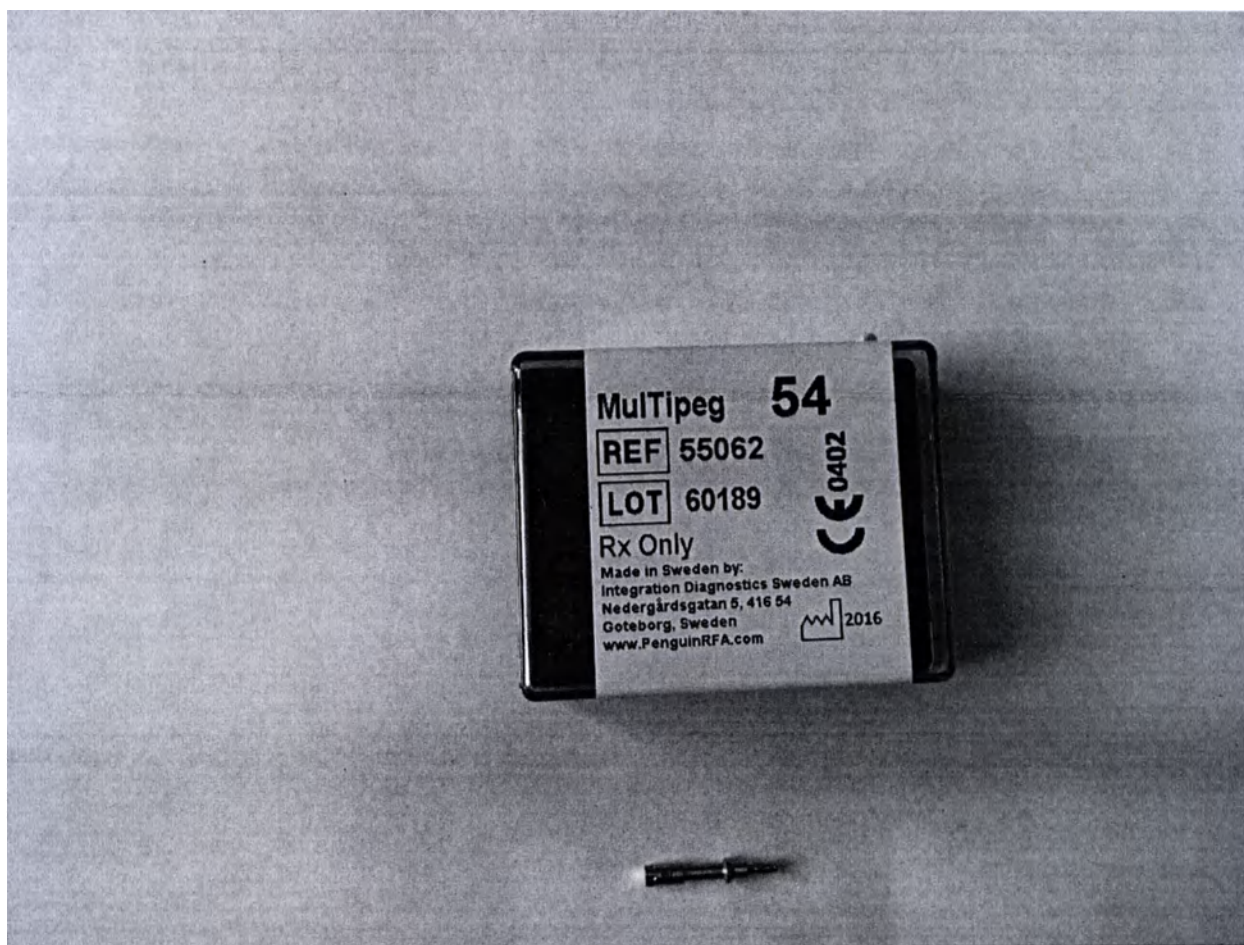


Рис. 58 Штифт MulTipeg 55

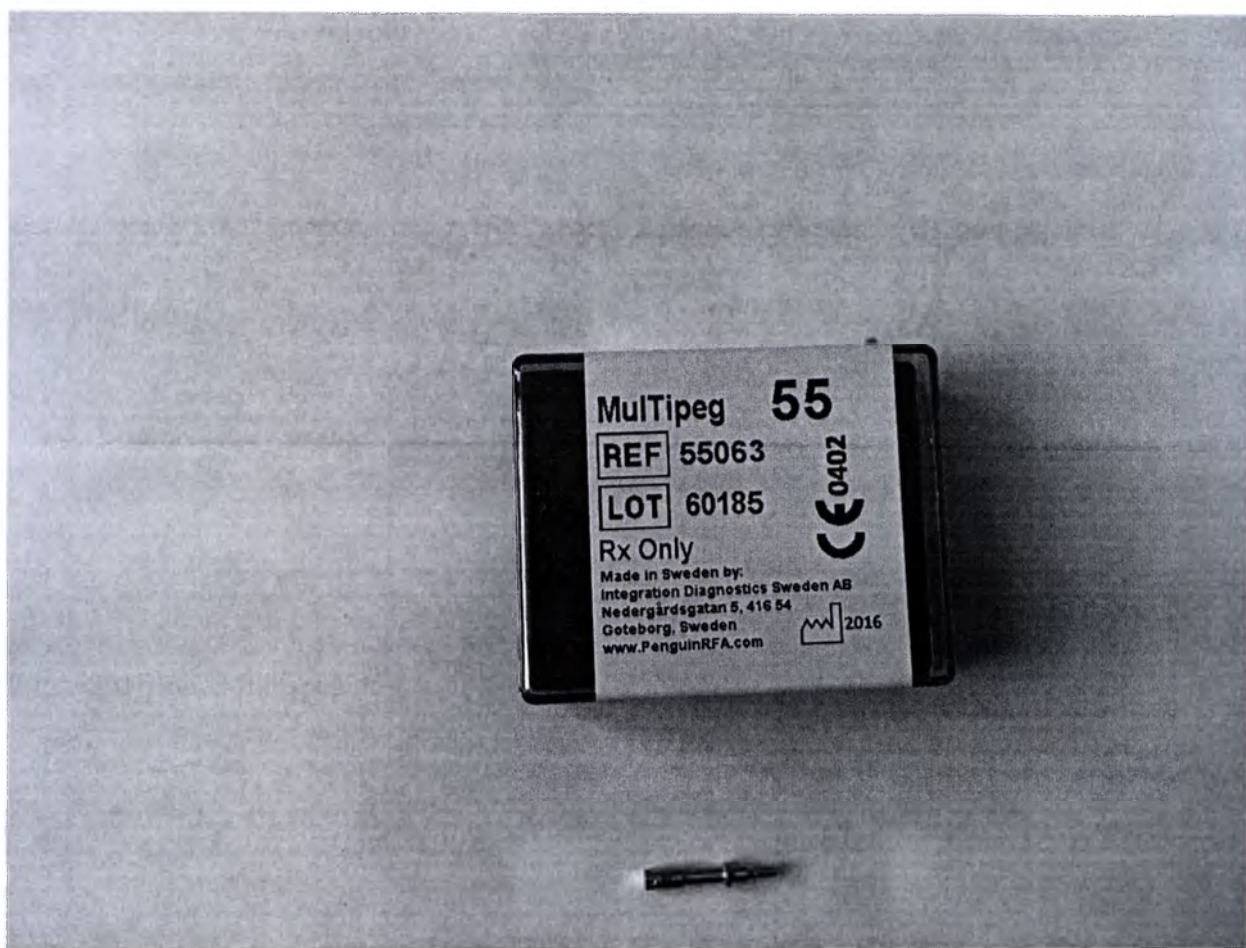


Рис. 59 Штифт MulTipeg 56

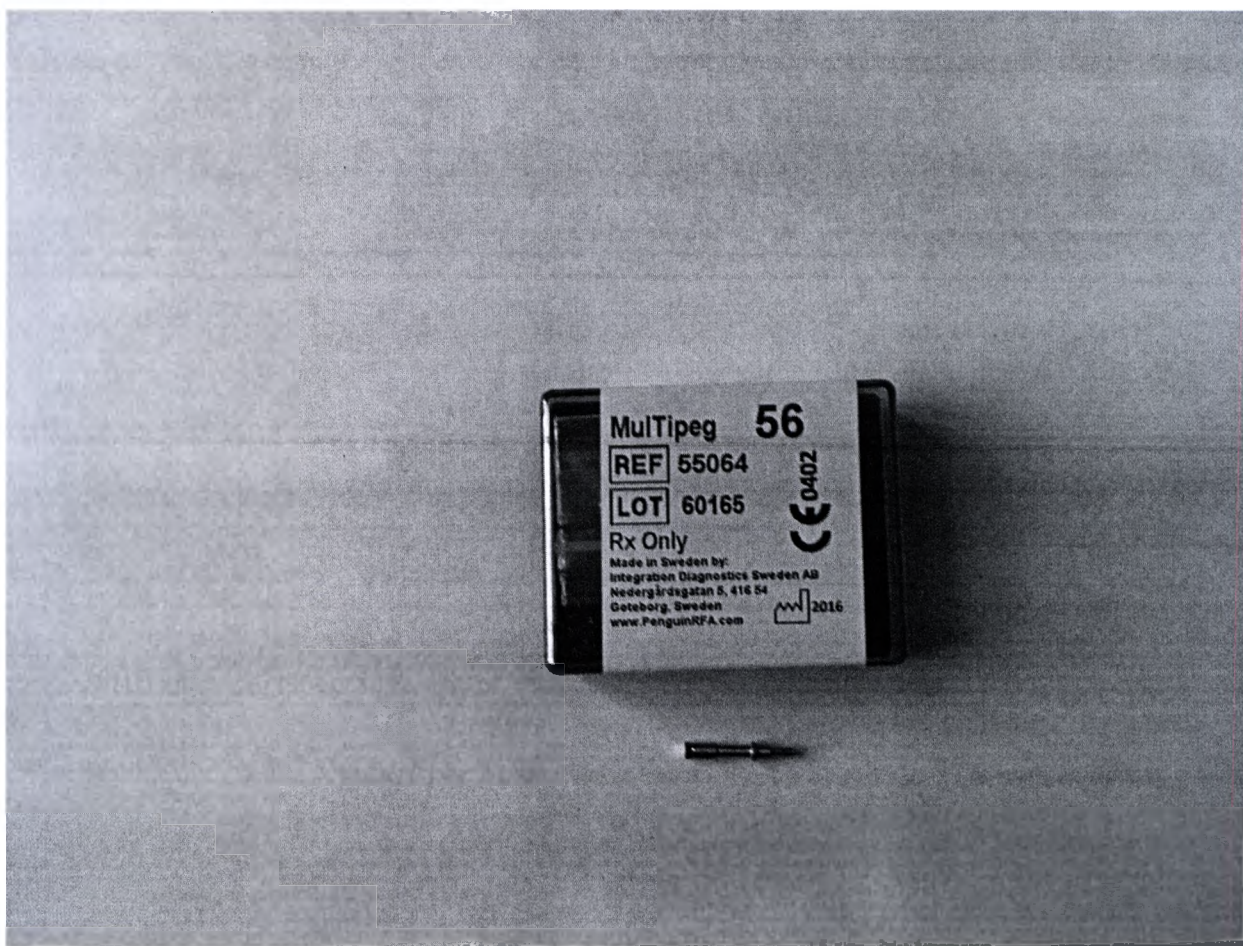


Рис. 60 Штифт MulTipeg 57



Рис. 61 Штифт MulTipeg 58

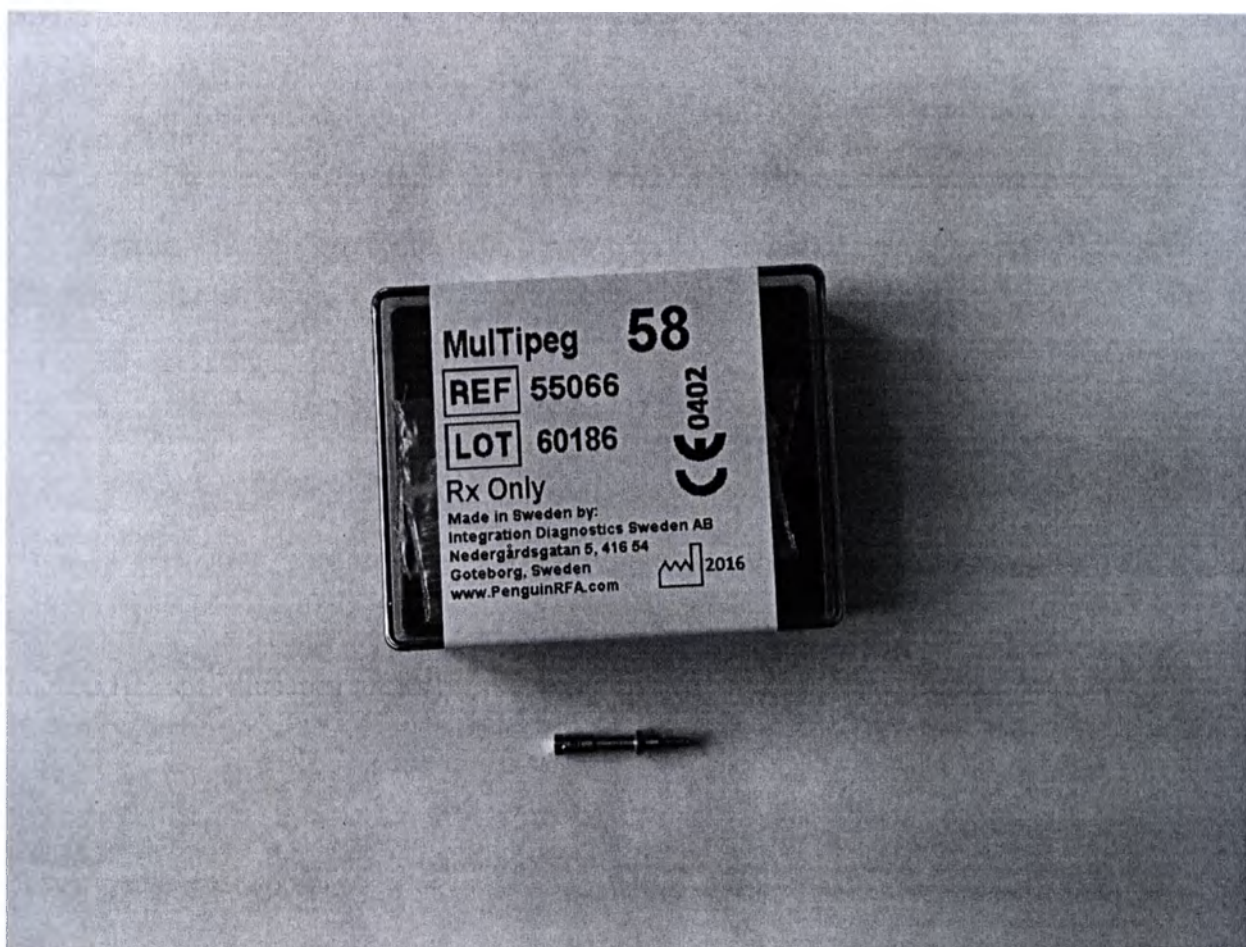


Рис. 62 Штифт MultiPeg 59

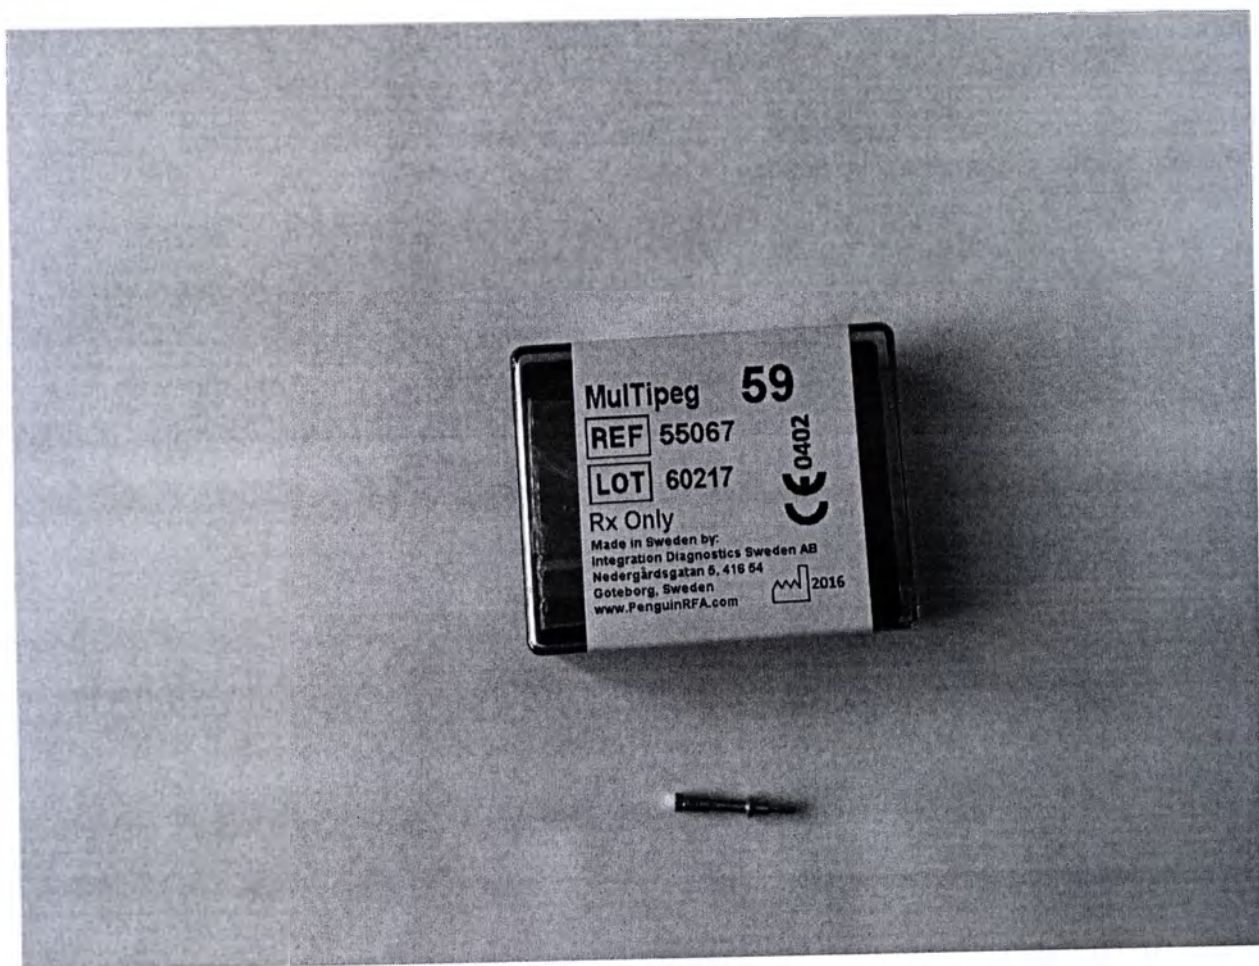


Рис. 63 Штифт MultiPeg 60

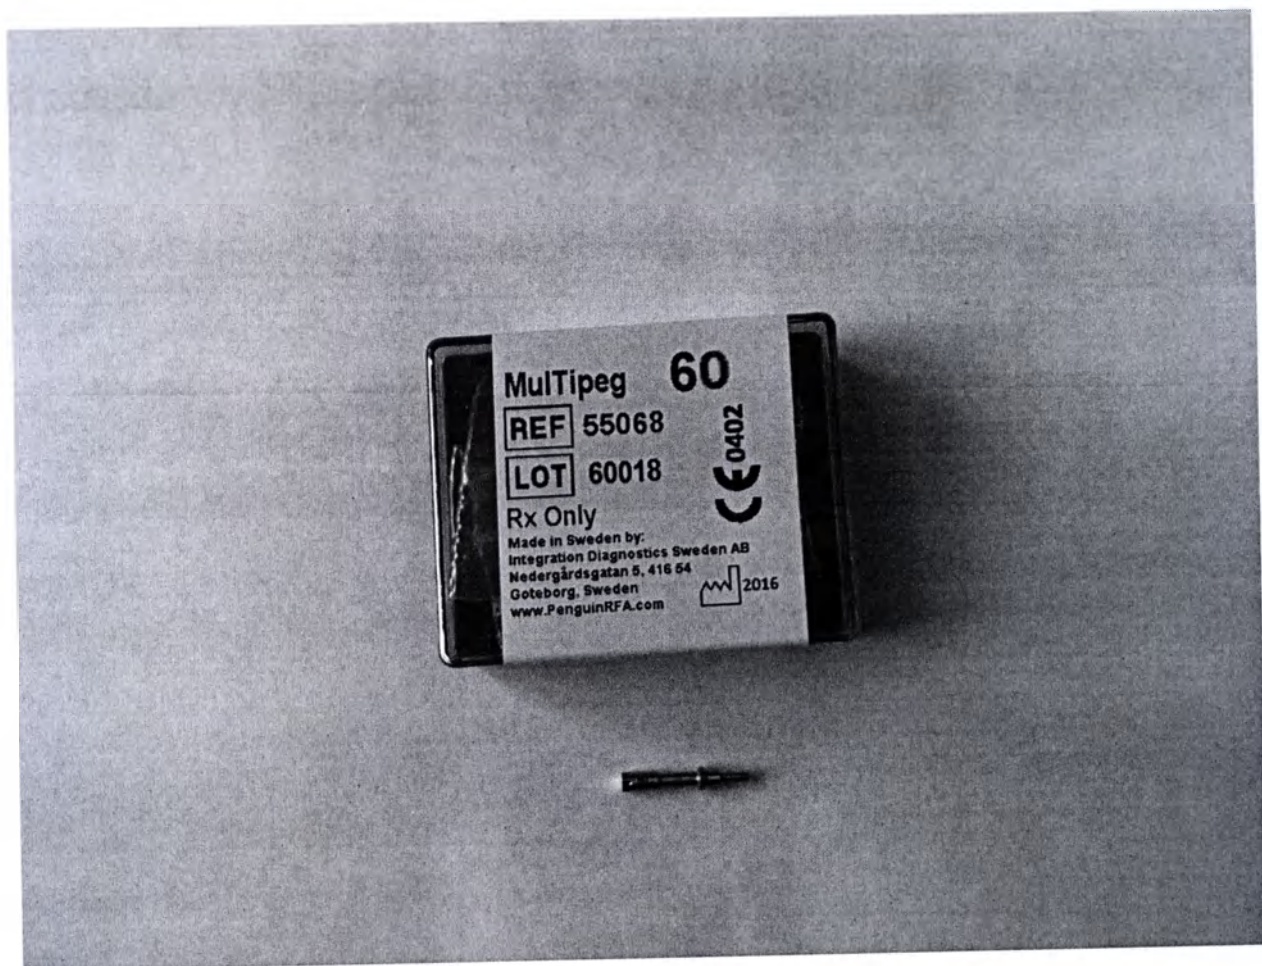


Рис. 64 Штифт MulTipeg 61

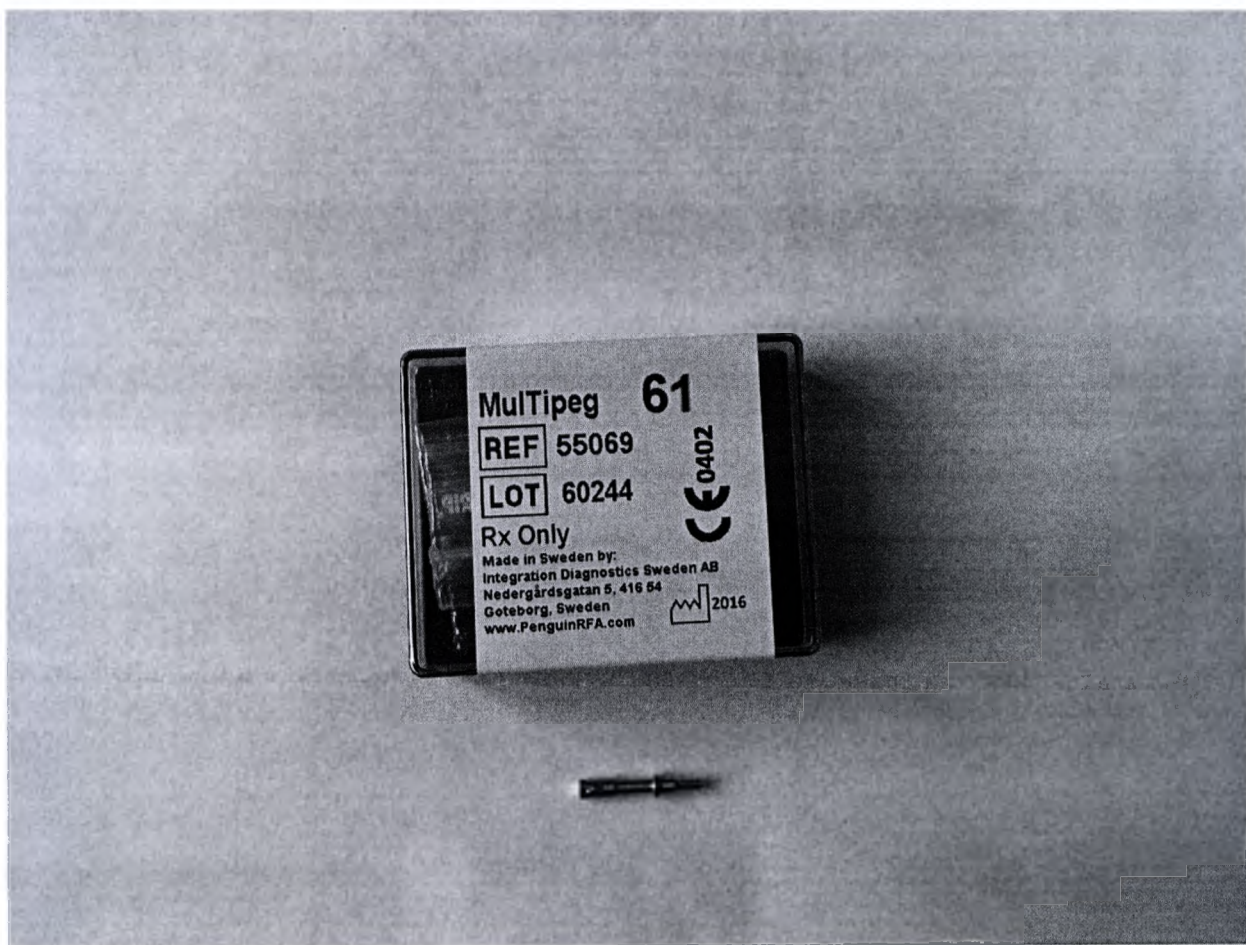


Рис. 65 Штифт MulTipeg 62

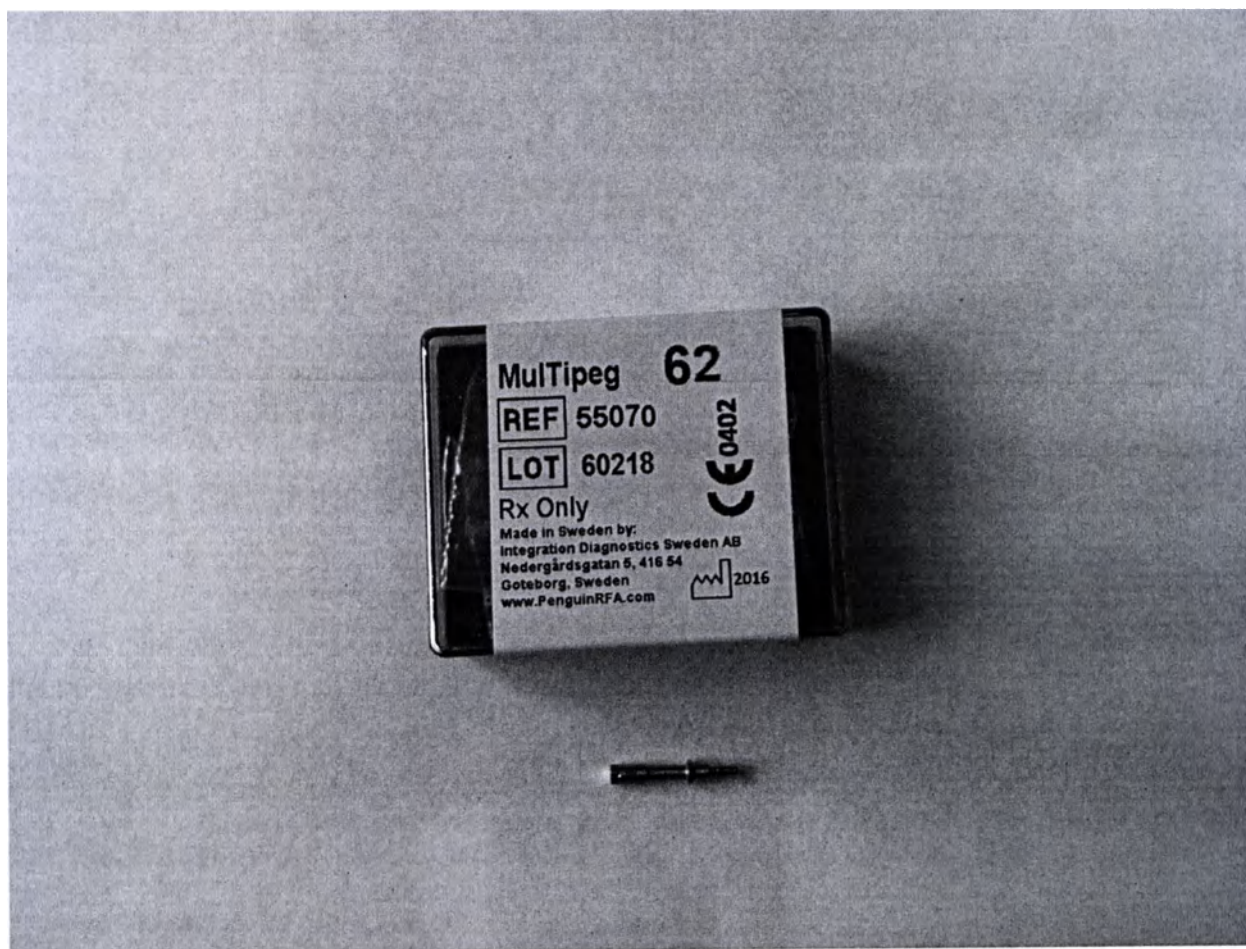


Рис. 66 Штифт MulTipeg 63

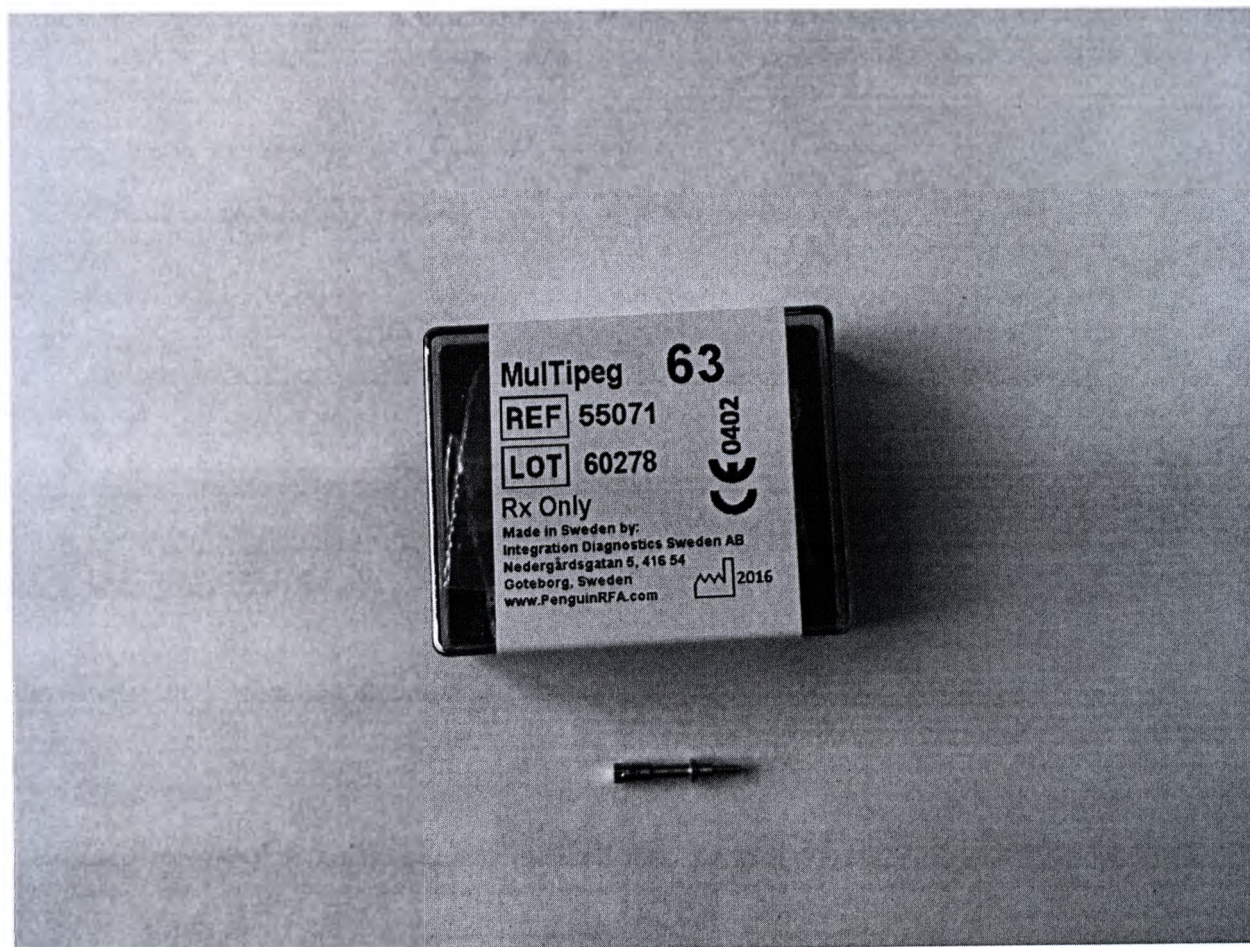


Рис. 67 Штифт MulTipeg 64

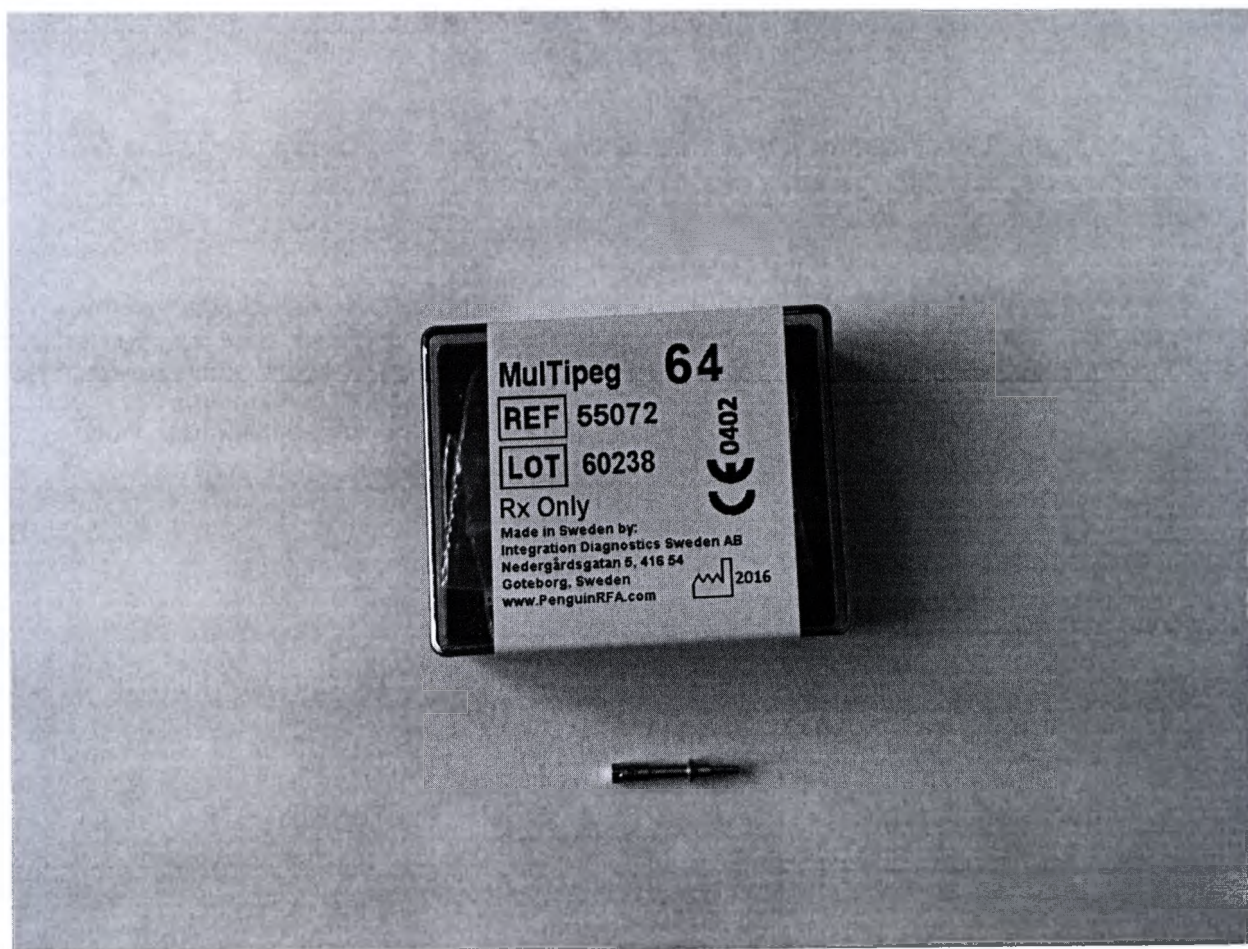


Рис. 68 Штифт MulTipeg 65

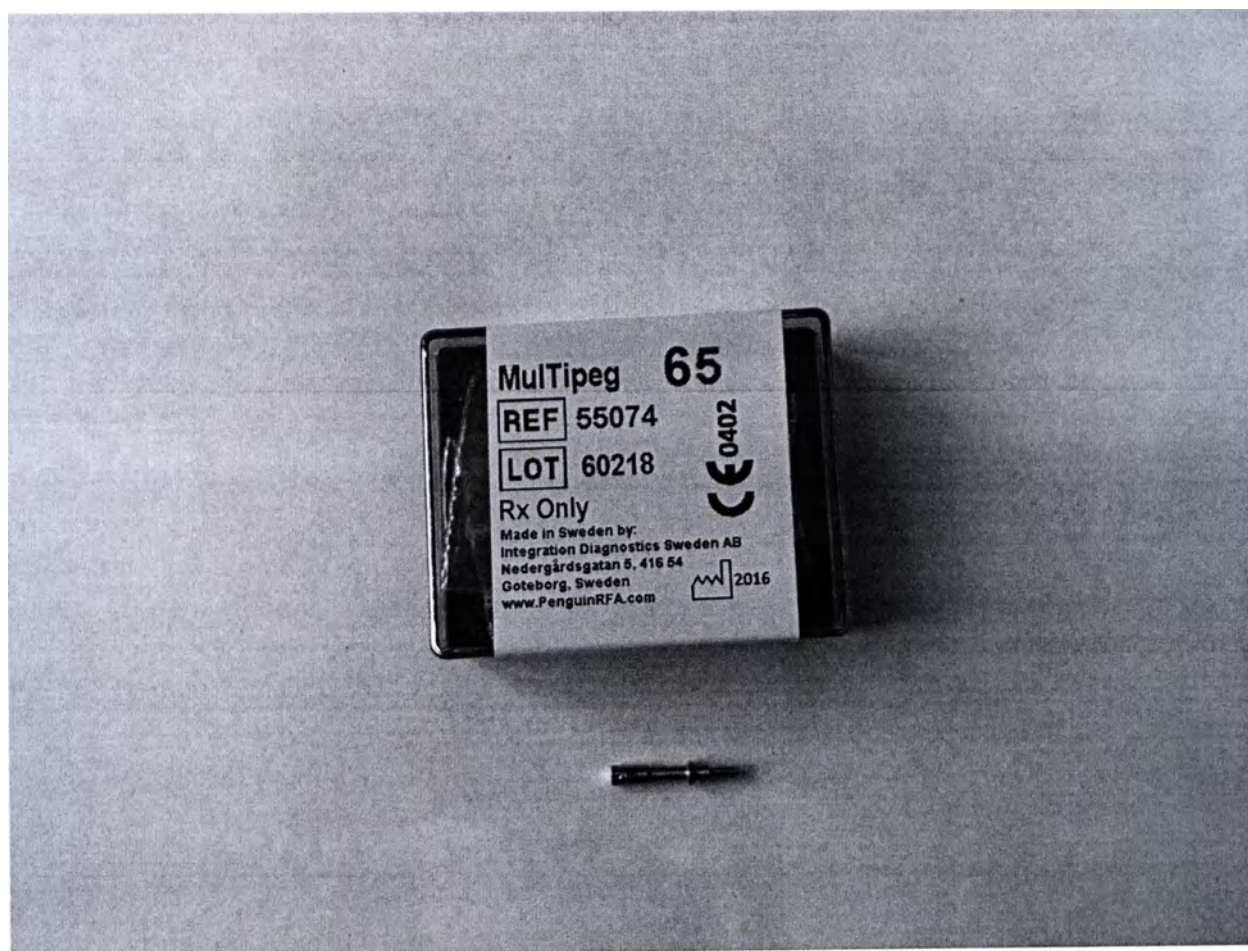


Рис. 69 Штифт MulTipeg 66

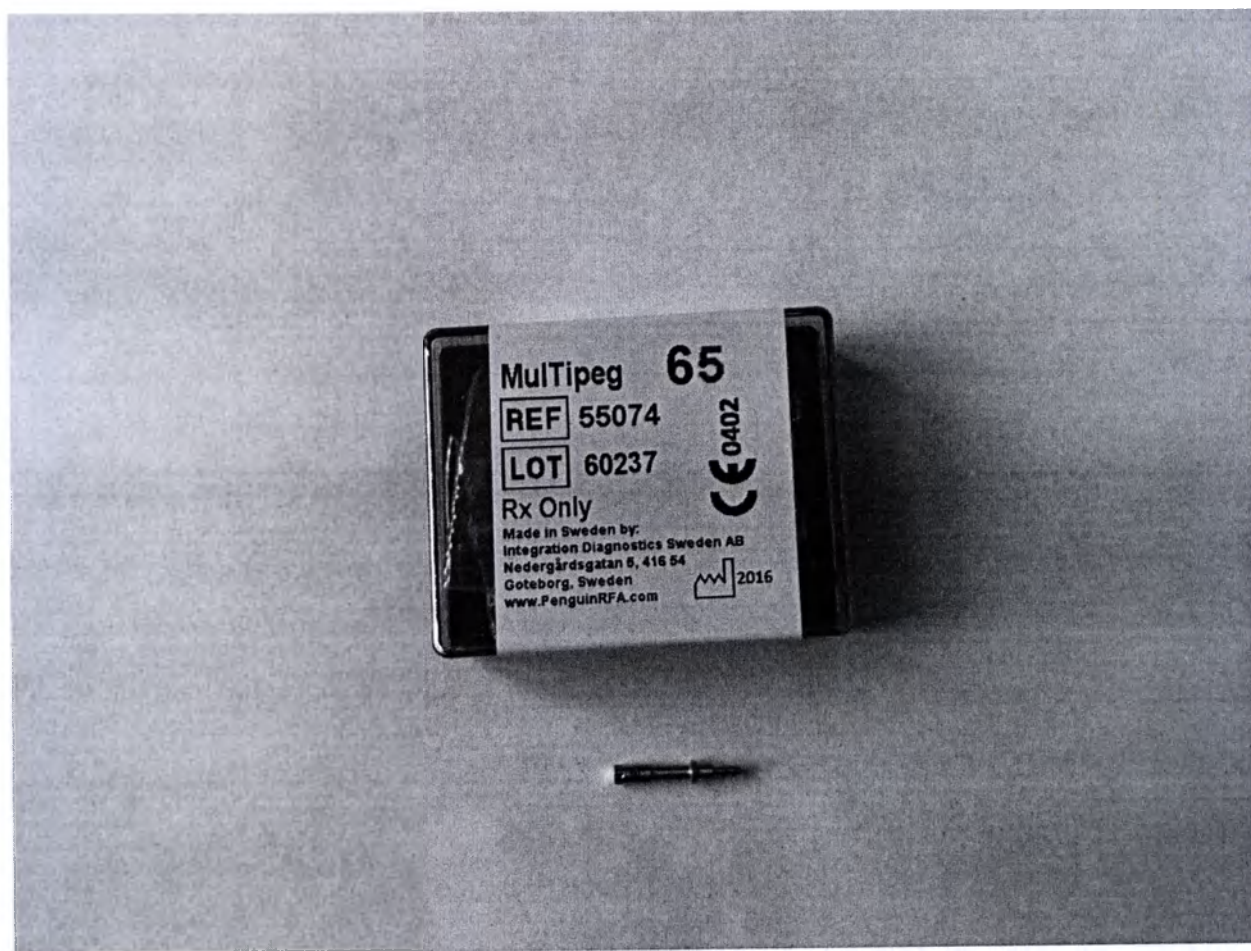


Рис. 70 Штифт MulTipeg 67

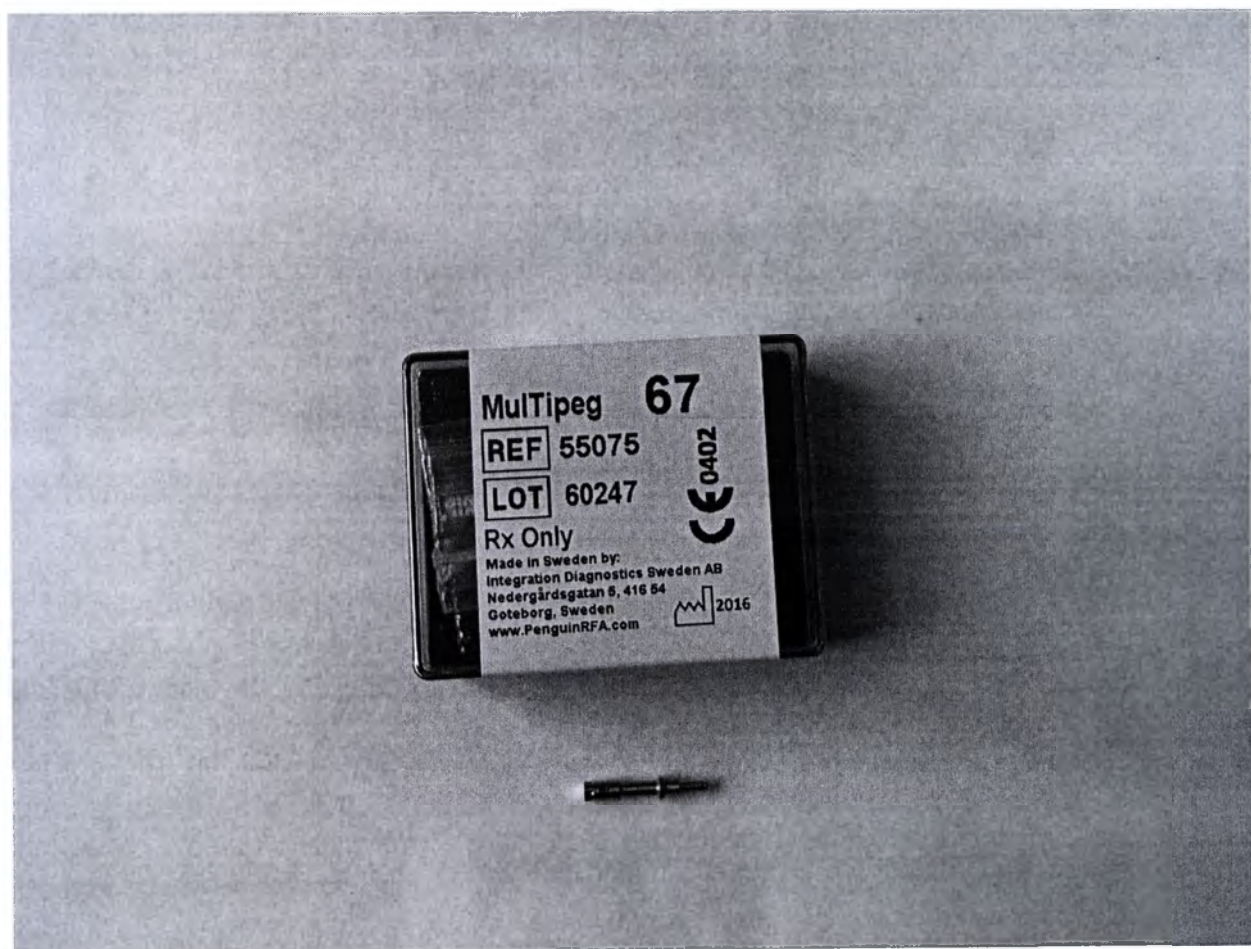


Рис. 71 Штифт MultiPeg 68

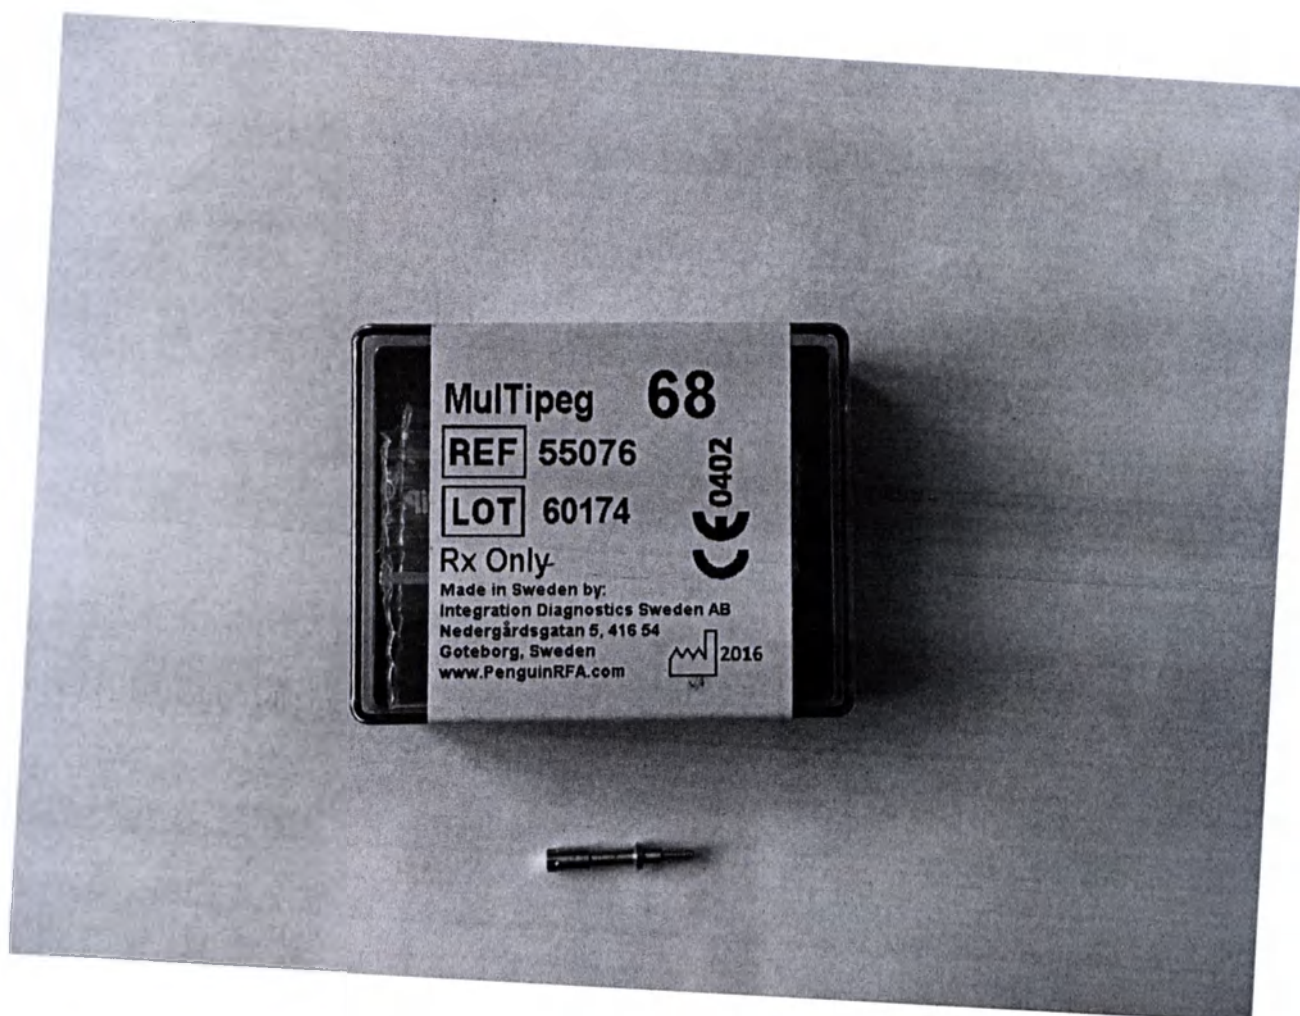


Рис. 72 Штифт MulTipeg 69

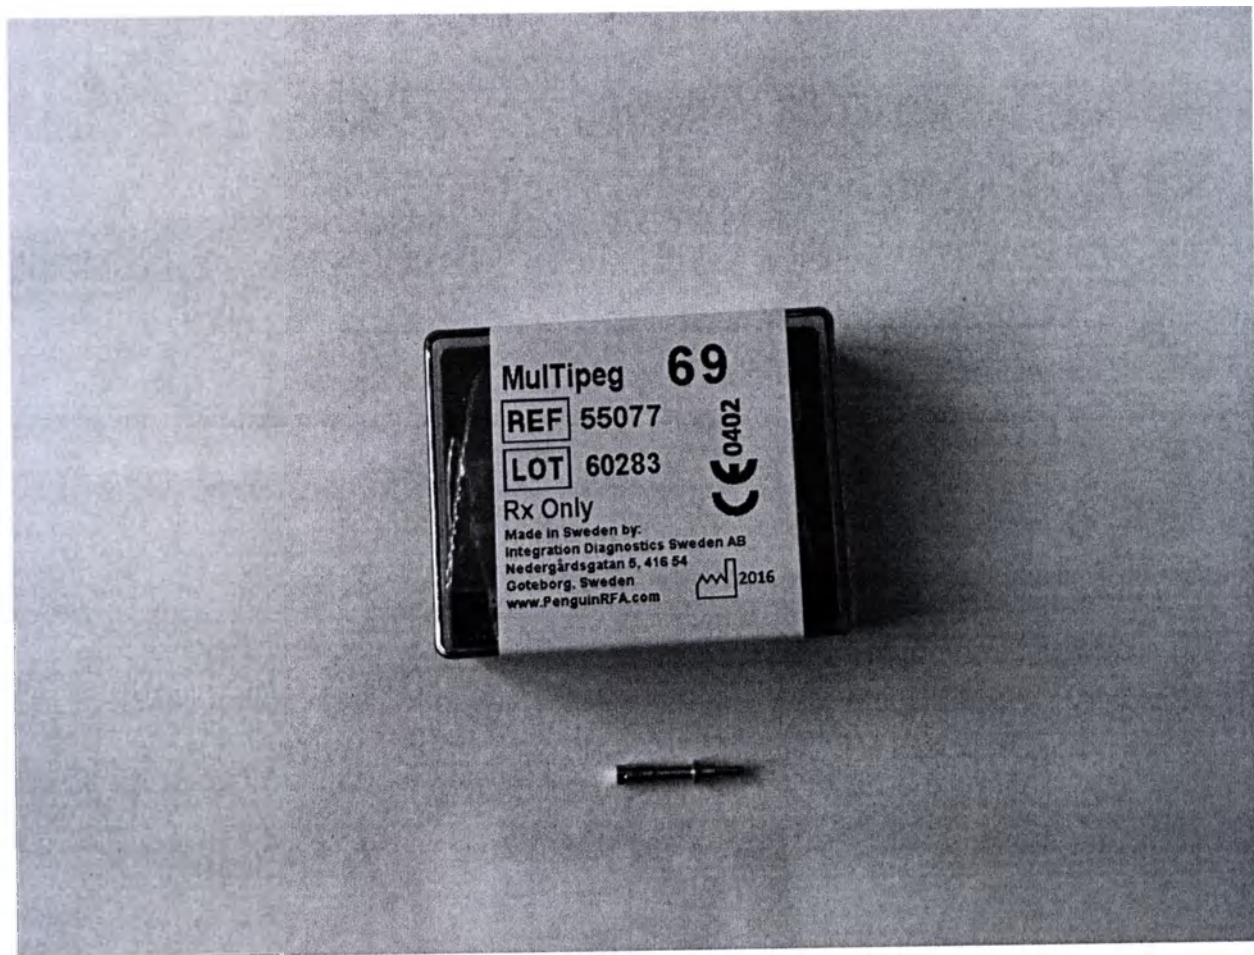


Рис. 73 Штифт MulTipeg 70

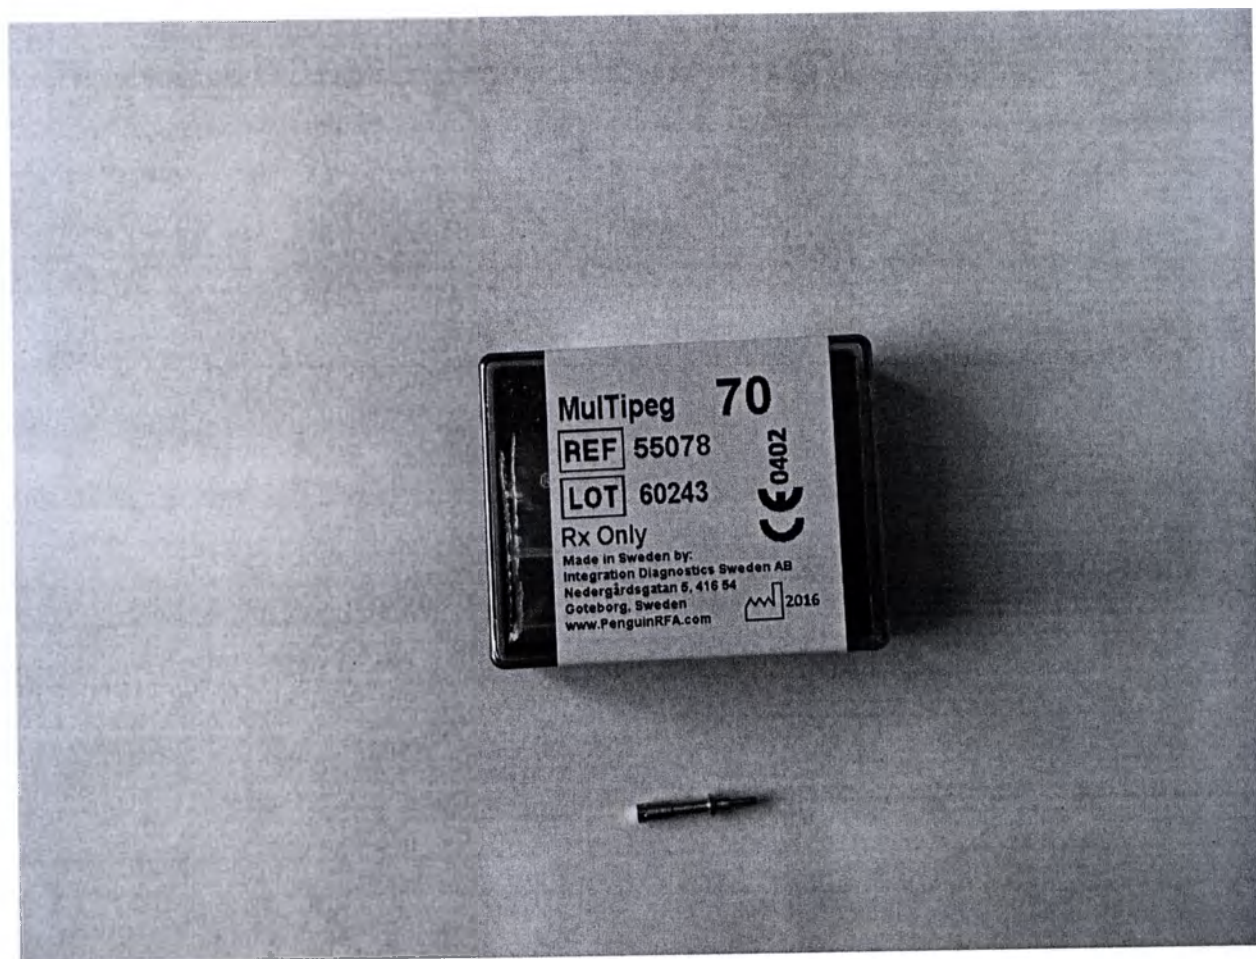


Рис. 74 Штифт MulTipeg 71

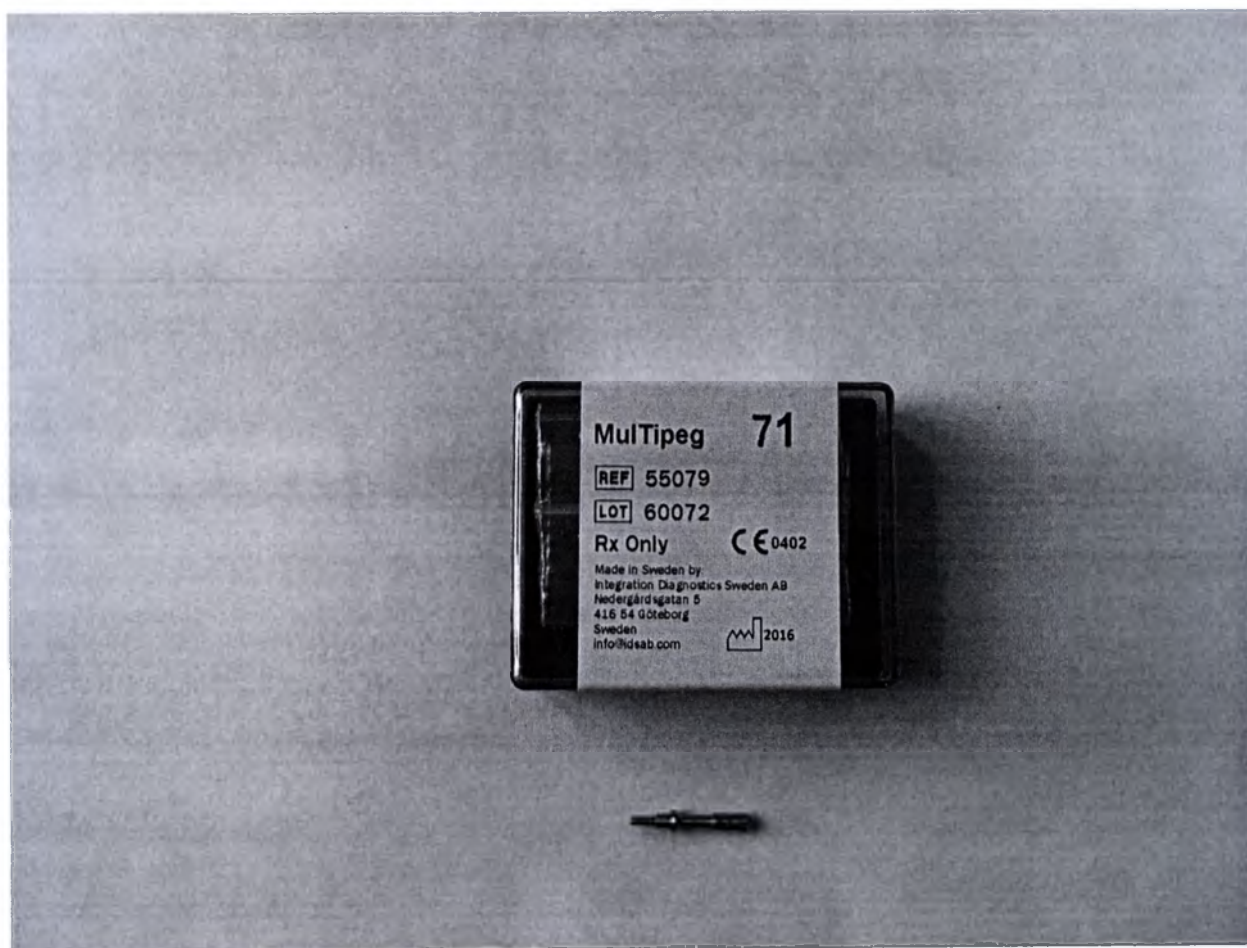


Рис. 75 Штифт MulTipeg 72

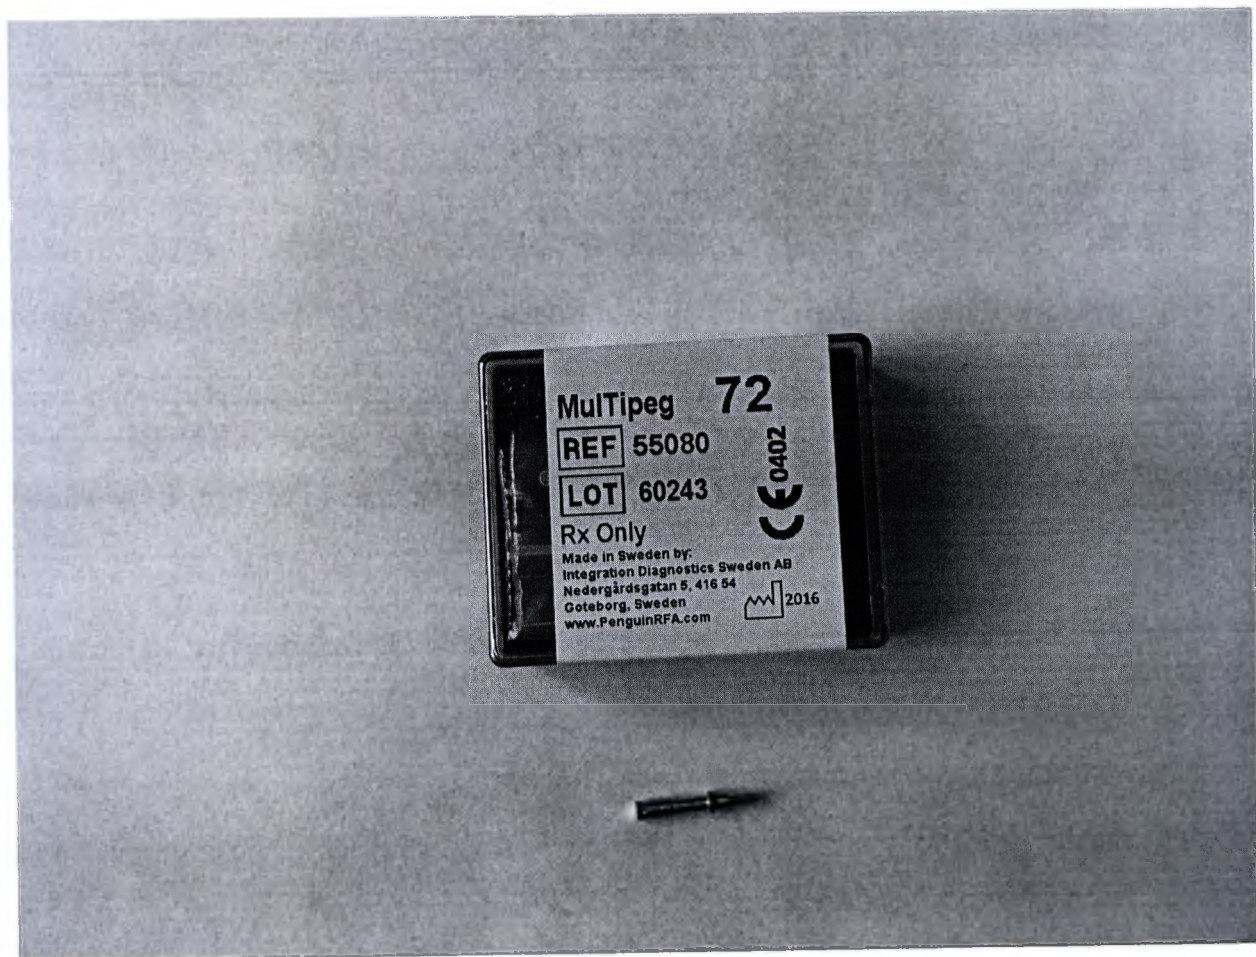


Рис. 76 Штифт MulTipeg 73

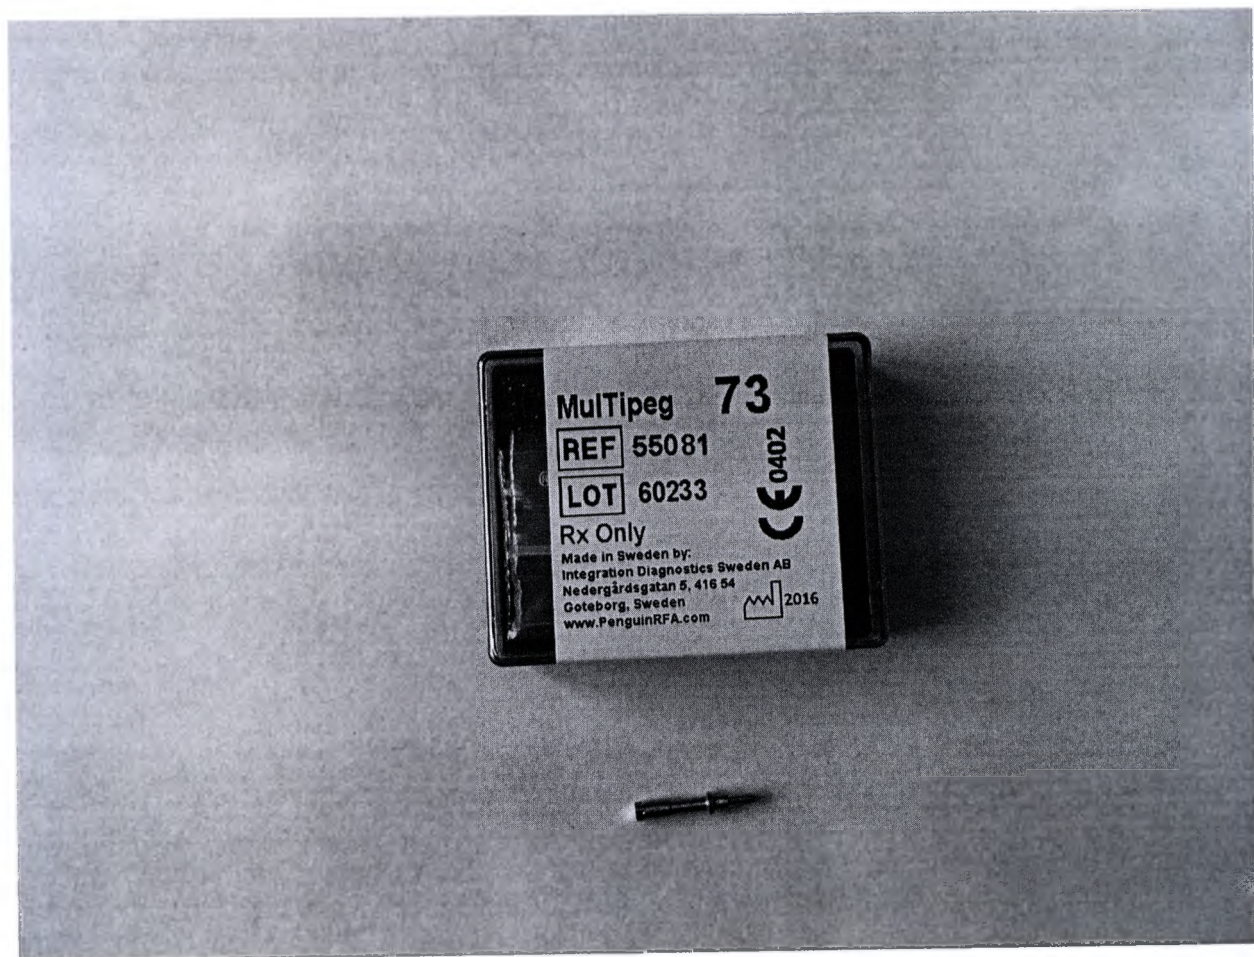


Рис. 77 Штифт MultiPeg 74

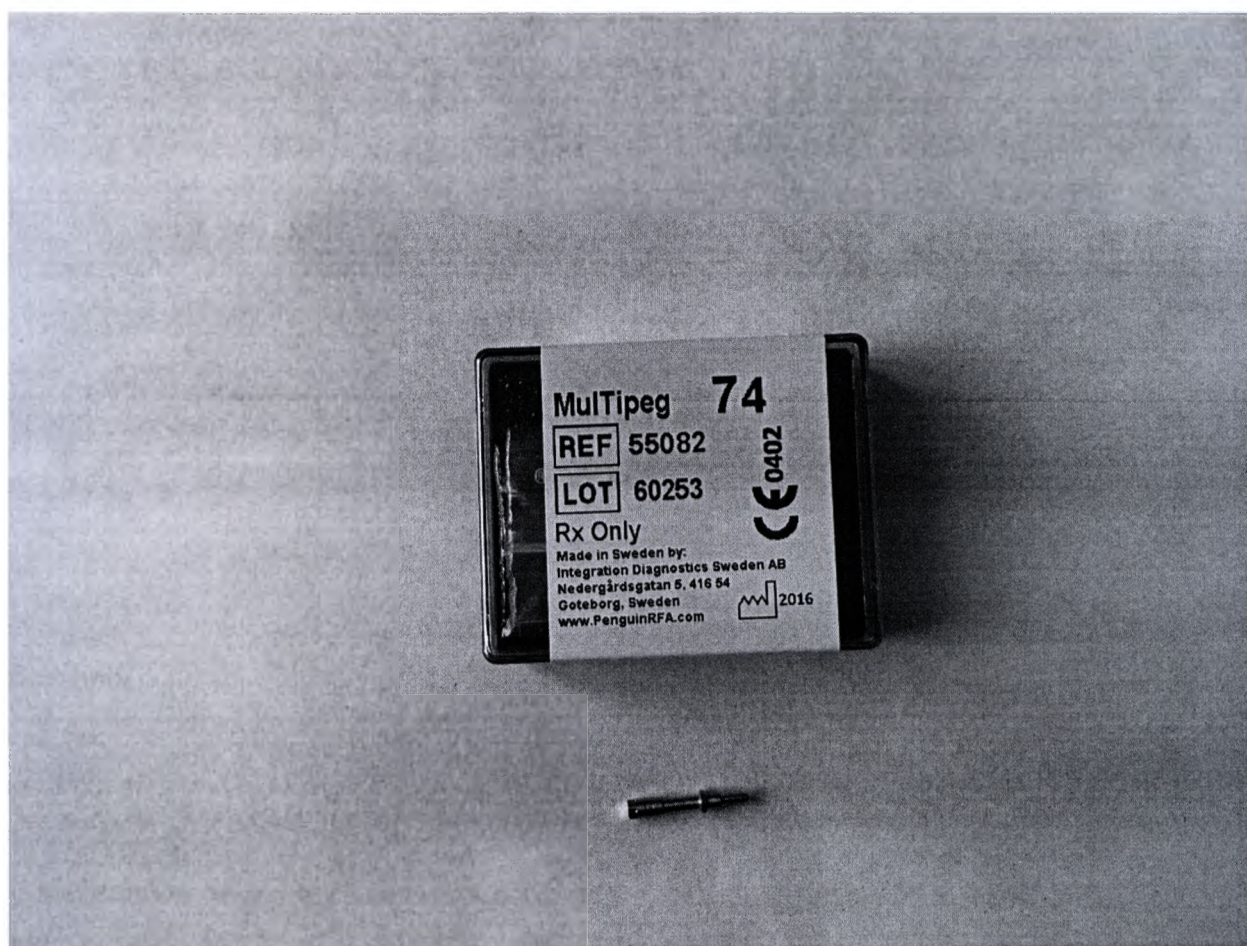


Рис. 78 Штифт MulTipeg 75

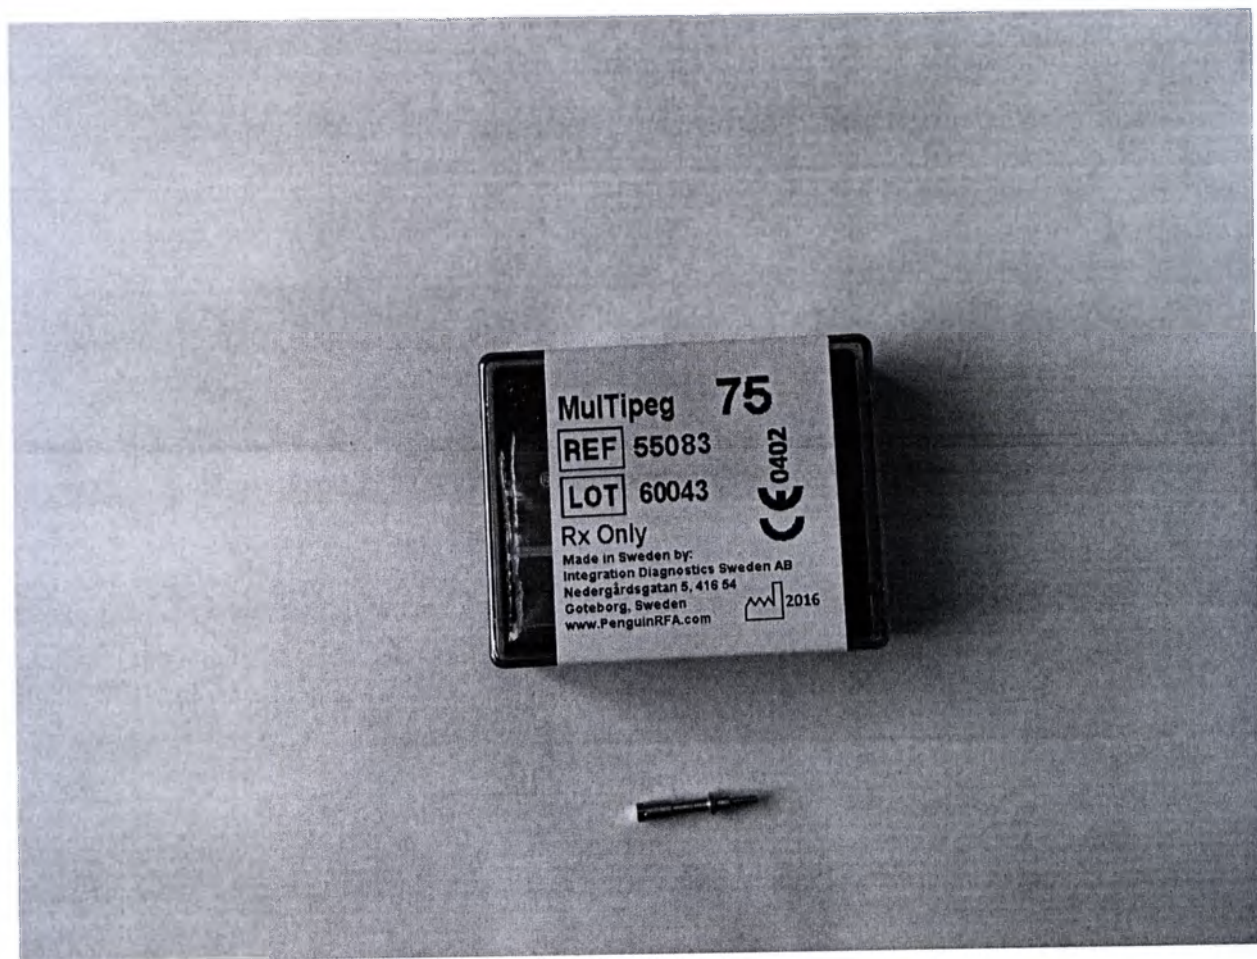


Рис. 79 Штифт MulTipeg 76

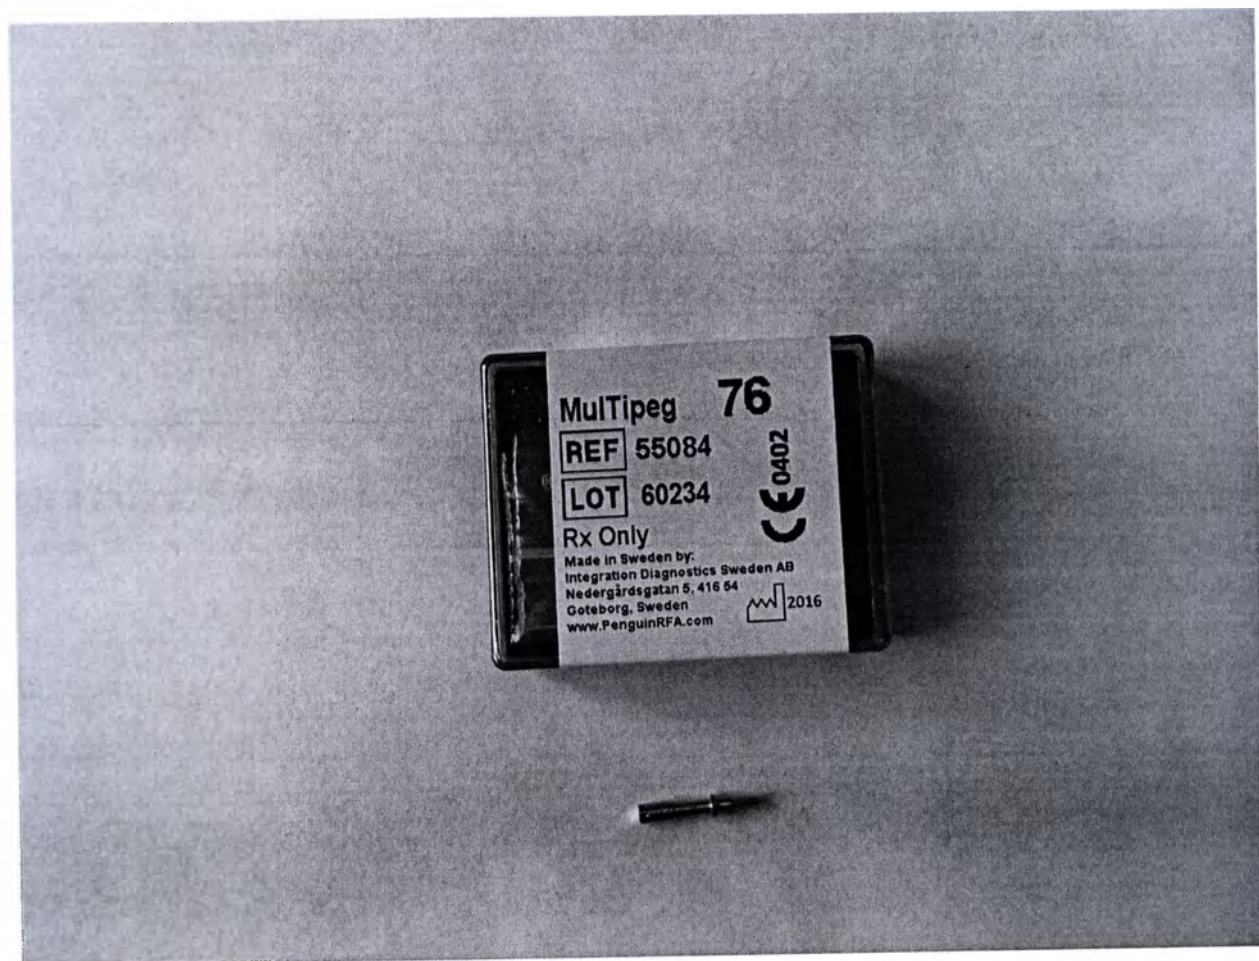


Рис. 80 Штифт MulTipeg 77

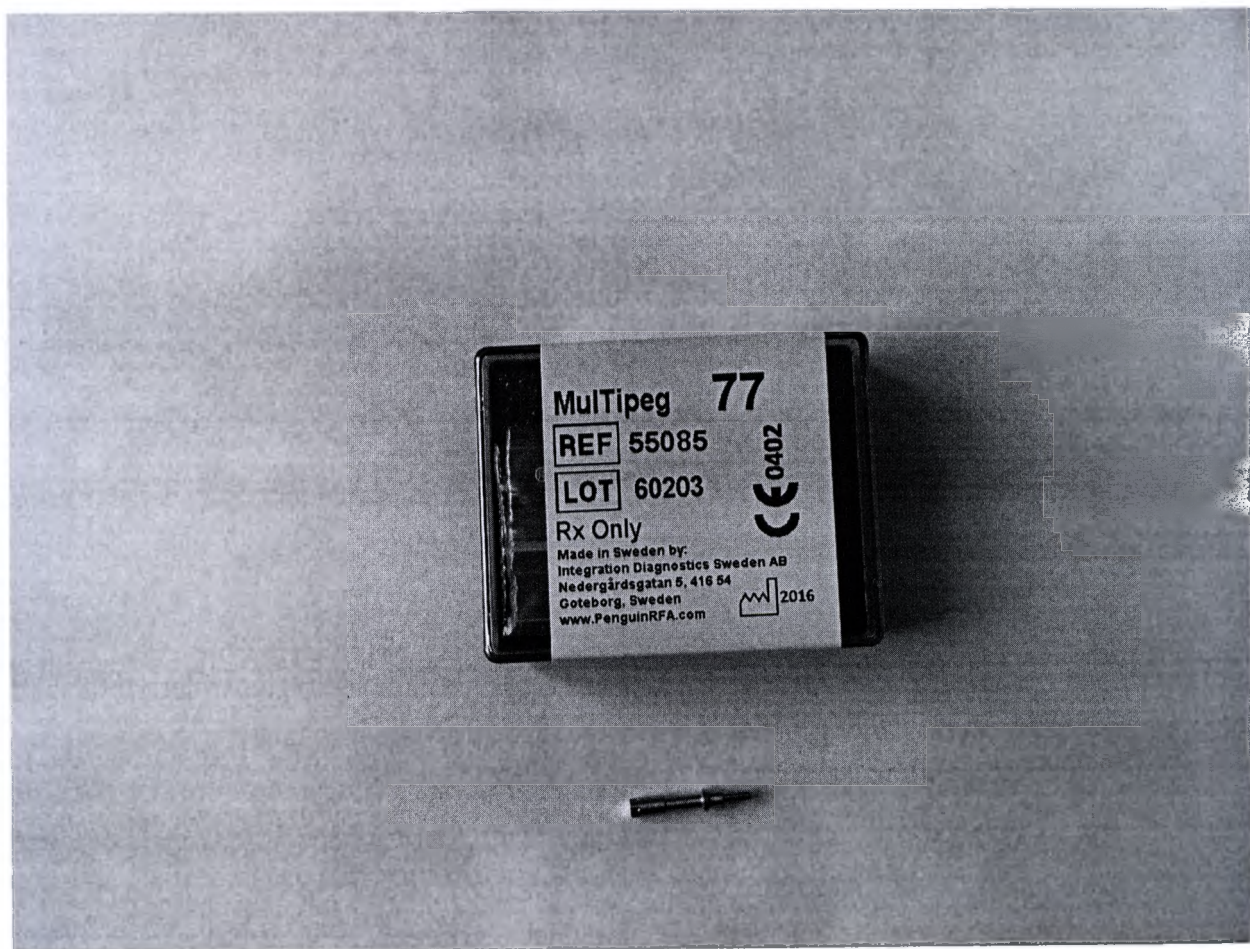


Рис. 81 Штифт MulTipeg 78

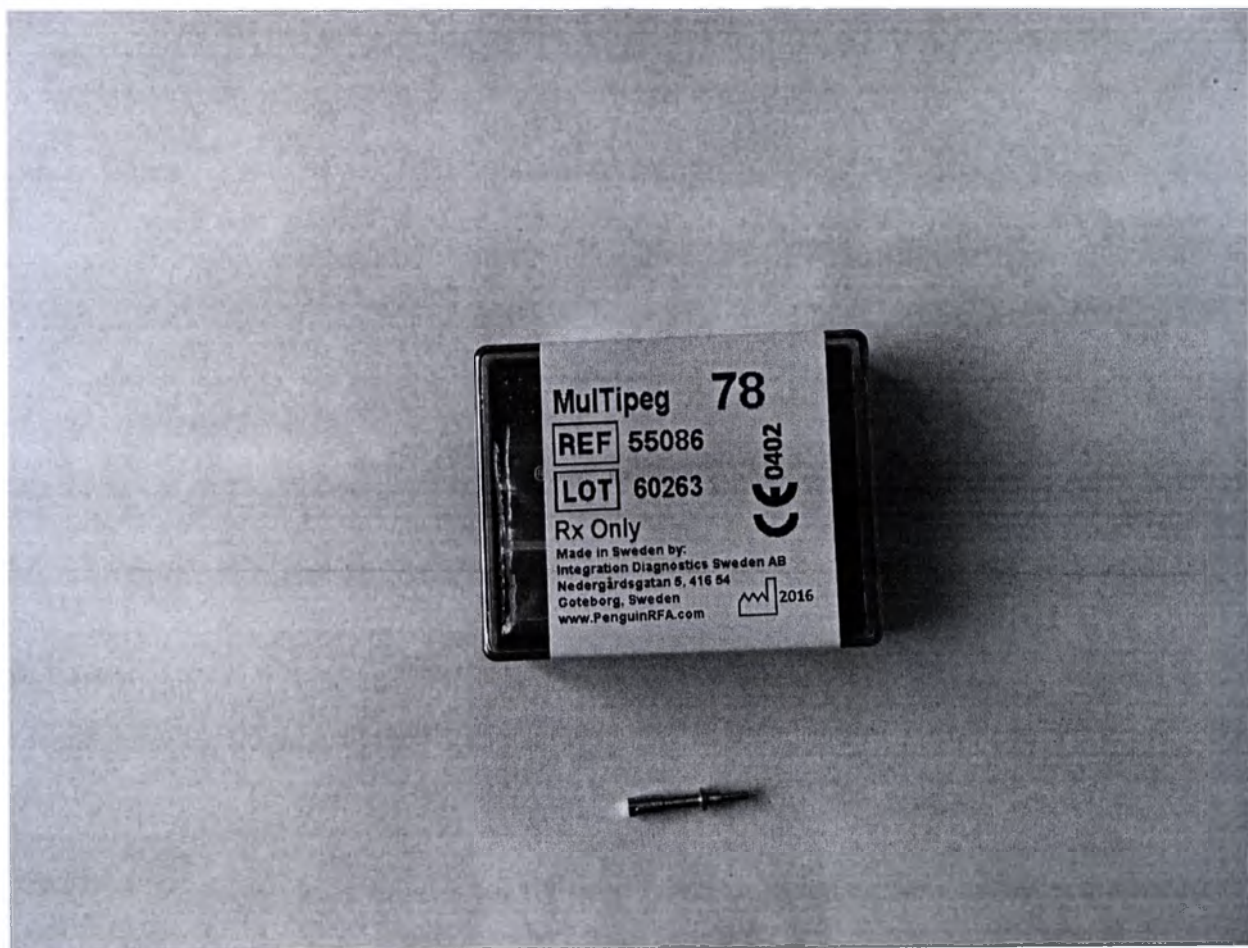


Рис. 82 Штифт MulTipeg 79


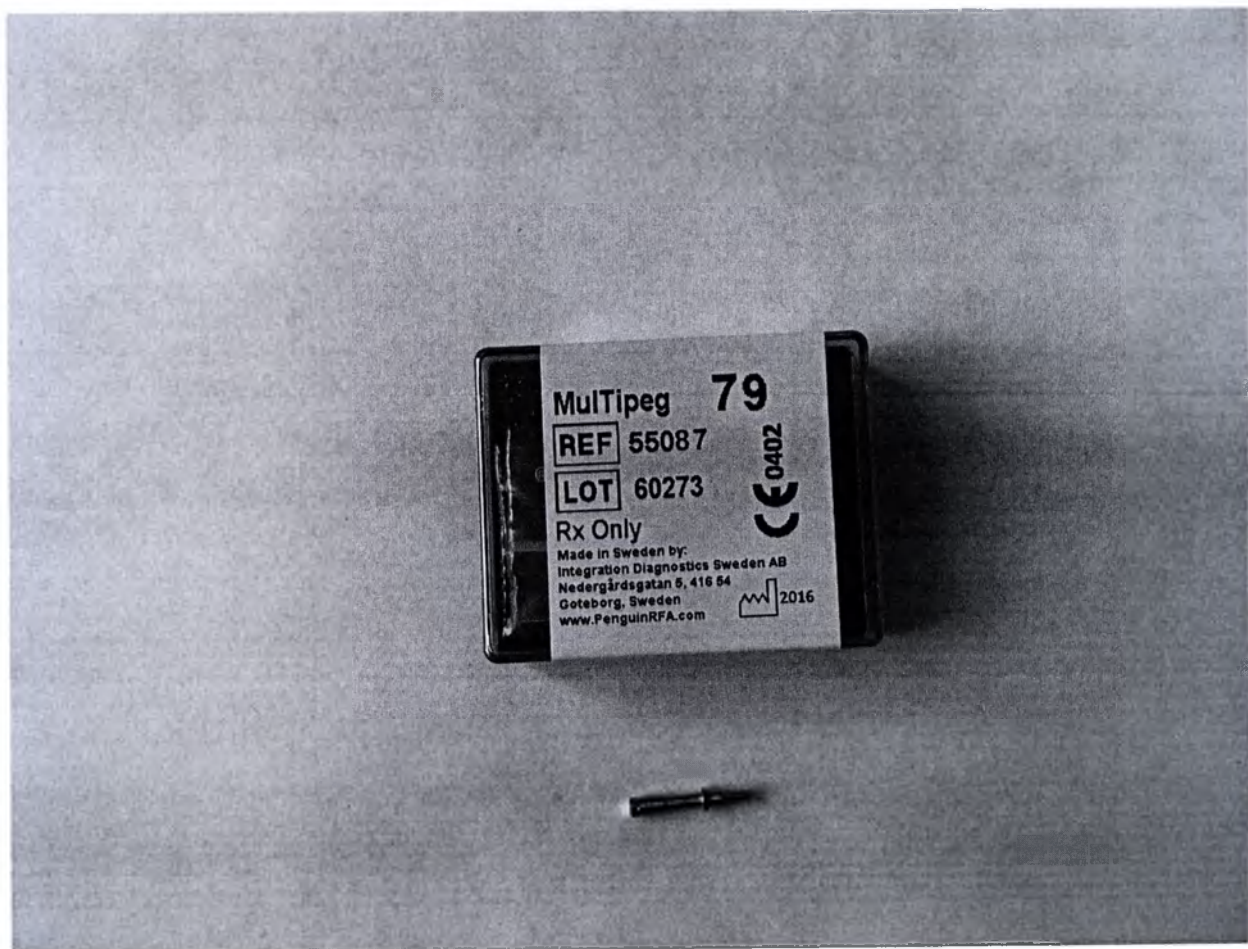


Рис. 83 Штифт MulTipeg 80

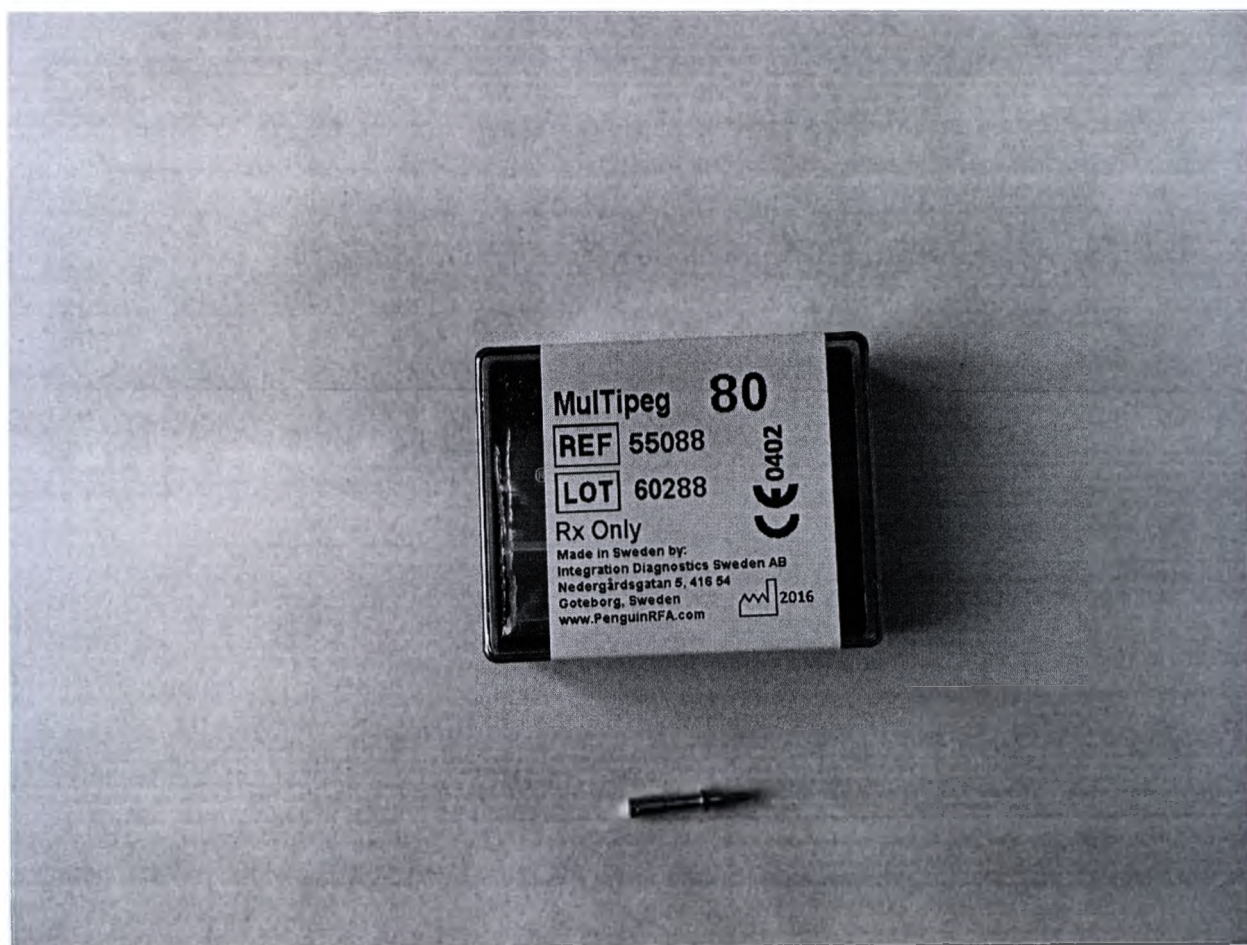

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Набор для измерения стабильности дентальных имплантатов Penguin RFA ((Implant Stability Meter Instrument Penguin RFA) с принадлежностями

Набор для измерения стабильности дентальных имплантатов Penguin RFA в составе:

I. Набор аппарата для измерения стабильности дентальных имплантатов Penguin RFA (Penguin Instrument Kit) в составе:

1. Аппарат для измерения стабильности дентальных имплантатов Penguin RFA (Implant Stability Meter Instrument Penguin RFA)
2. Отвертка (MulTipeg Driver)
3. Сетевой адаптер/зарядное устройство (Mains Adapter EU)
4. Руководство по эксплуатации

II. Штифты MulTipeg в отдельных упаковках:

MulTipeg 1 - 1 шт. в уп. (при необходимости);
MulTipeg 2 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 3 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 4 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 5 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 6 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 7 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 8 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 9 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 10 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 11 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 12 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 13 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 14 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 15 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 16 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 17 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 18 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 19 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 20 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 21 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 22 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 23 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 24 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 25 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 26 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 27 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 28 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 29 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);

MulTipeg 76 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 77 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 78 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 79 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);
MulTipeg 80 - 1 шт. в уп.; (при необходимости);

Принадлежности:

1. Штифты MulTipegs в отдельных упаковках:

MulTipeg 1 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 2 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 3 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 4 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 5 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 6 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 7 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 8 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 9 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 10 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 11 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 12 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 13 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 14 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 15 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 16 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 17 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 18 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 19 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 20 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 21 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 22 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 23 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 24 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 25 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 26 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 27 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 28 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 29 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 30 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 31 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 32 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 33 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 34 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 35 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 36 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 37 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 38 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;

MulTipeg 39 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 40 - 1 шт. в уп., не более 50 уп. ;
MulTipeg 41 - 1 шт. в уп., не более 50 уп. ;
MulTipeg 42 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 43 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 44 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 45 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 46 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 47 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 48 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 49 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 50 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 51 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 52 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 53 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 54 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 55 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 56 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 57 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 58 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 59 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 60 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 61 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 62 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 63 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 64 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 65 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 66 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 67 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 68 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 69 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 70 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 71 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 72 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 73 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 74 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 75 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 76 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 77 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 78 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 79 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;
MulTipeg 80 - 1 шт. в уп., не более 50 уп.;

2. Отвертка (MulTipeg Driver);

3. Сетевой адаптер/зарядное устройство (Mains Adapter EU)

Прошито и пронумеровано

88 лист 6

