





I. Варианты исполнения:

1. Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S7 Expert:

1.1. Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской.

3

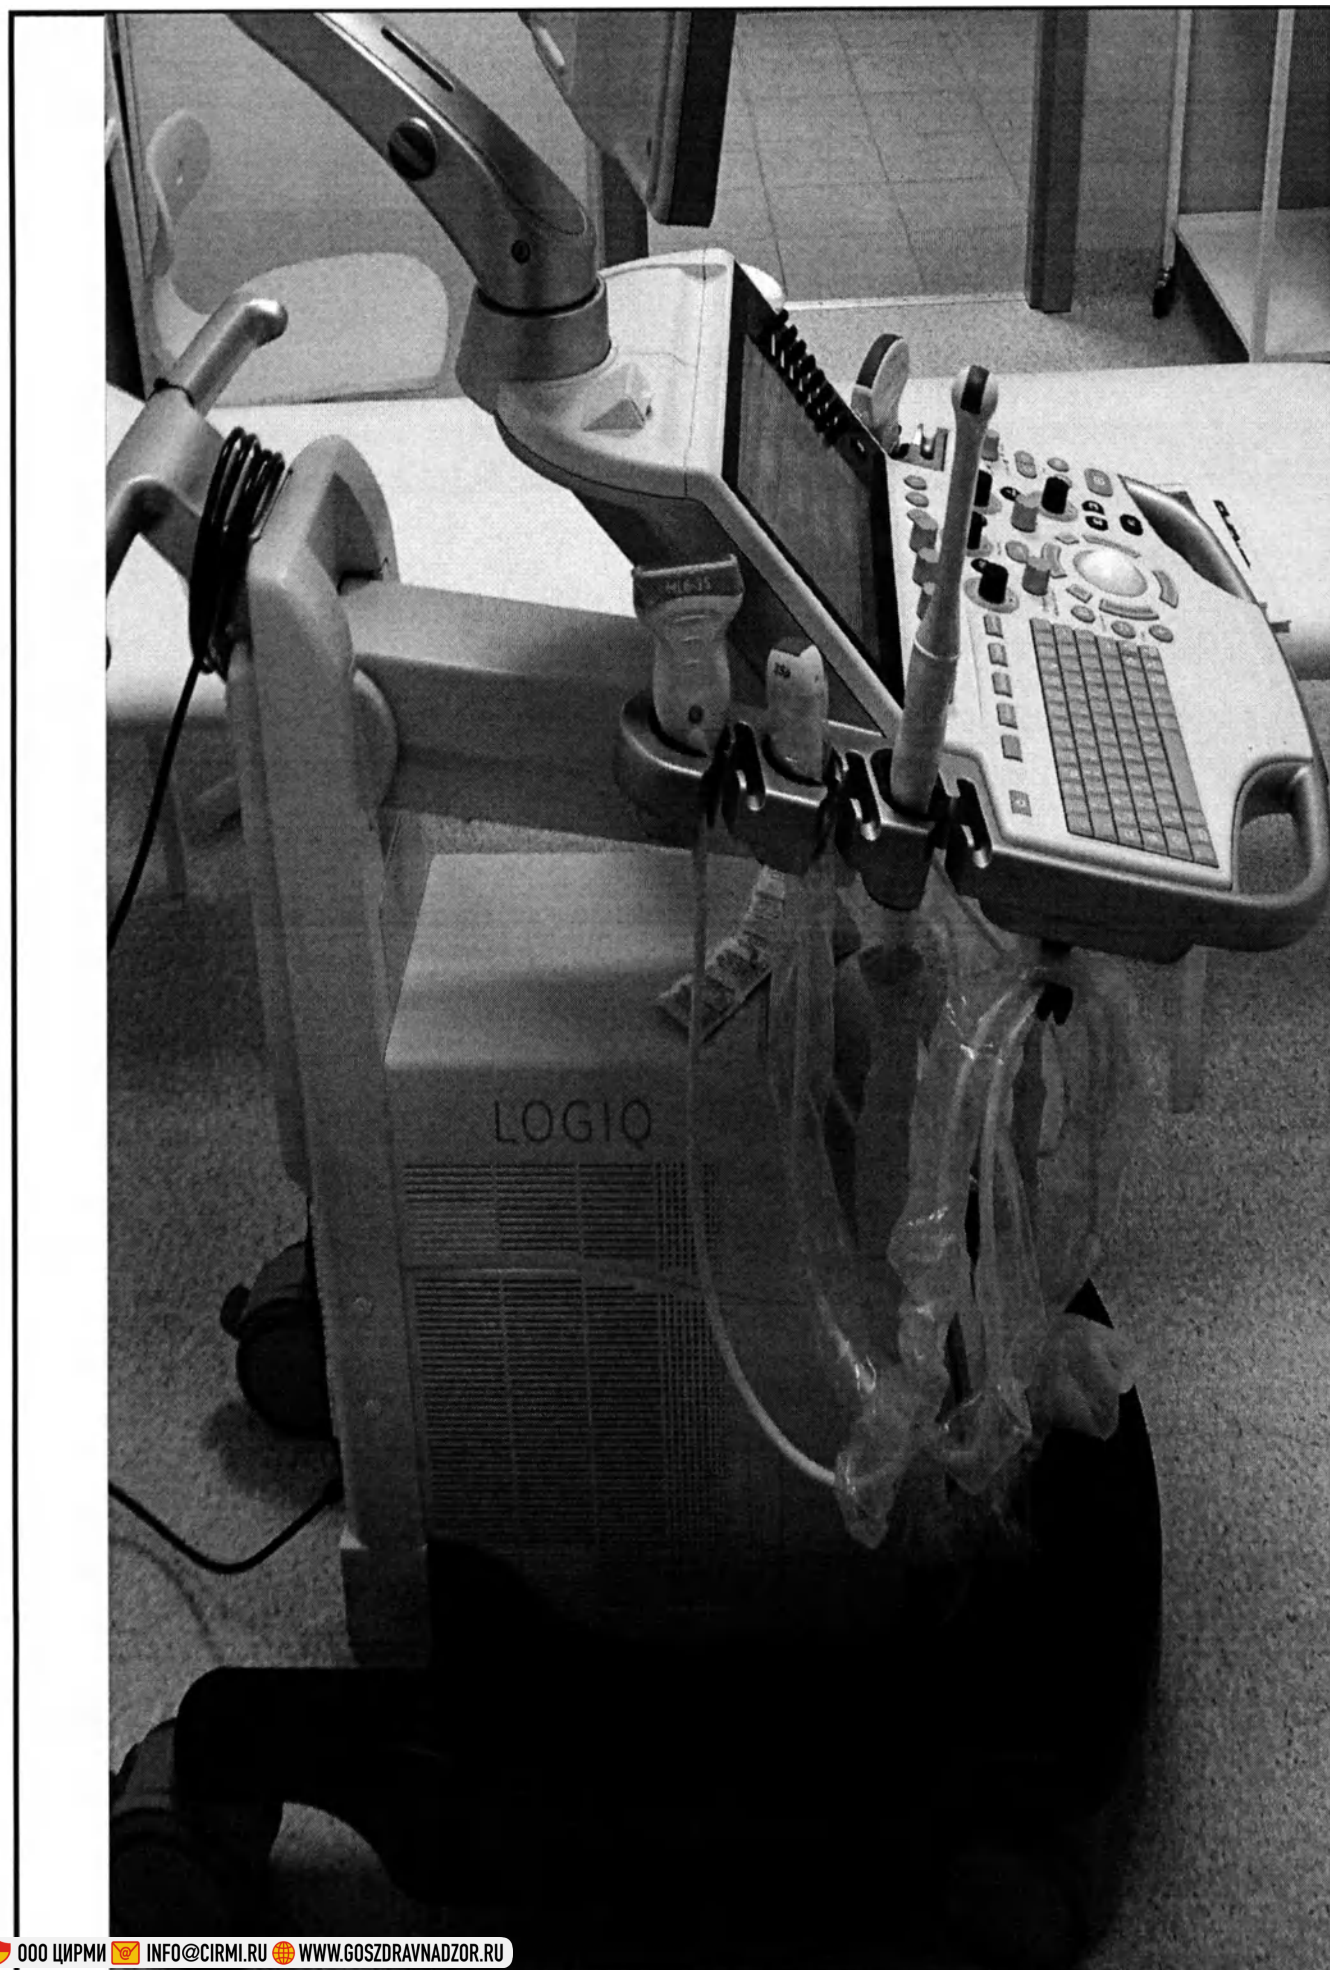


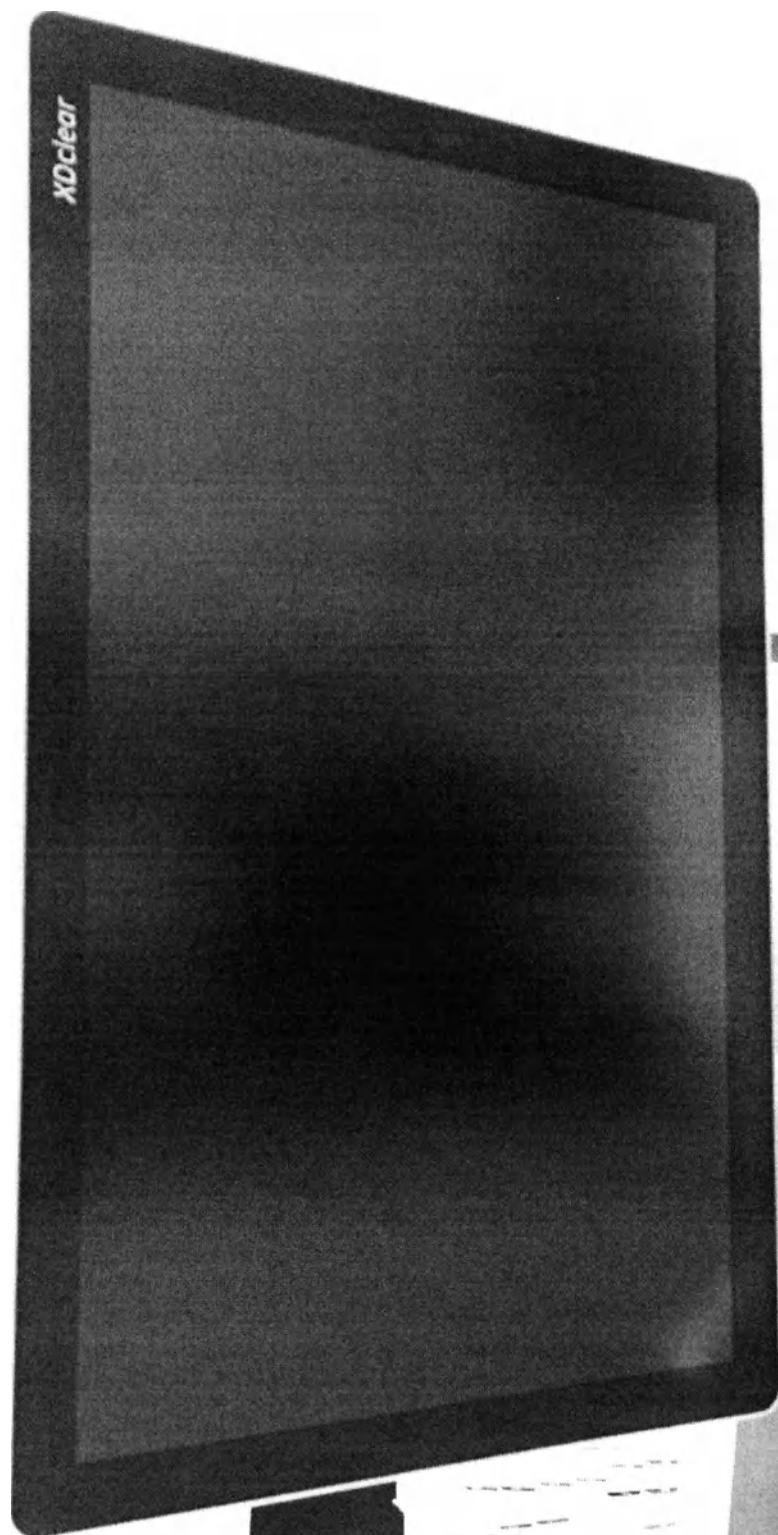





2. Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S7 Expert с устройством для хранения, обработки (дезинфекции) и тестирования чрепщеводных датчиков. 6

2.1. Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской.

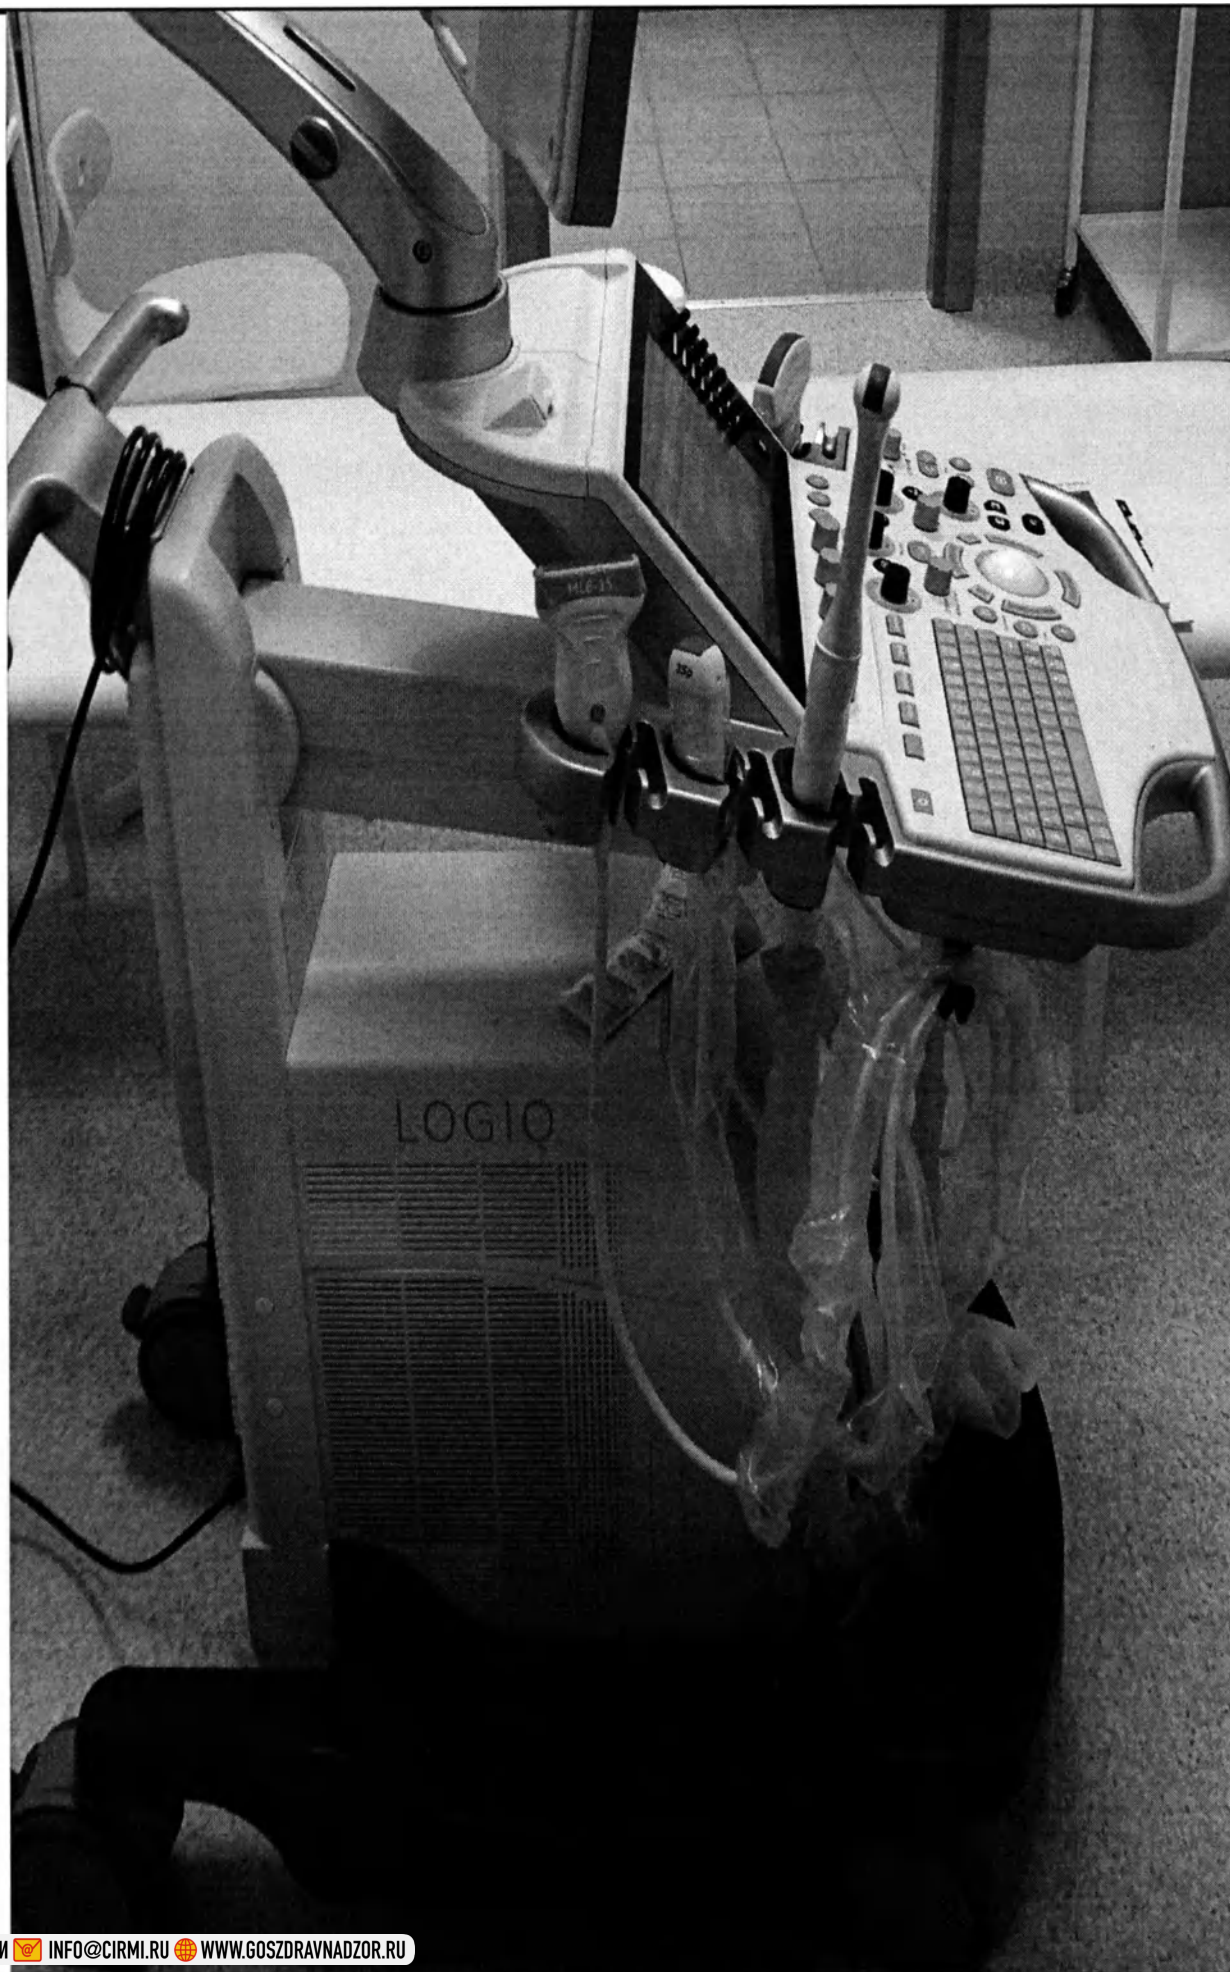

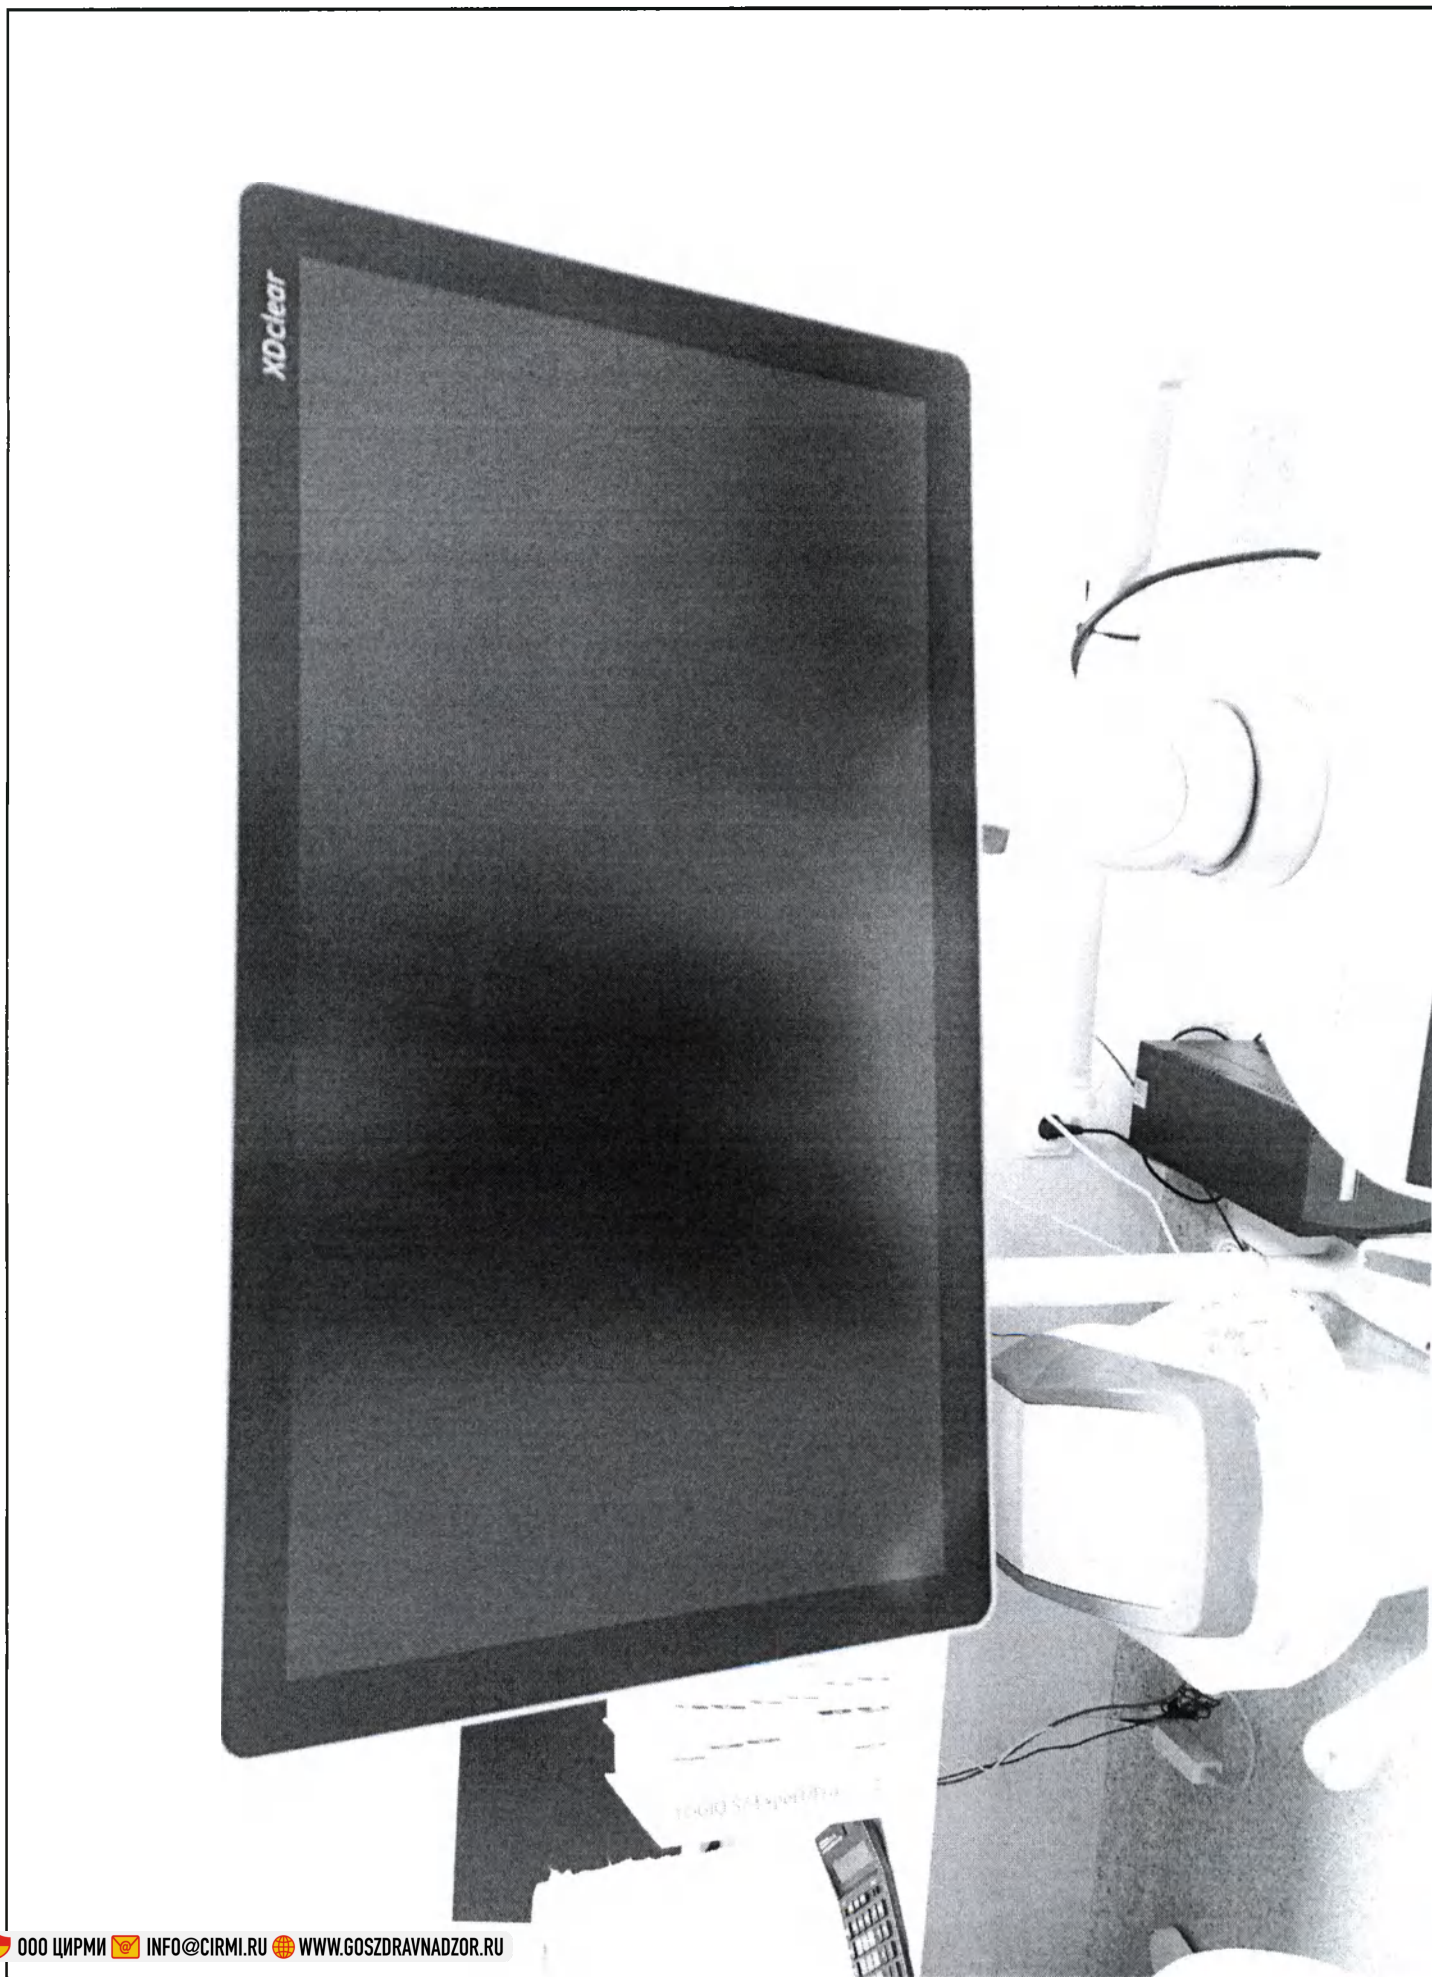



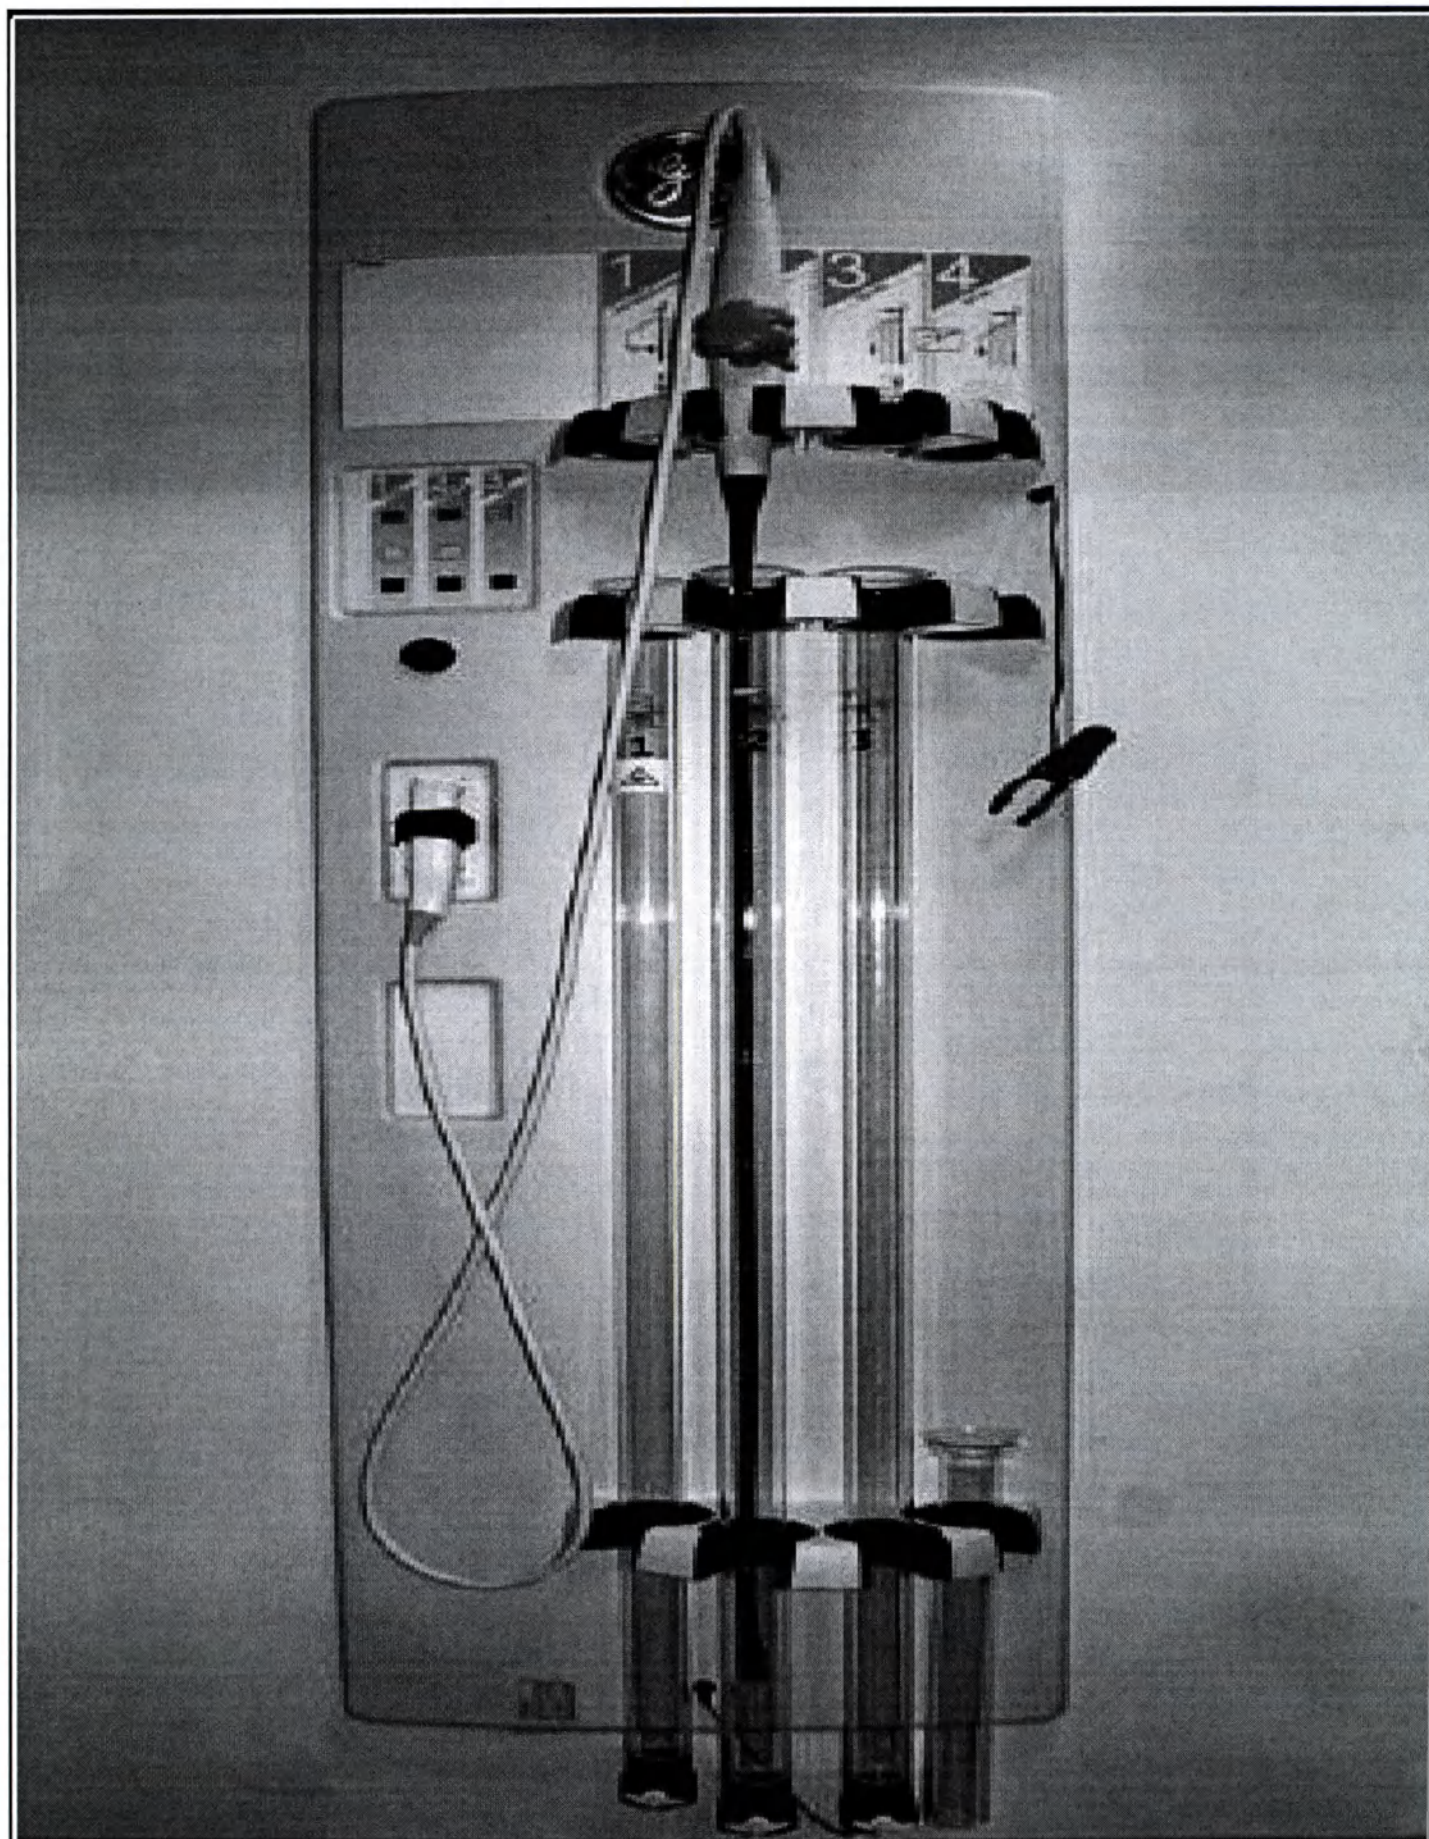



Технические издания

Руководство пользователя устройства
для хранения, обработки и тестирования
чреспищеводных датчиков

CE 0123


Руководство пользователя
KZ192885 — на русском языке

Ред. 11

Рабочая документация

© 2016 General Electric Co.

1. Руководство пользователя для LOGIQ S7 Expert на английском языке.

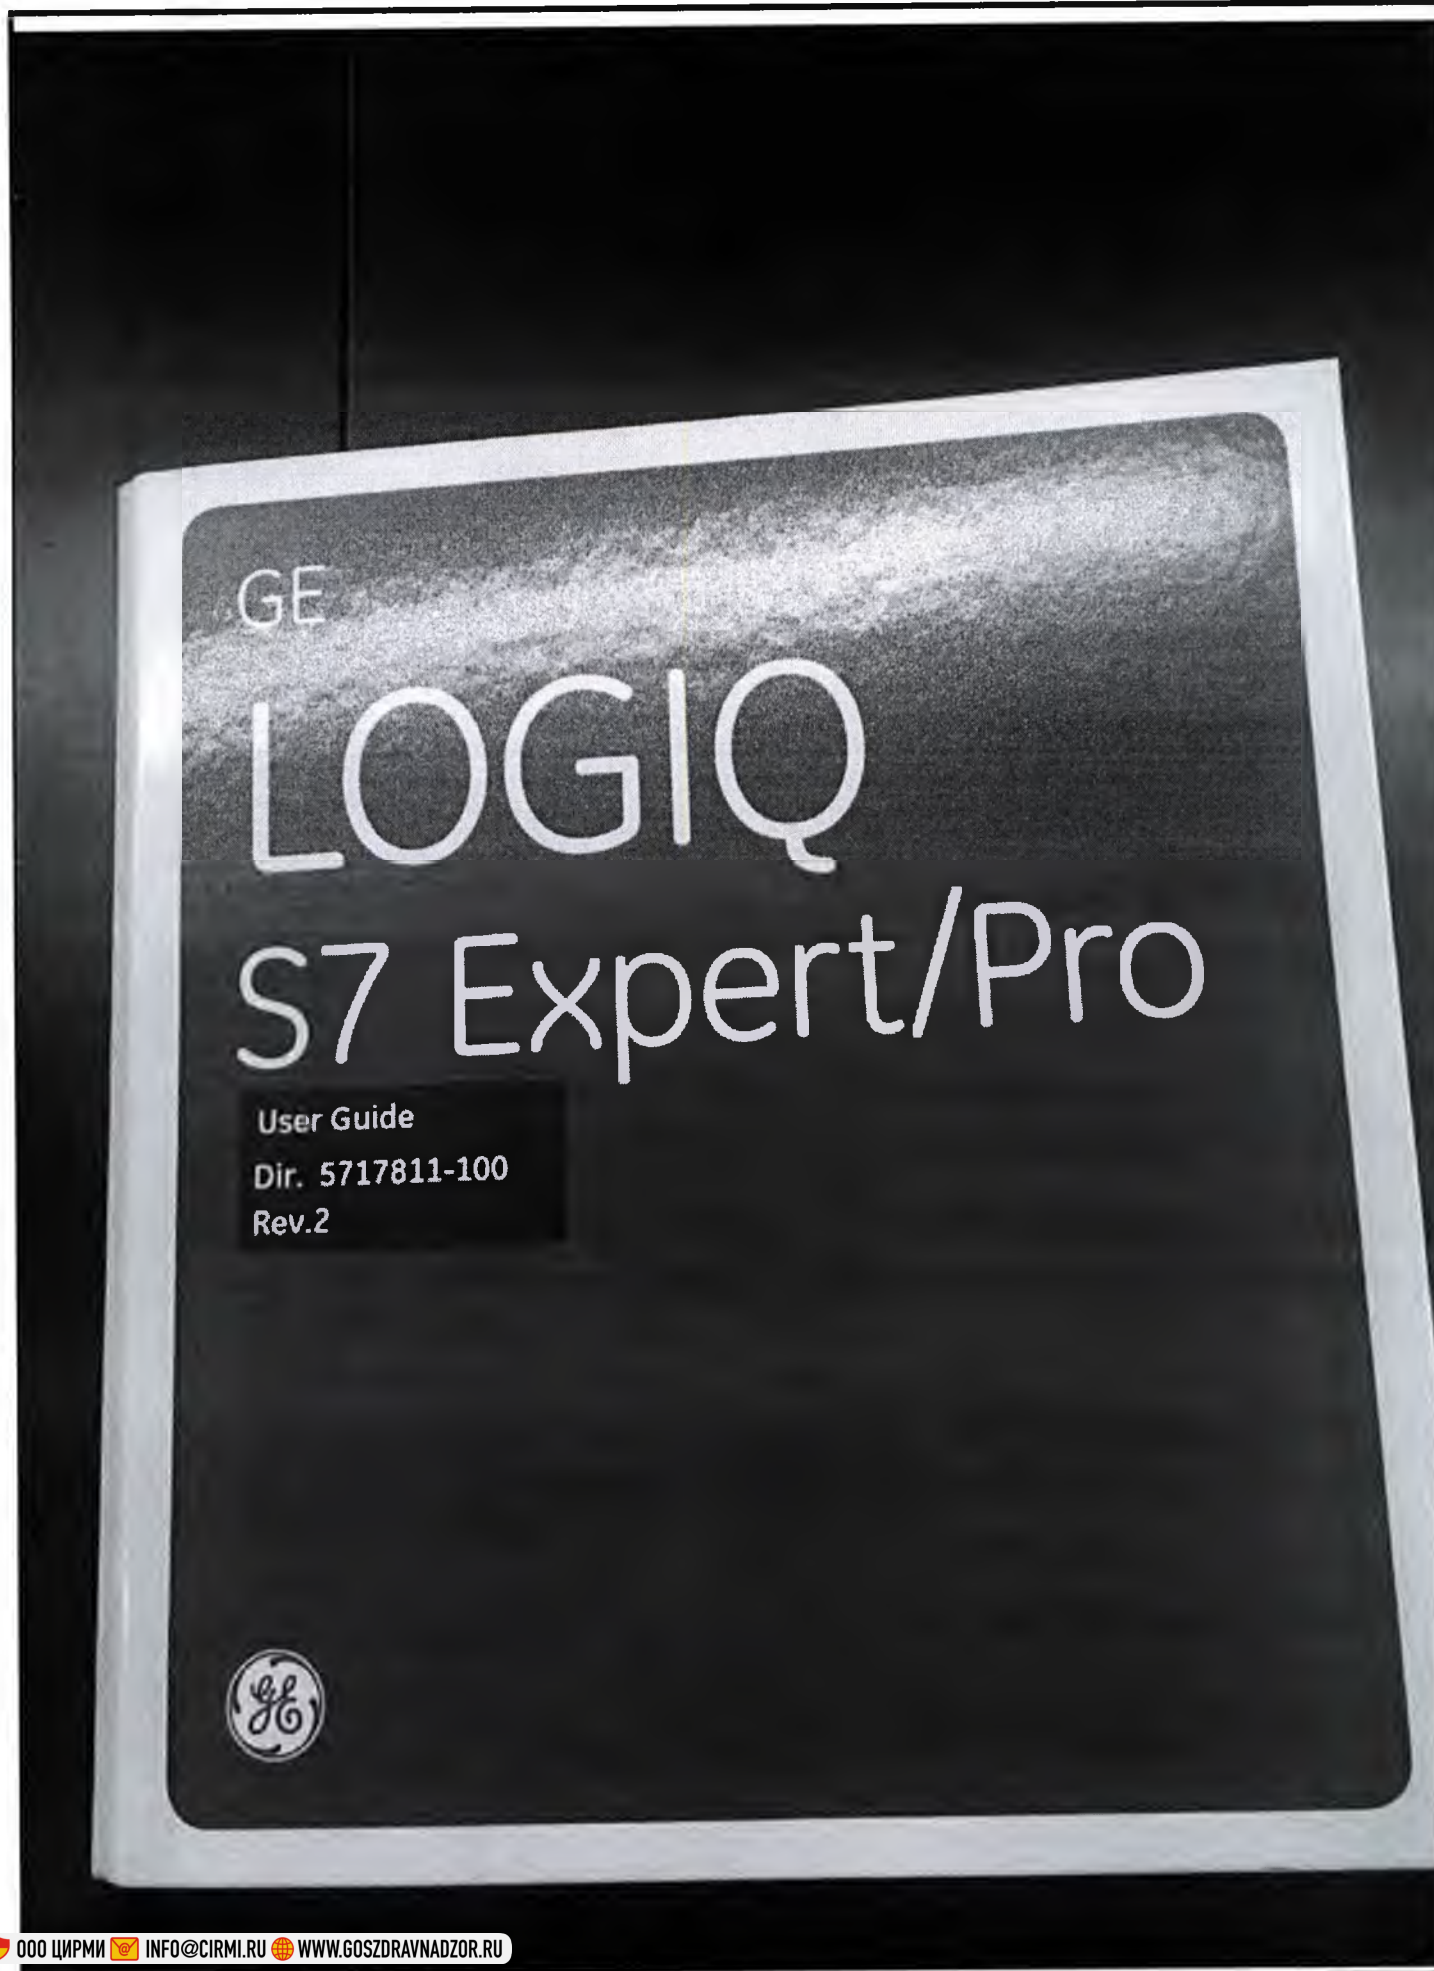

GE Healthcare

LOGIQ


S7 Expert/Pro

User Guide

Dir. 5717811-145


Rev.1



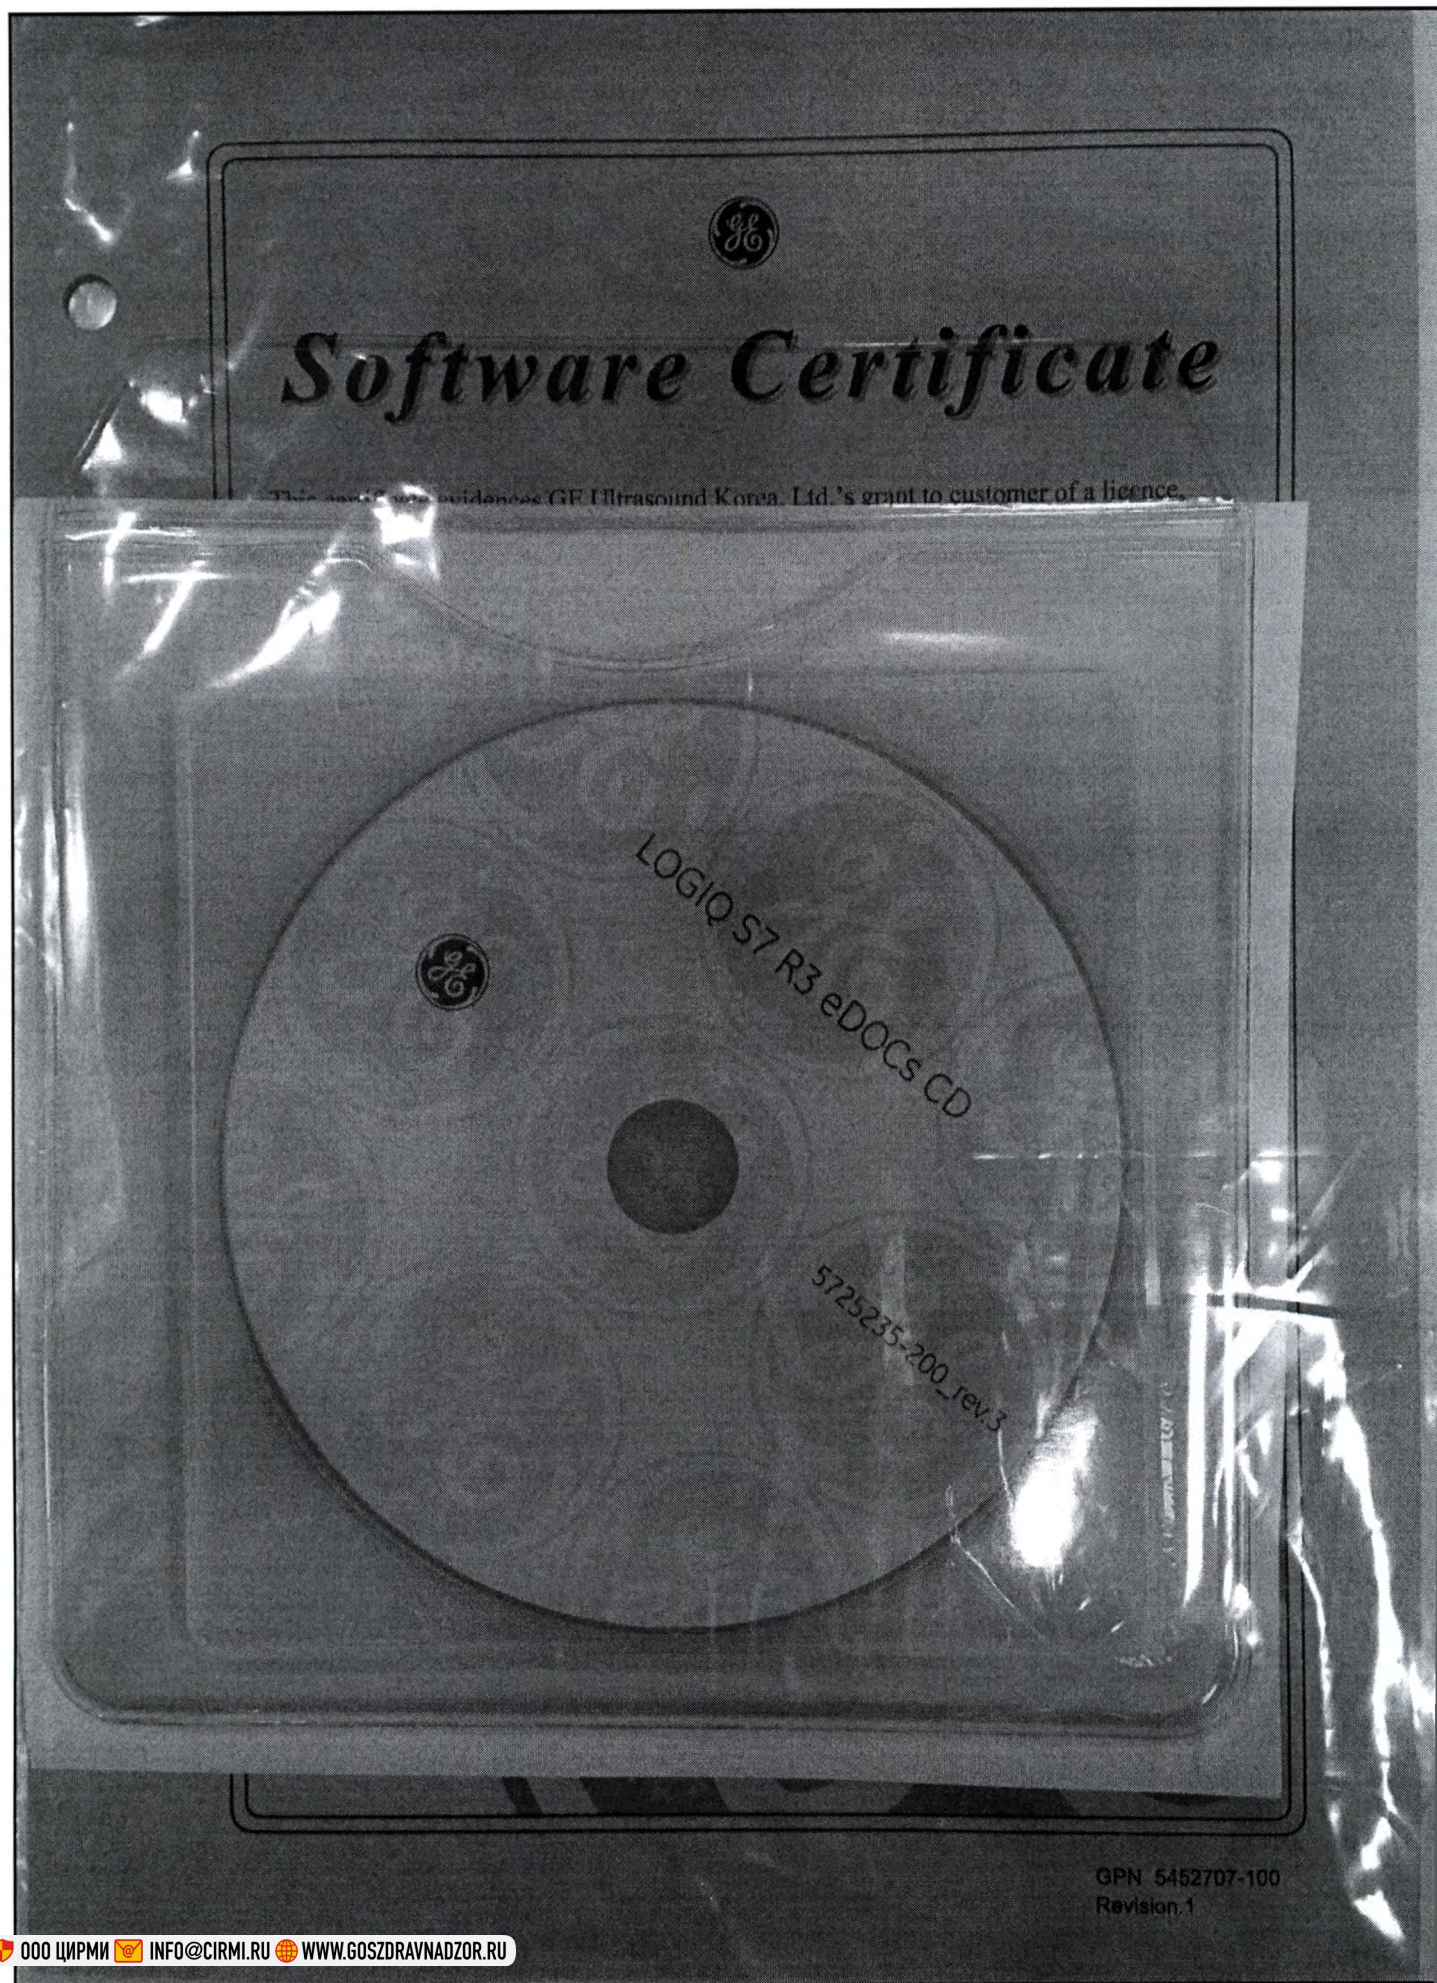

GPN 5452707-100
Revision 1



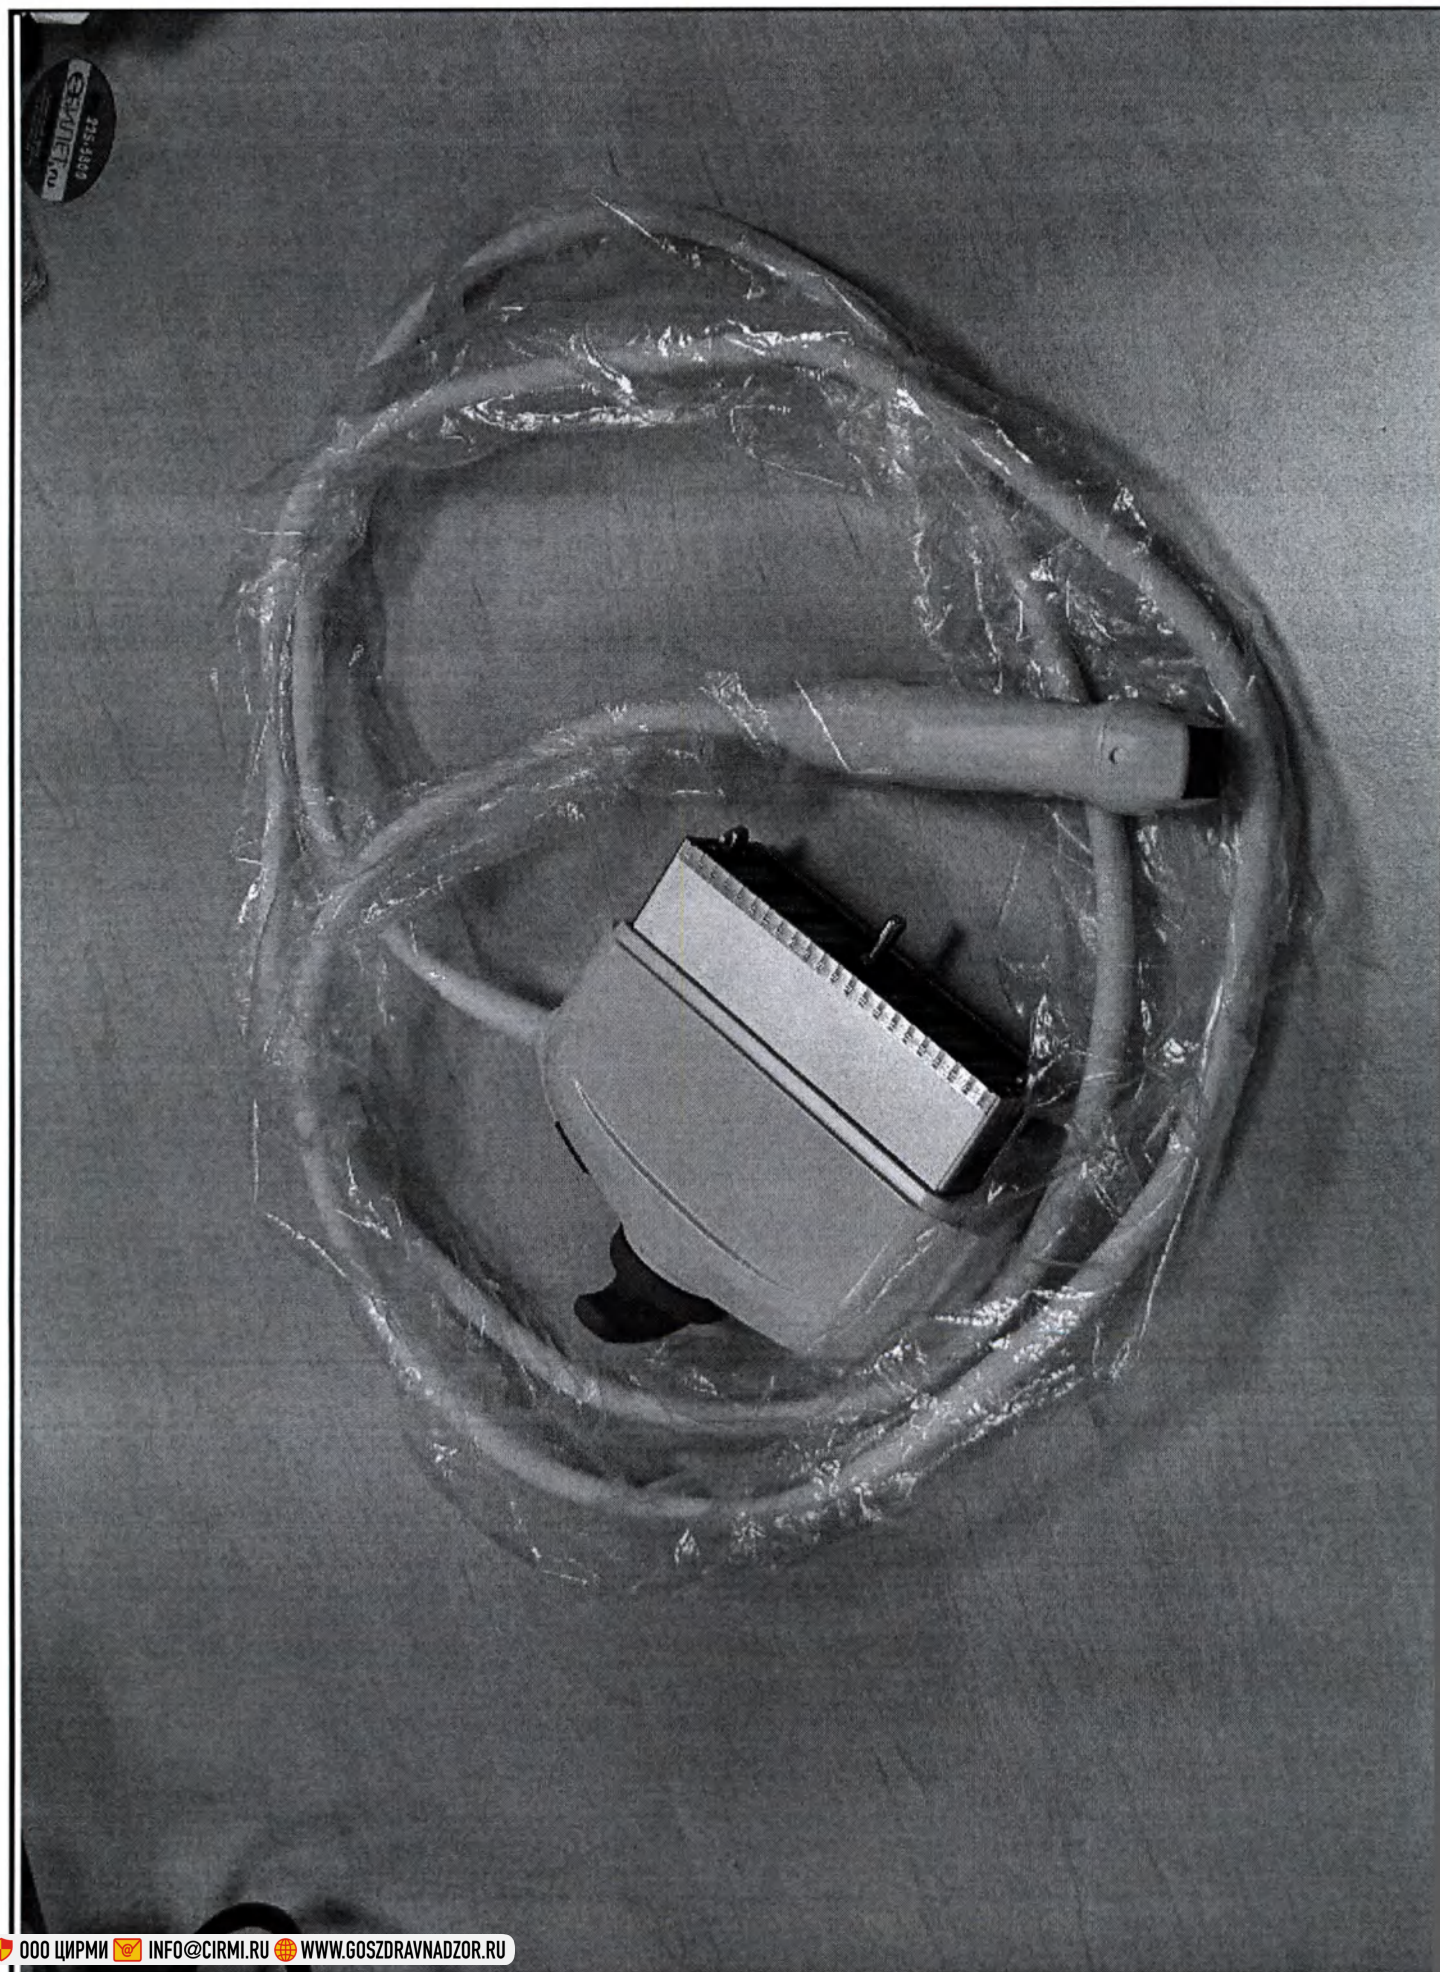






8. Датчик секторный фазированный S1-4-D.


18




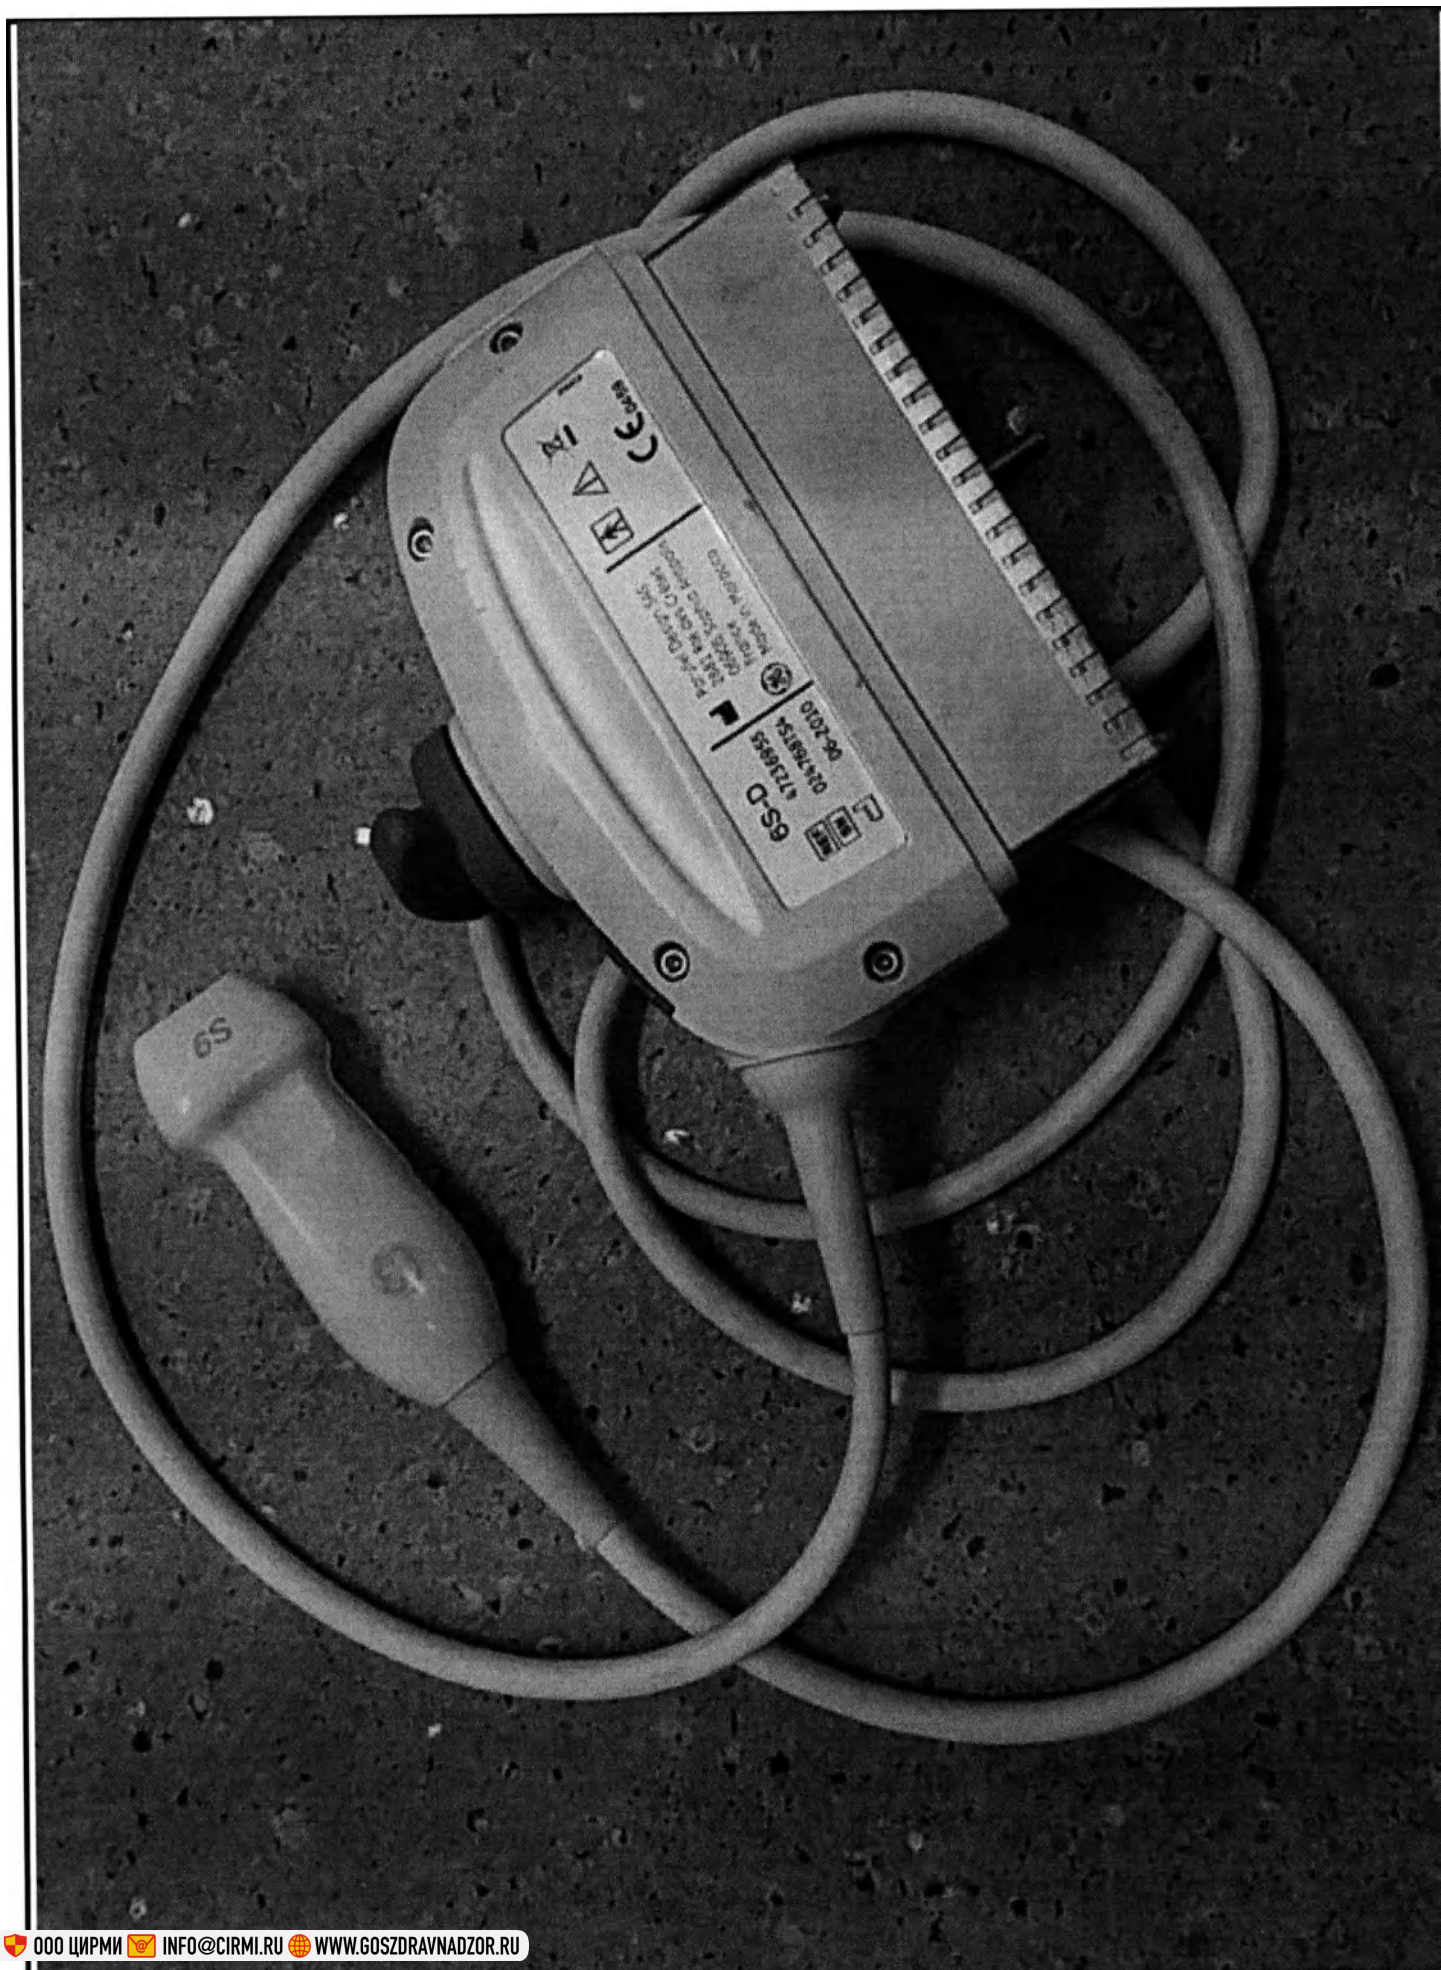







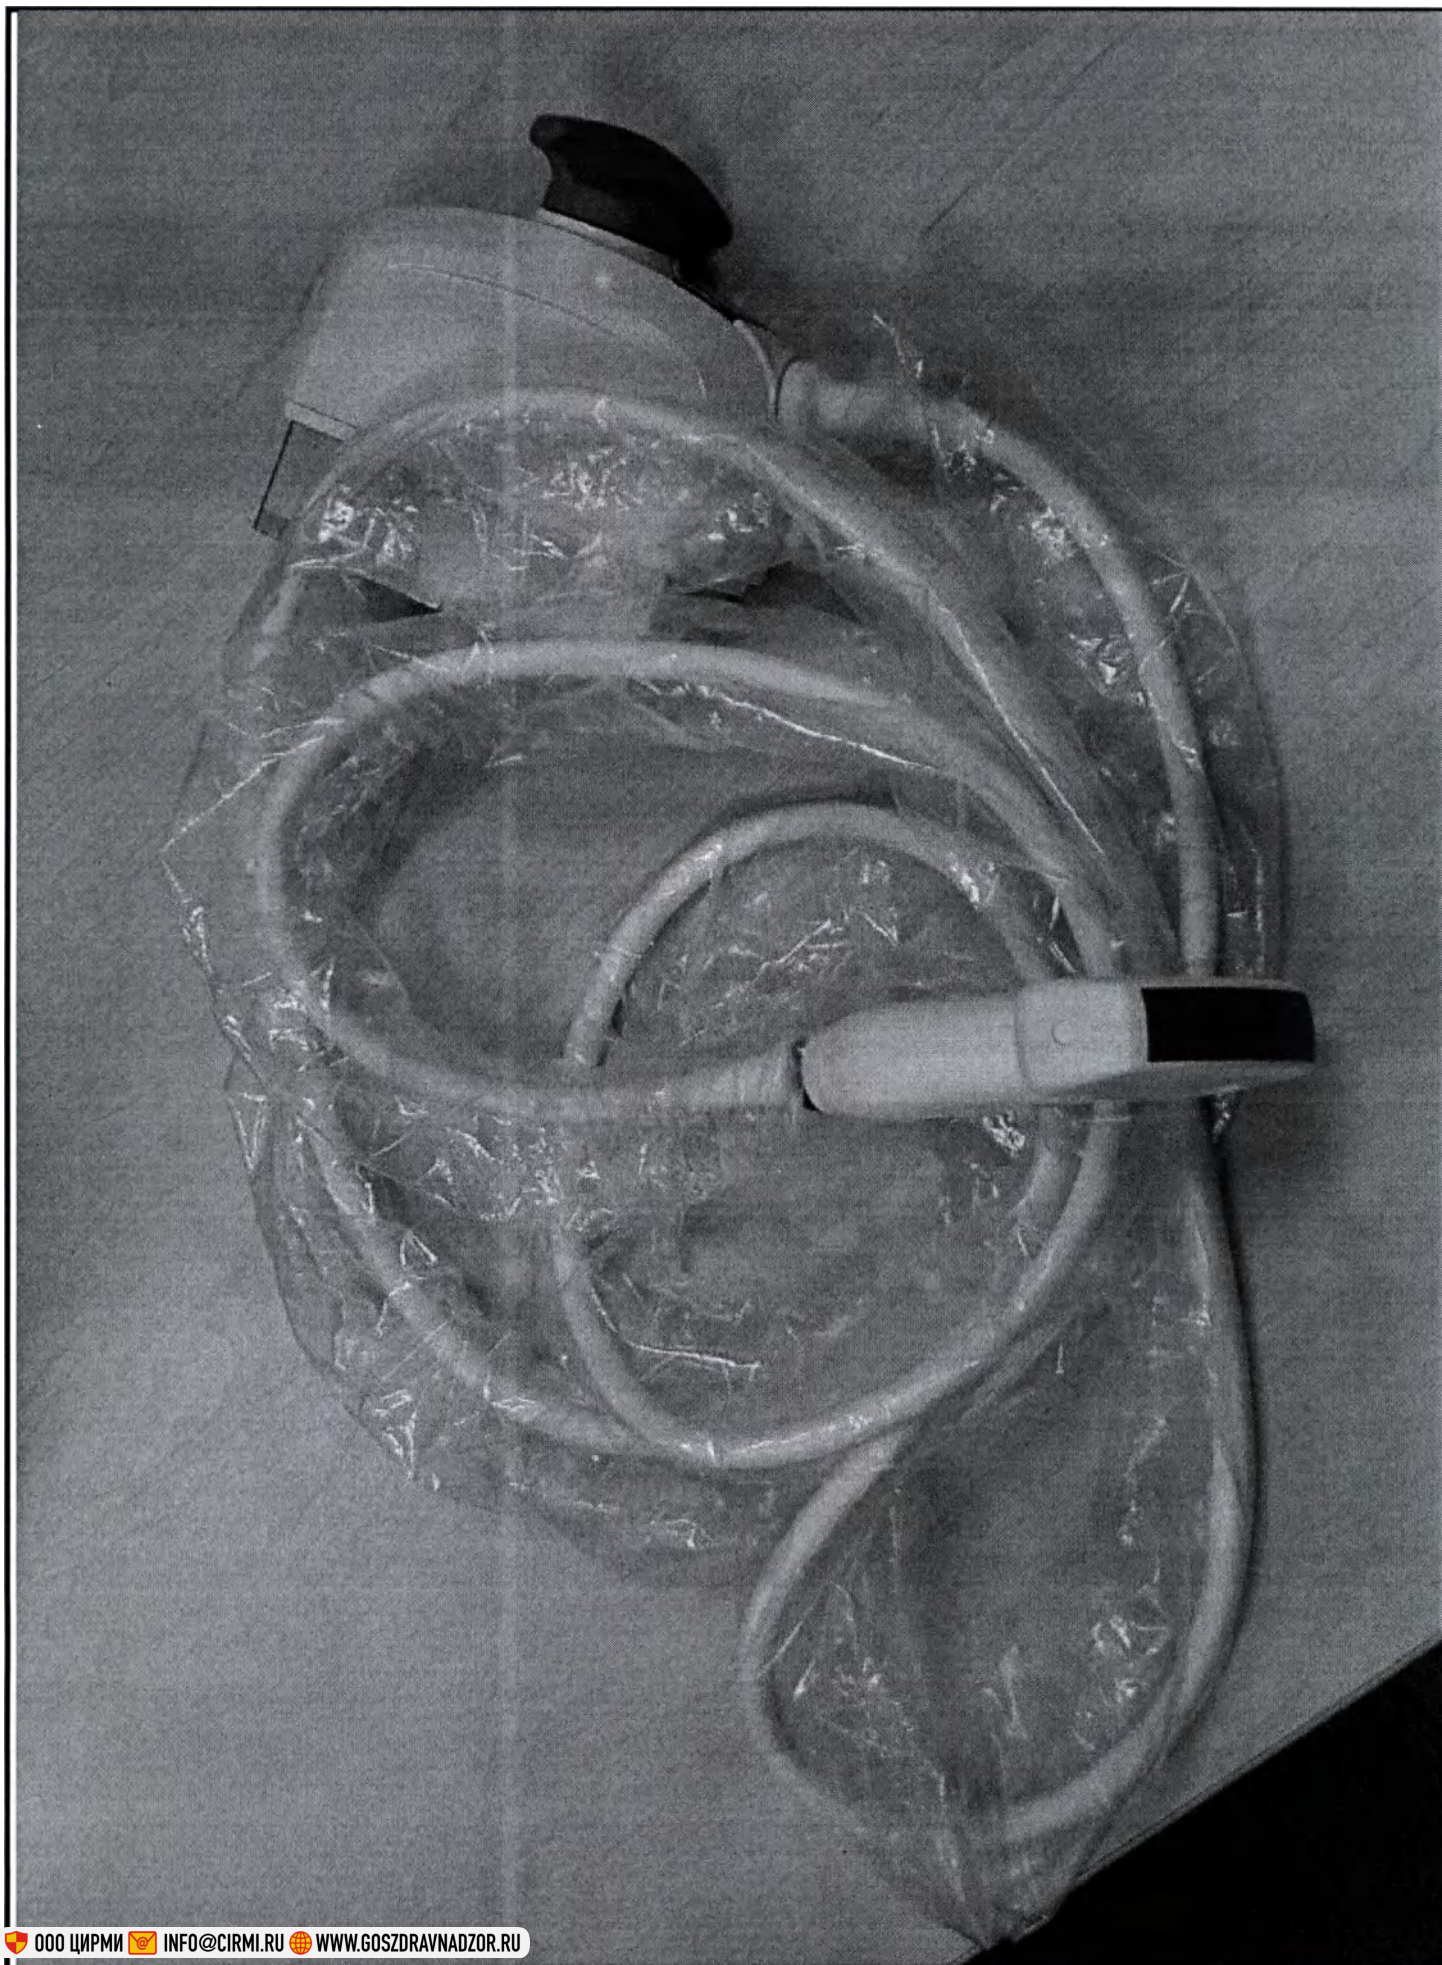

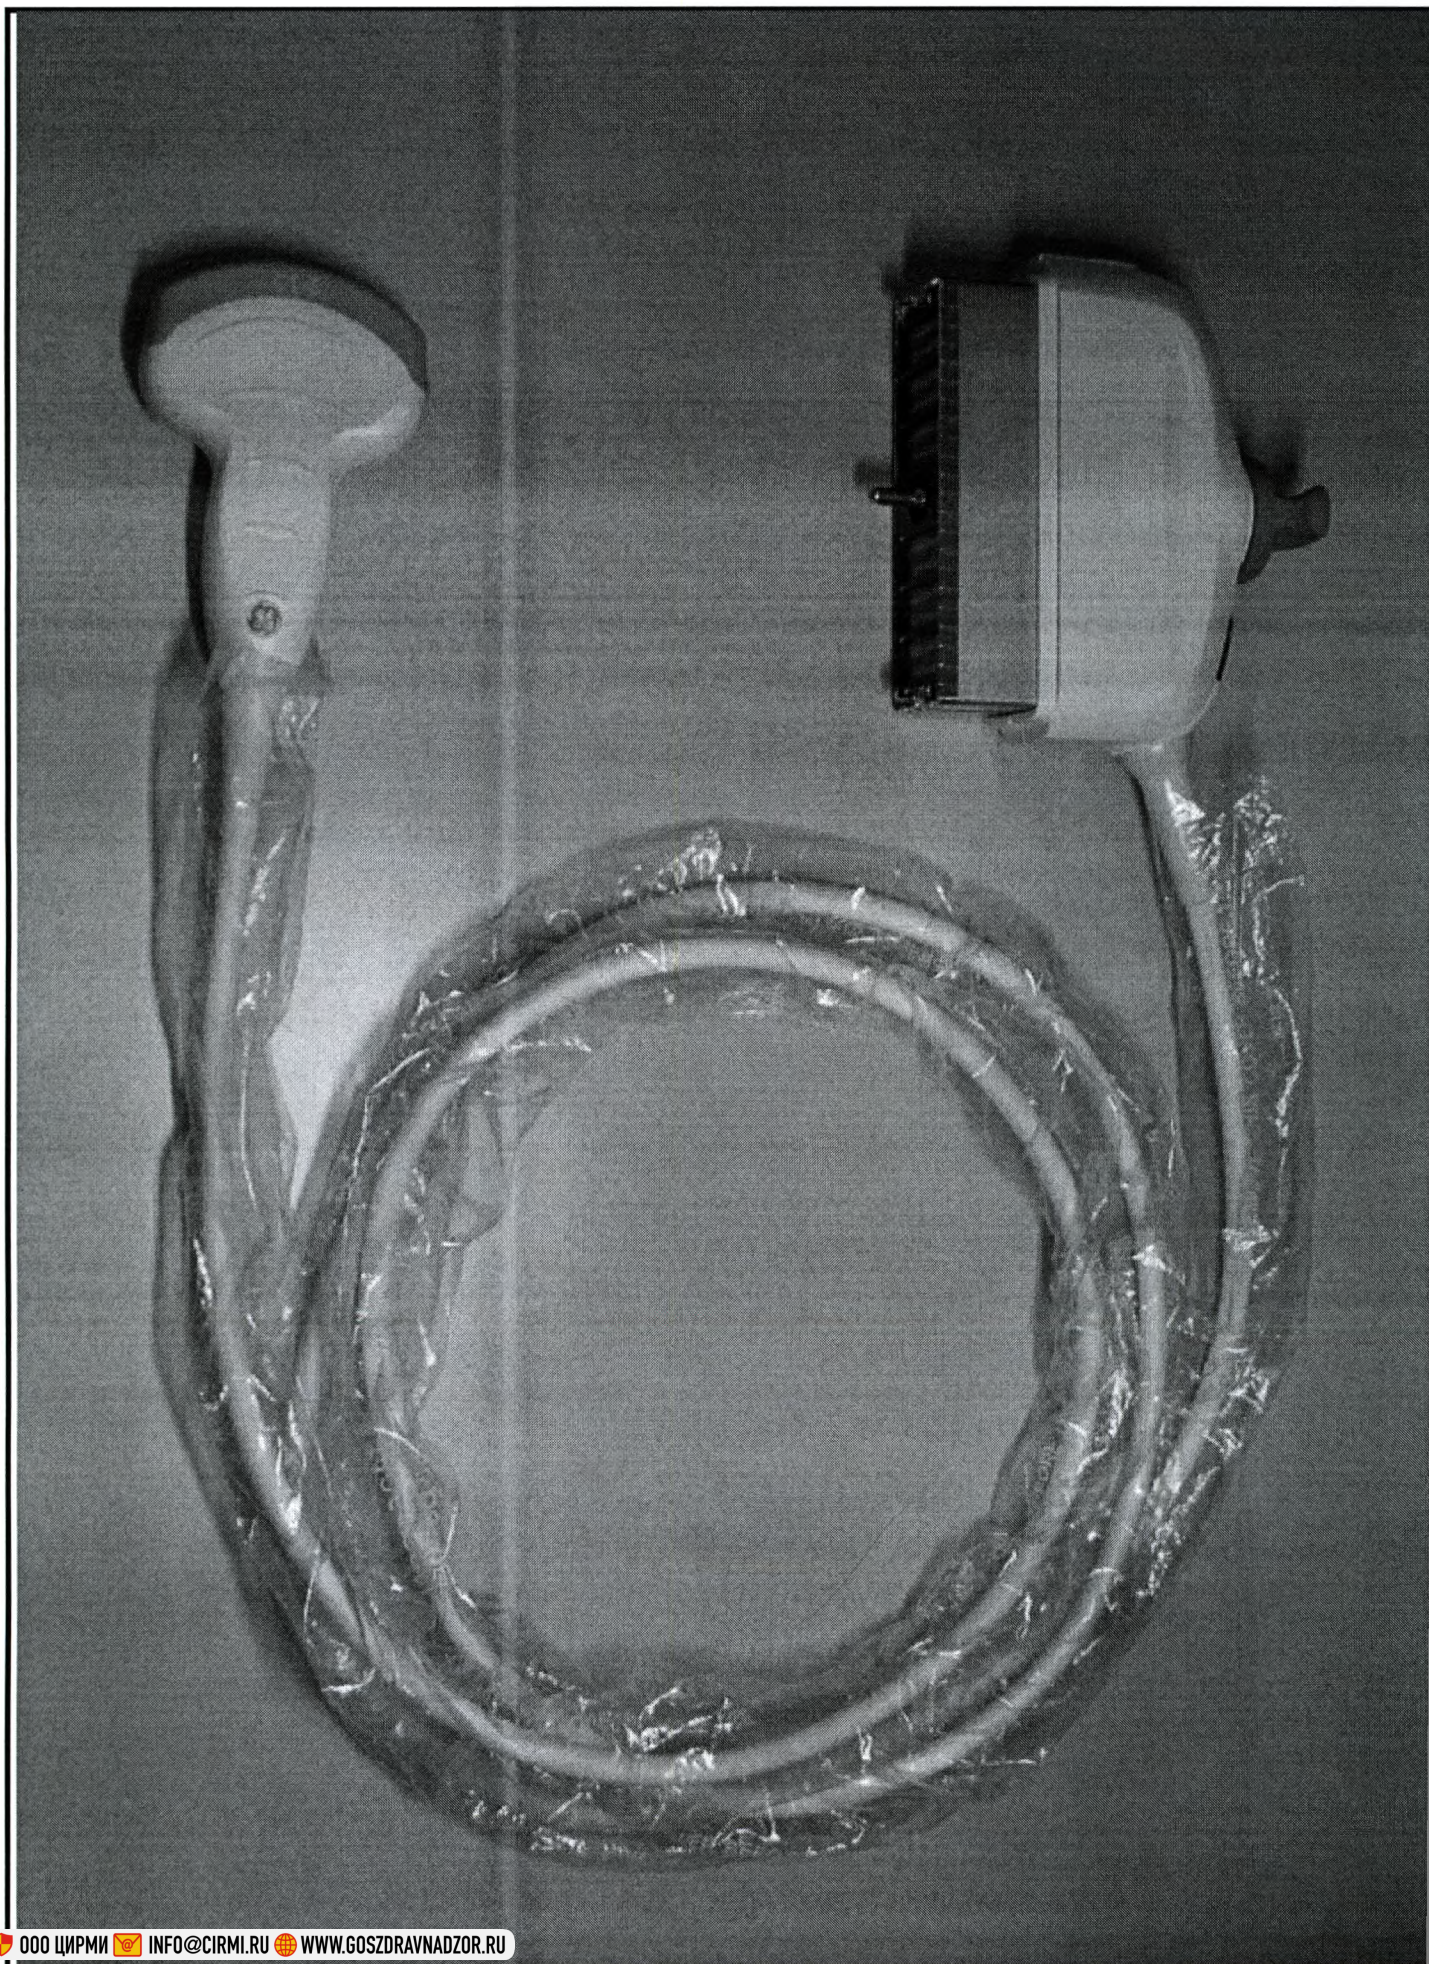

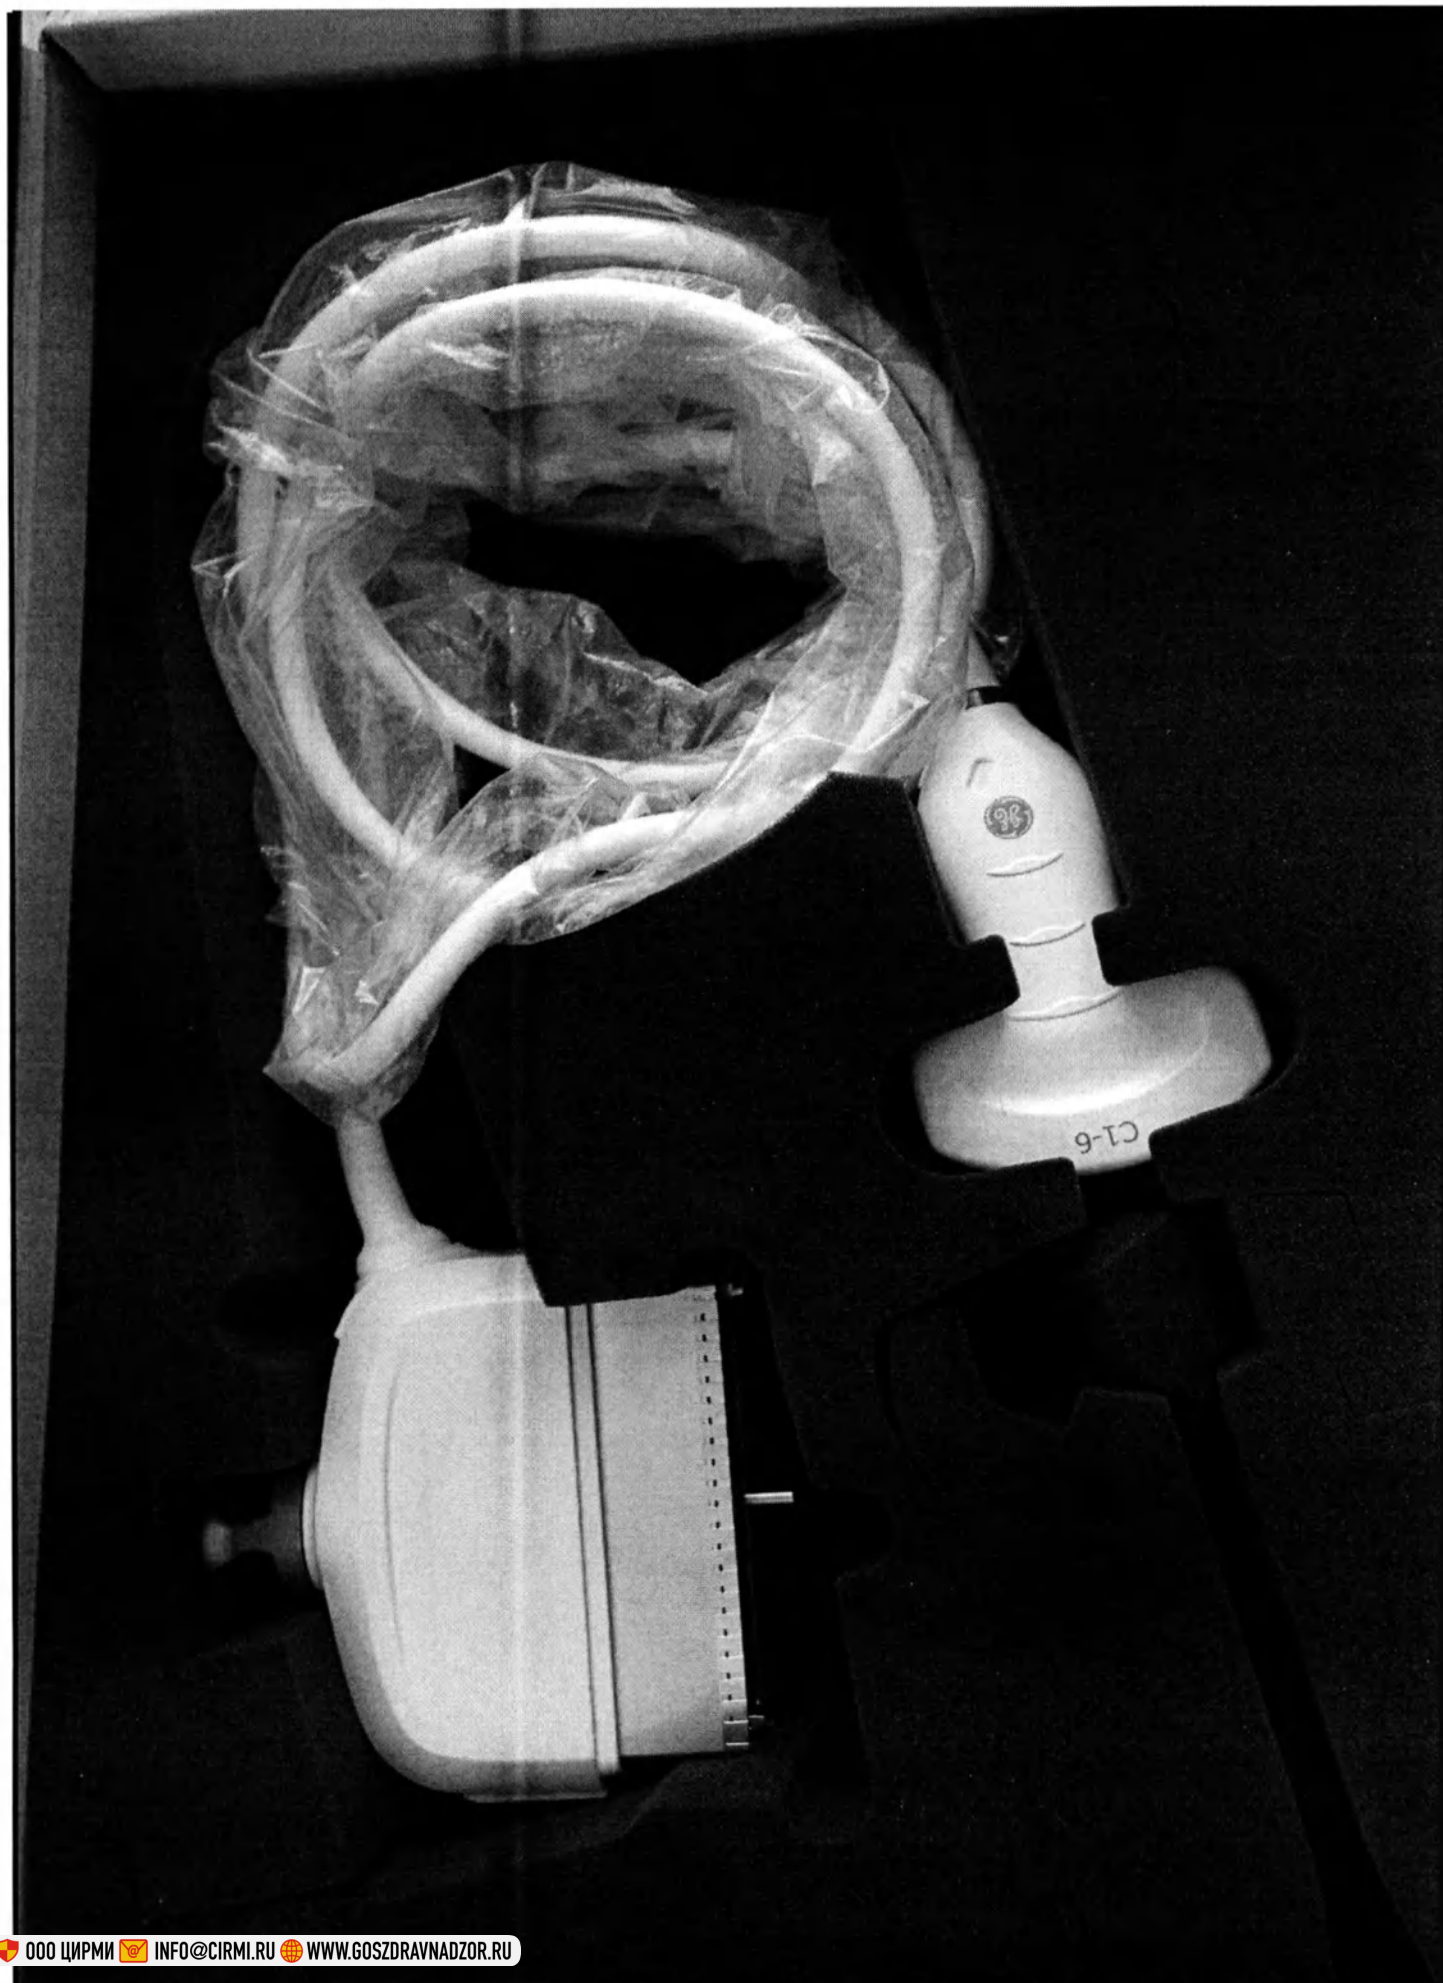


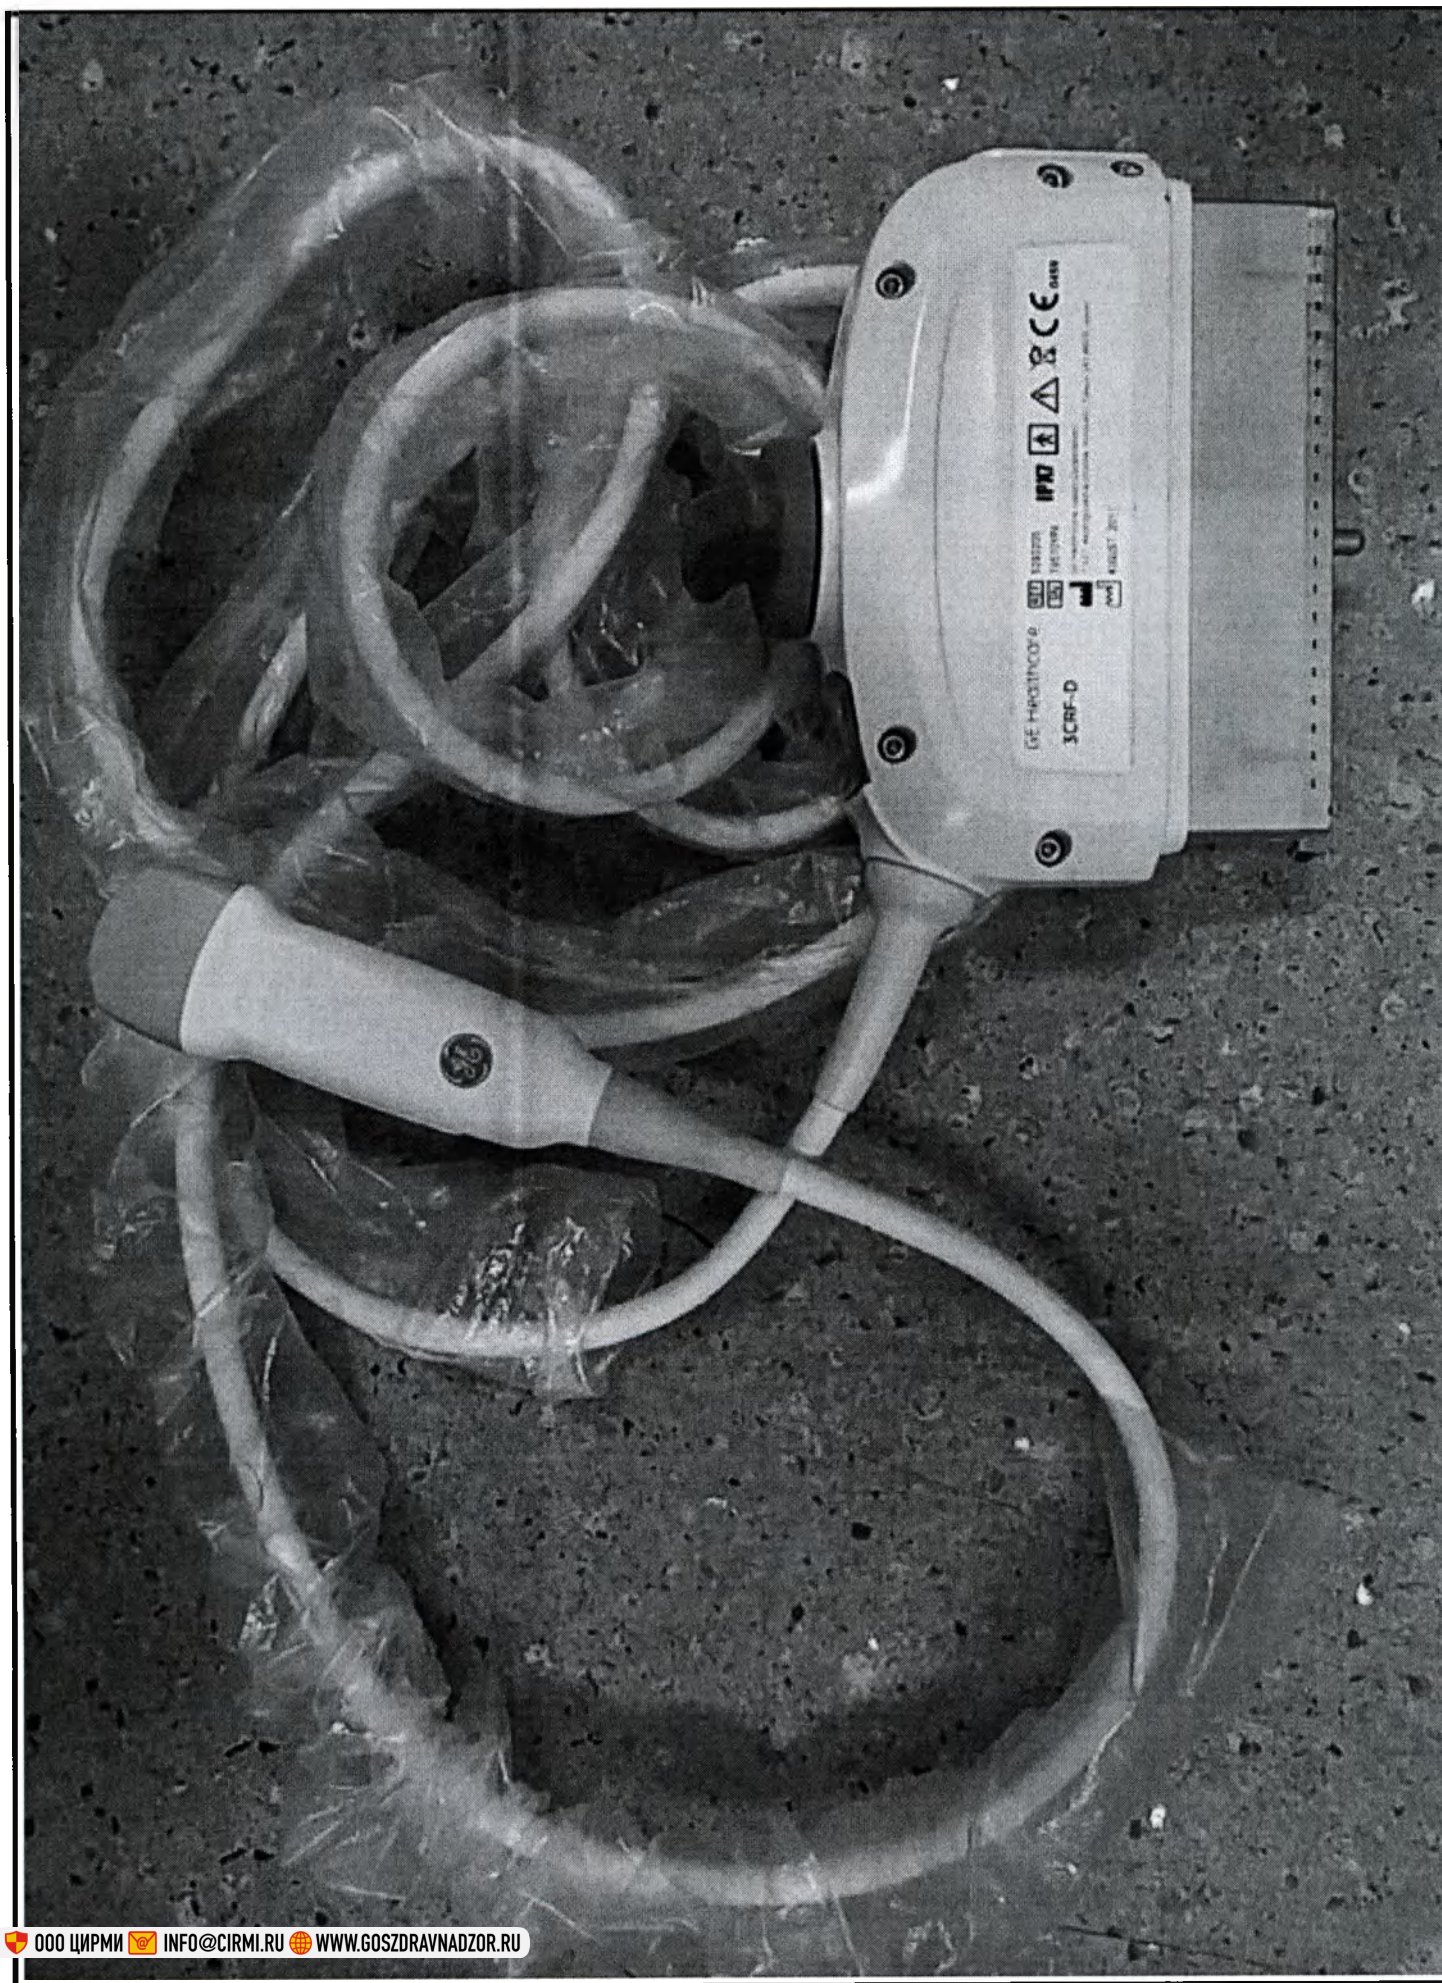






17. Датчики линейные серии L


27

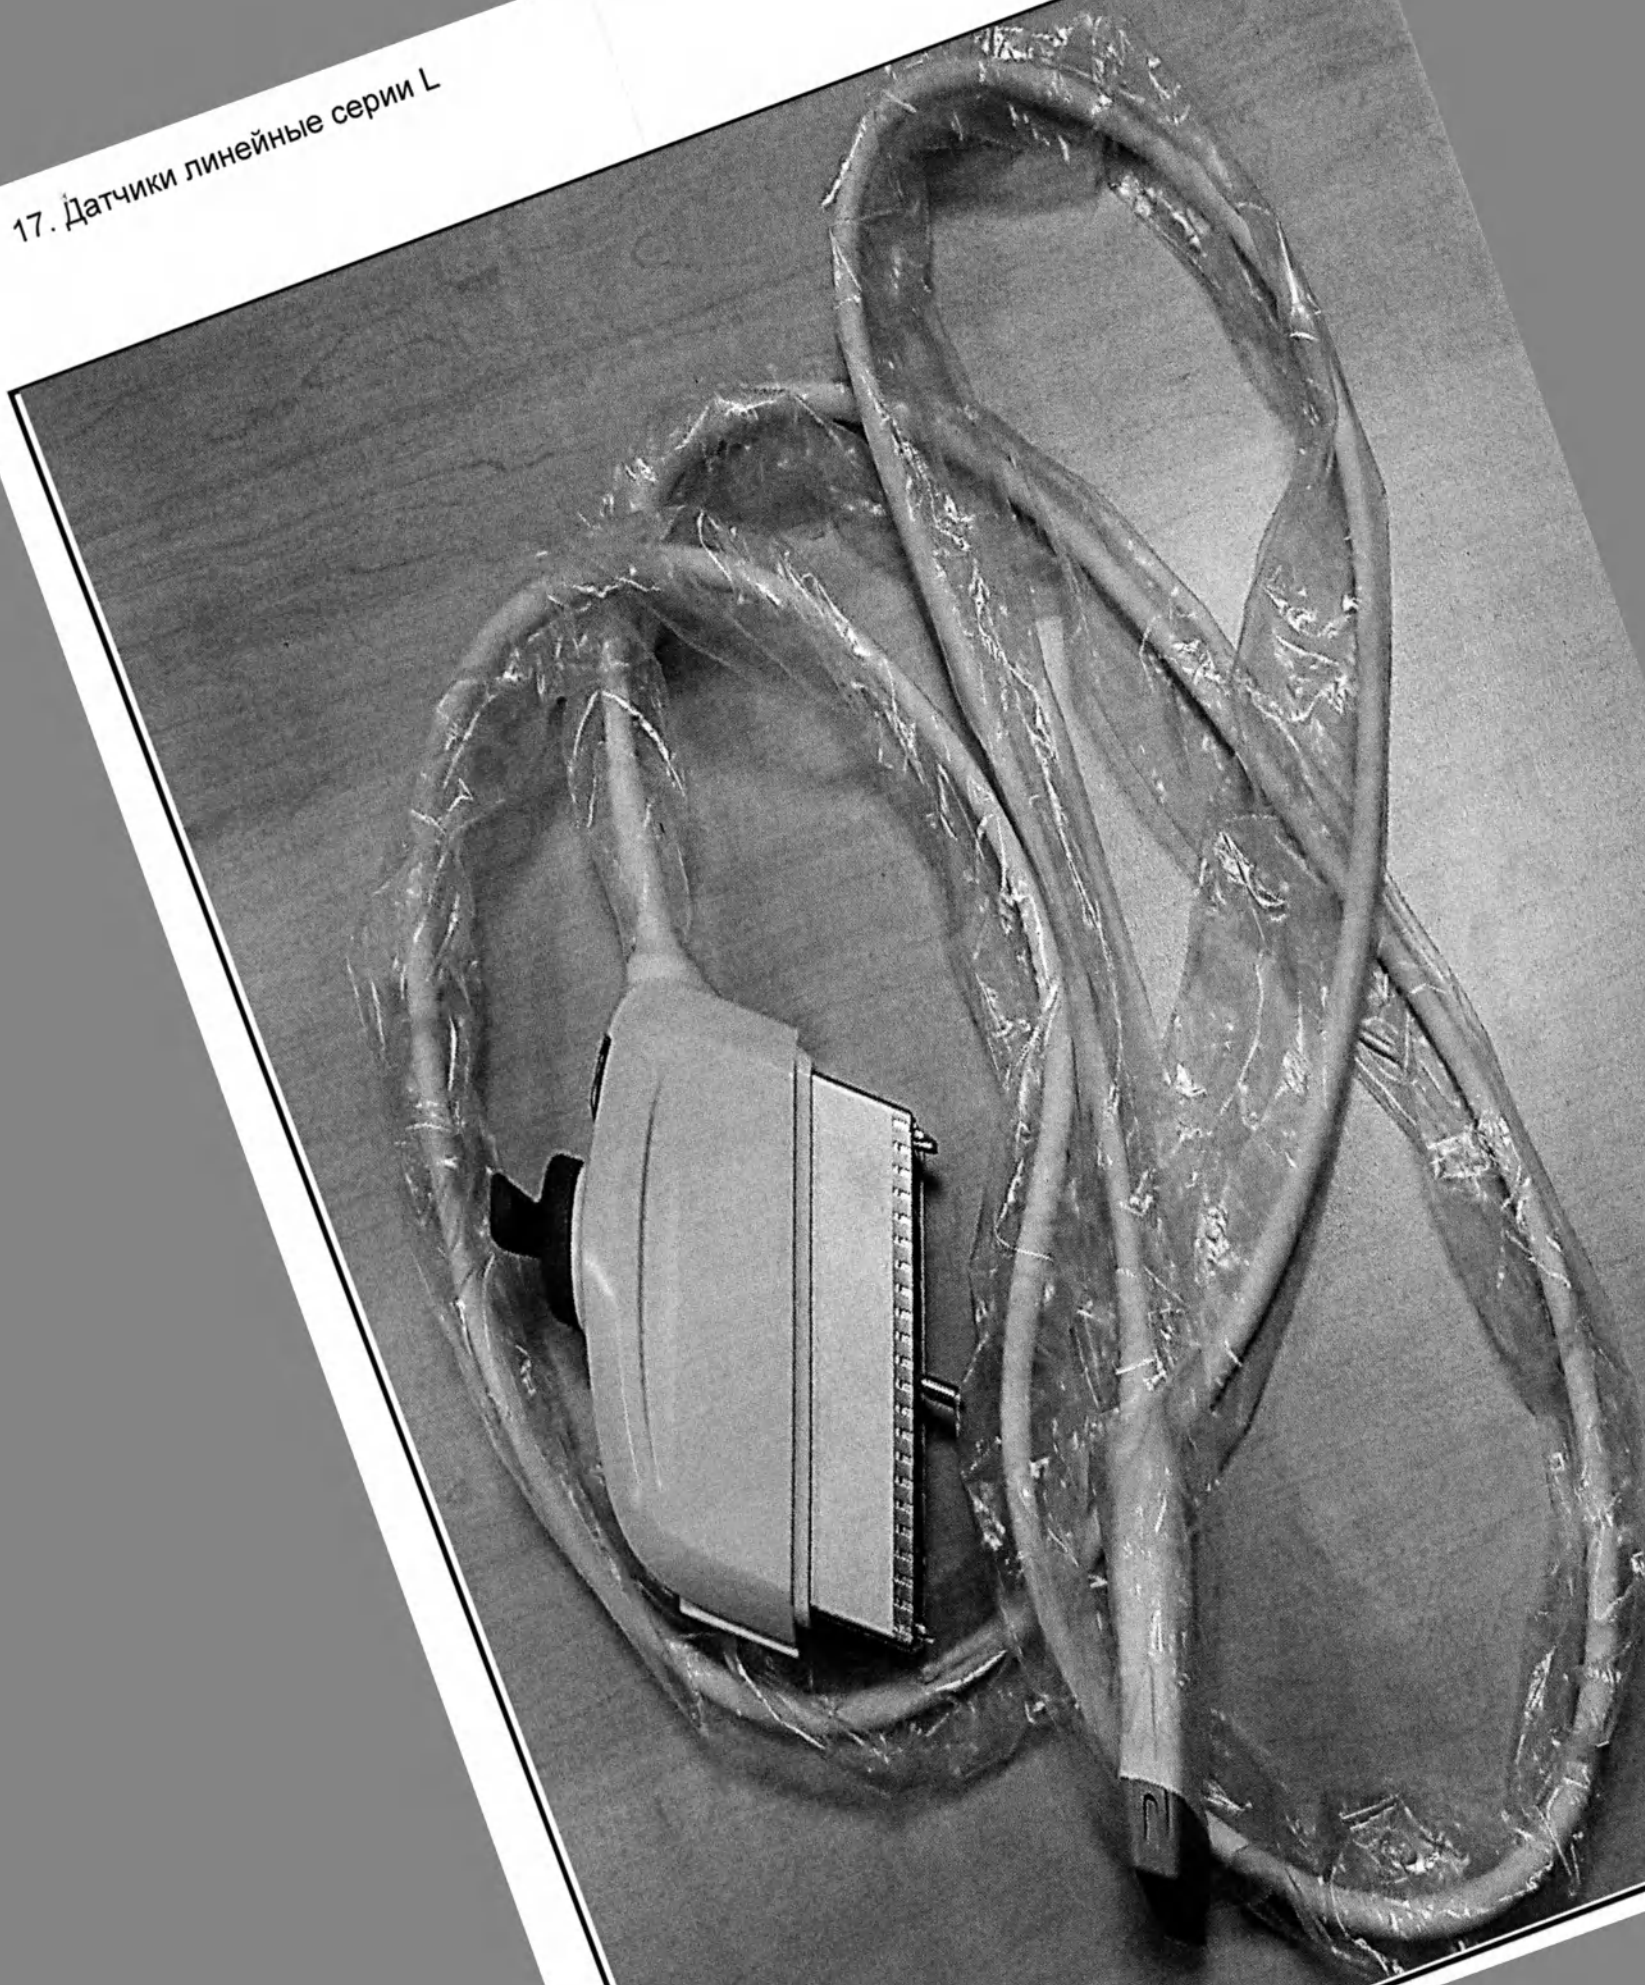


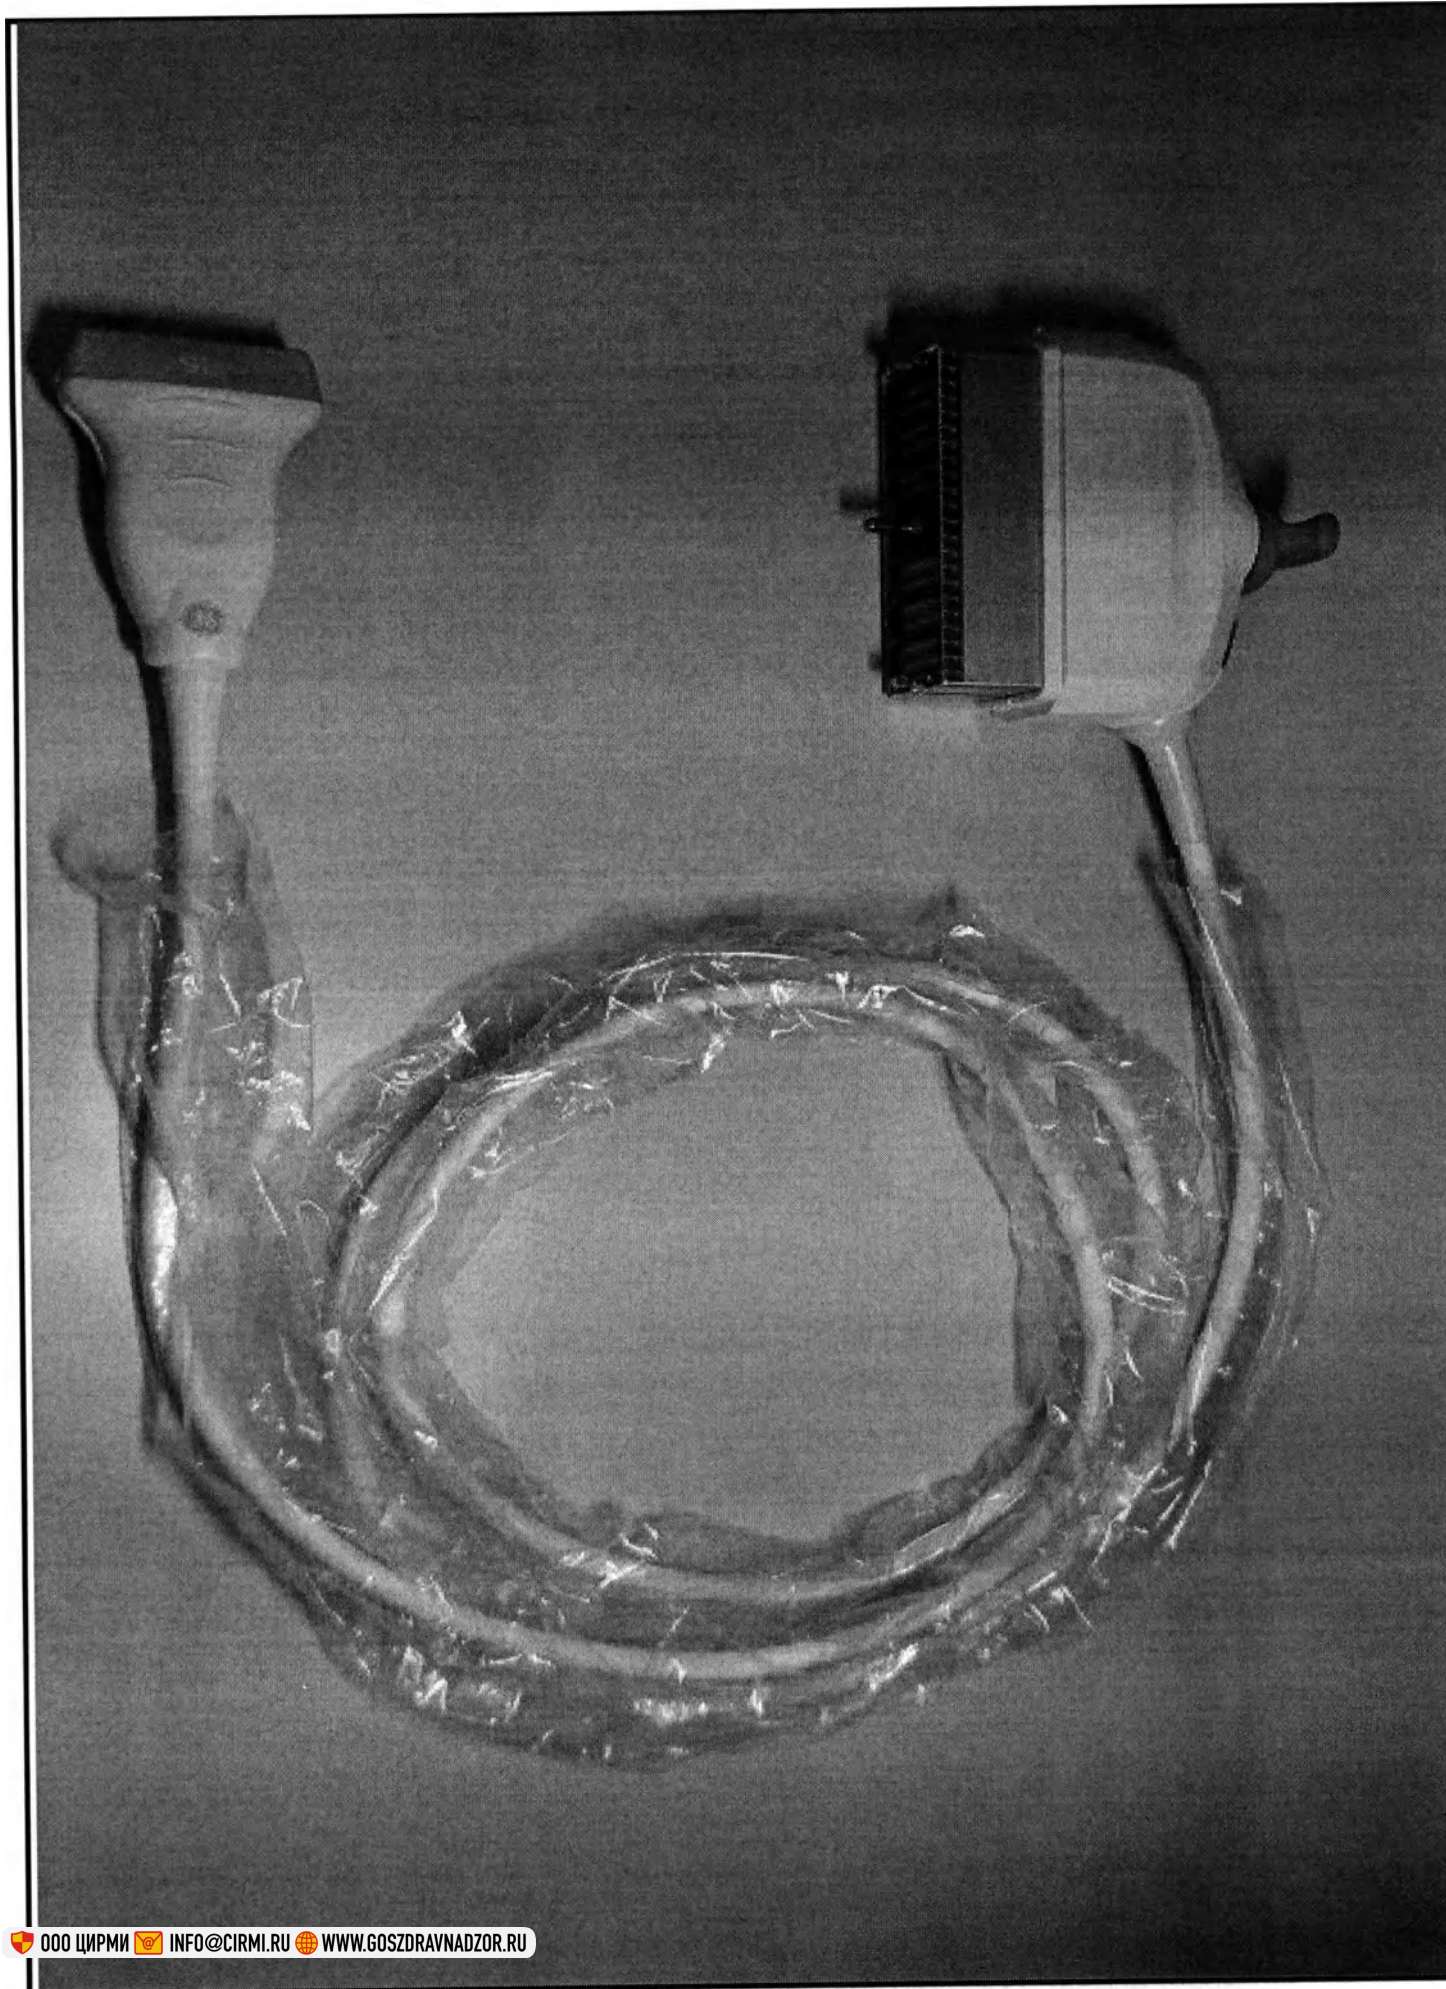


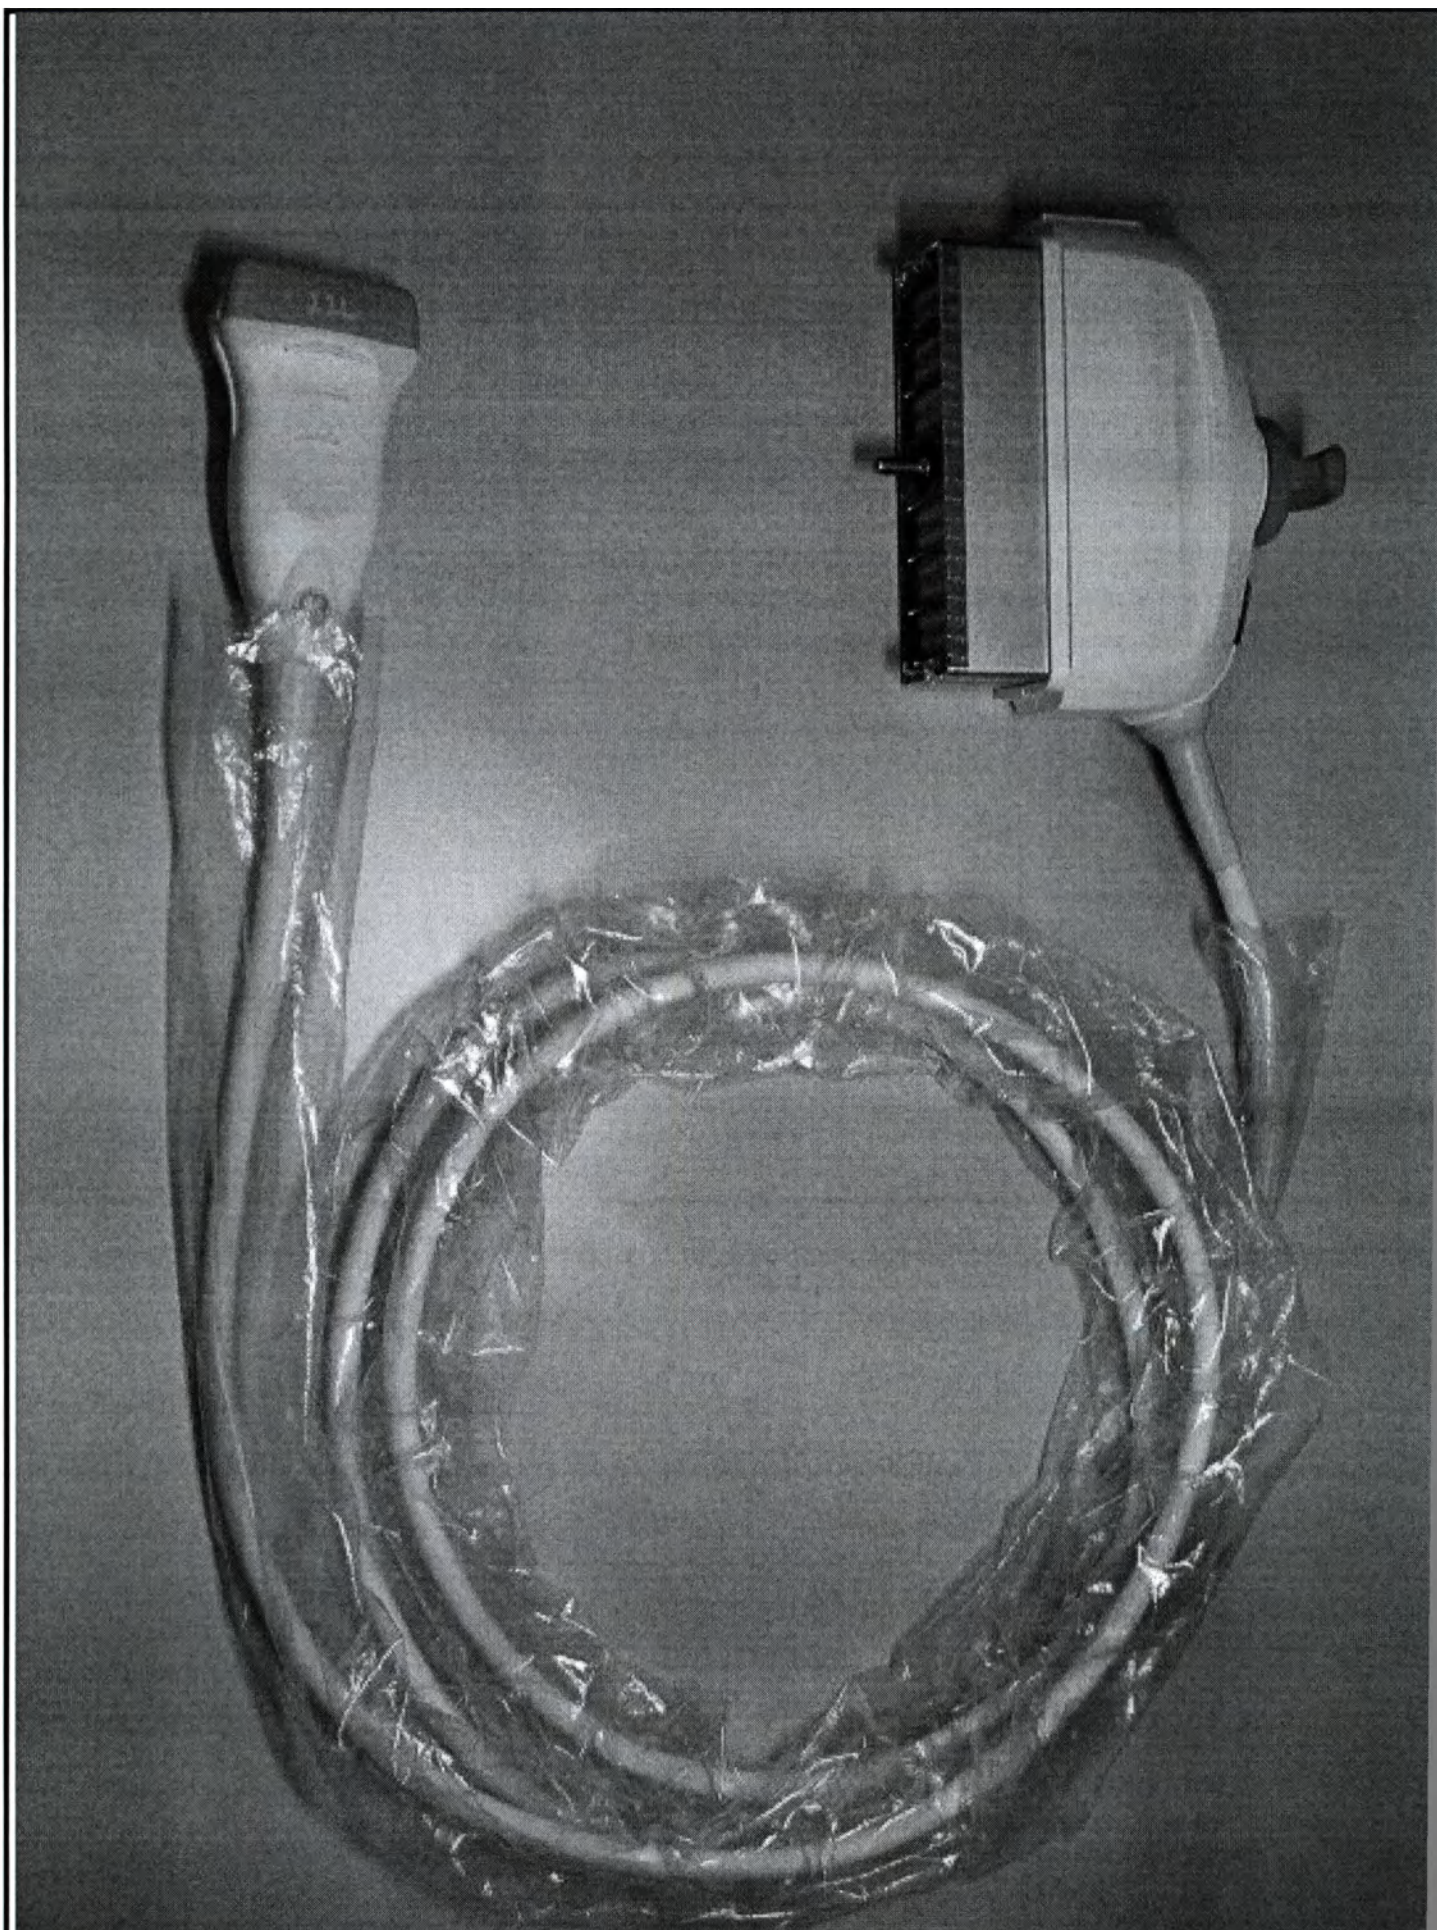


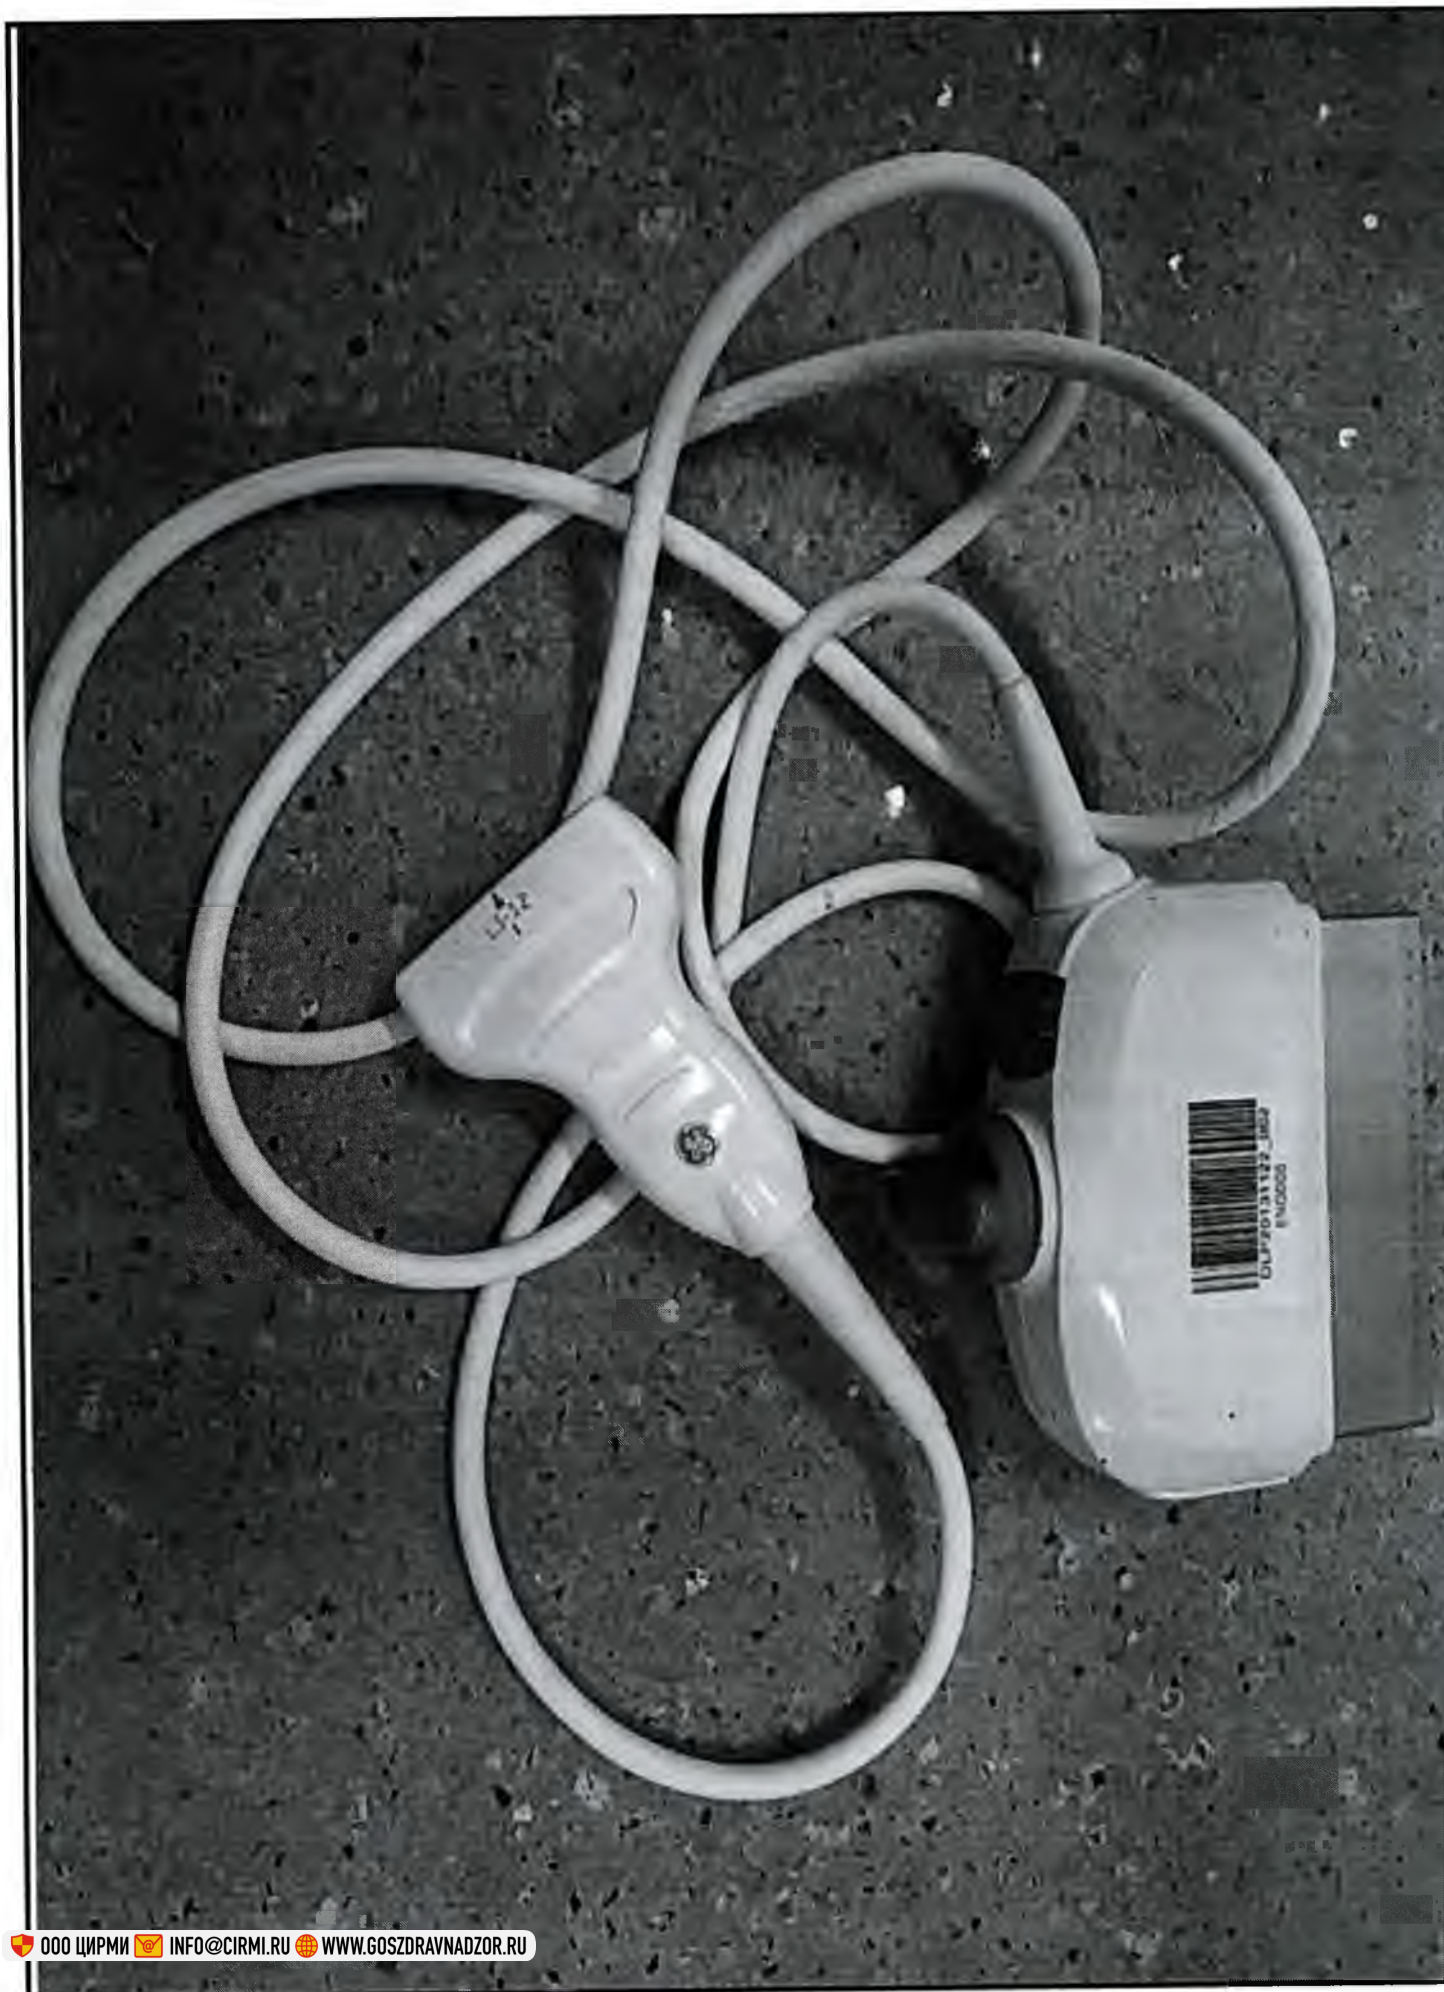


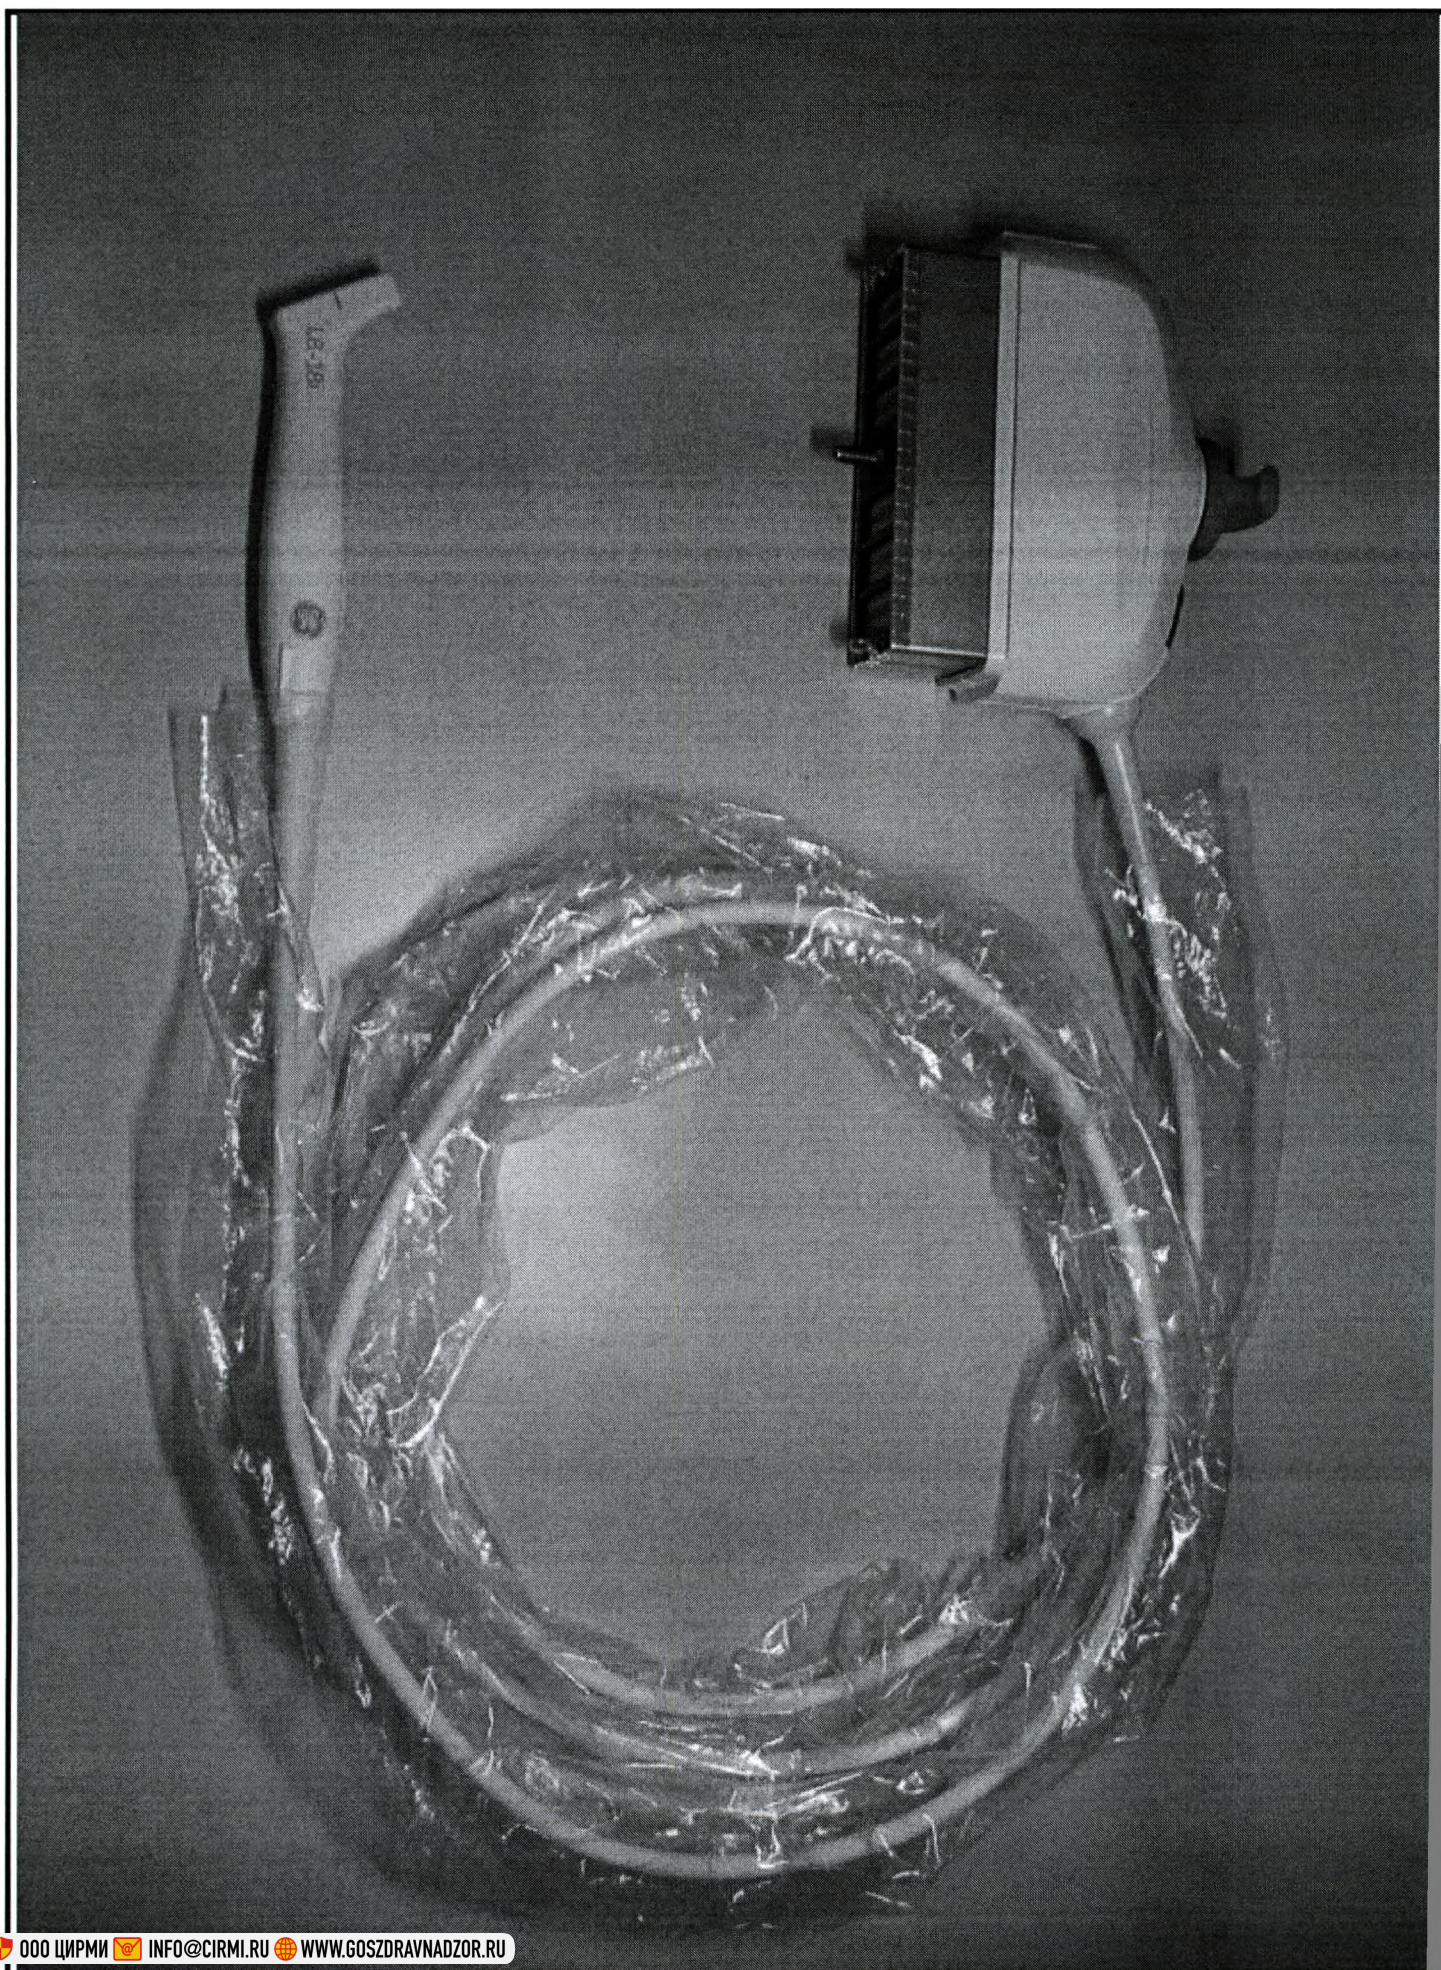


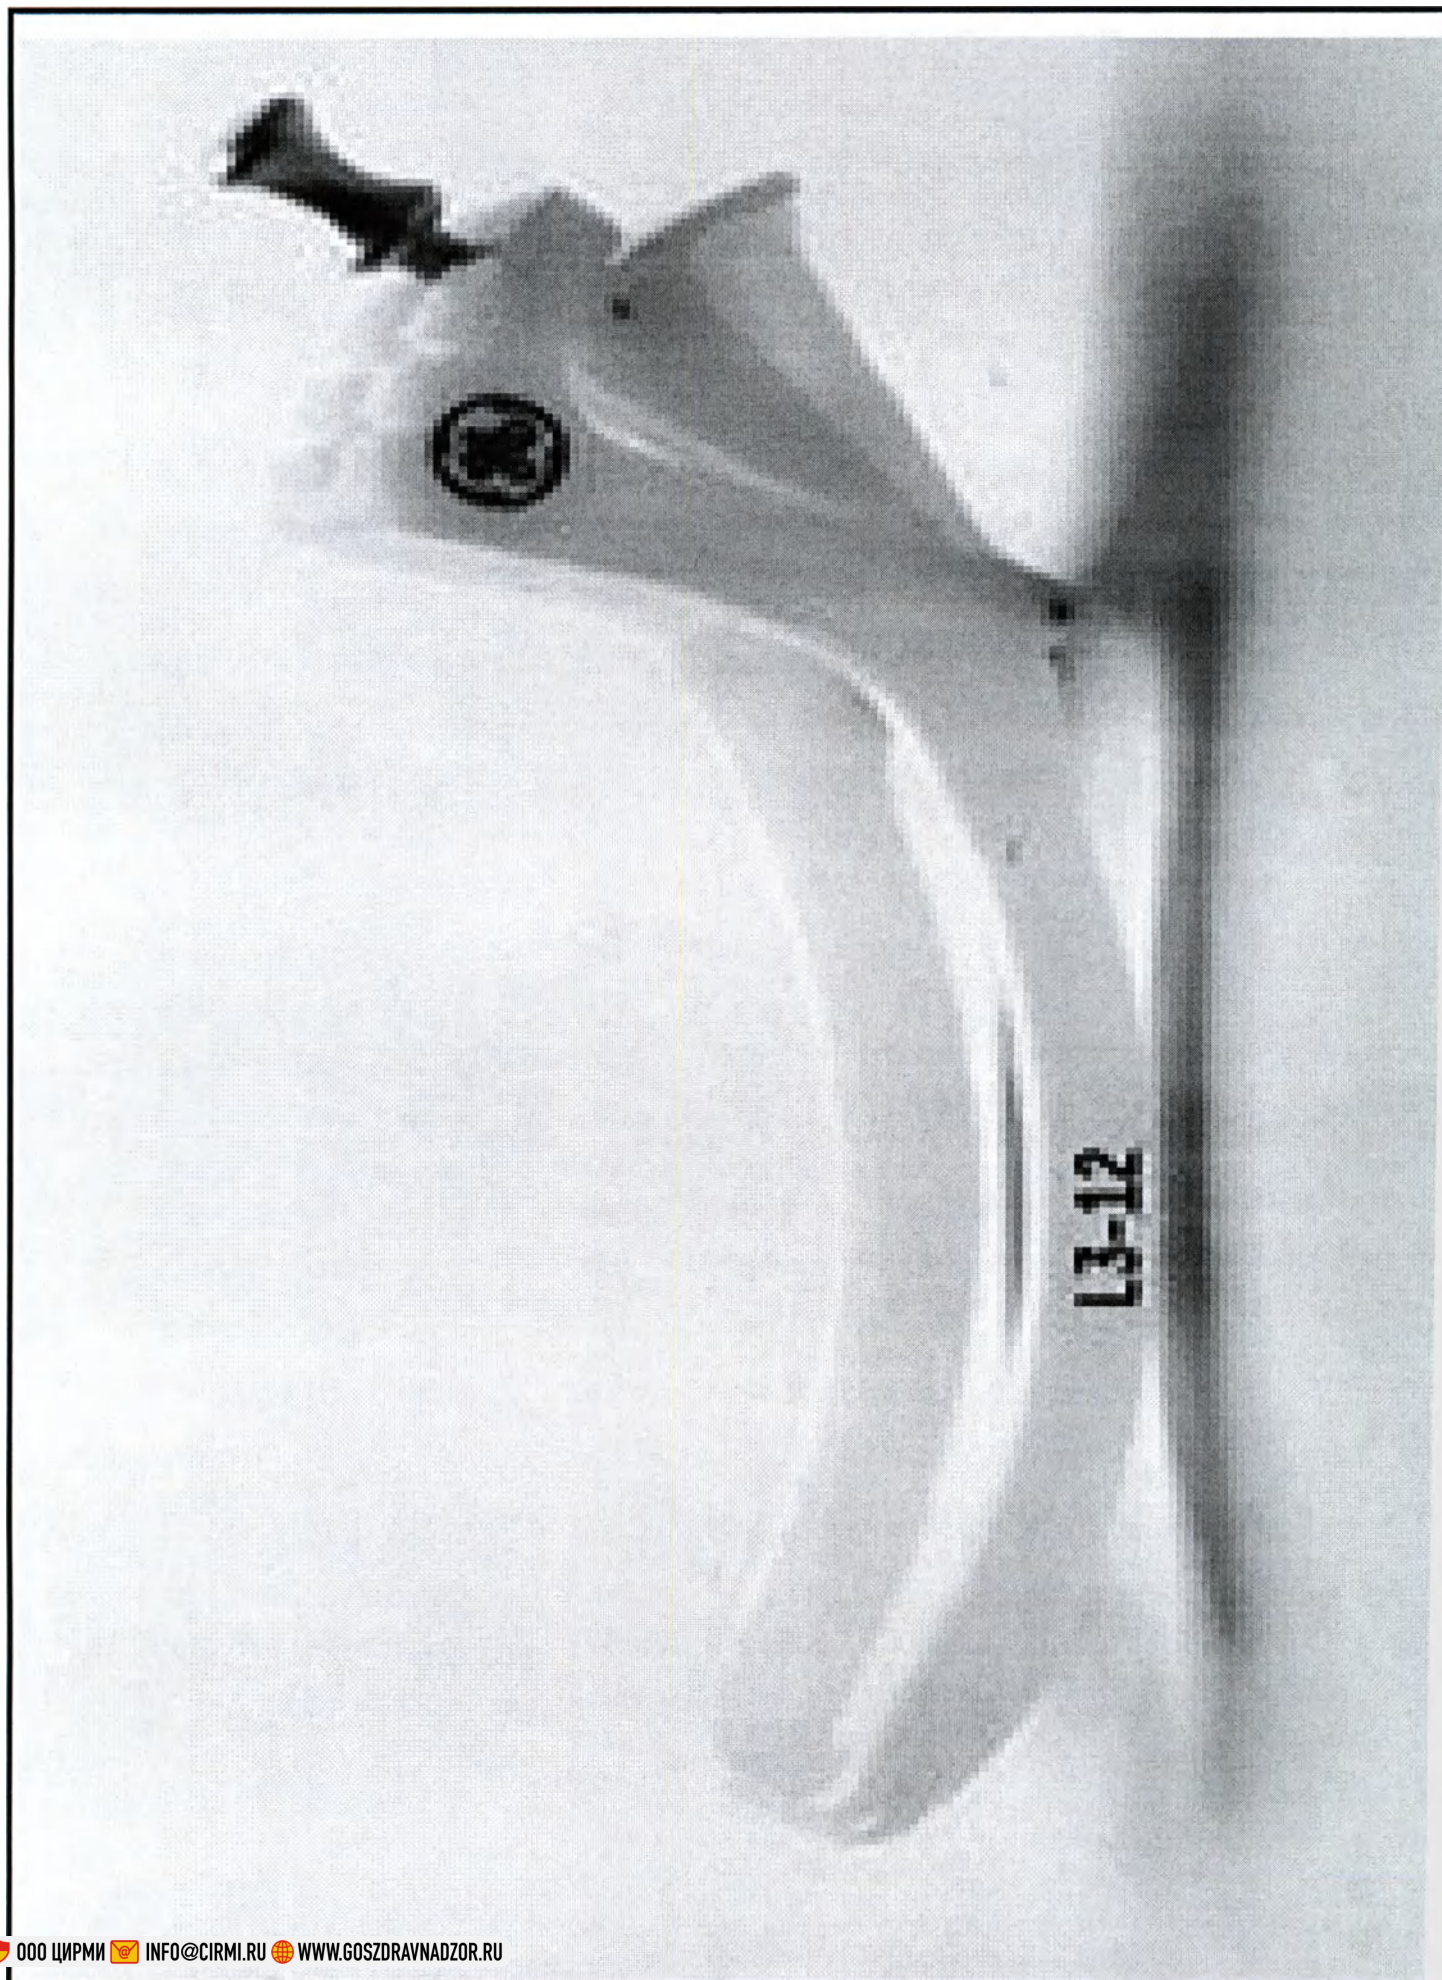


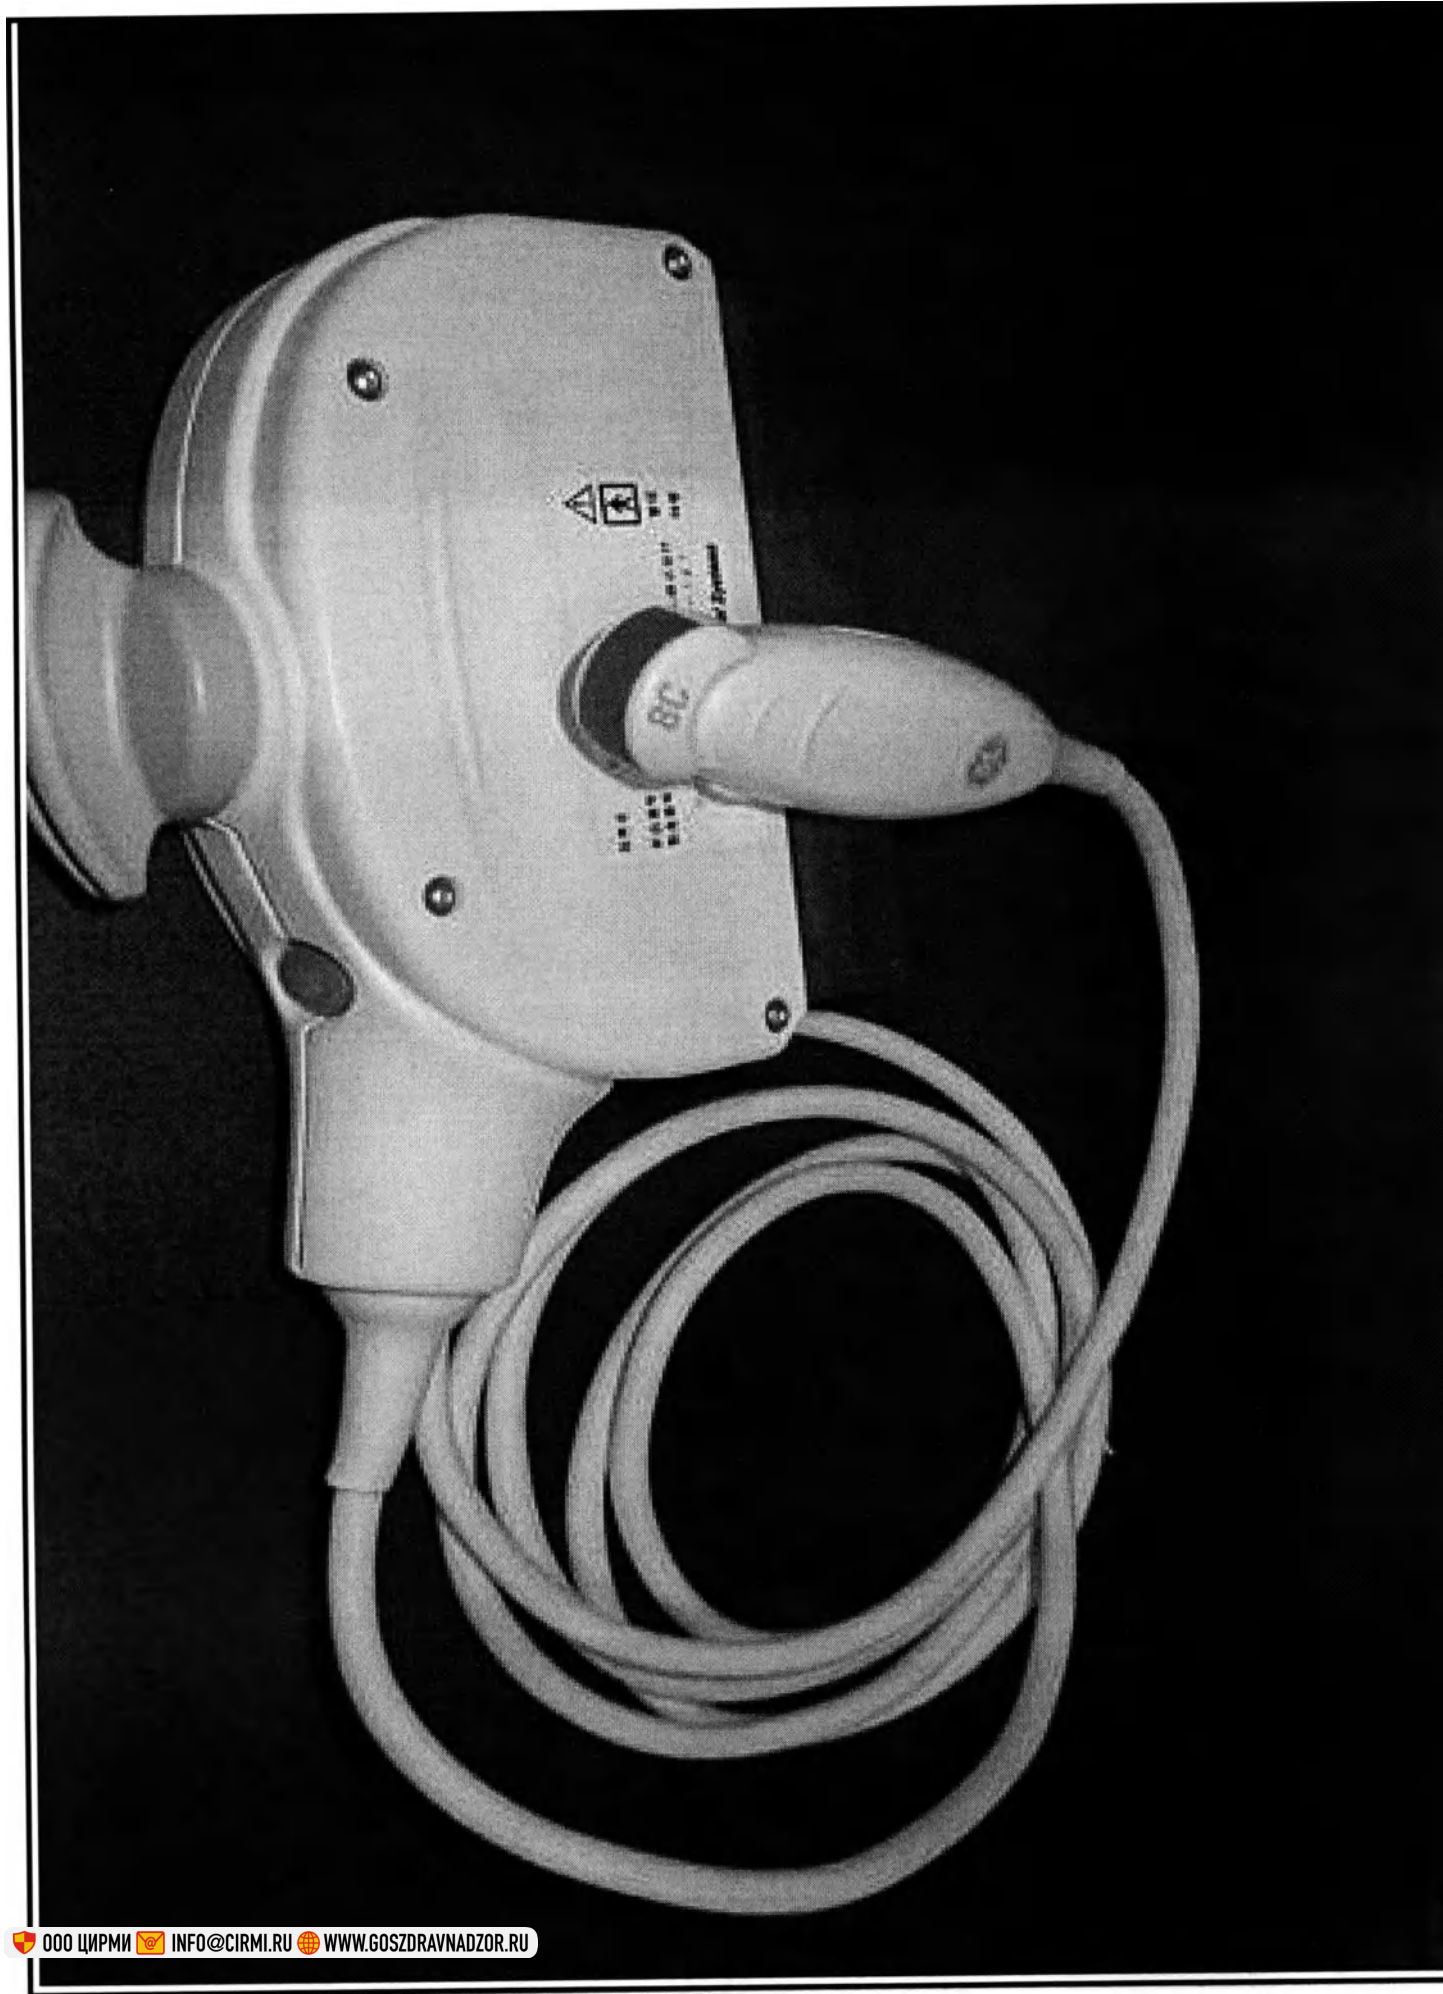


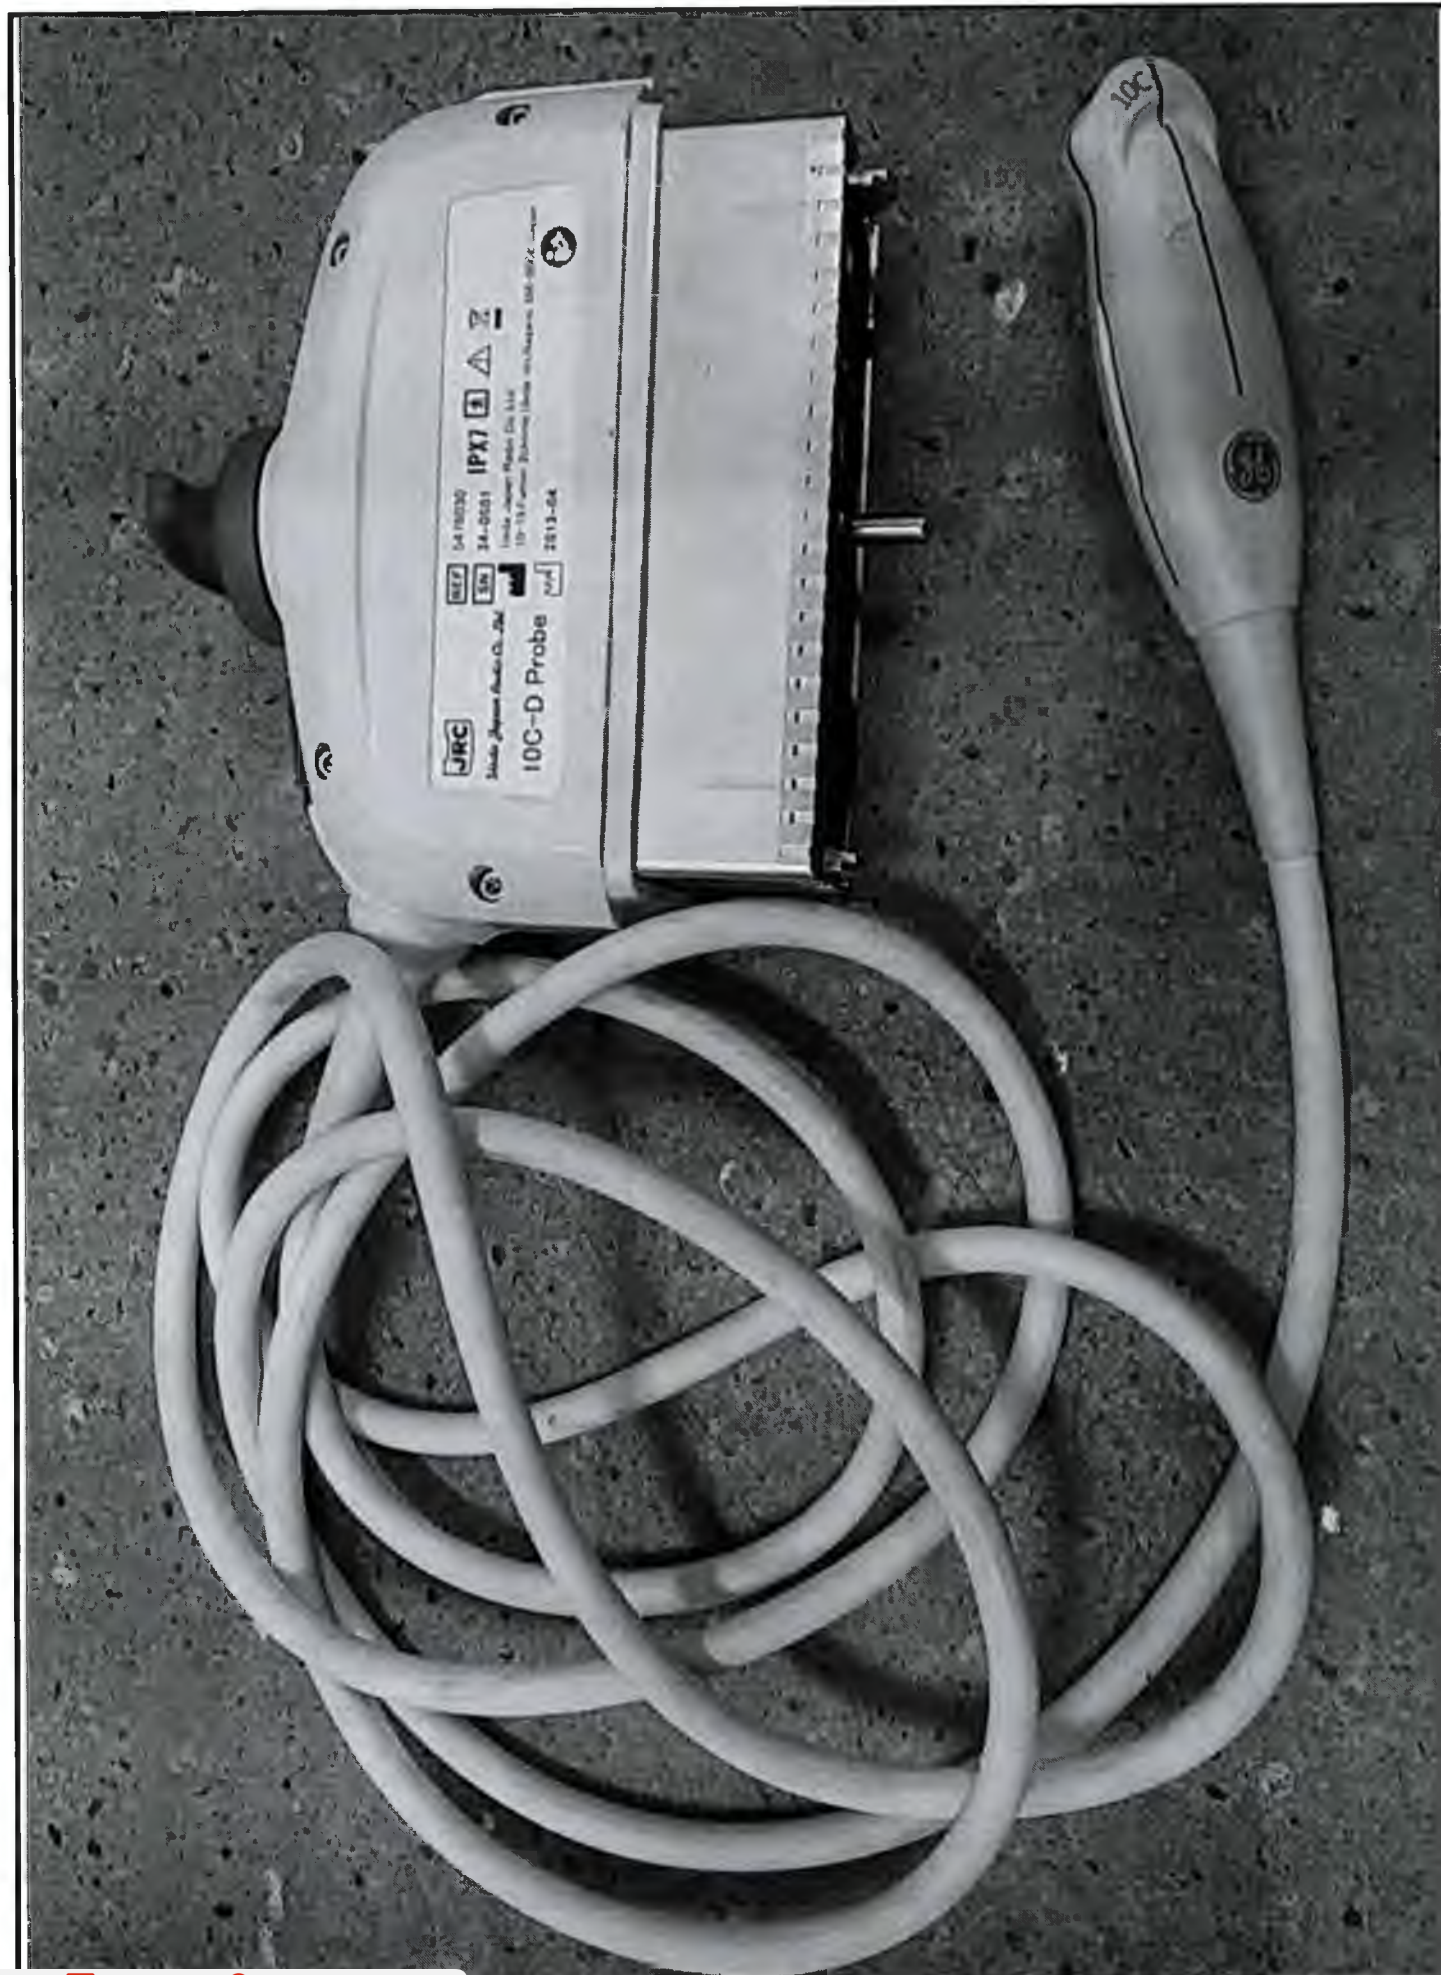





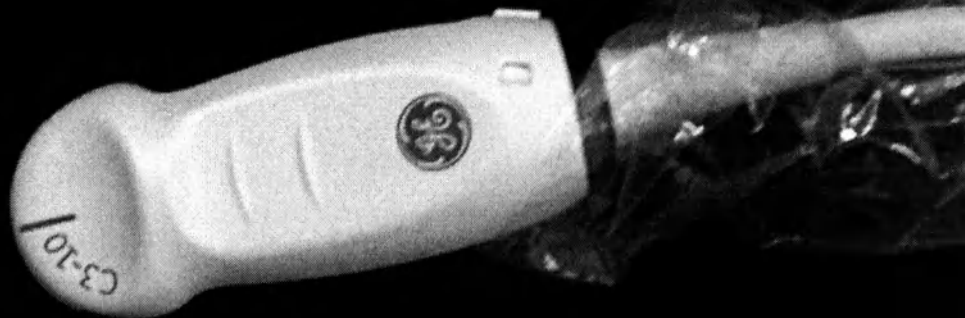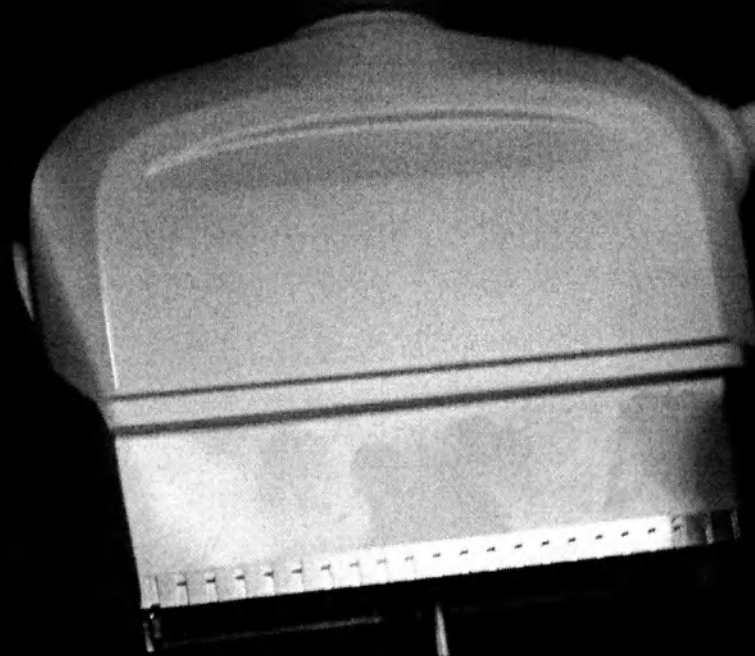


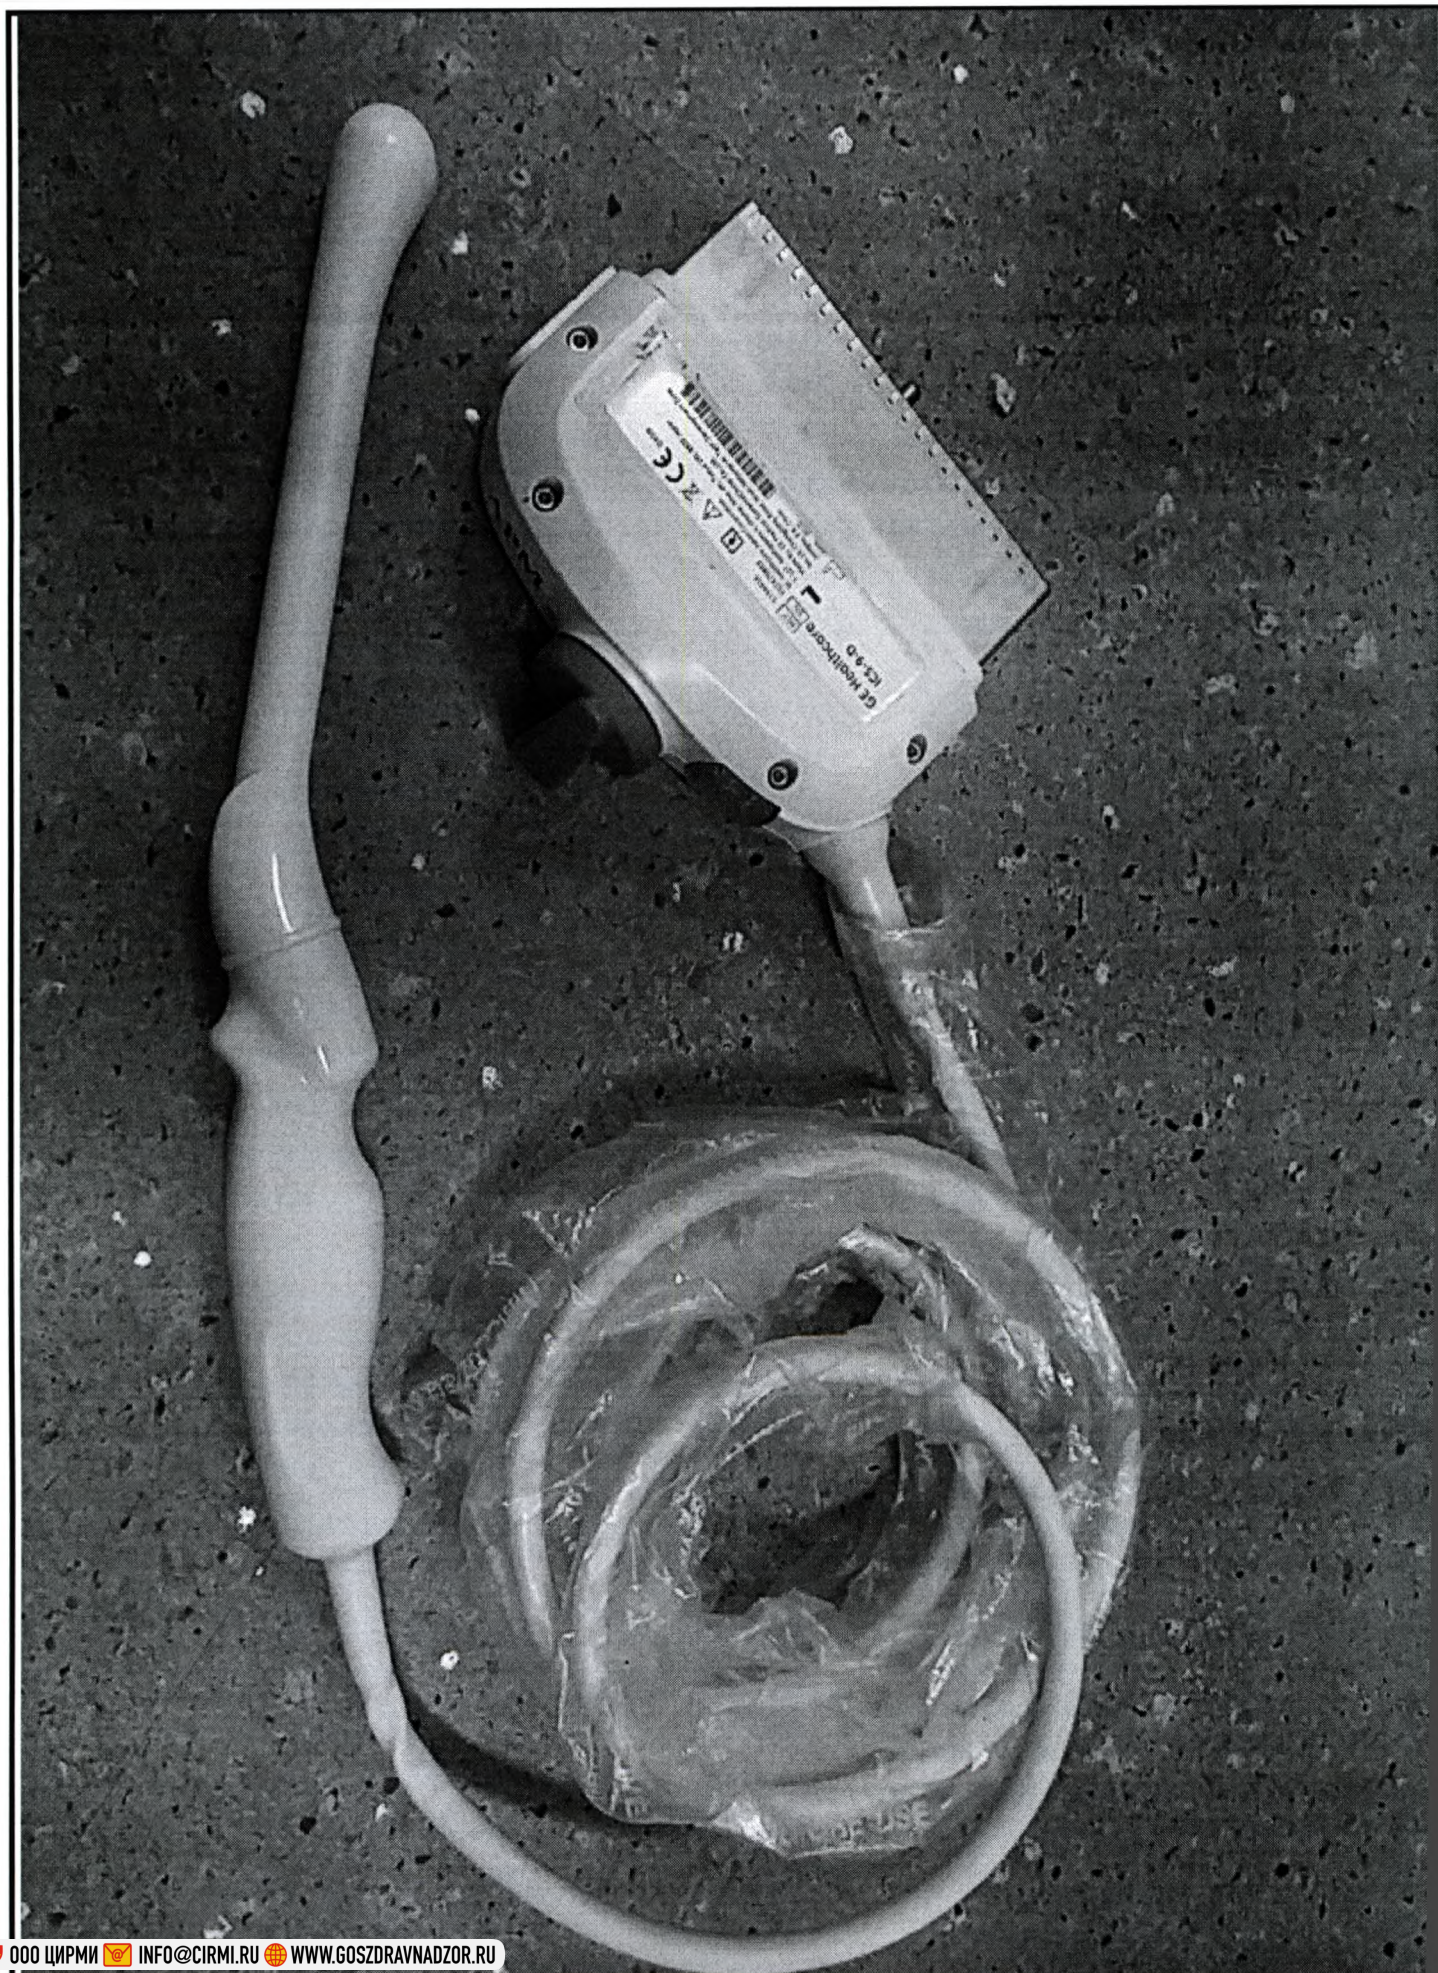

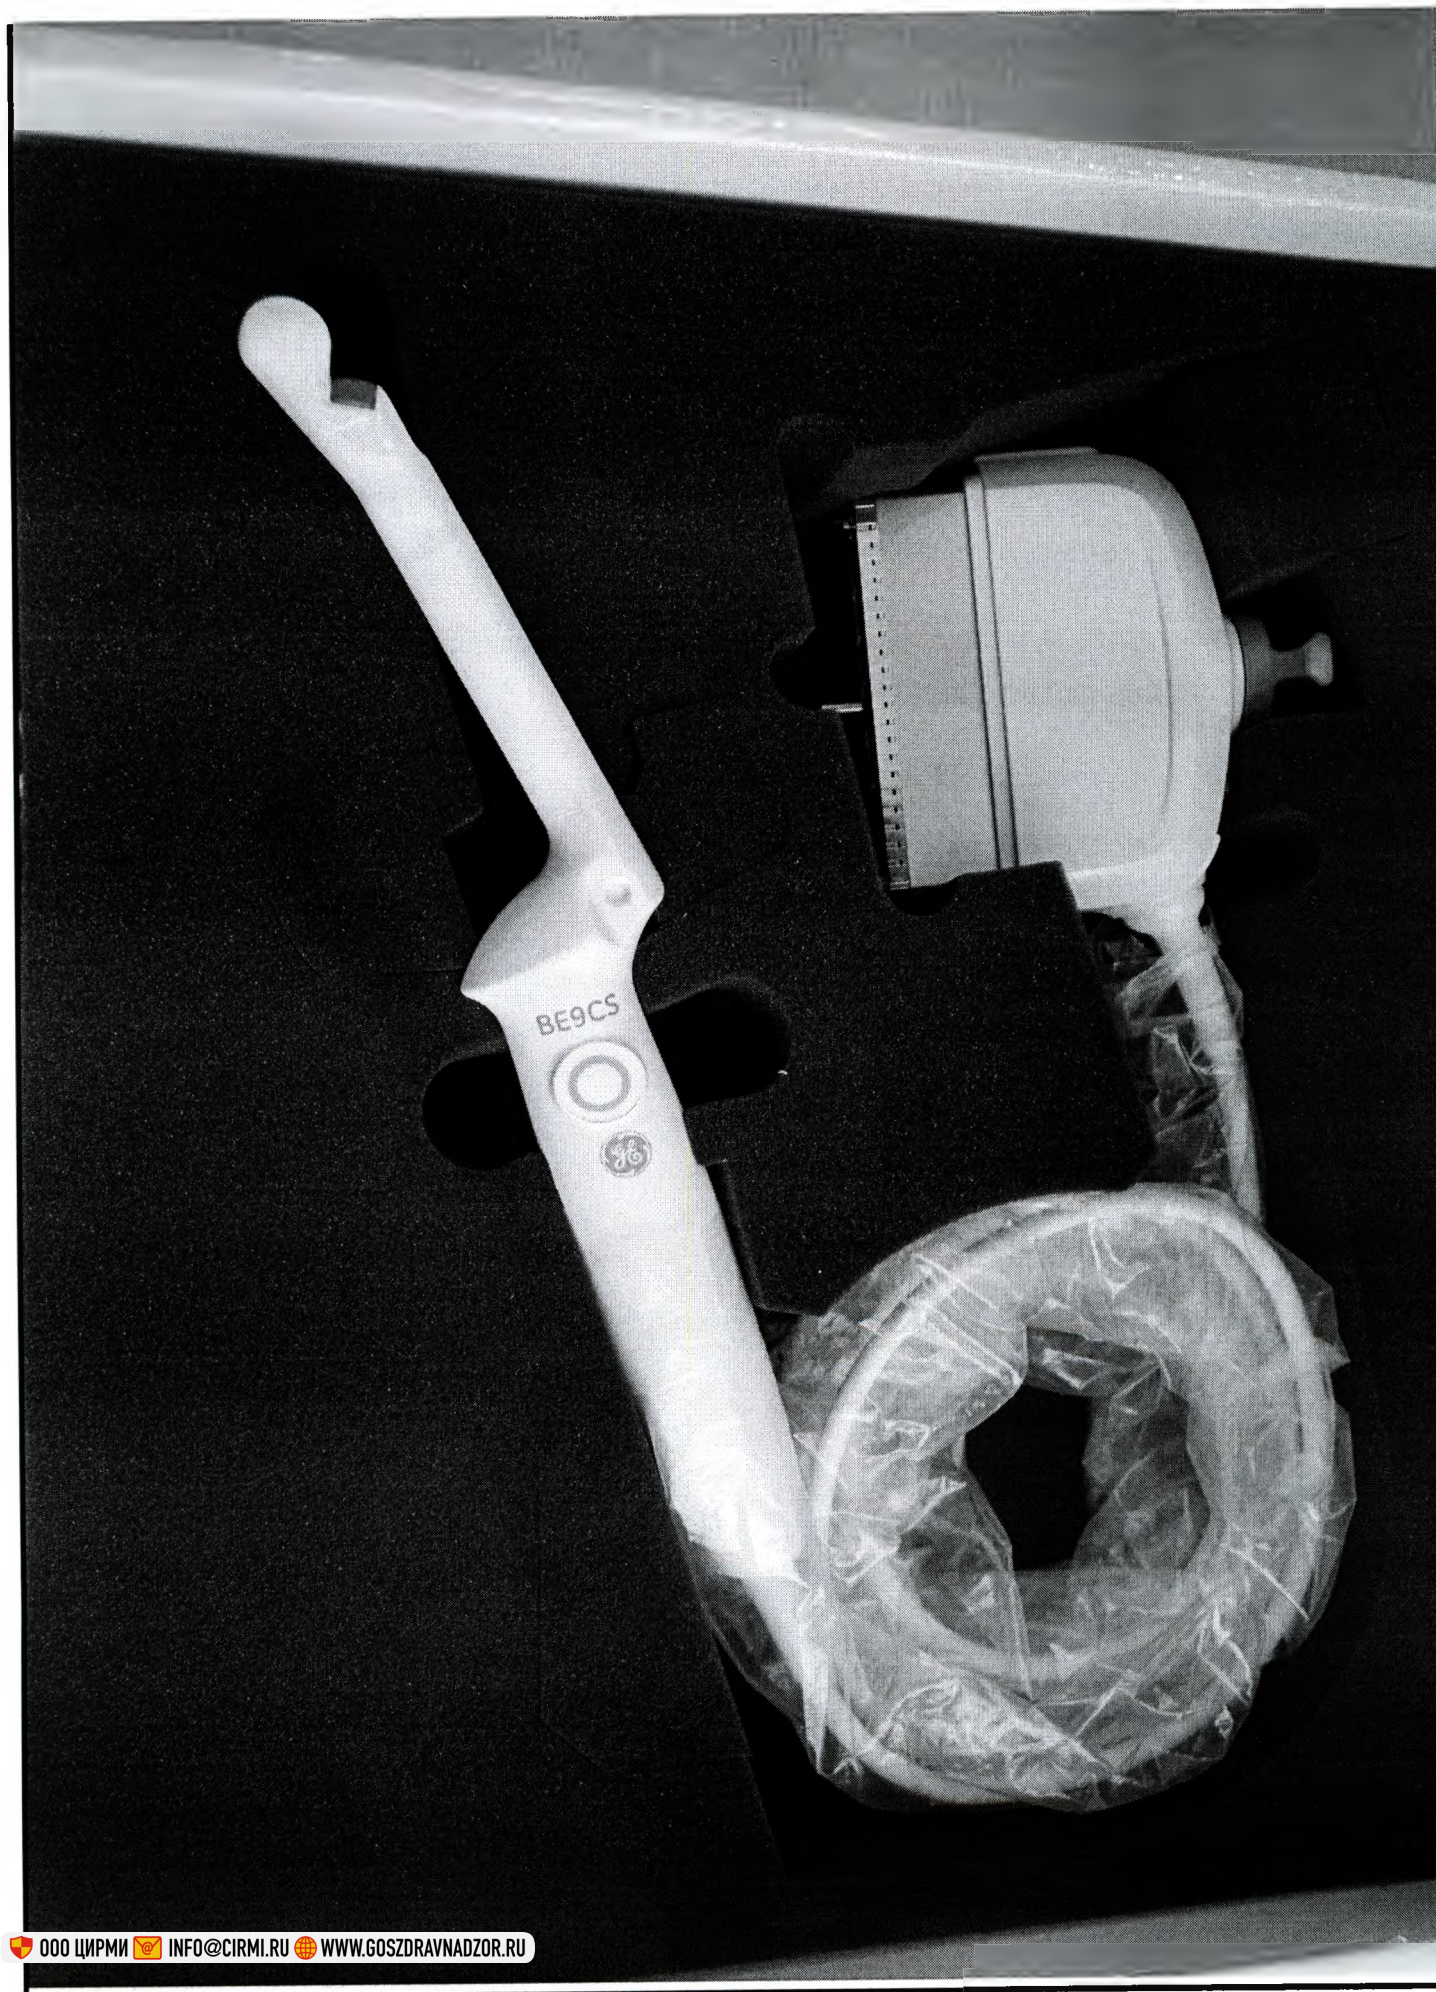

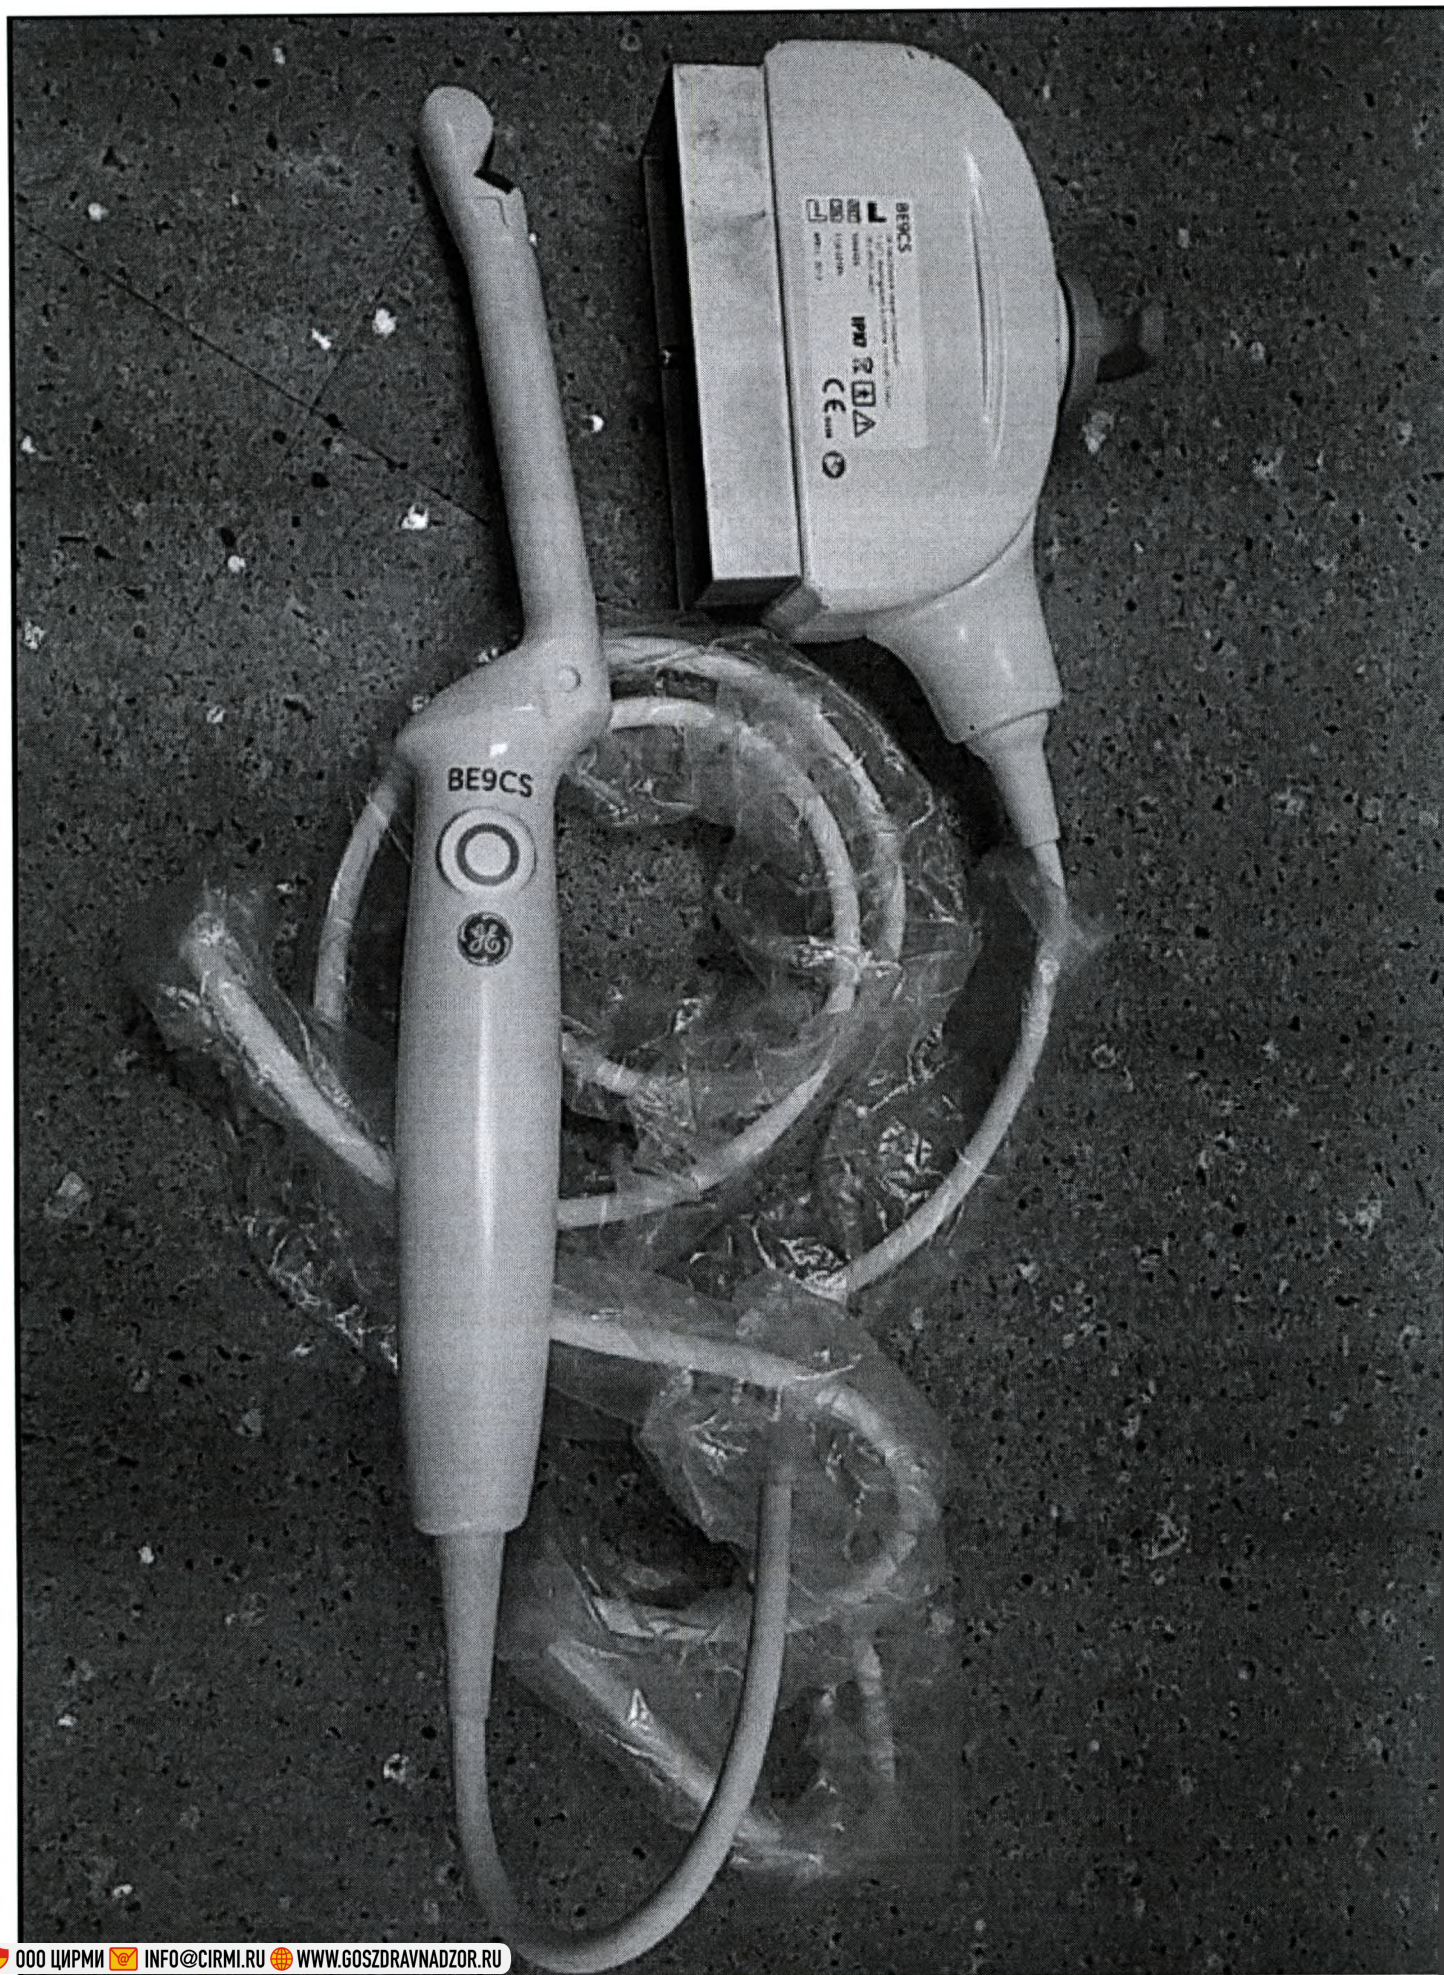


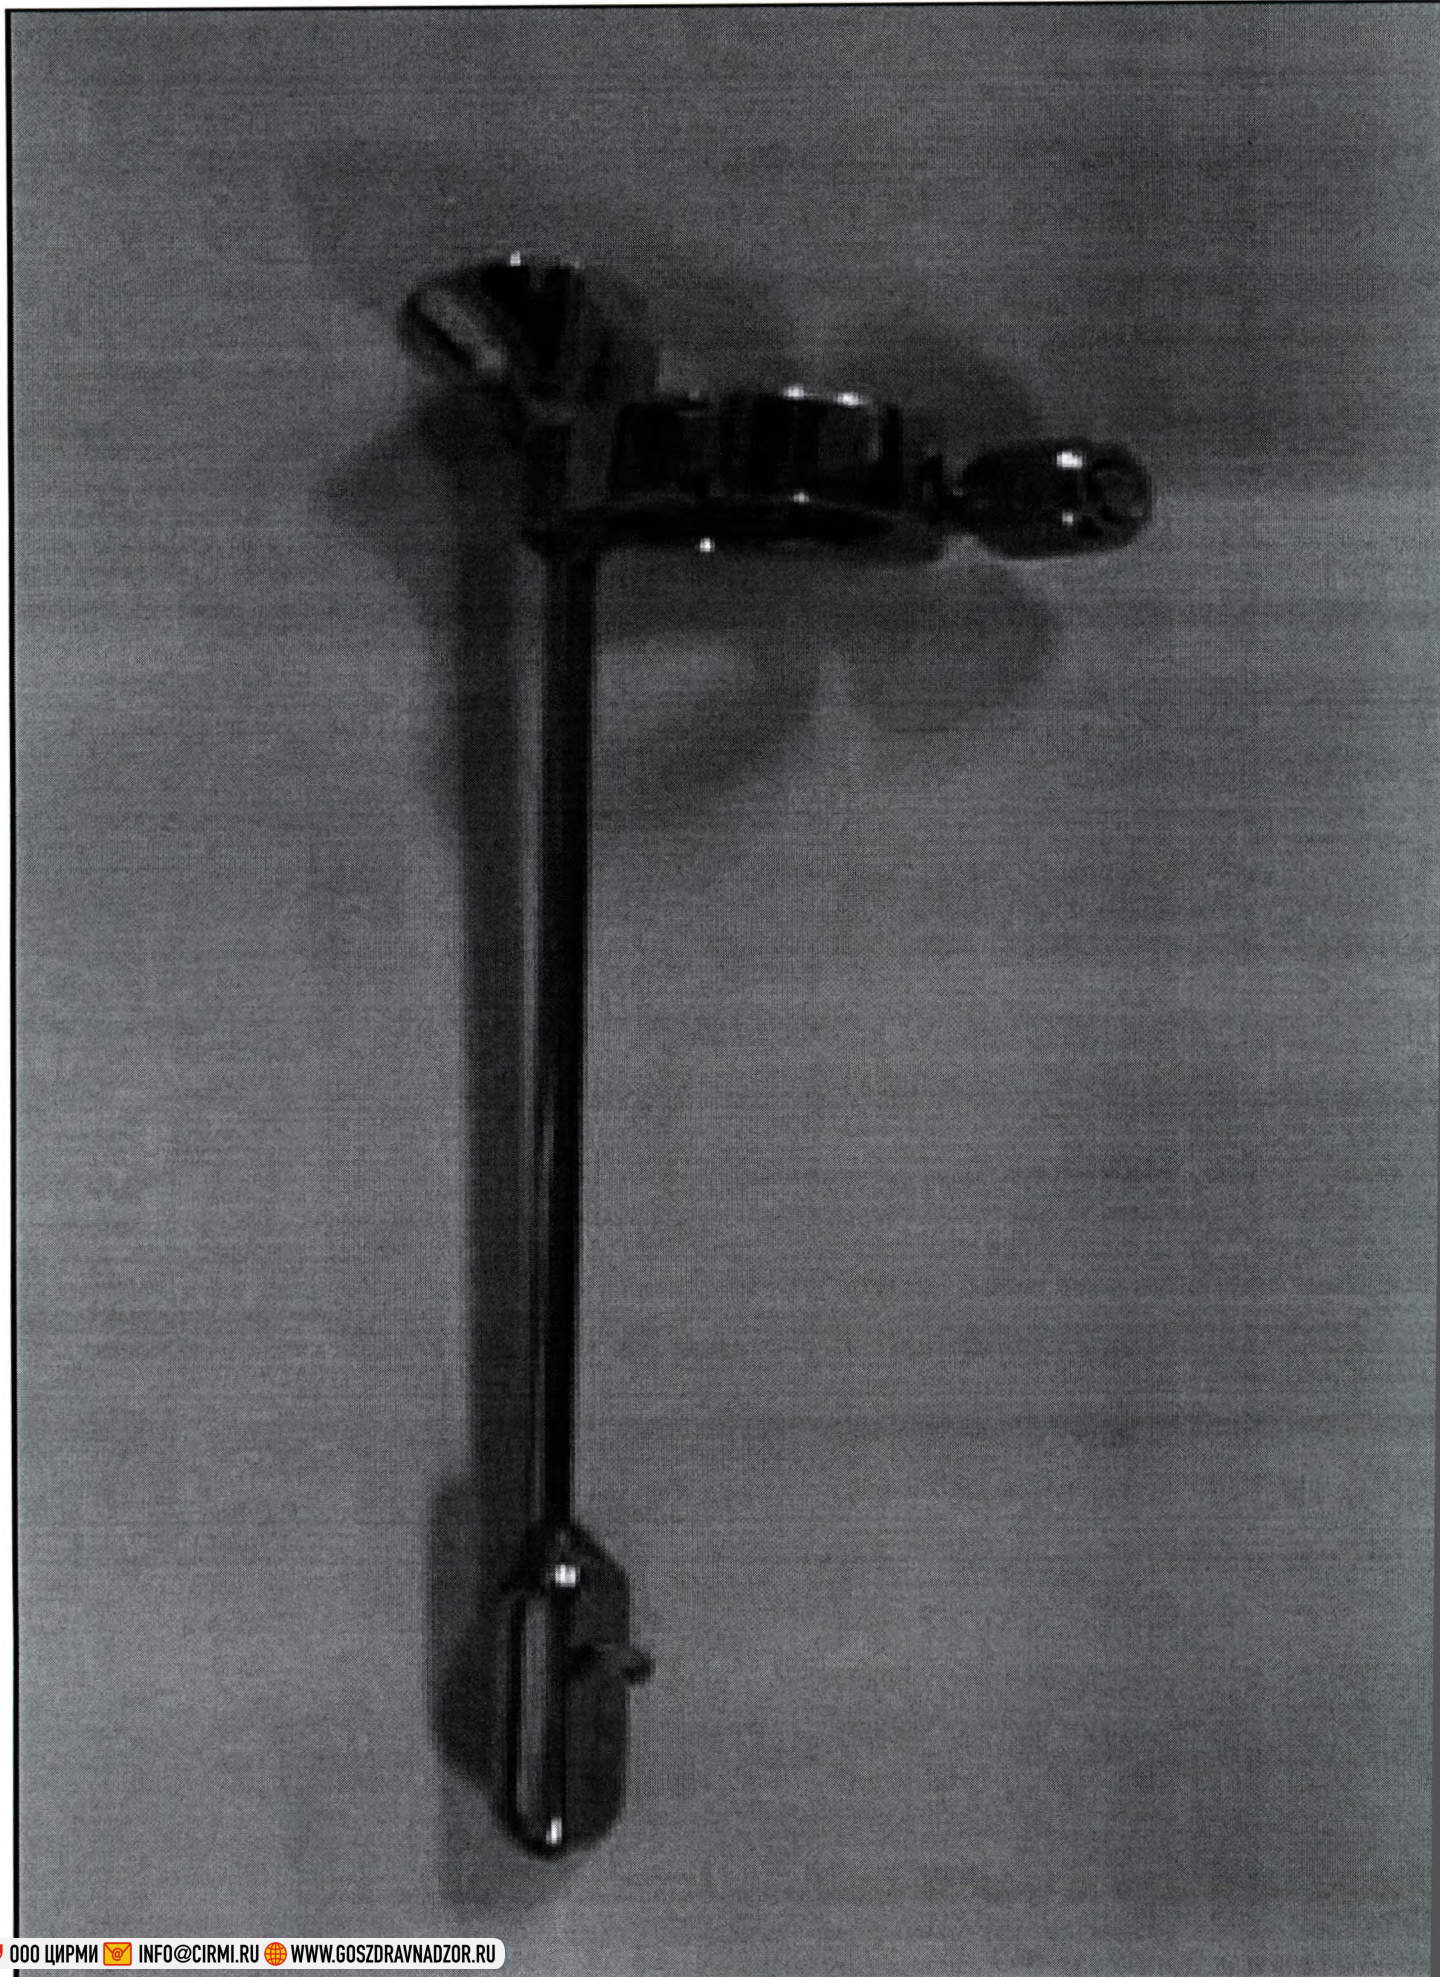

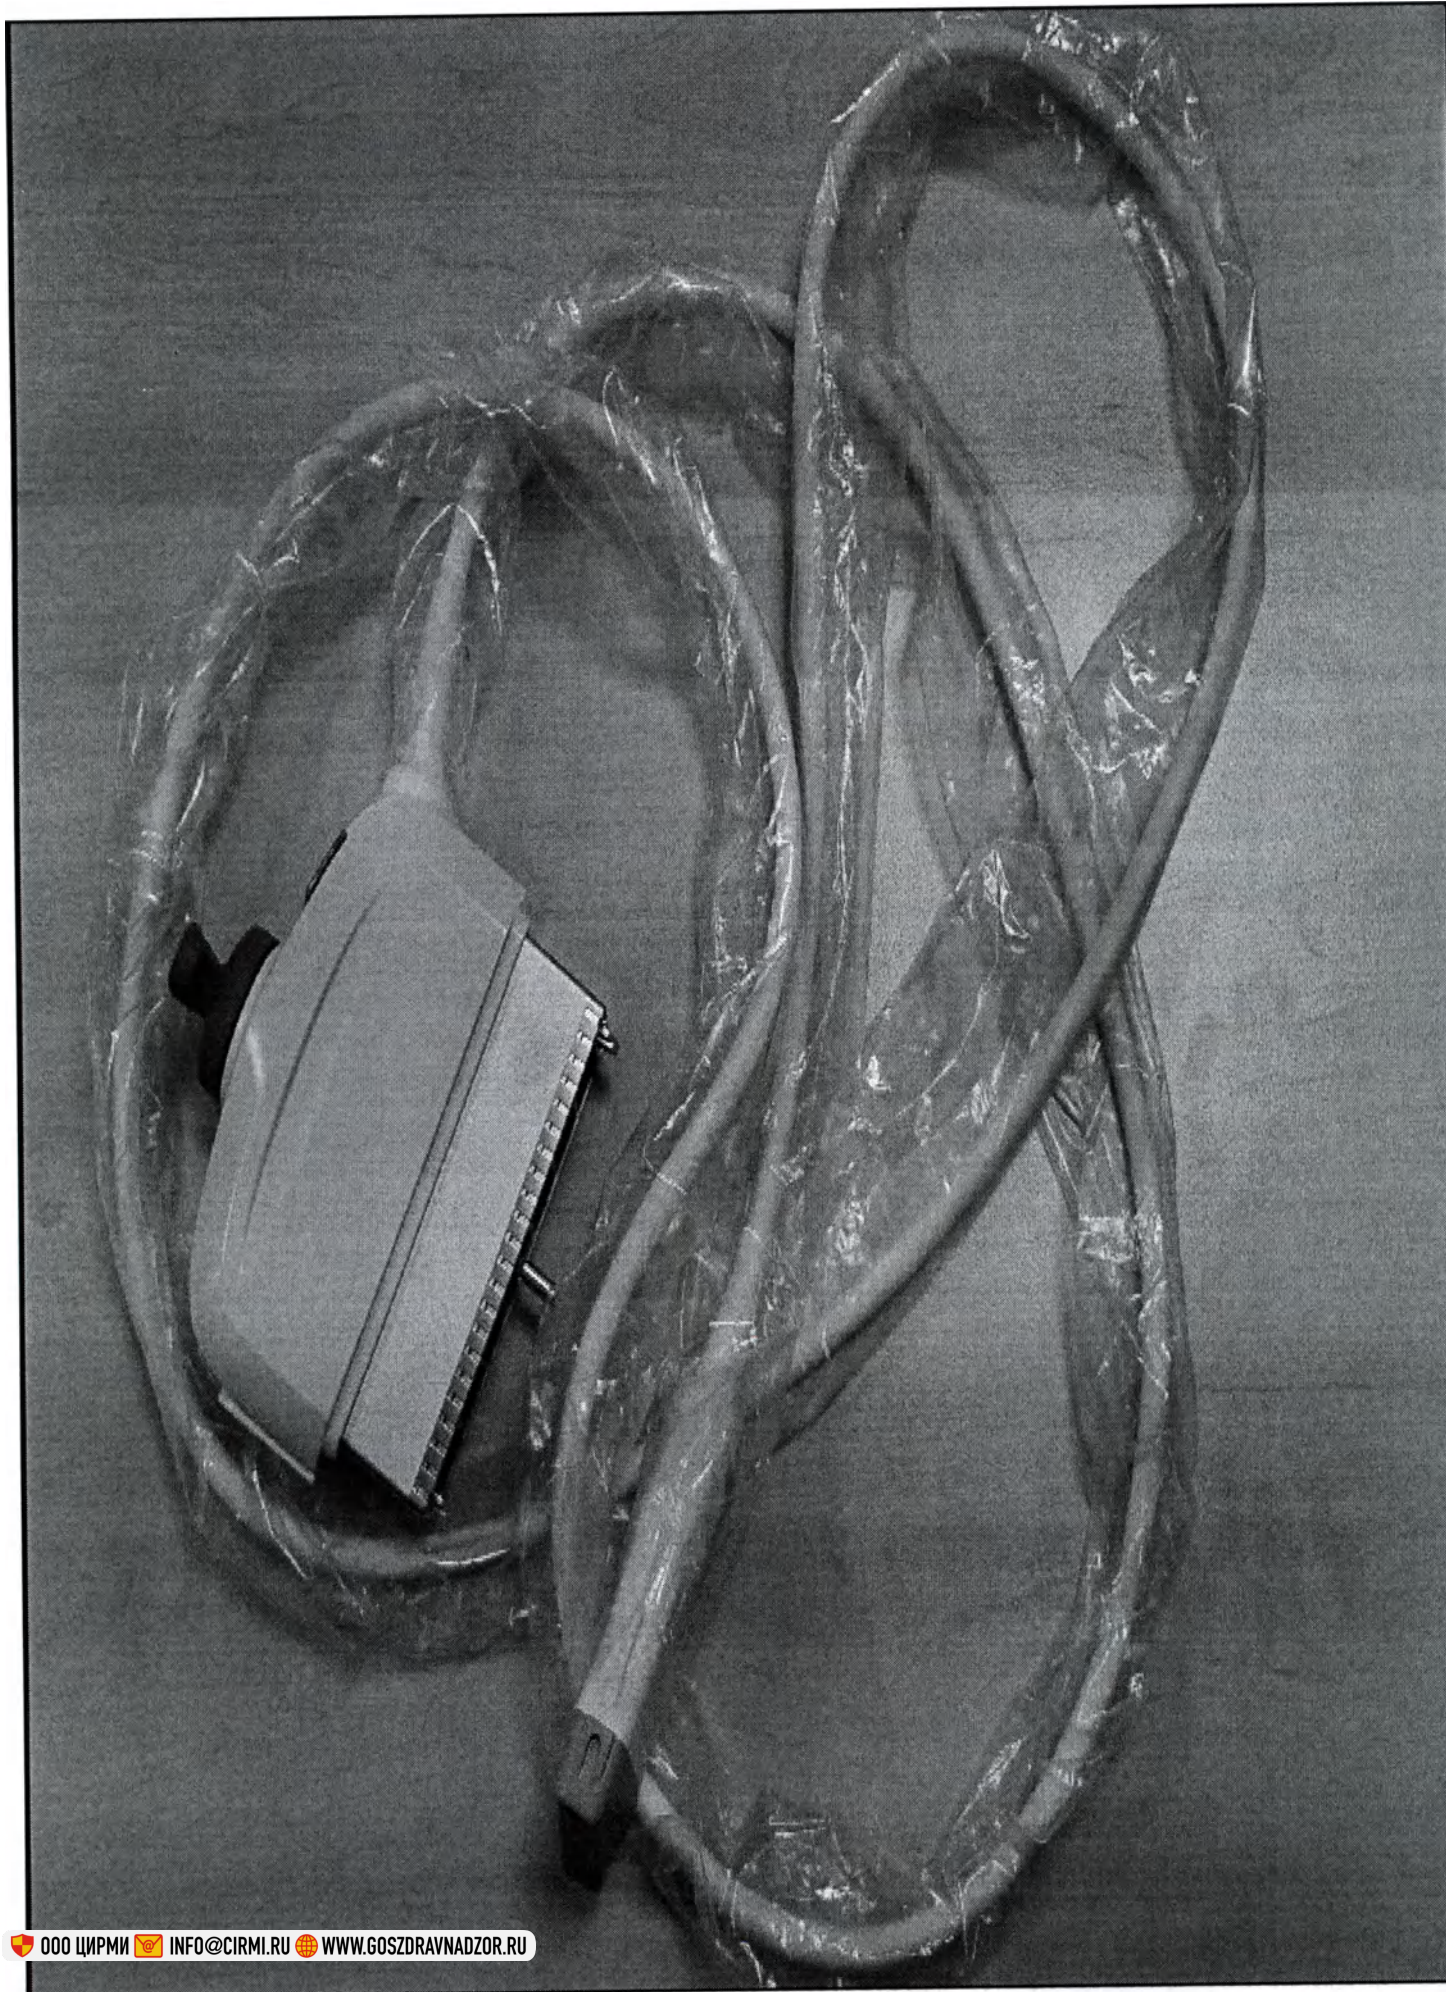





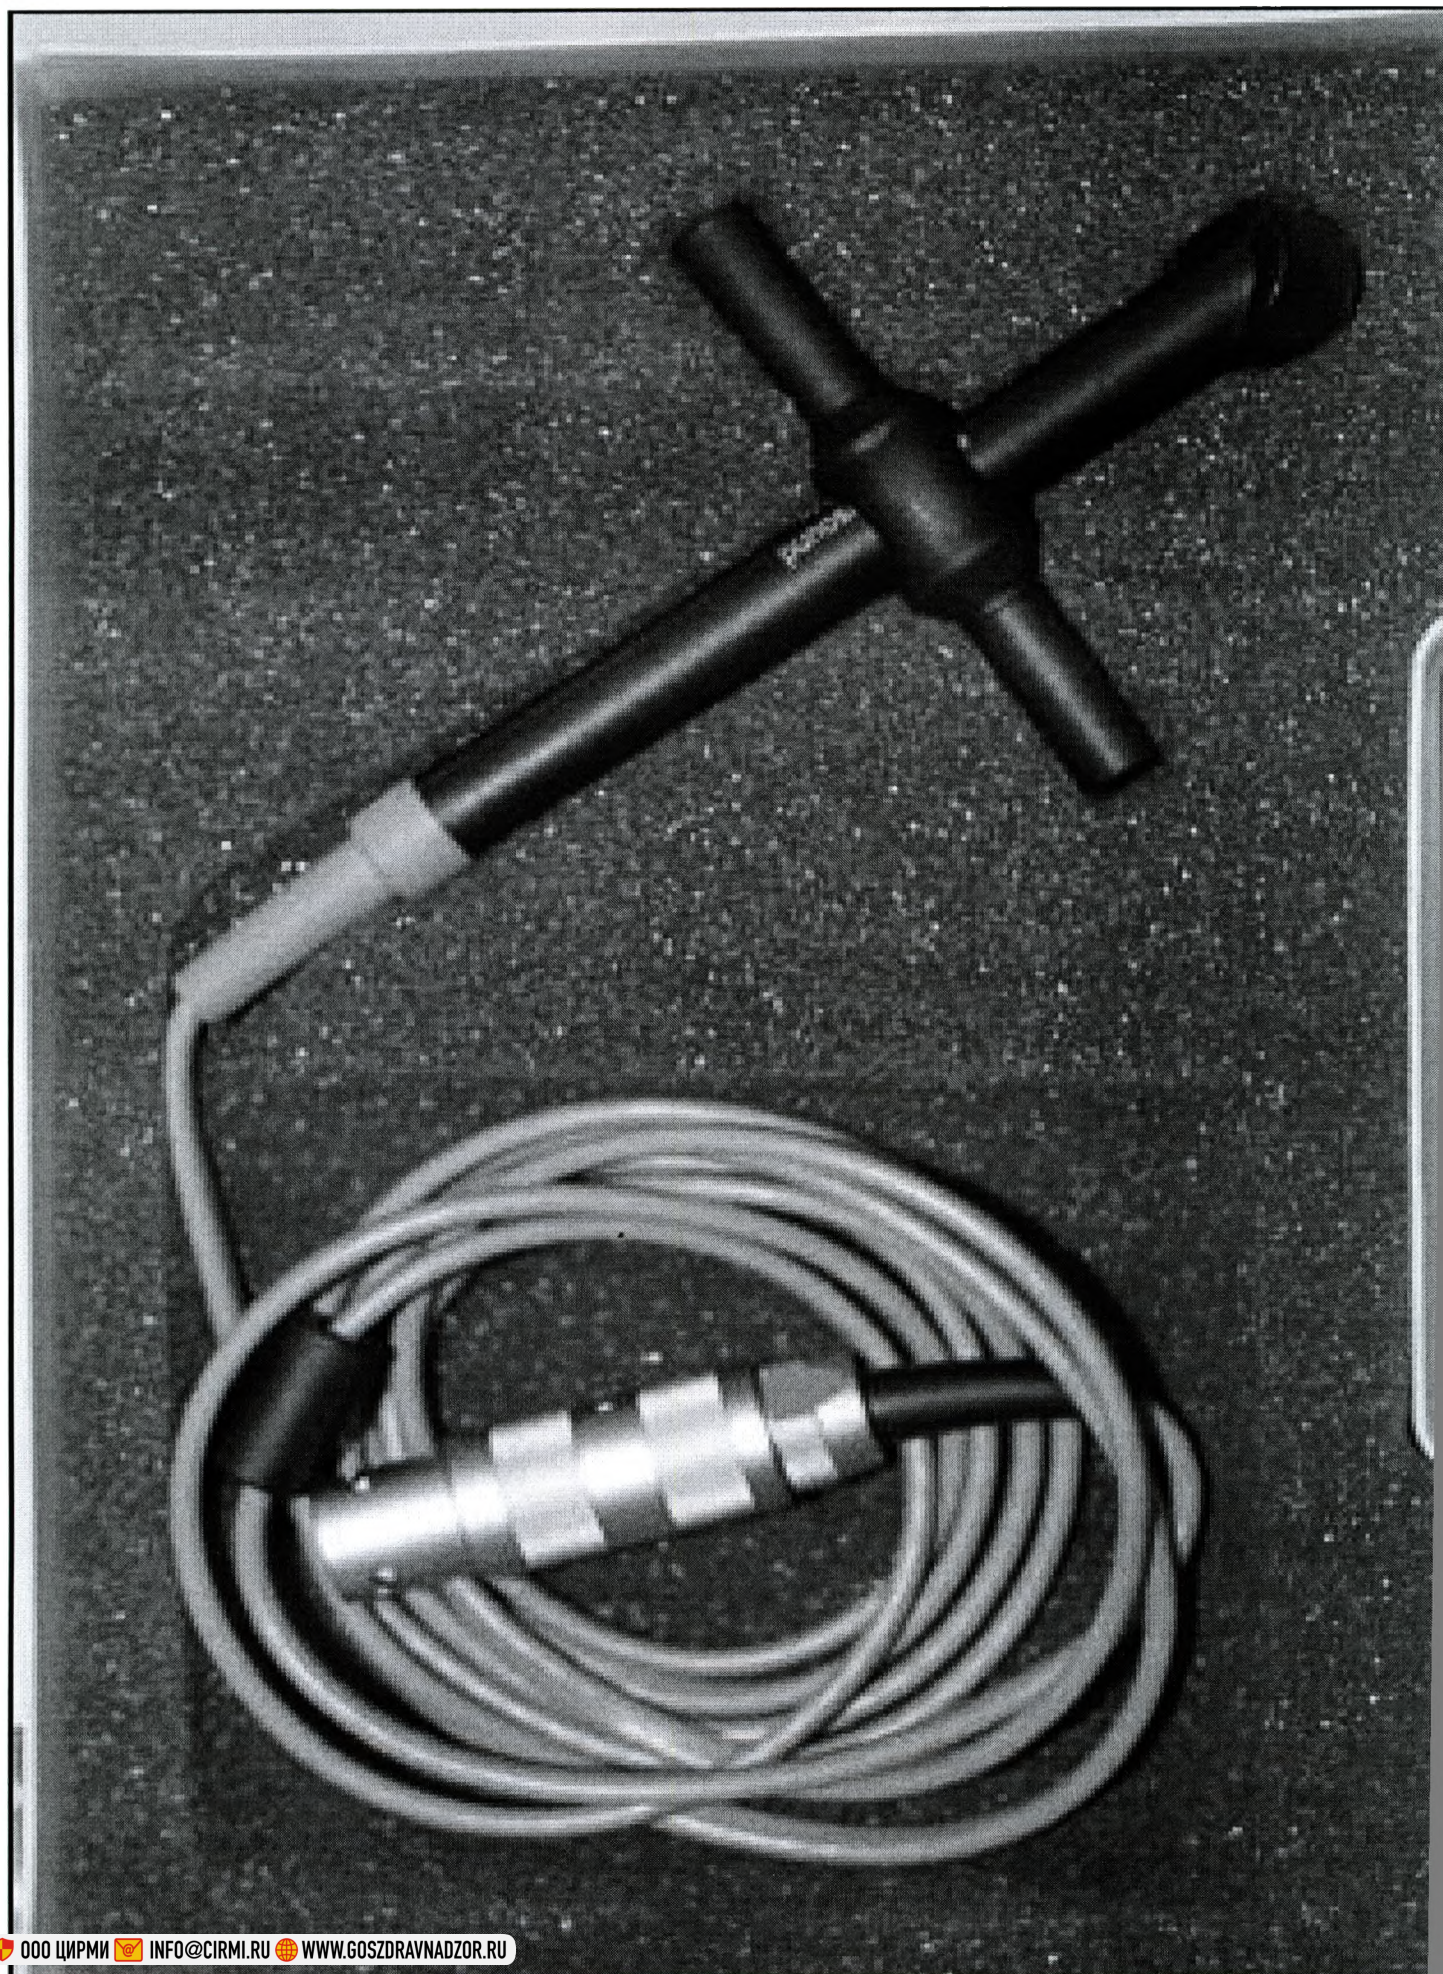












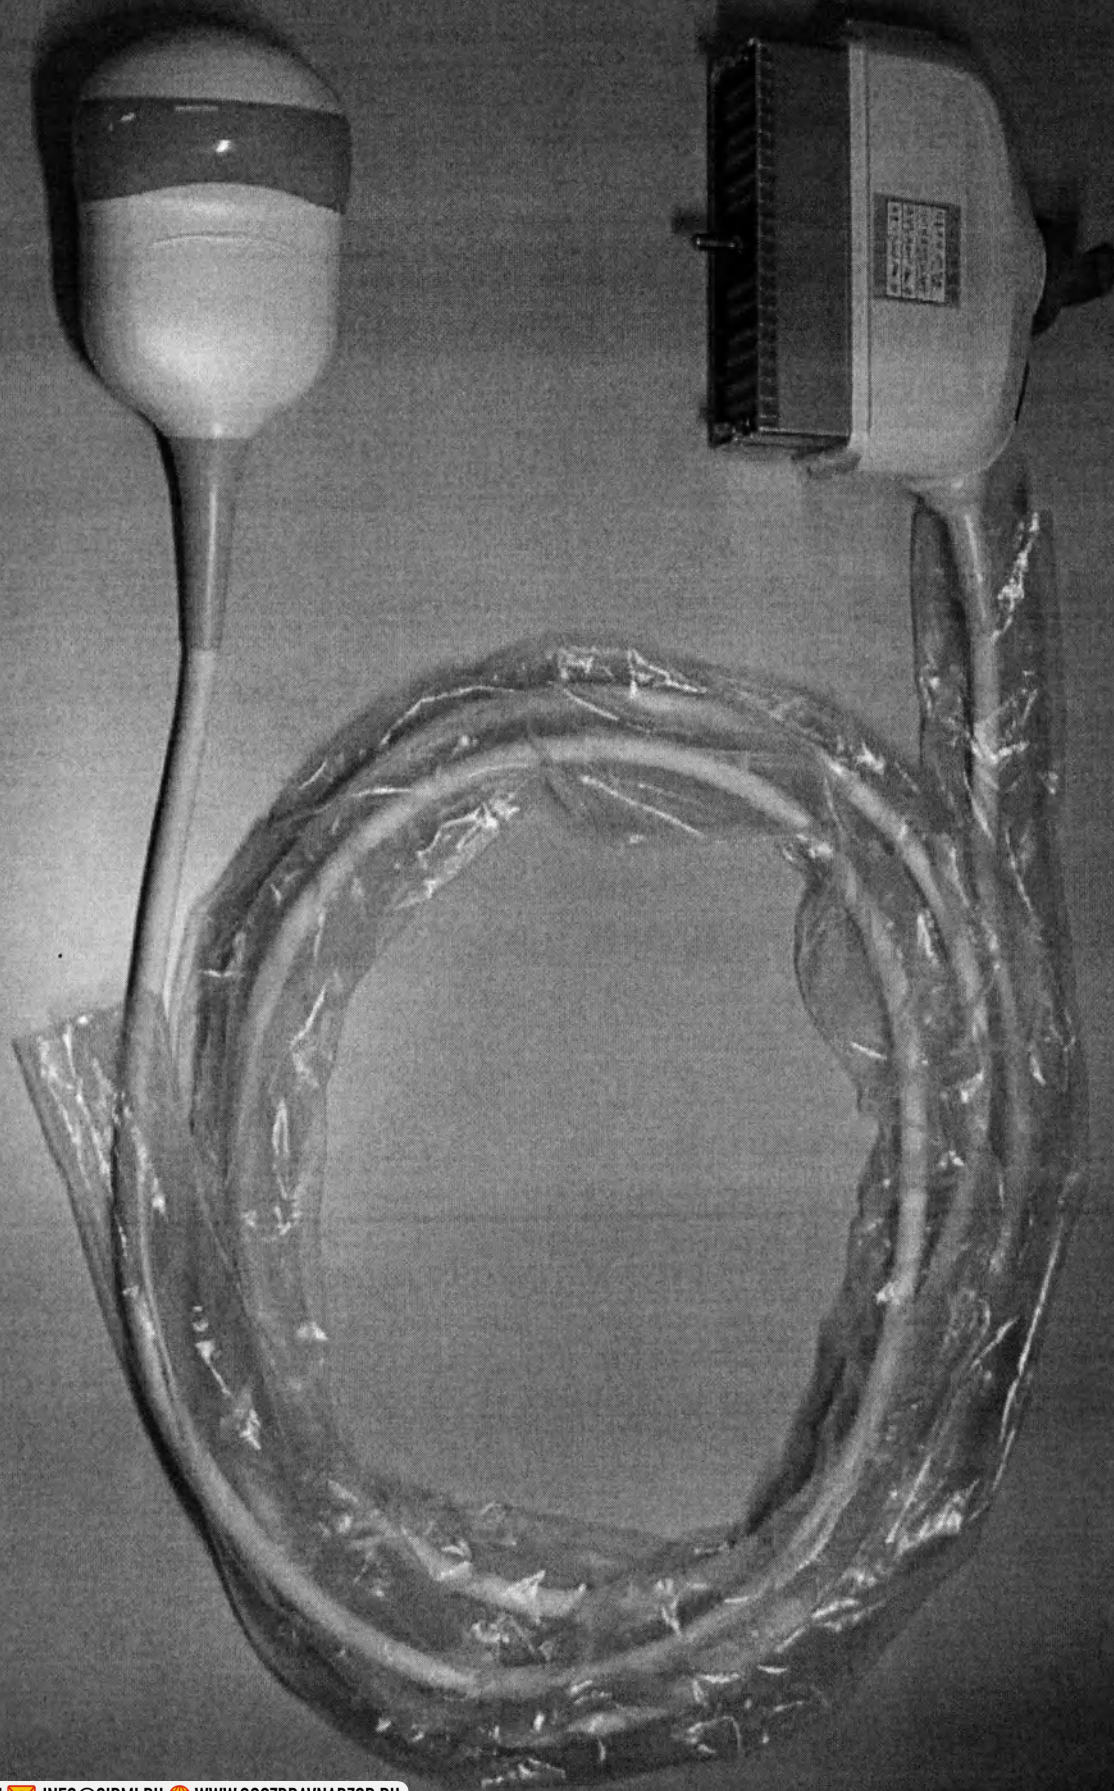








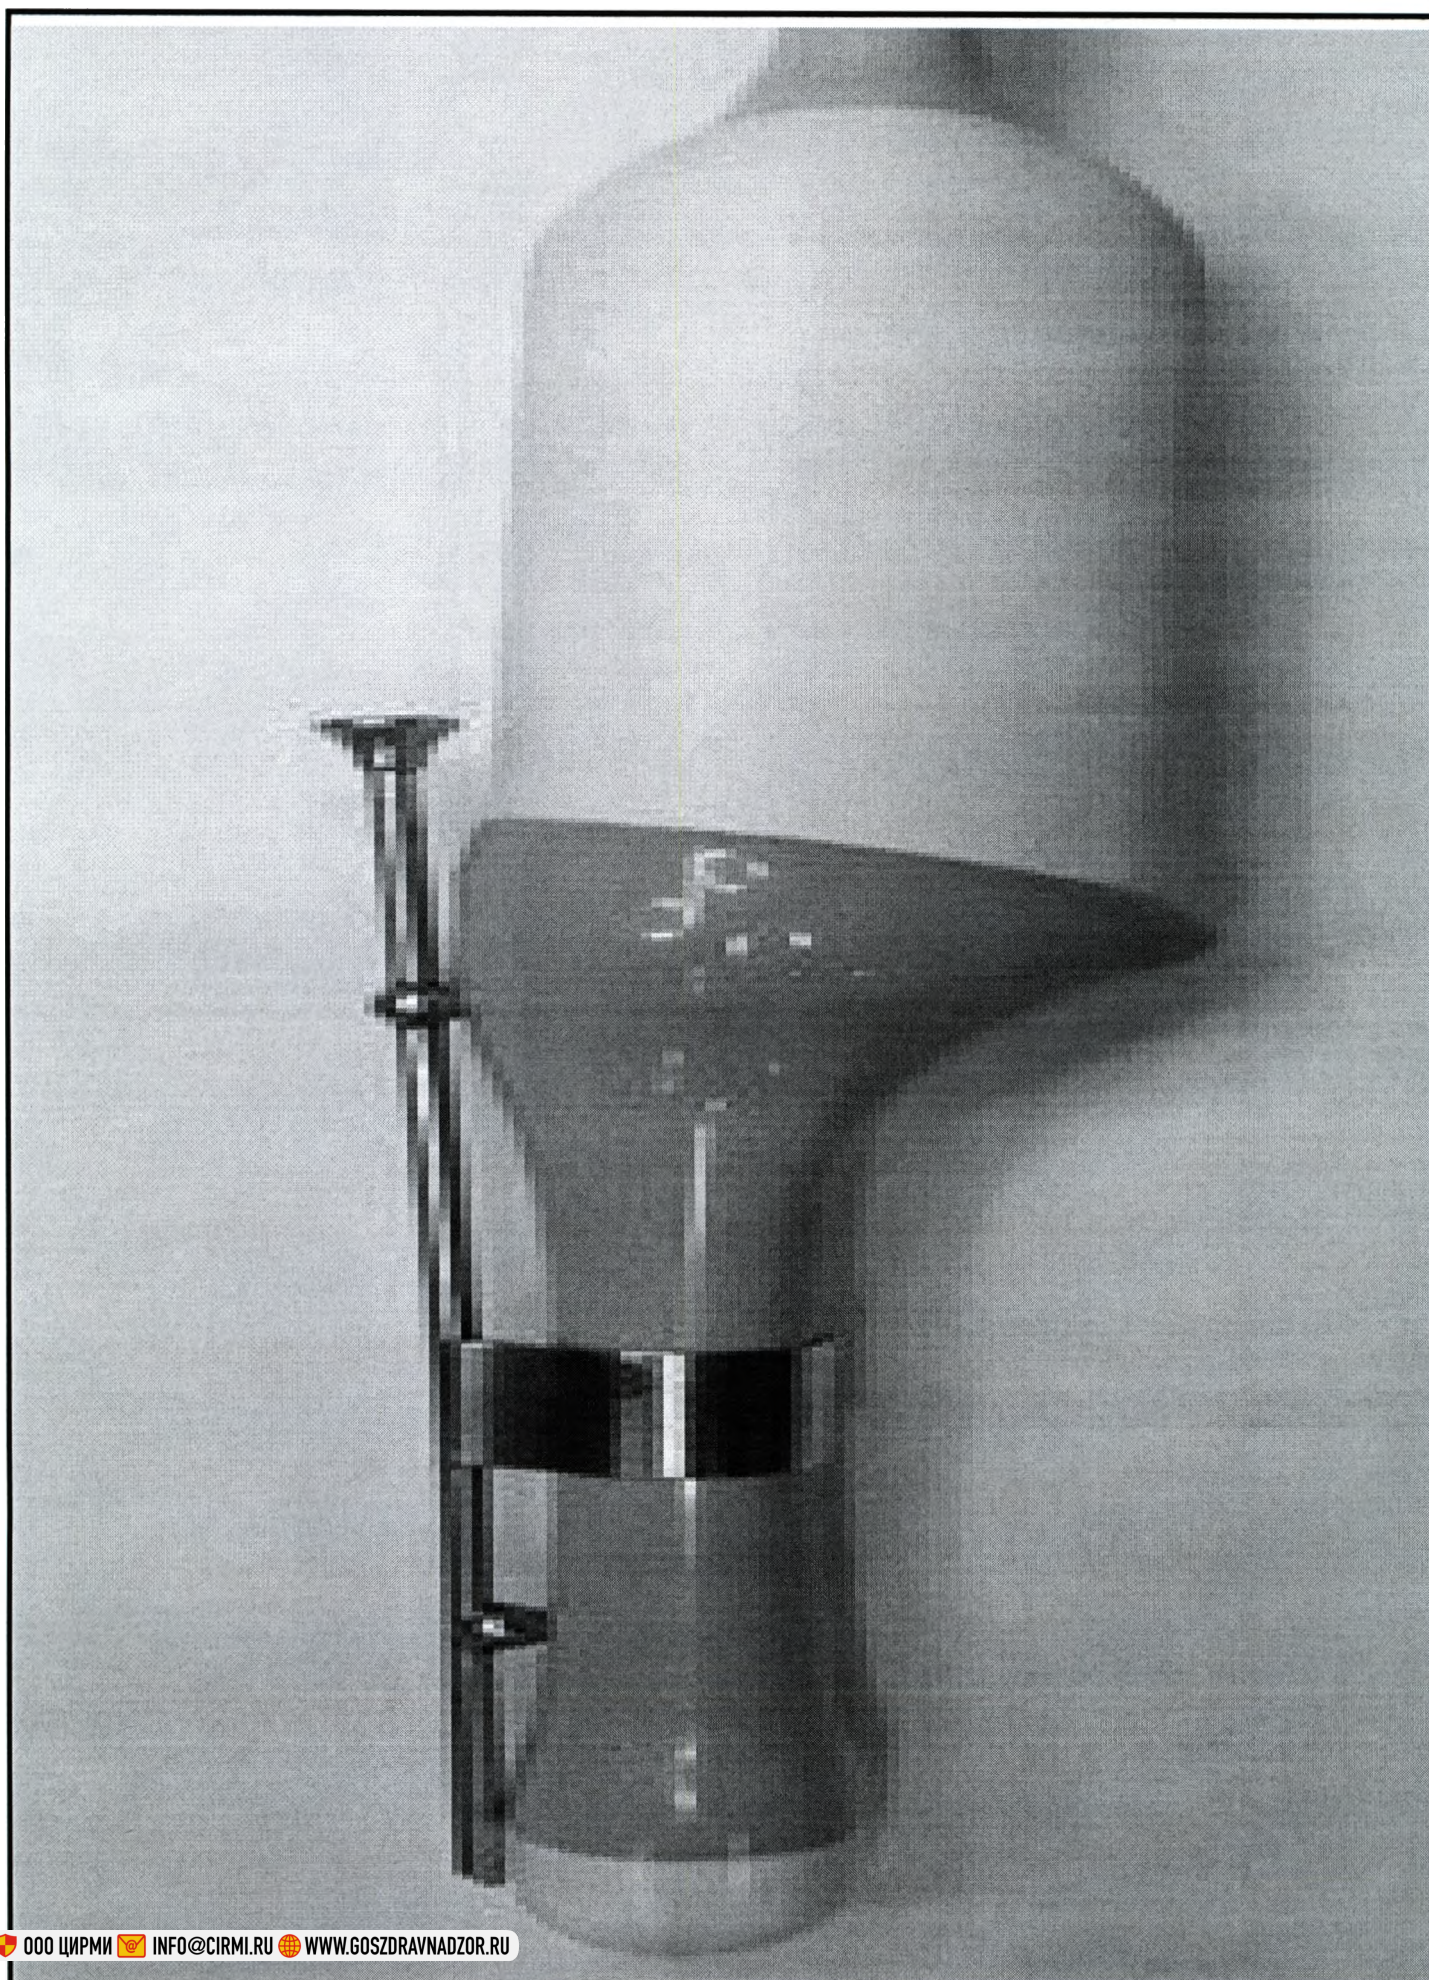

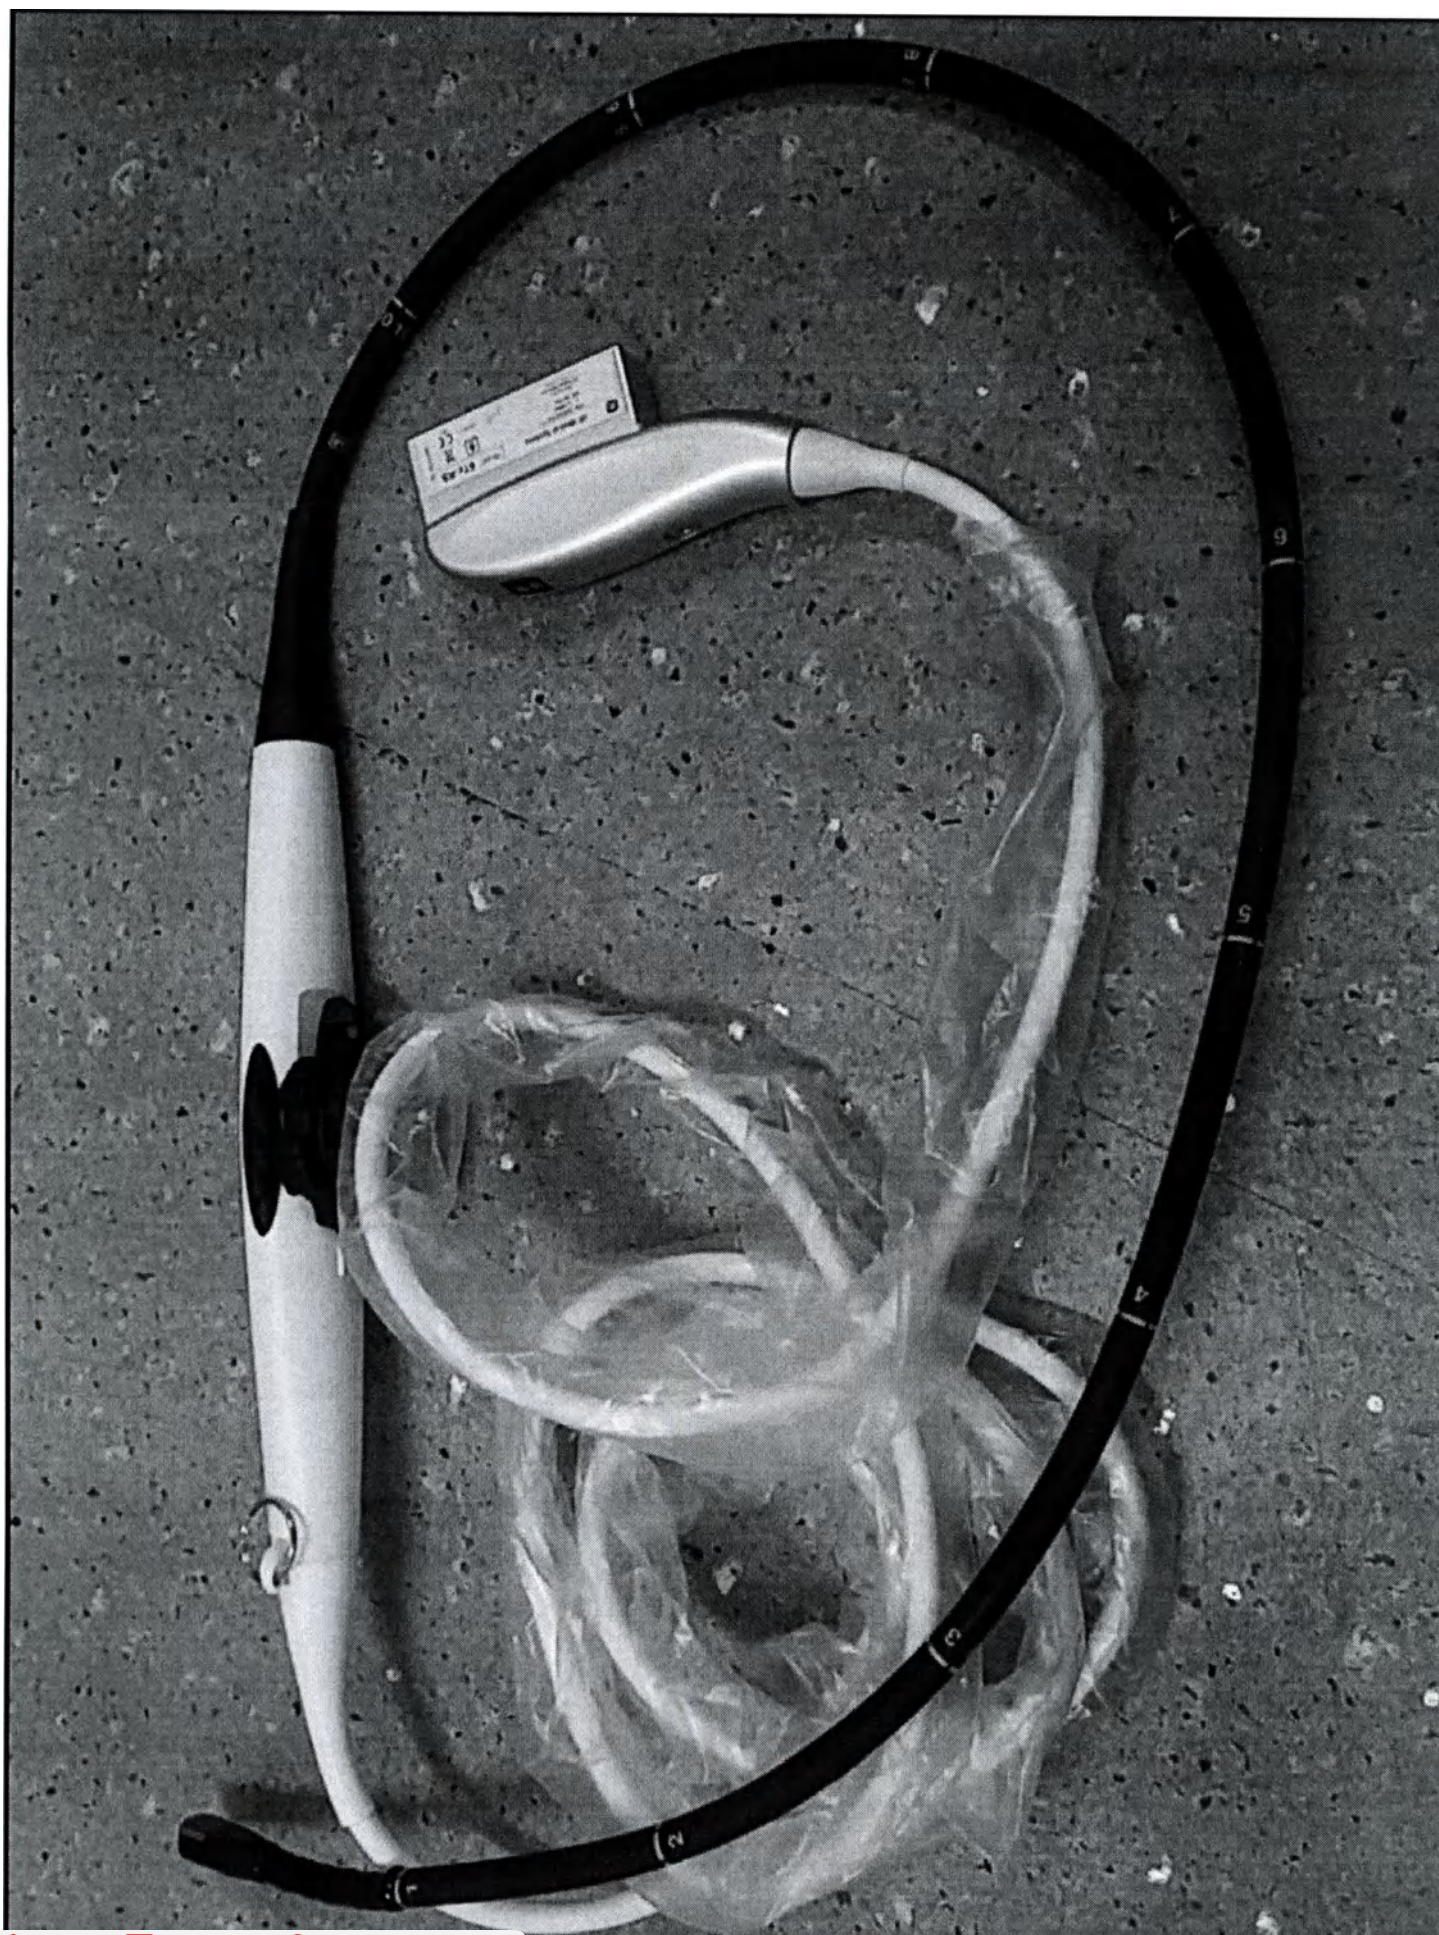

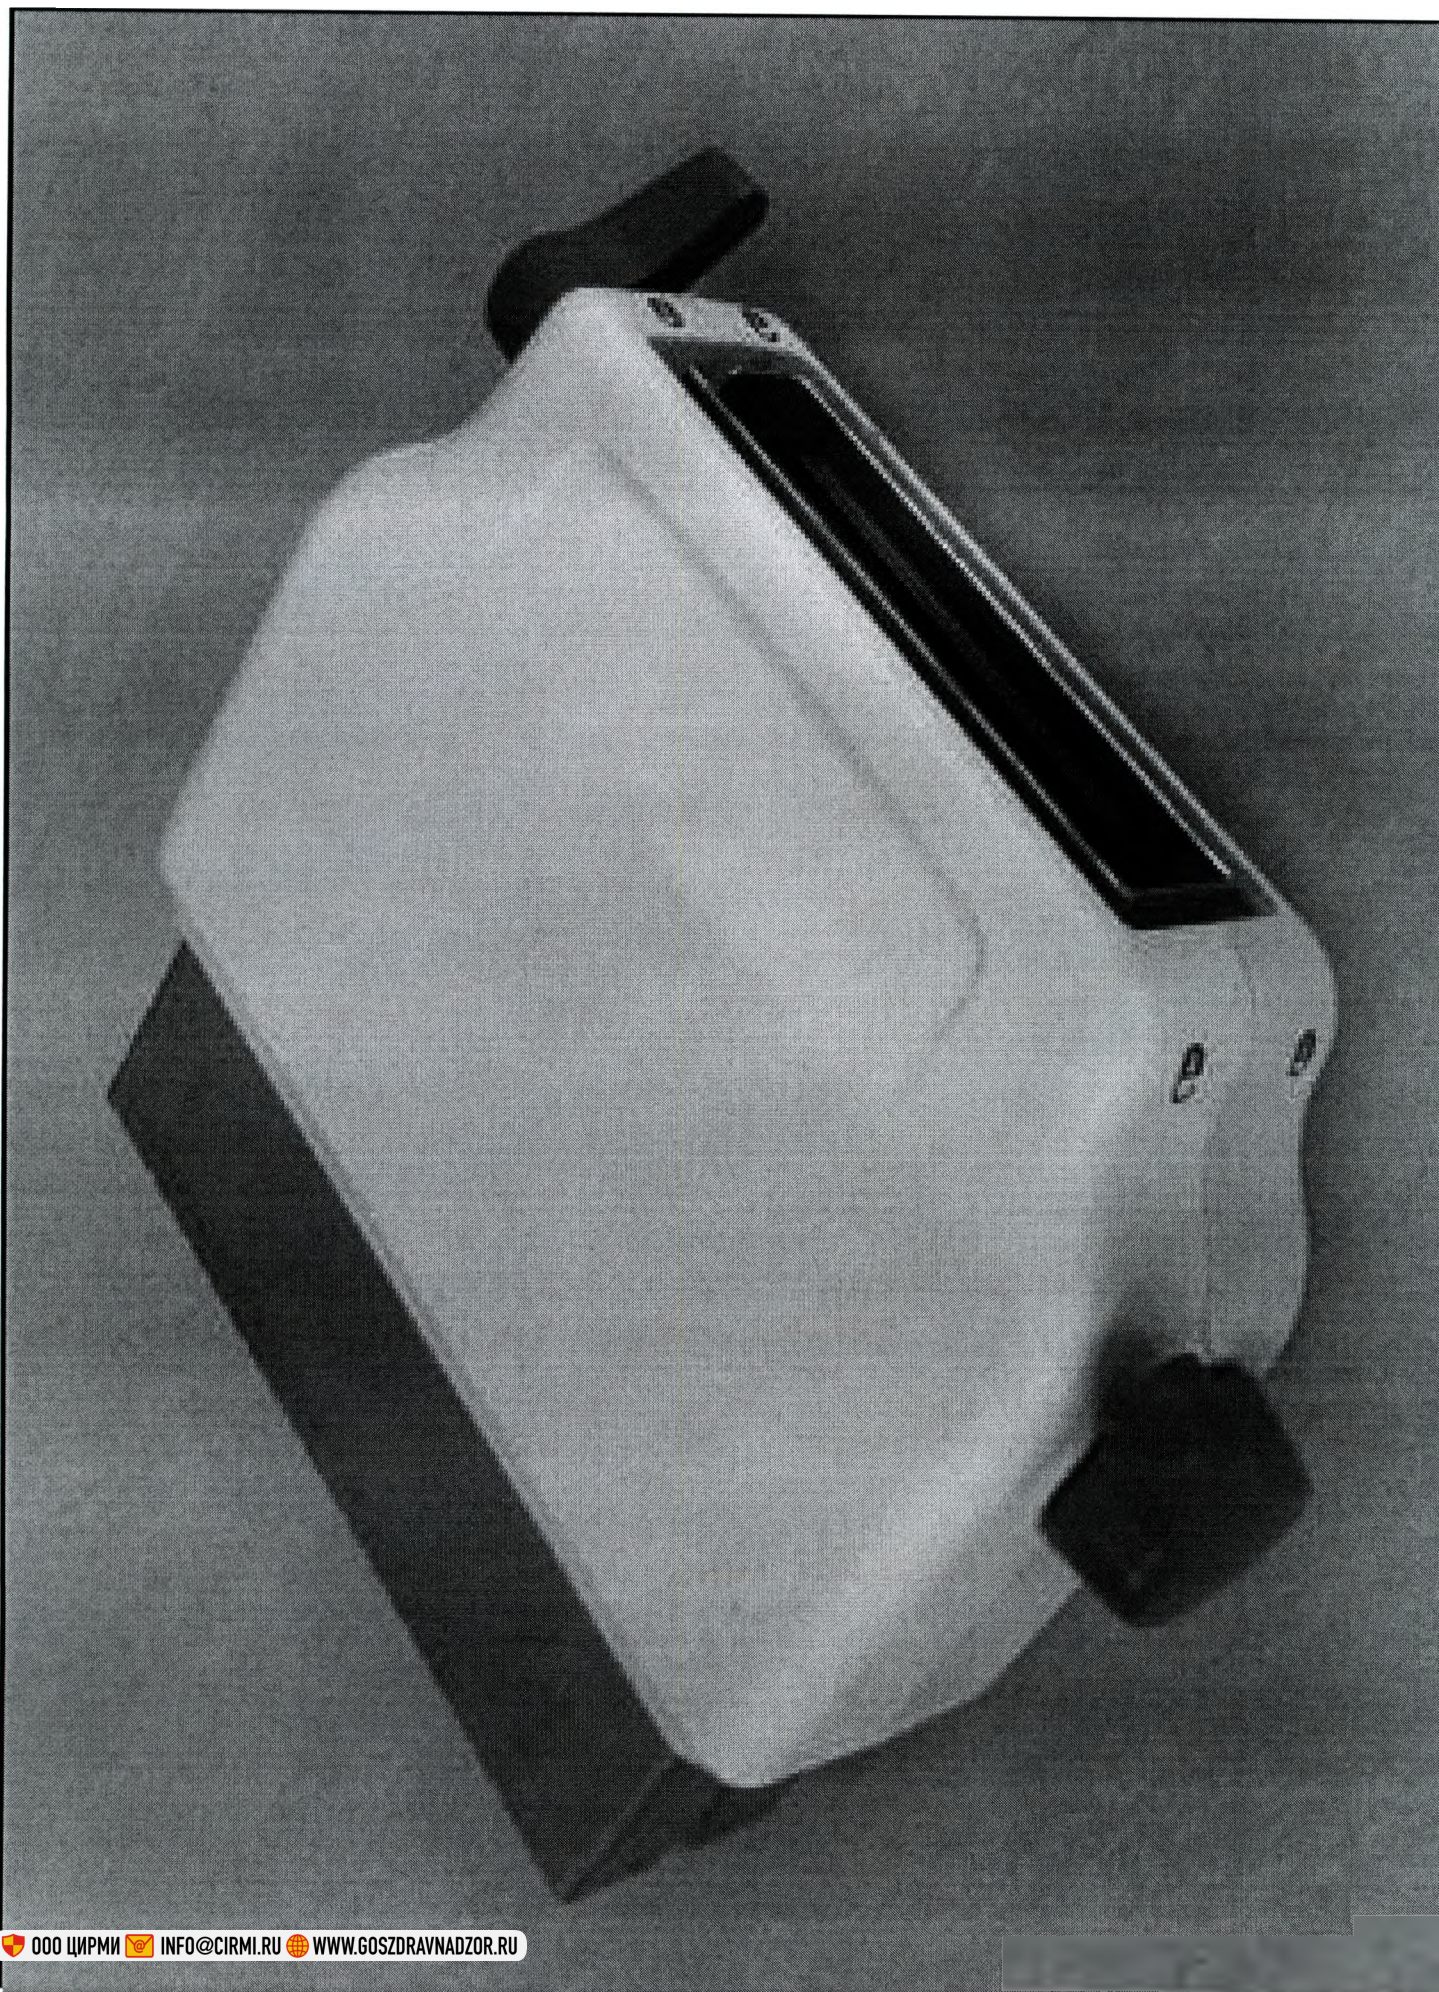

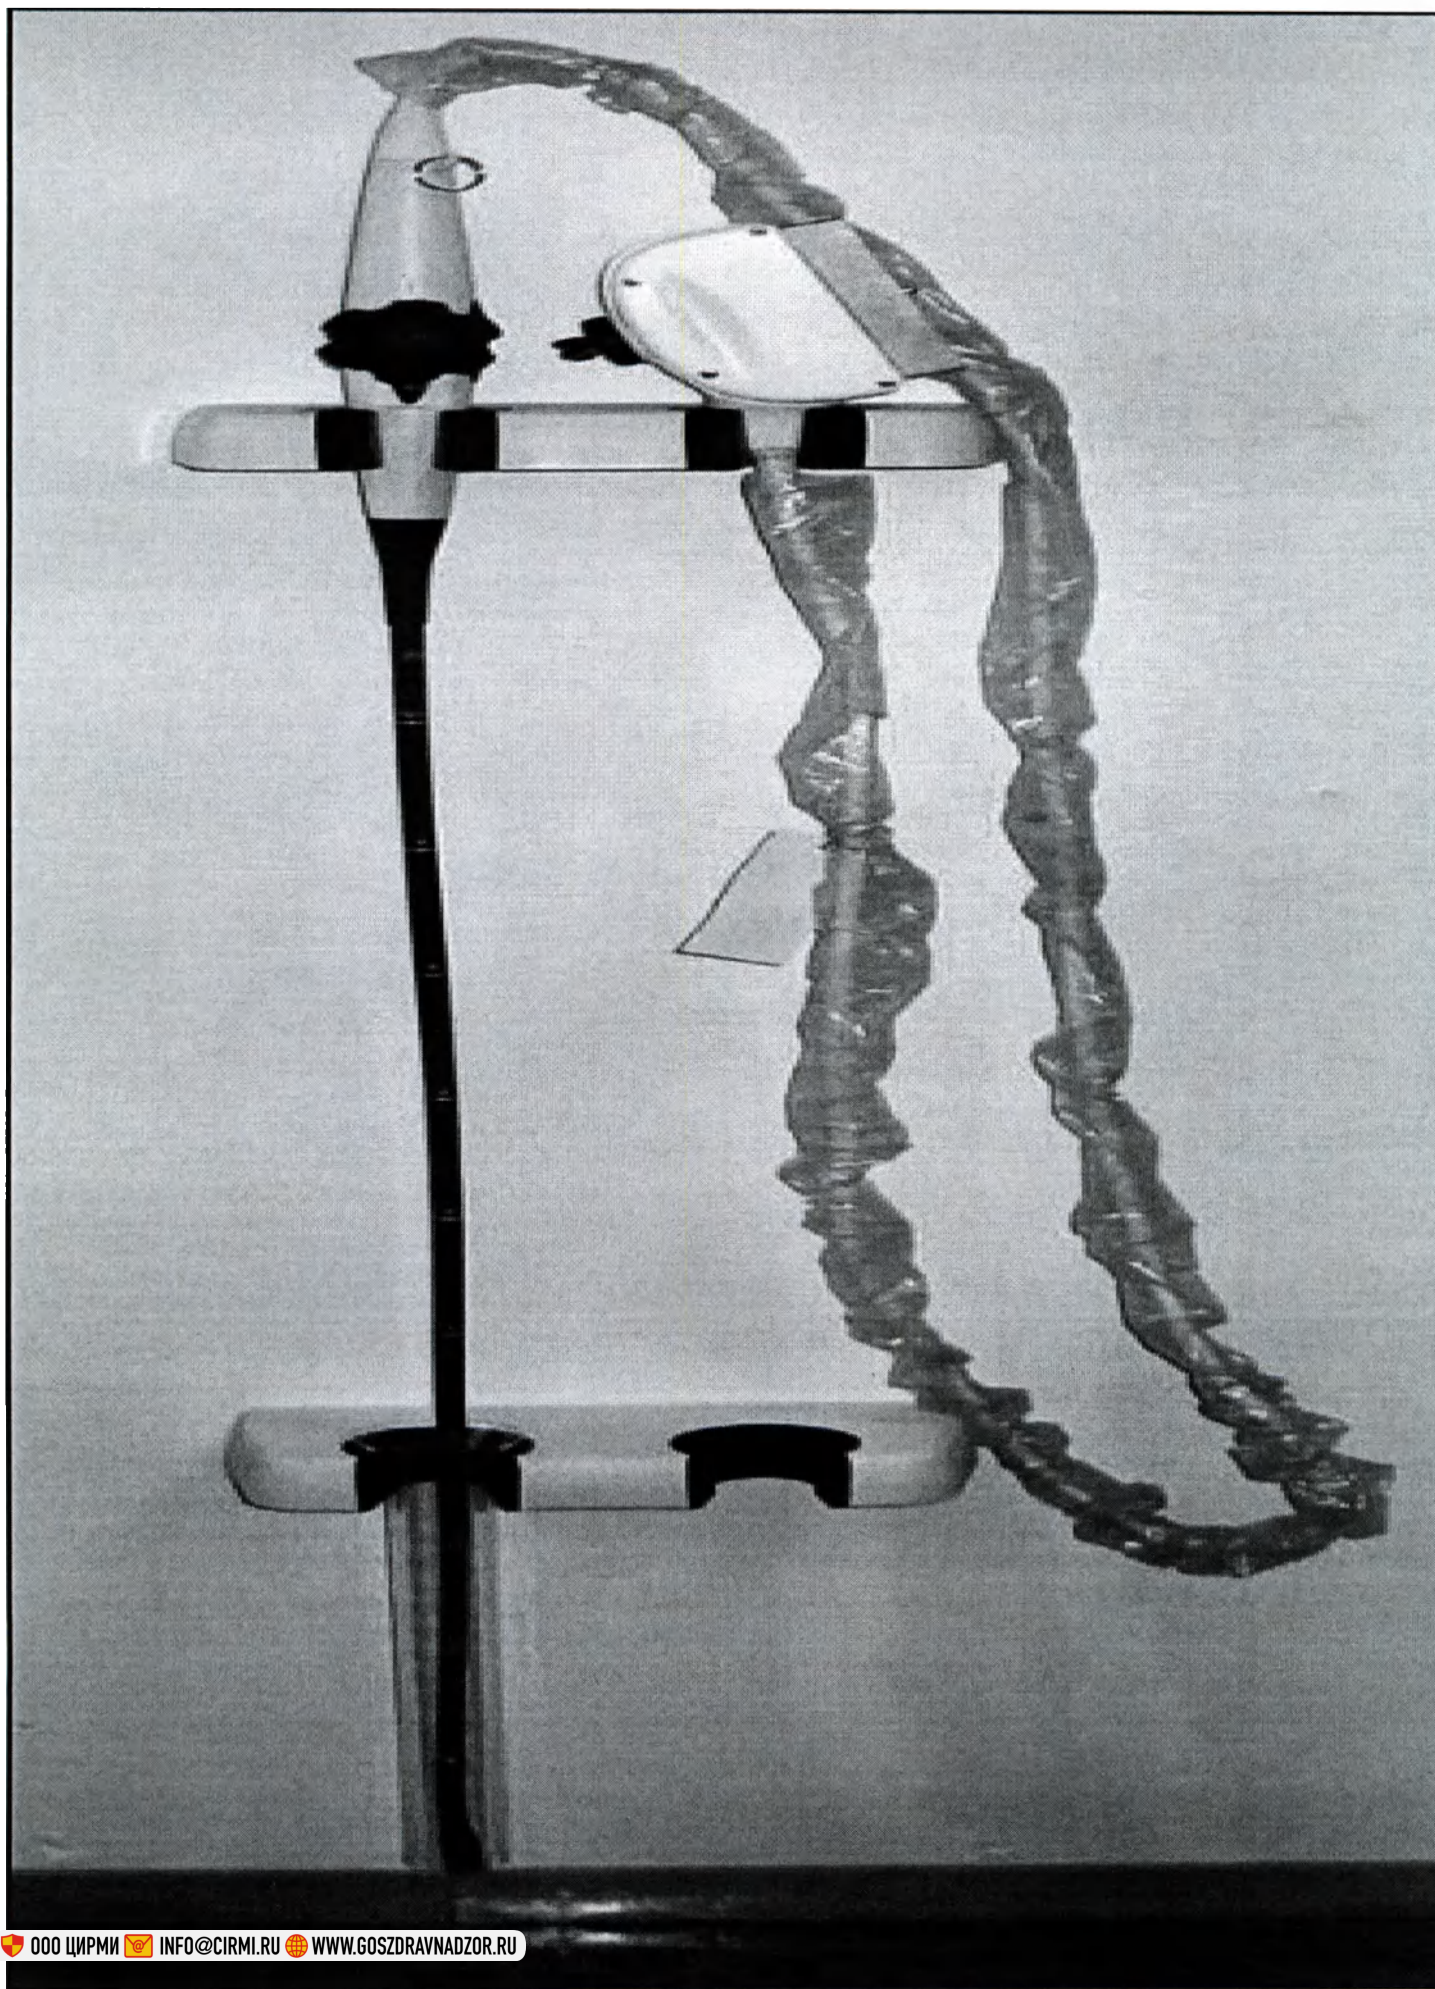

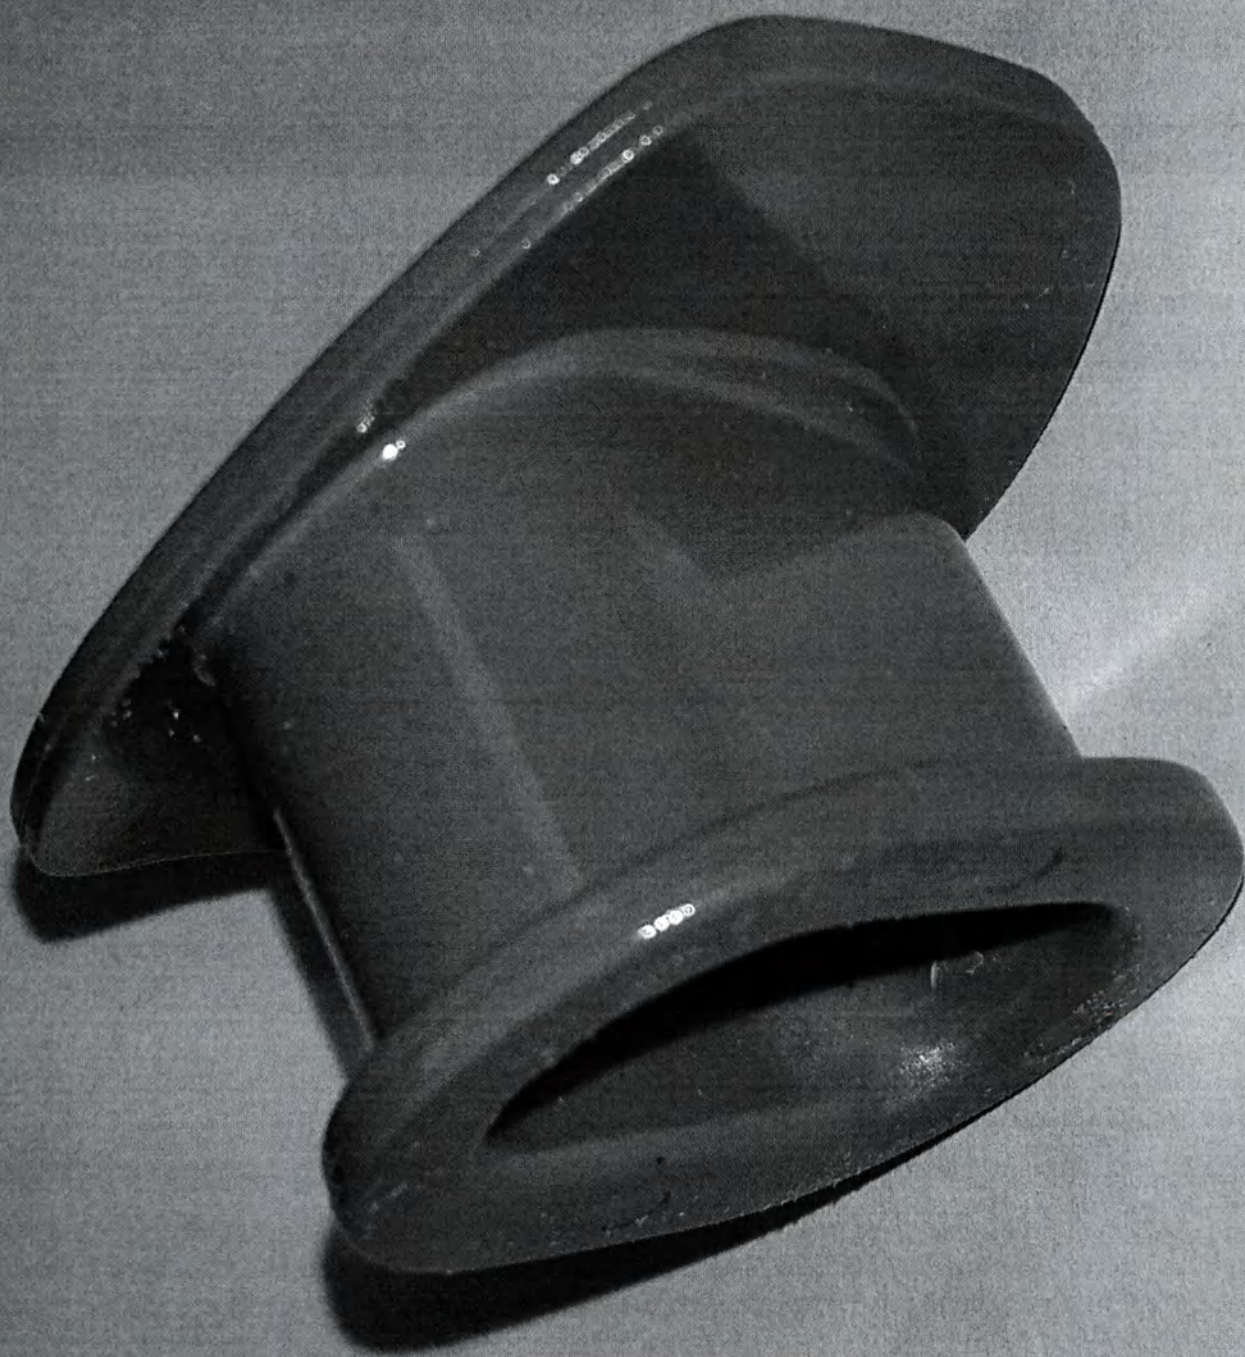






49. Модуль программный встроенный для получения объемных медицинских ультразвуковых изображений в реальном масштабе времени – Real Time 4D




50. Модуль программный встроенный для дополнительной объемной контрастной визуализации в режиме 3D/4D, активируемый электронным ключом

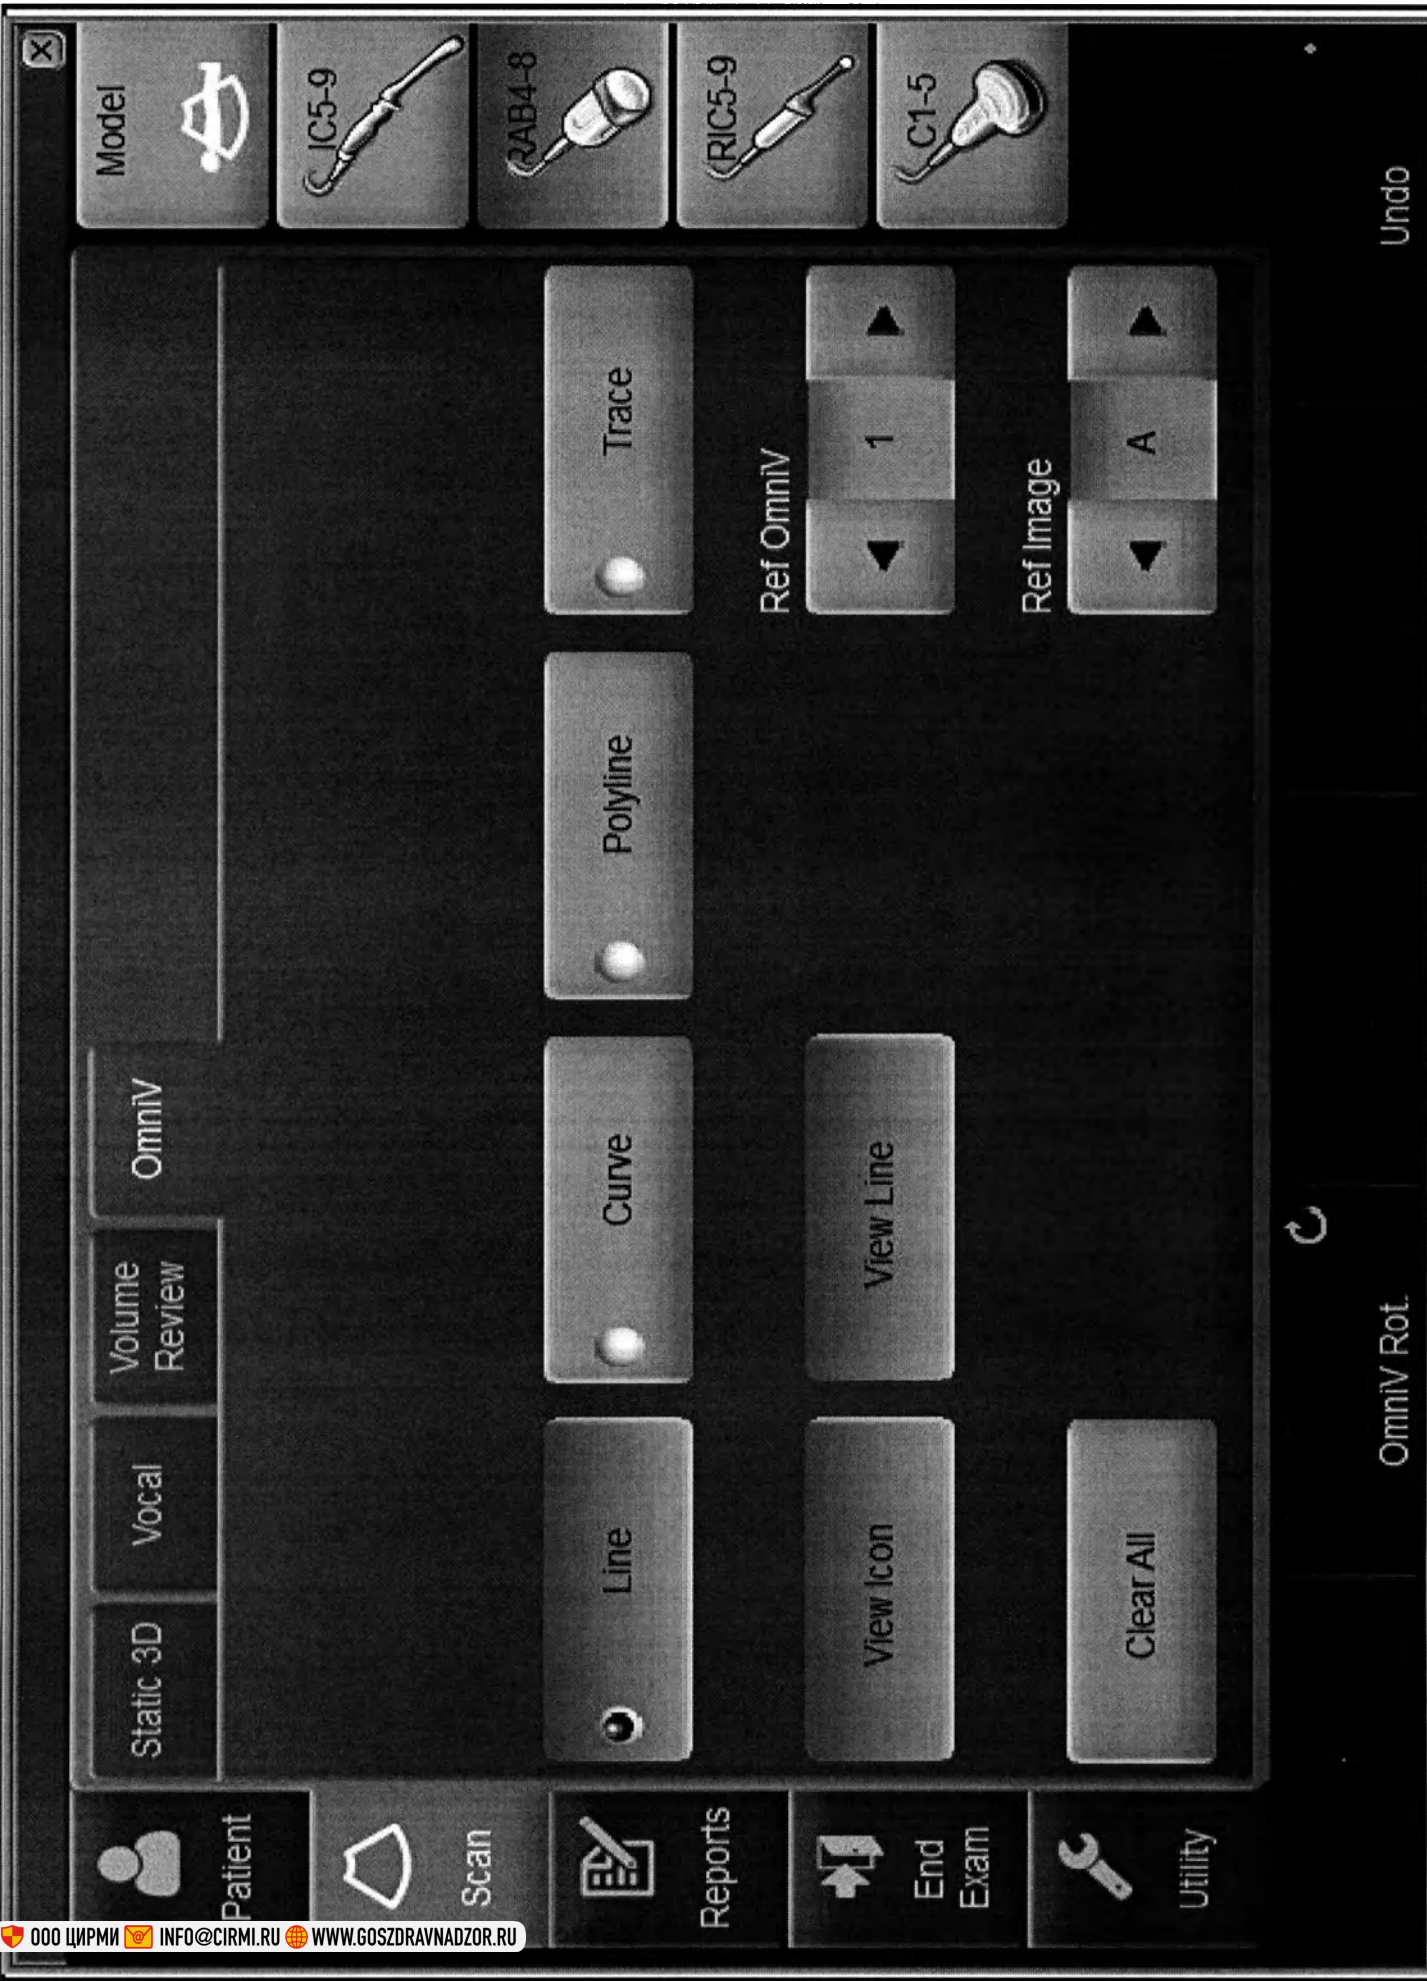

51. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме непрерывно-волнового доплера, активируемый электронным ключом


61

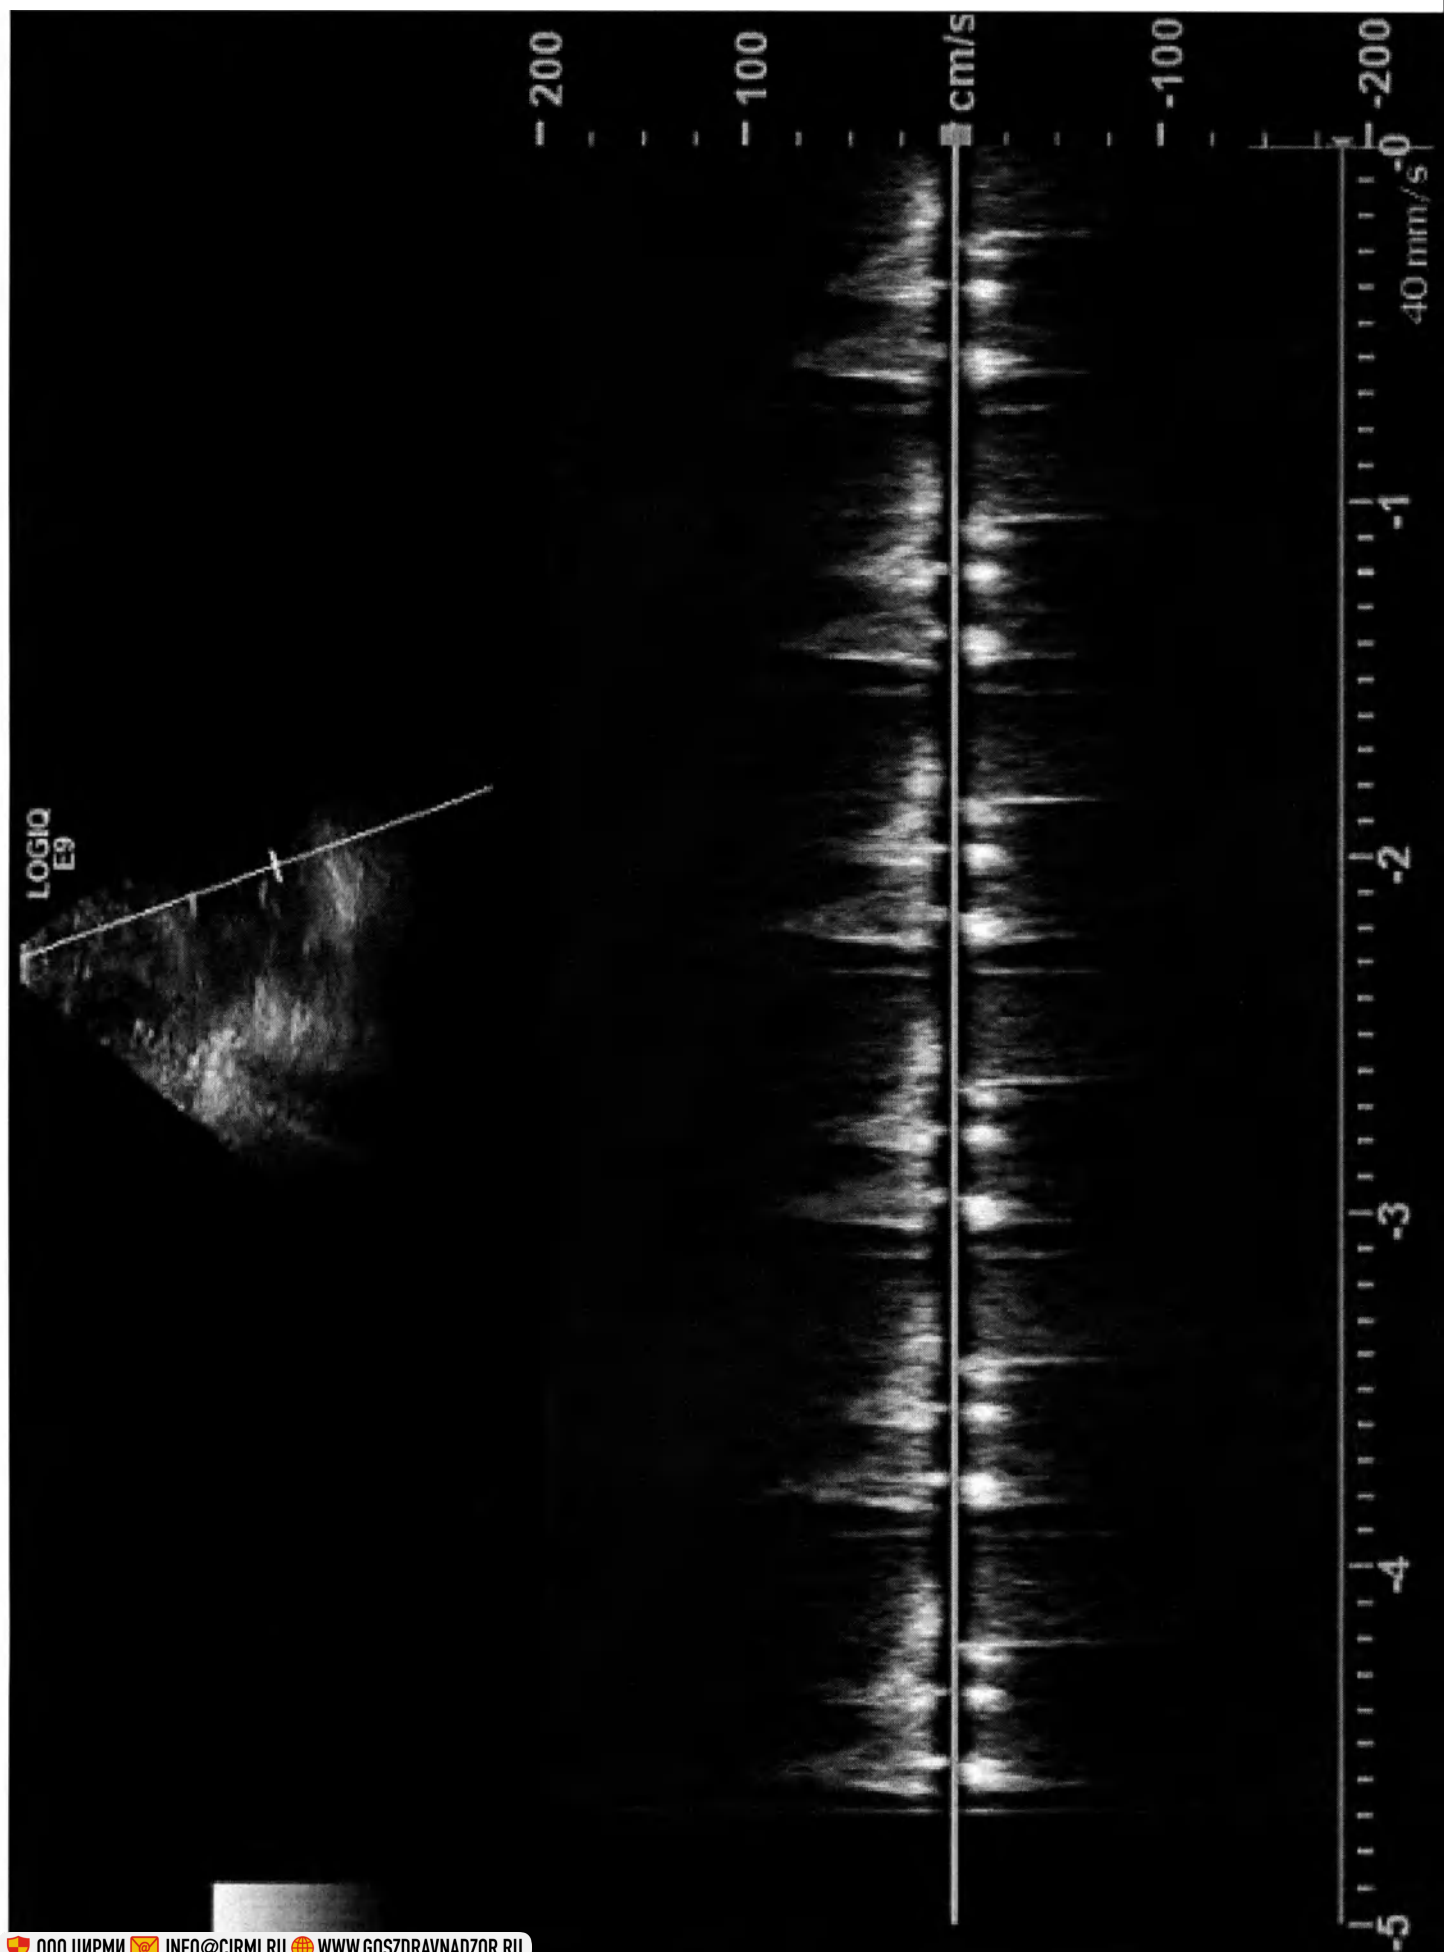

52. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме недоплеровской визуализации кровотока - B-flow, активируемый электронным ключом




53. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме панорамного сканирования - LogiqView, активируемый электронным ключом

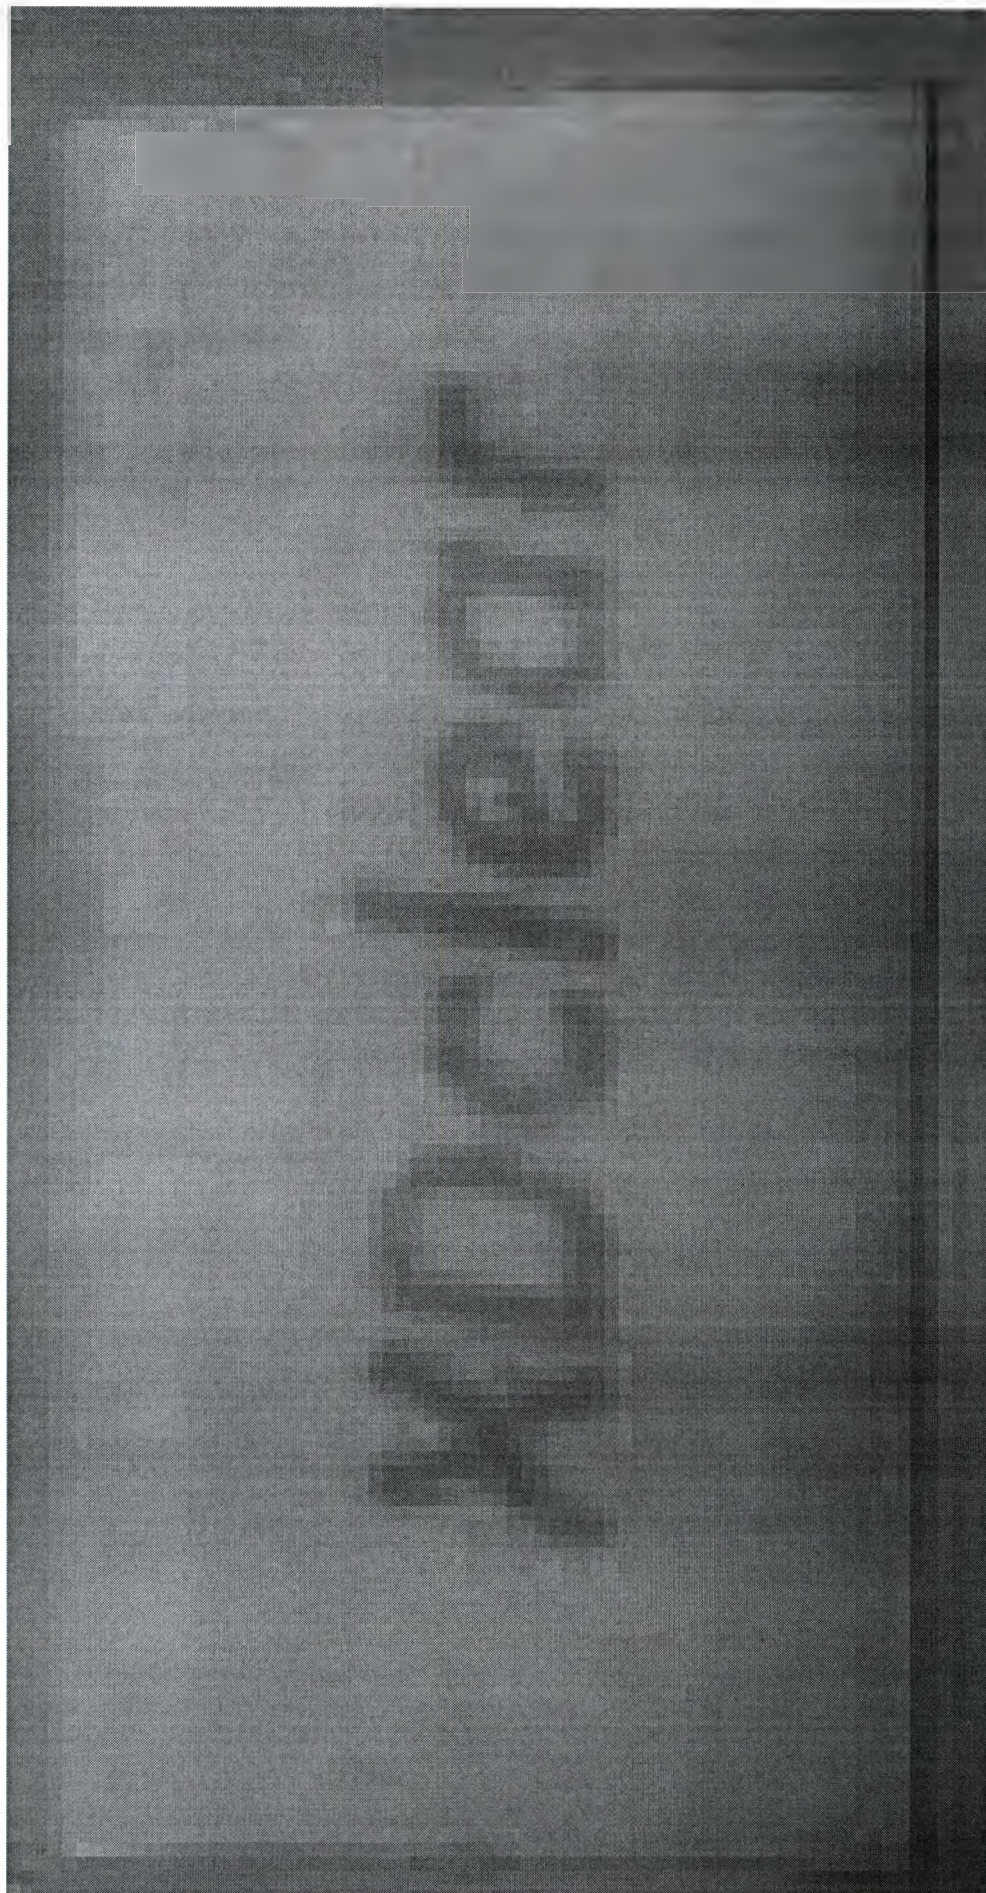


55. Модуль программный встроенный для улучшения визуализации биопсийной иглы
в режиме B-Steer, активируемый электронным ключом

65


56. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Coded Contrast – УЗИ с контрастированием, активируемый электронным ключом

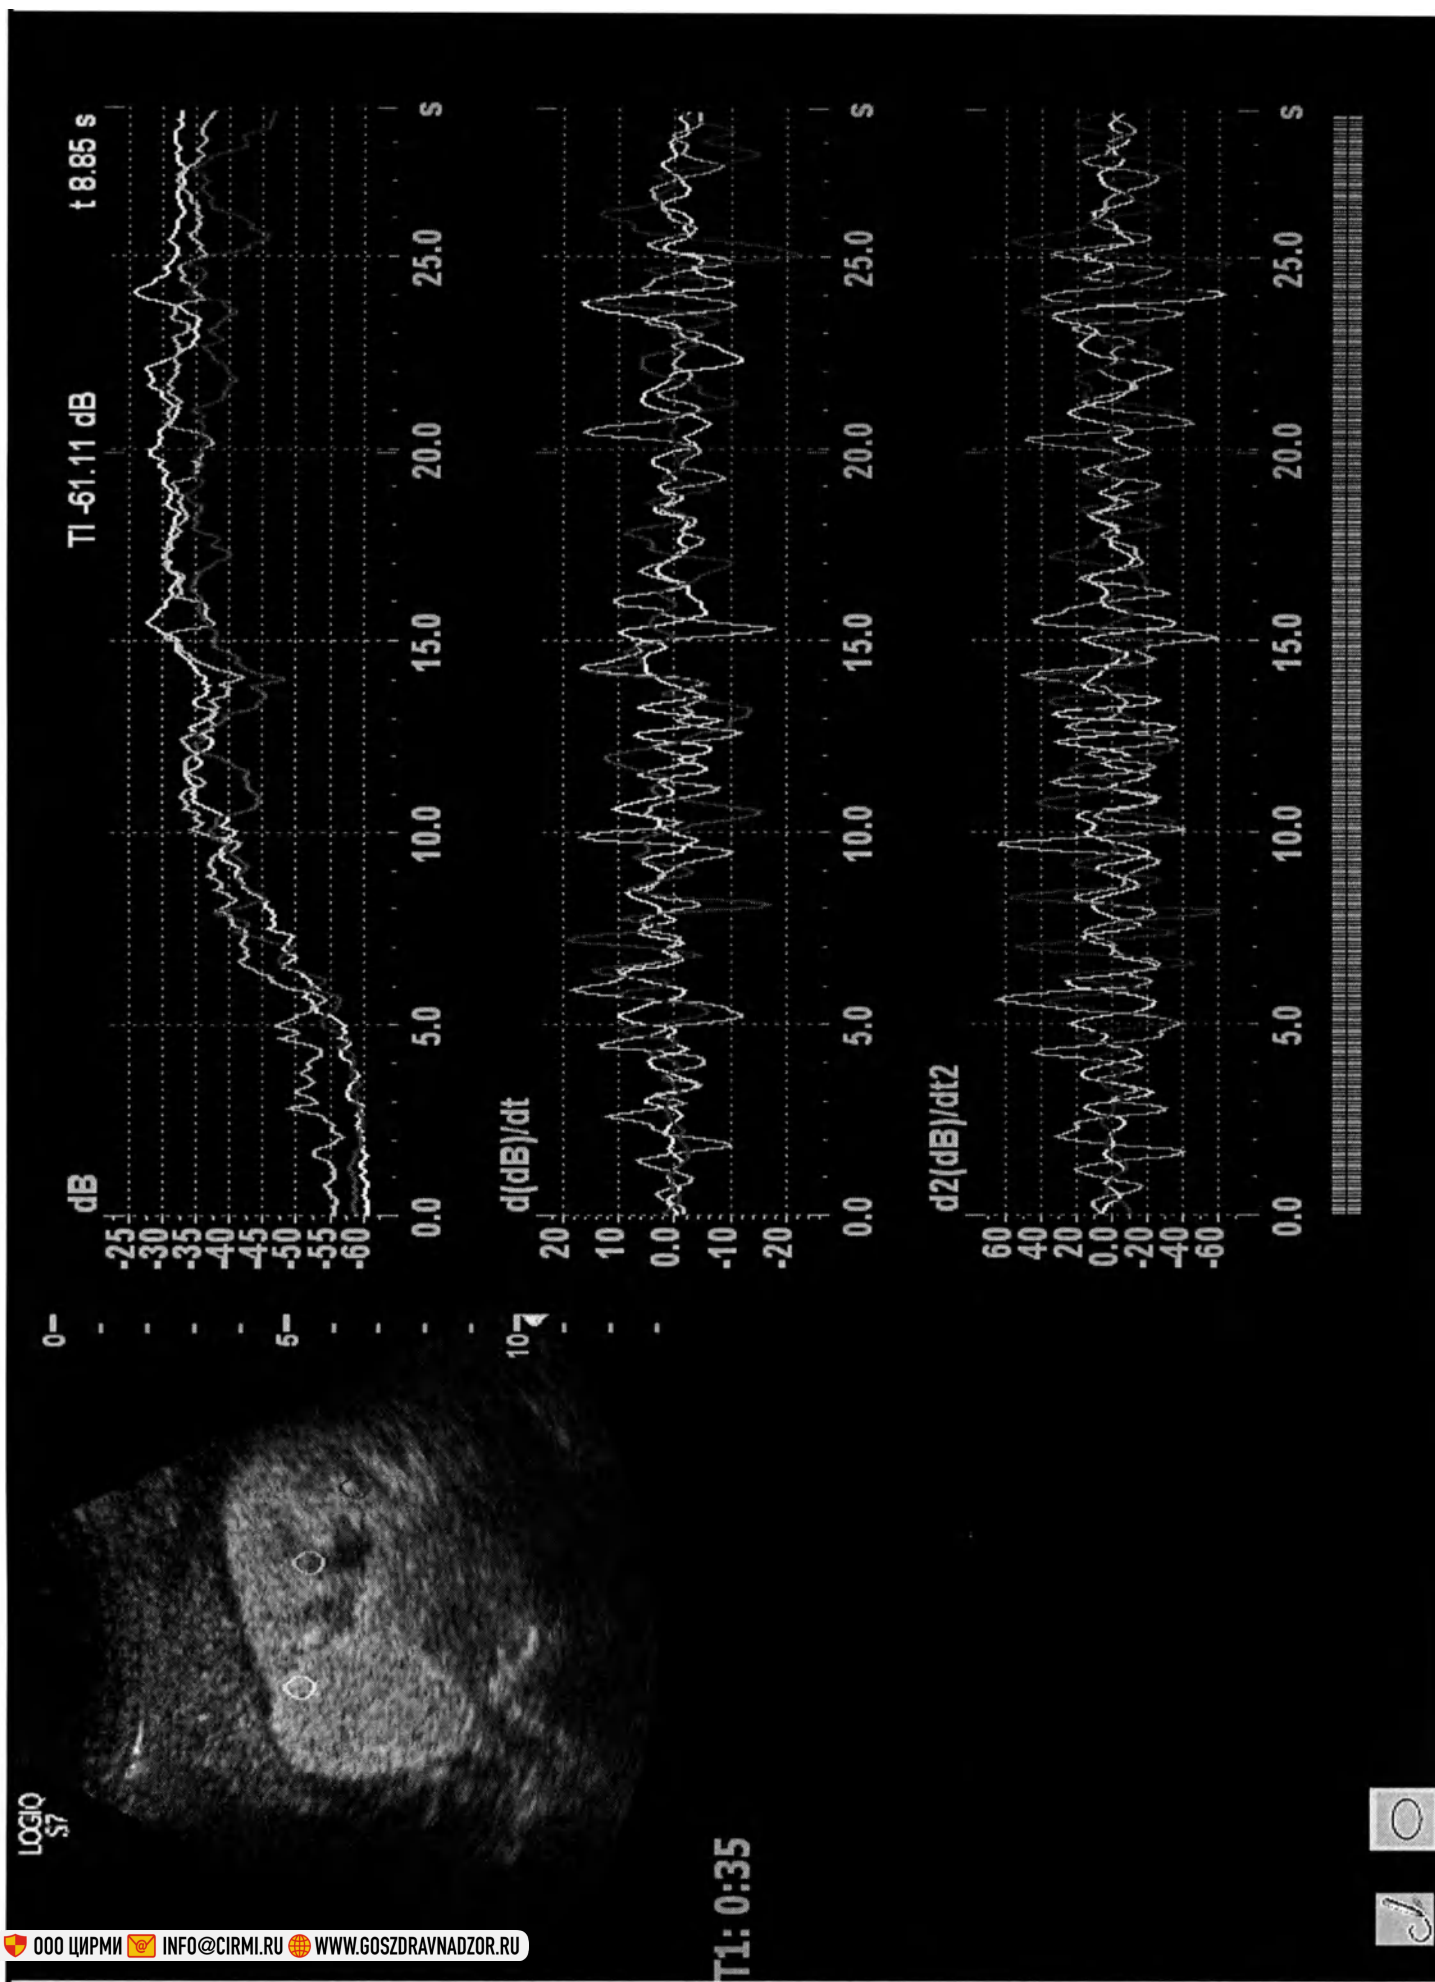


57. Модуль программный встроенный для расчета объема анатомических структур в режиме 3D/4D – VOCAL, активируемый электронным ключом

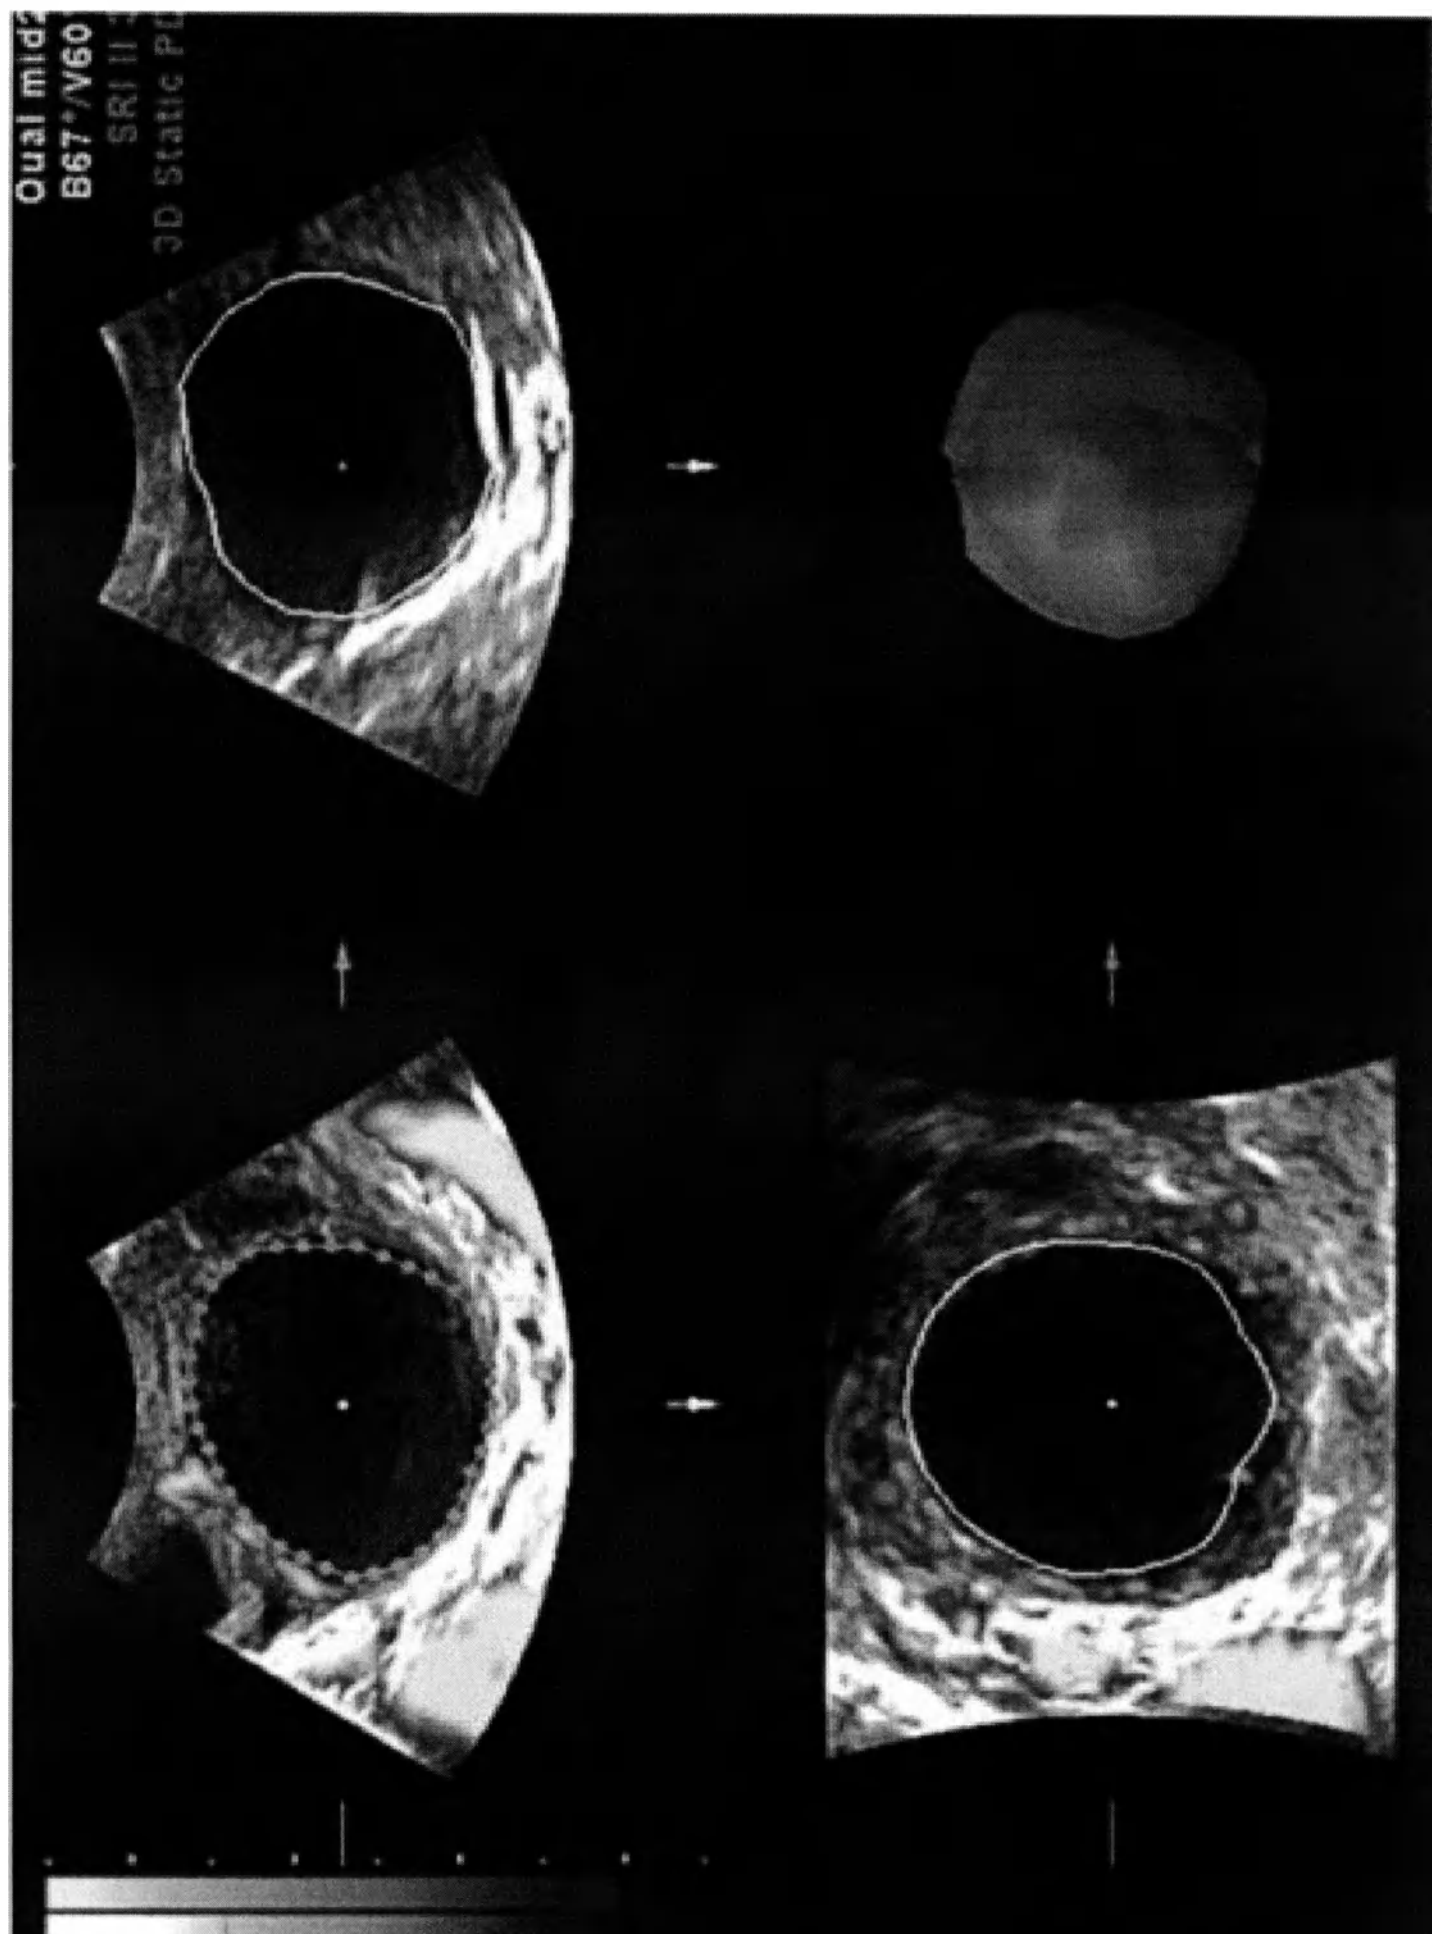


58. Модуль программный встроенный для объемной контрастной визуализации в режиме 3D/4D – VCI, активируемый электронным ключом

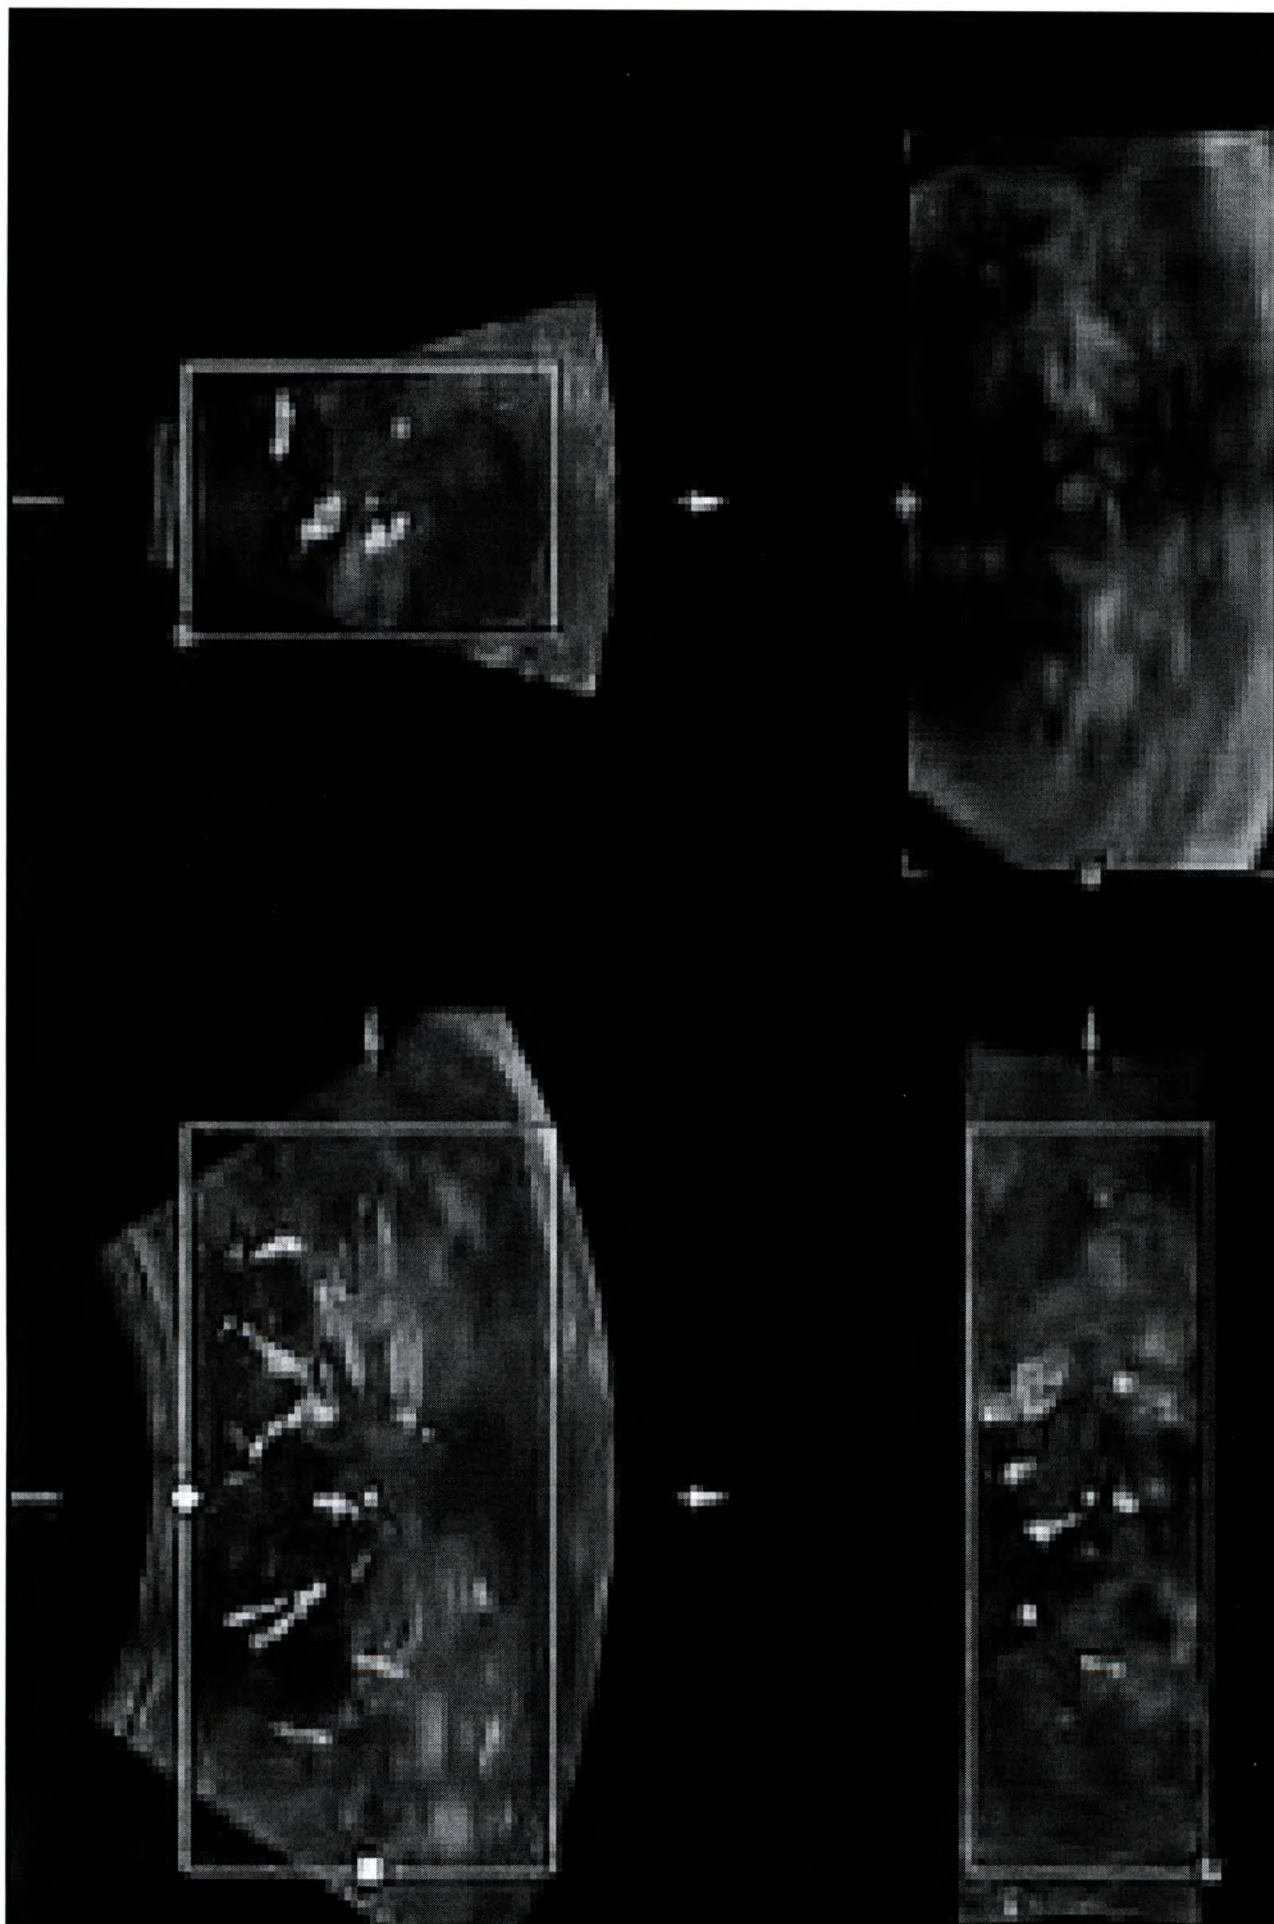

59. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме проведения исследований с контрастными веществами с повышенным разрешением, активируемый электронным ключом

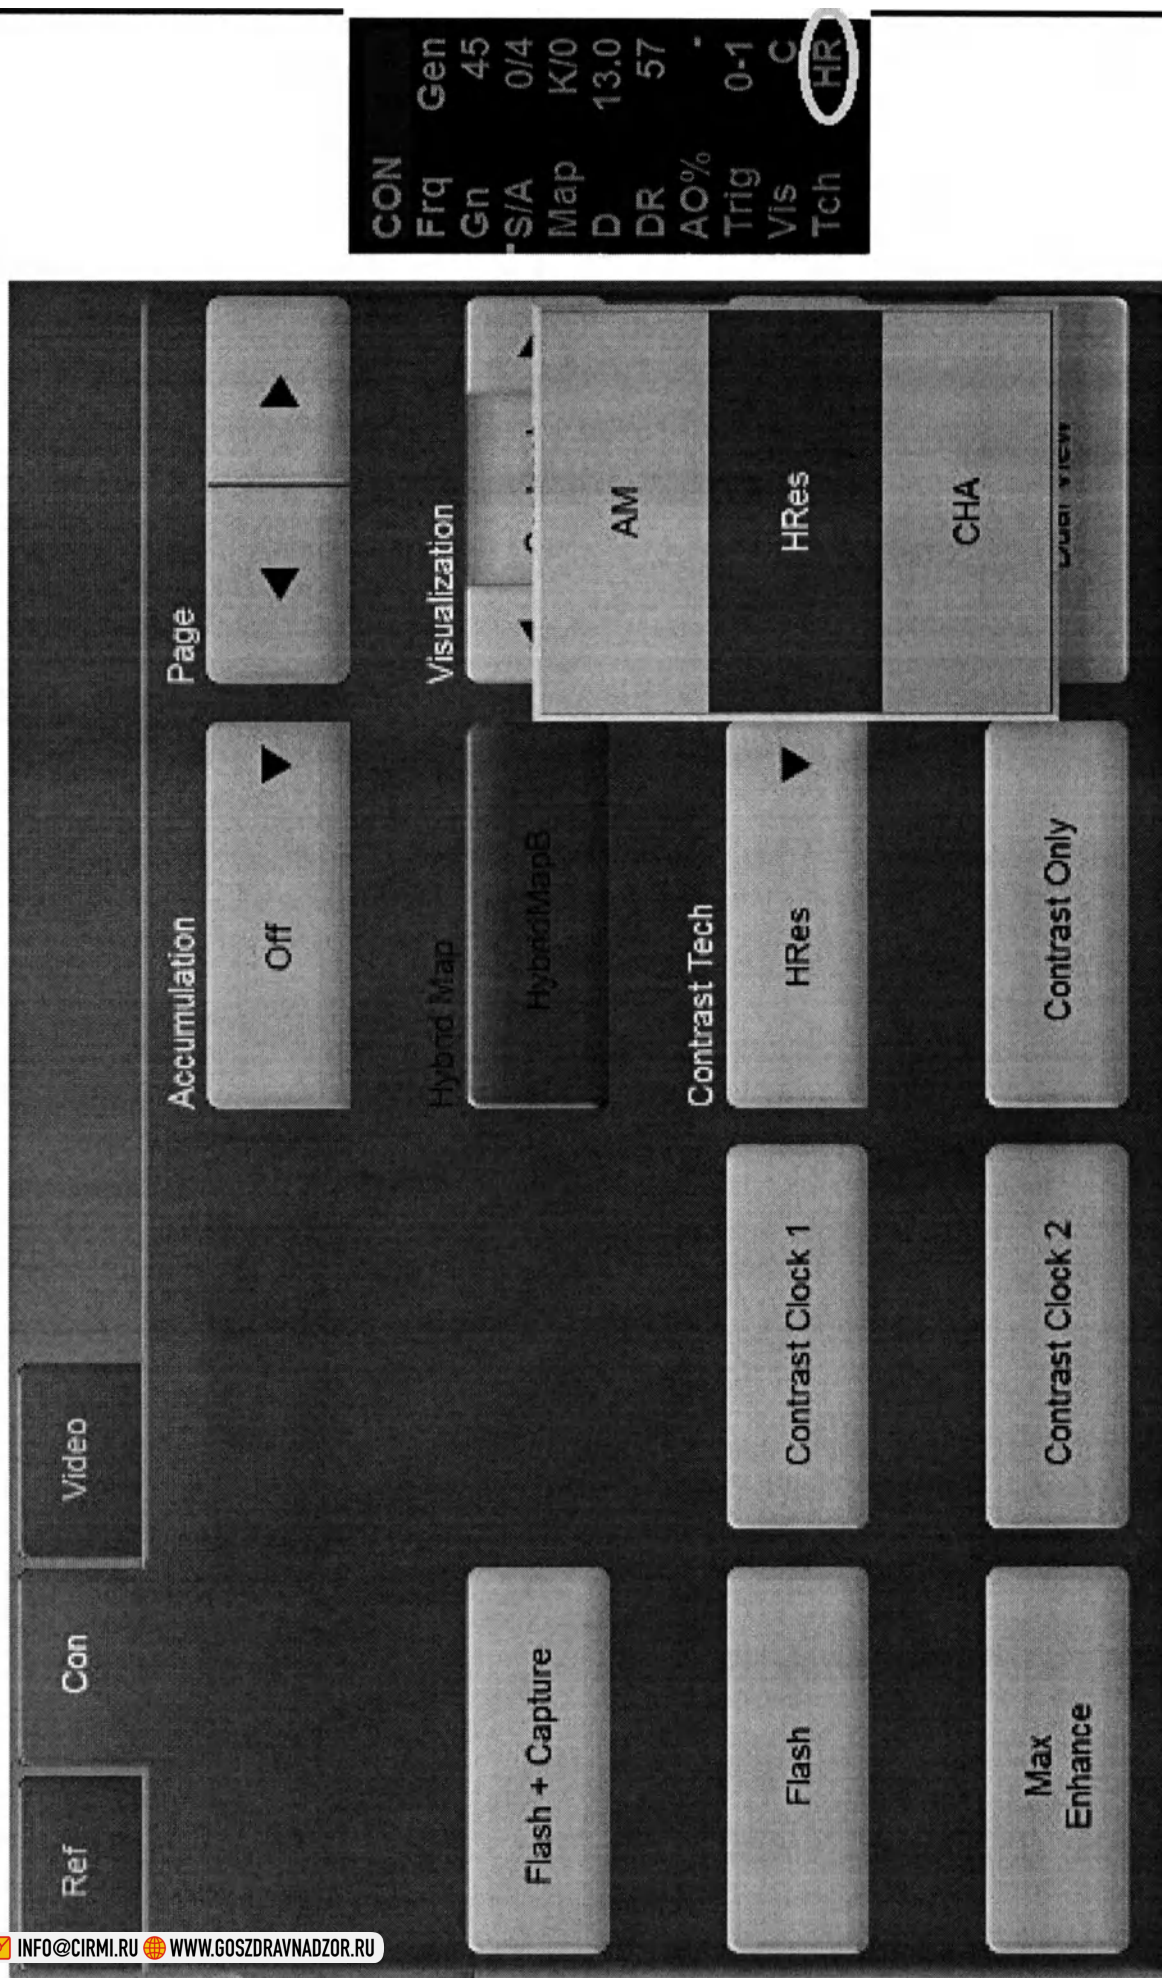



60. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме ультразвуковой томографии – TUI, активируемый электронным ключом

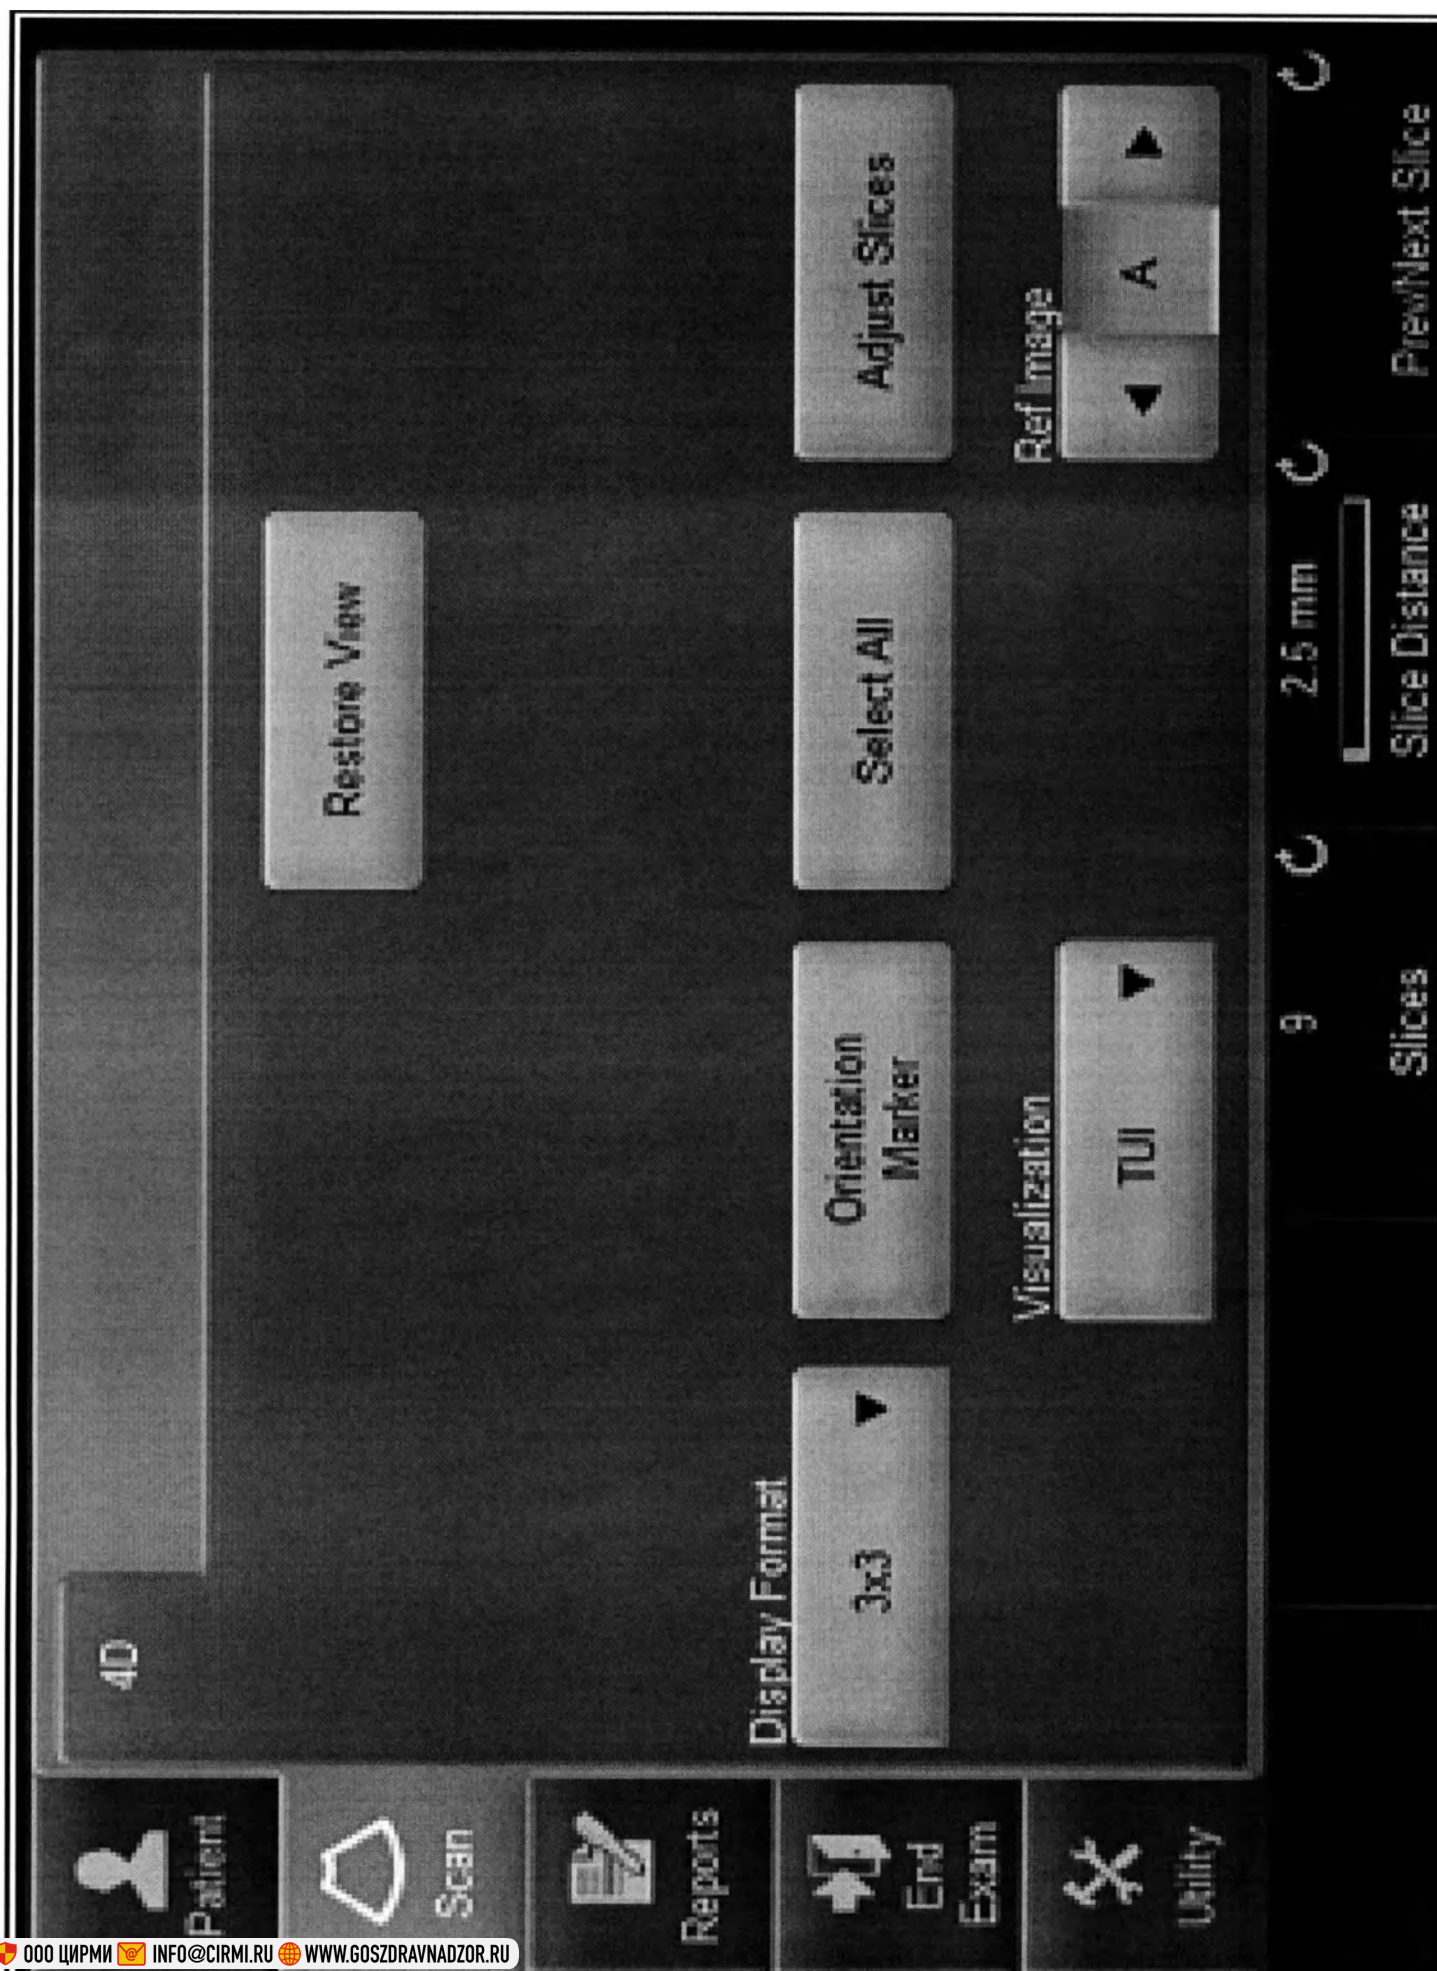


61. Модуль программный встроенный для регистрации работы сердца плода в режиме 4D – STIC, активируемый электронным ключом


71

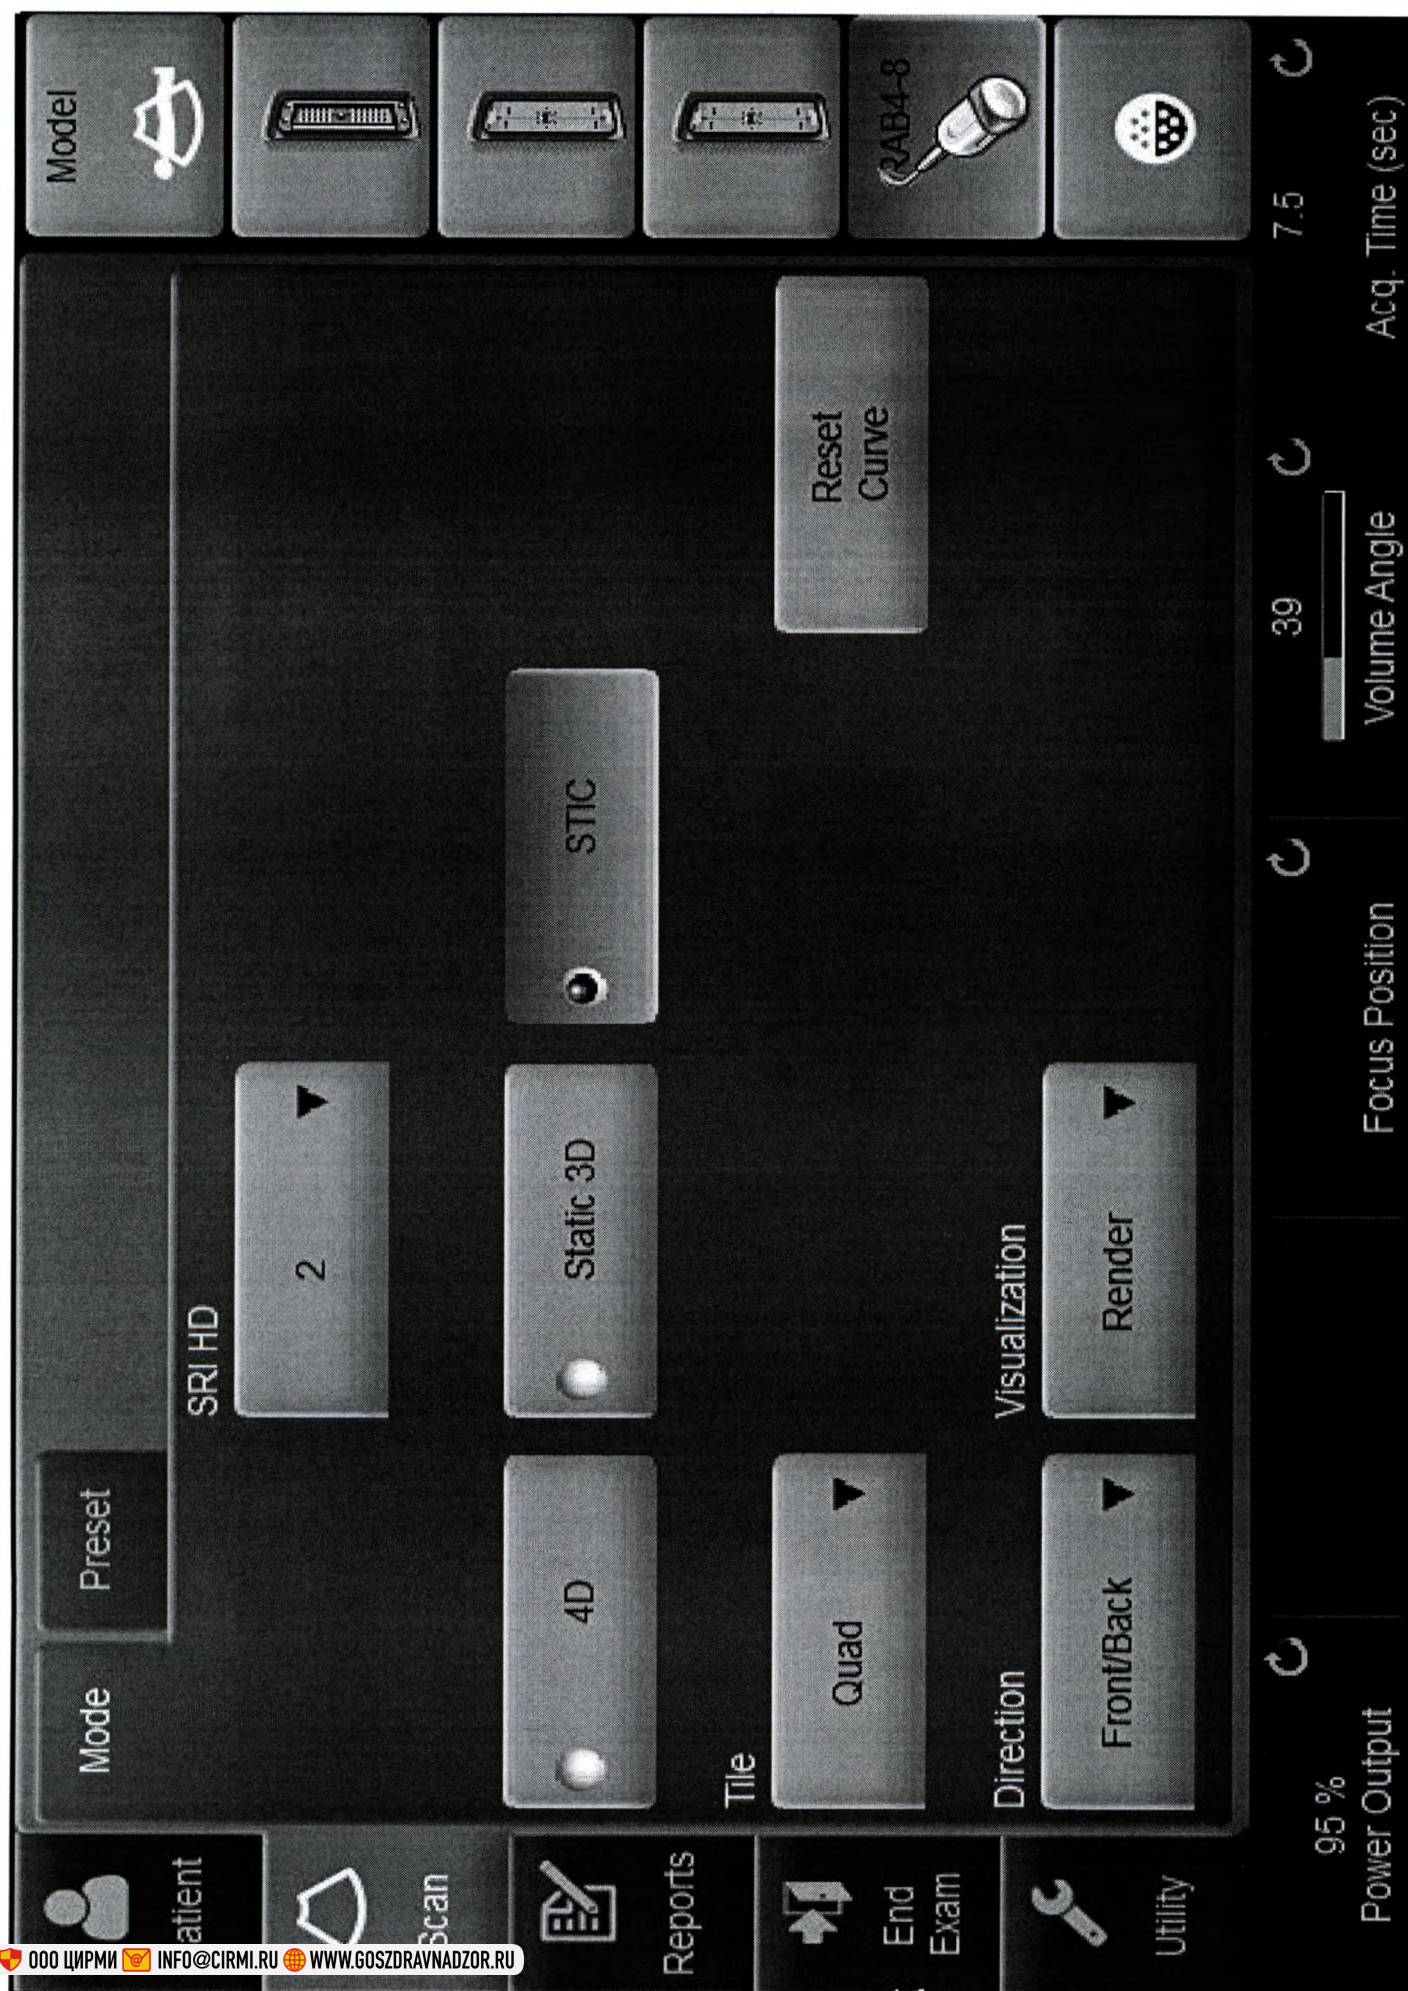


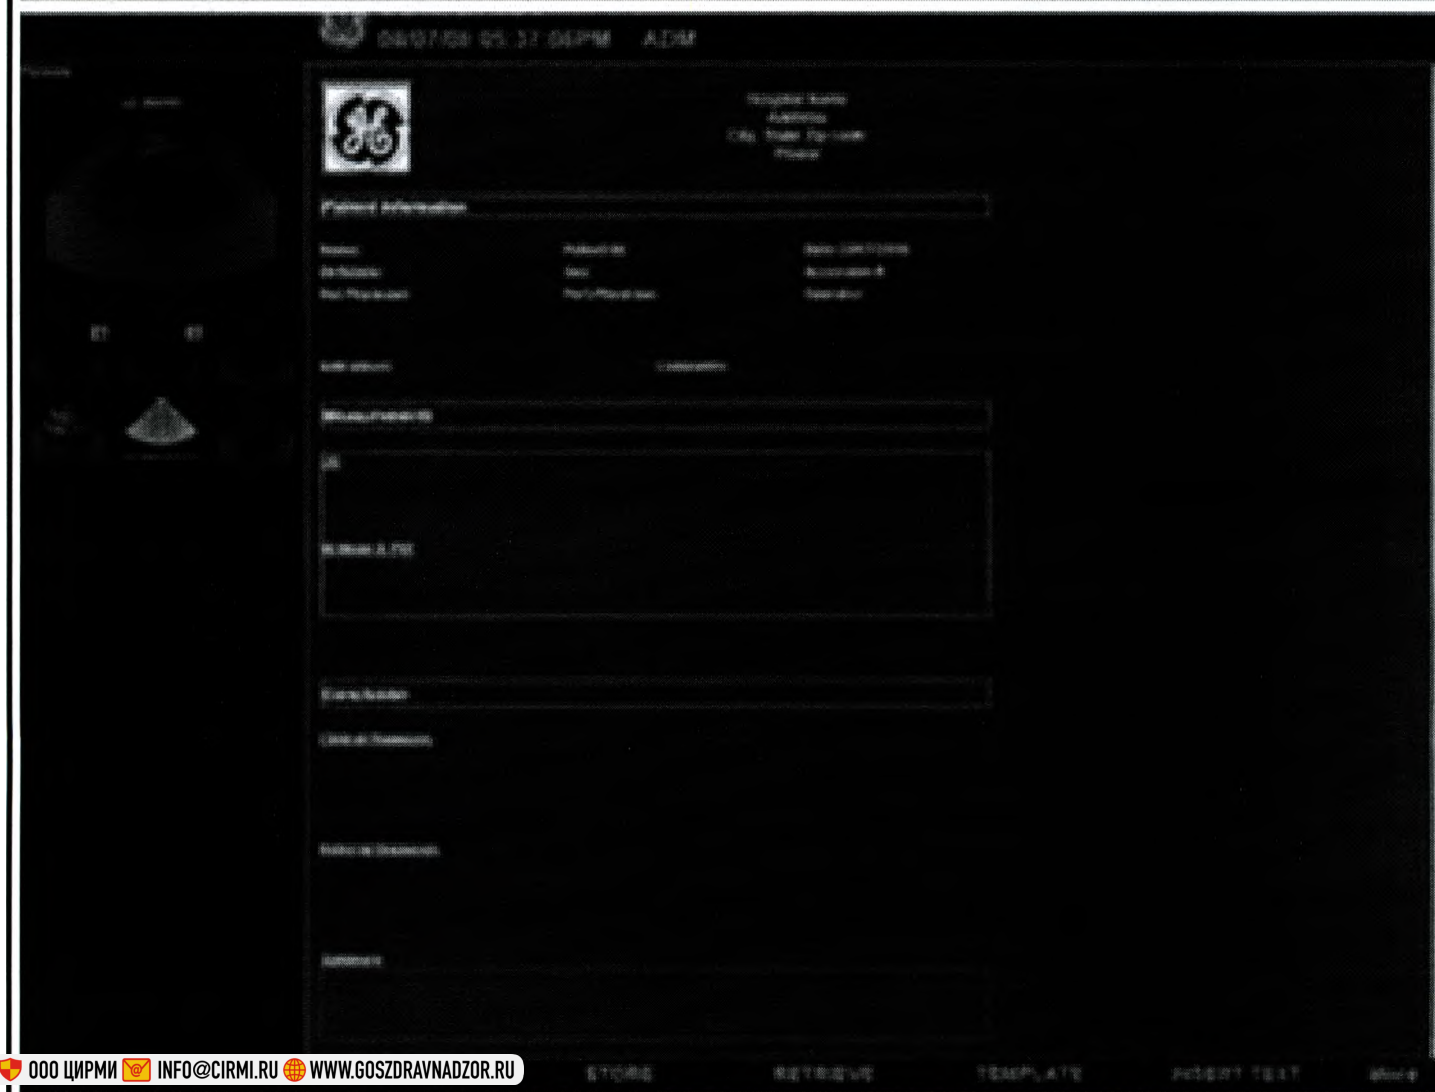

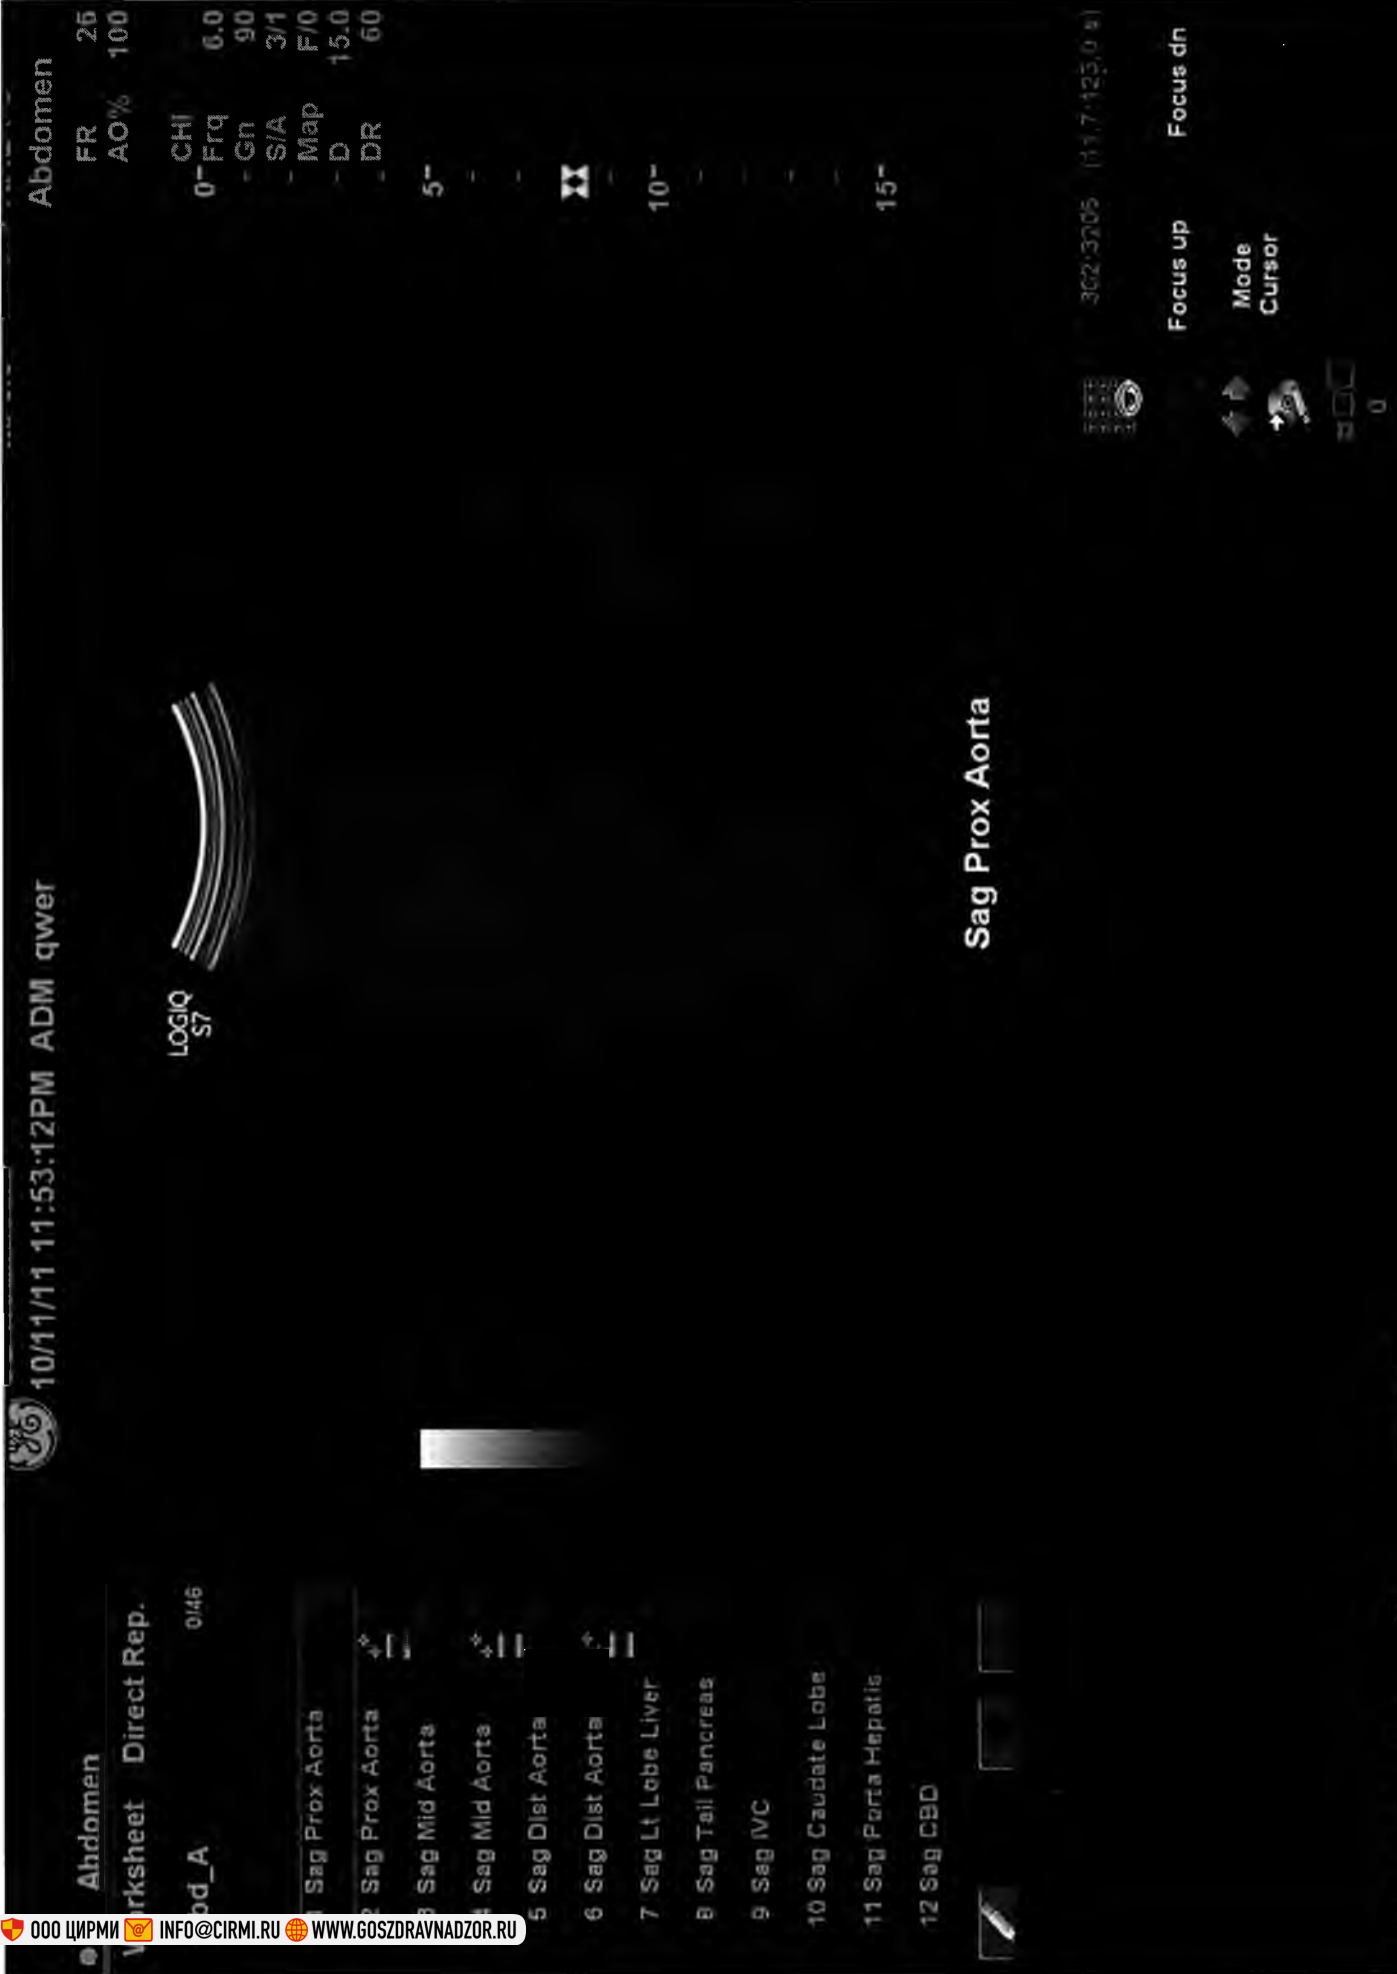

64. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии – Elastography, активируемый электронным ключом

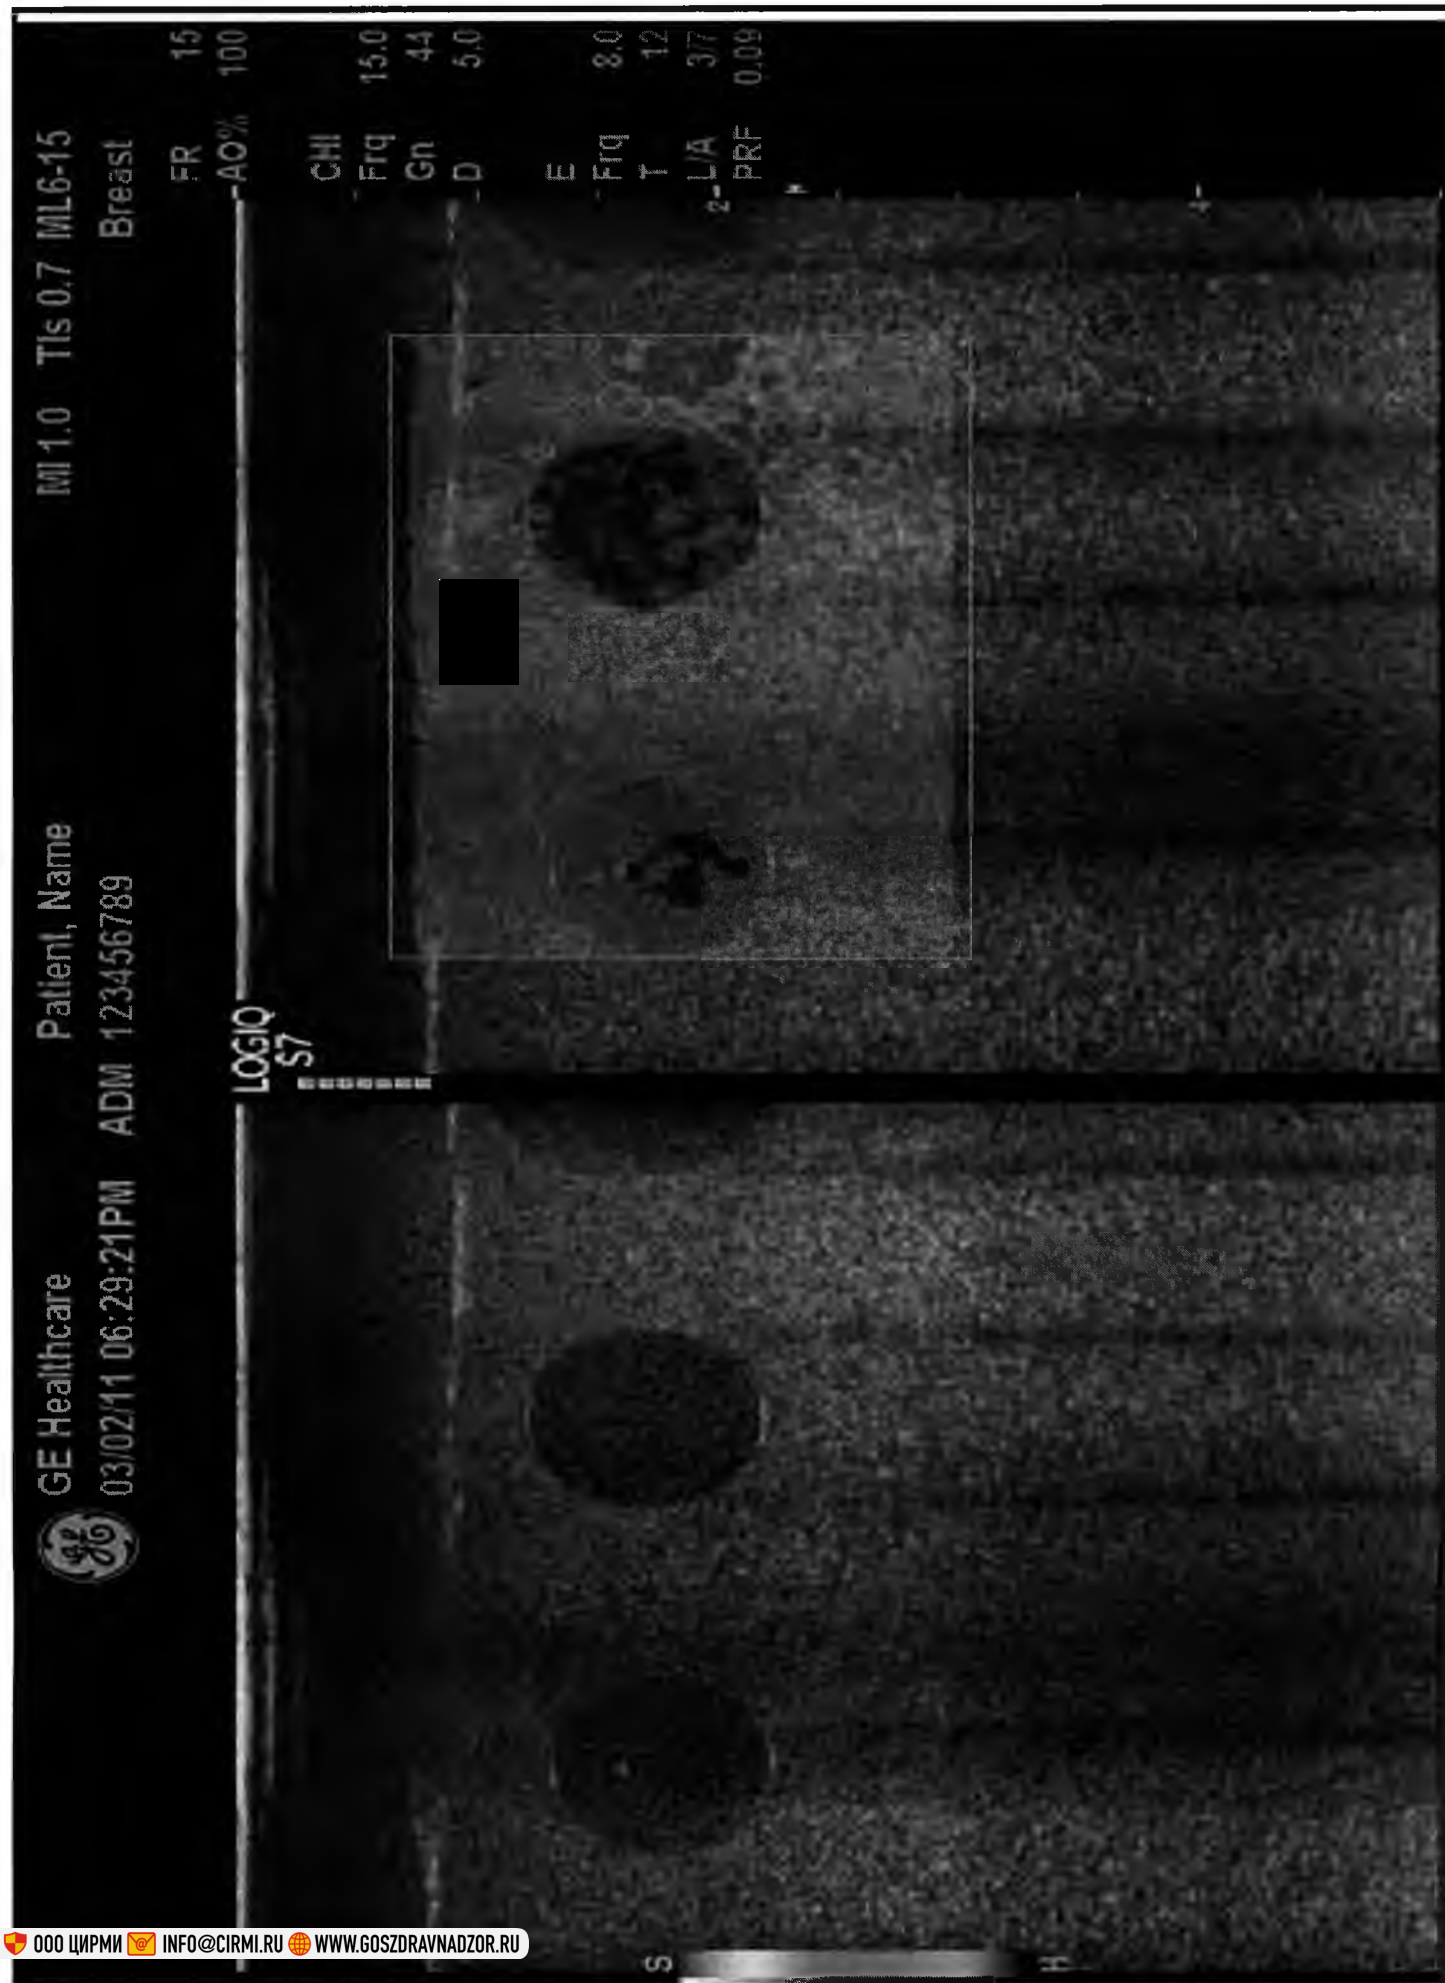

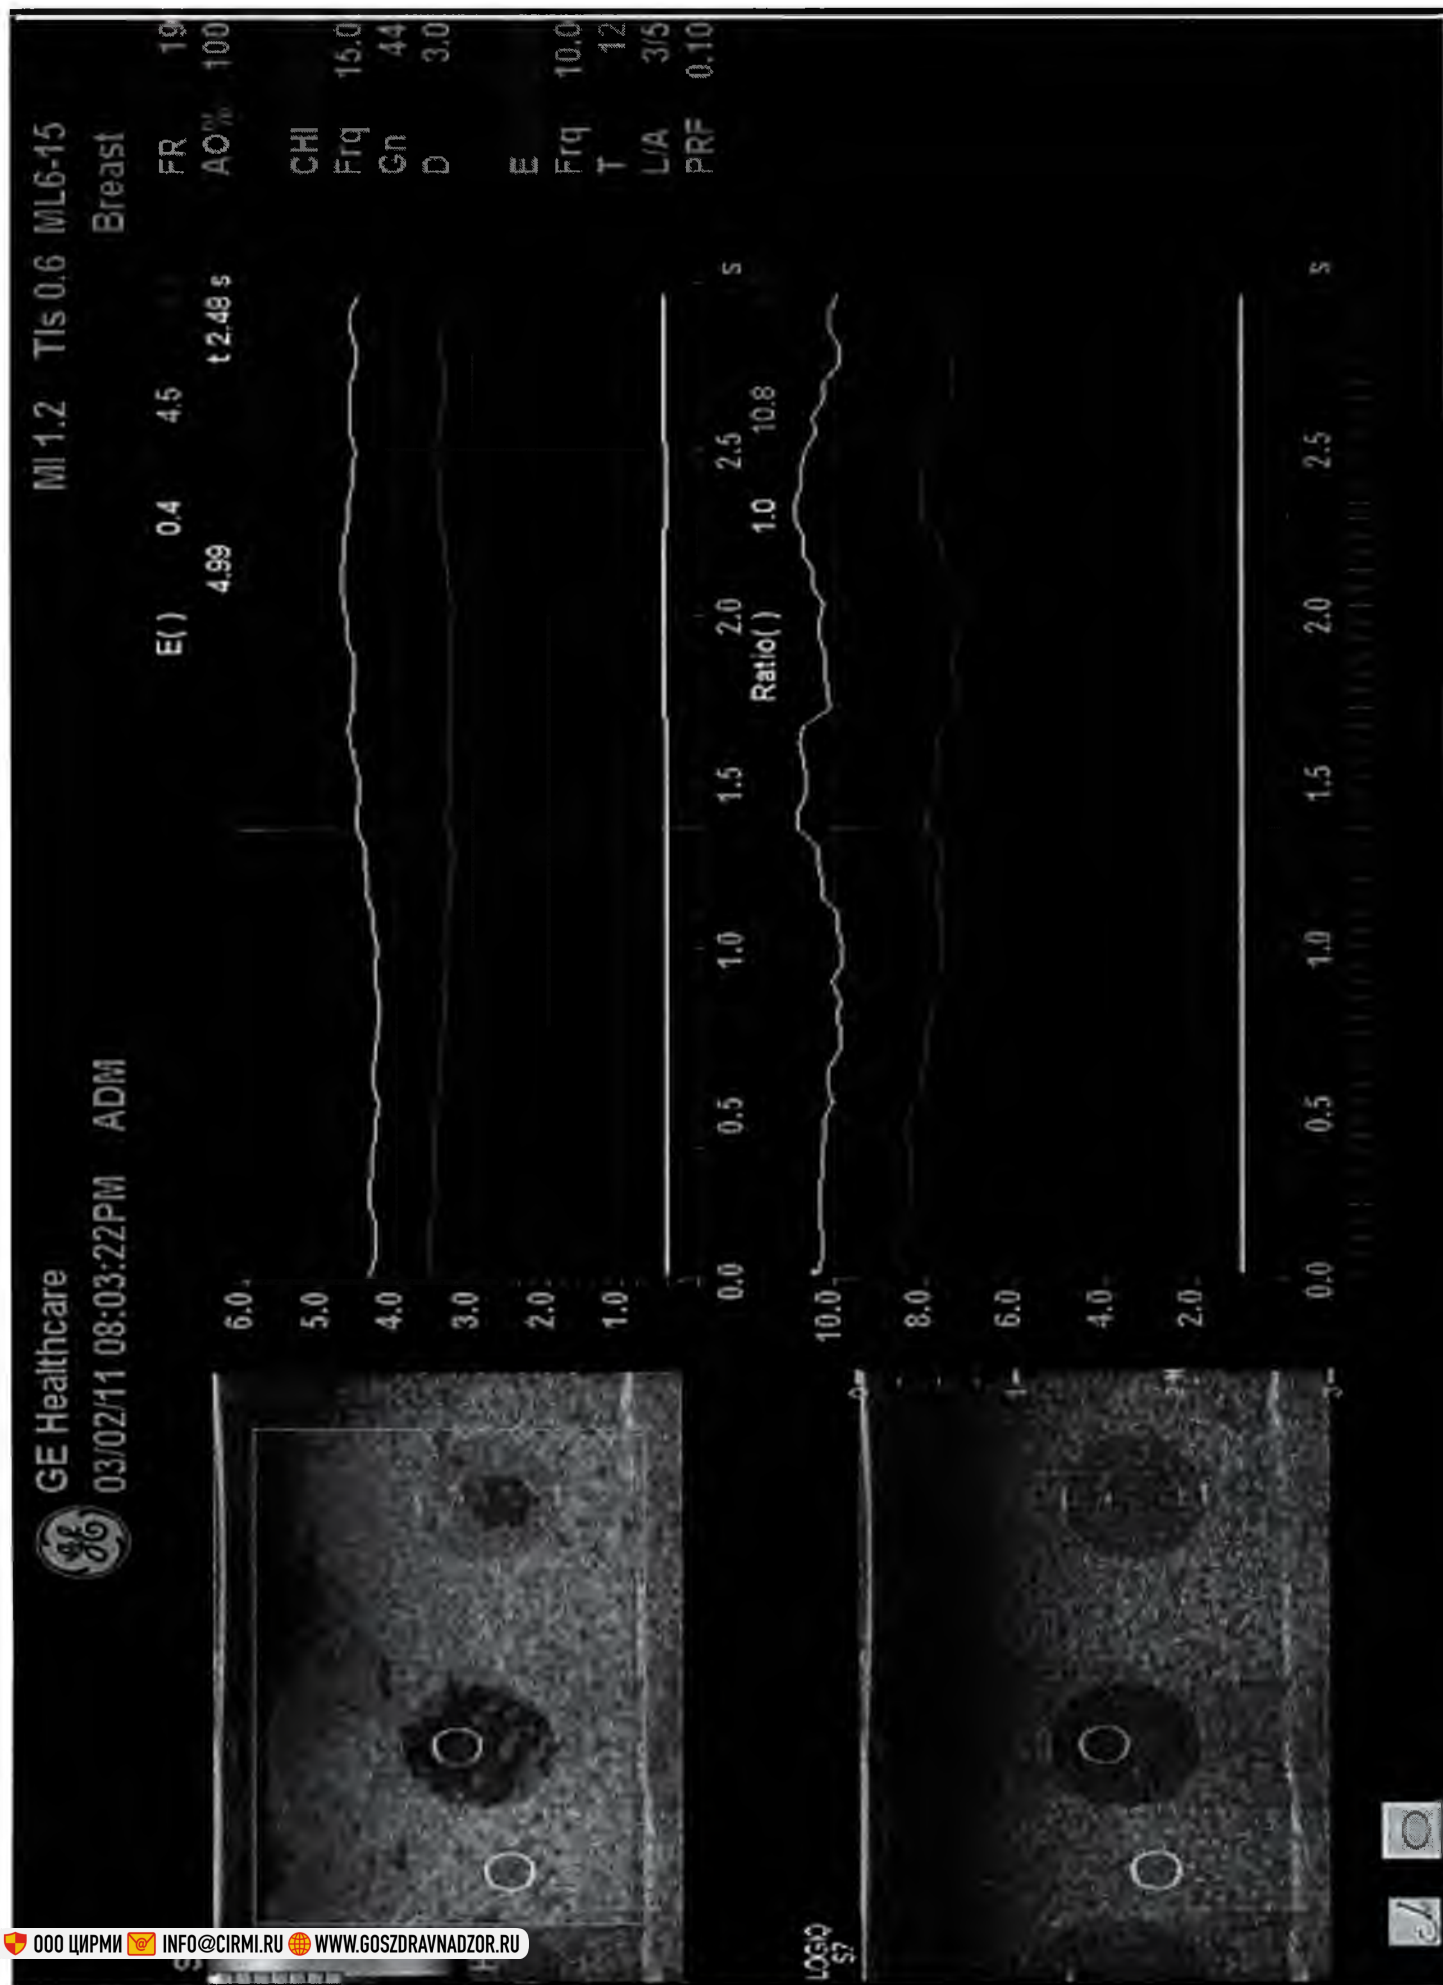


66. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии «сдвиговой волны», активируемый электронным ключом



**Patient**

**Data Transfer**

**Image History**

**Active Images**

Task: ☒ Import ☐ Export ☐ Worklist ☐ QR ☐ MPEG4

From:

No Archive

To:



Patient ID:

Last Name:

First Name:

string:

Search key:

Exam Description ▼

Clear

Patient ID

Last Name

First Name

Last Exam

Copi...

Status Msg

Img. size


Qty


Transfer


Selected Data 0.0 / 1027.9 MB

Show: ☒ All ☐ -/-

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRavnADZOR.RU

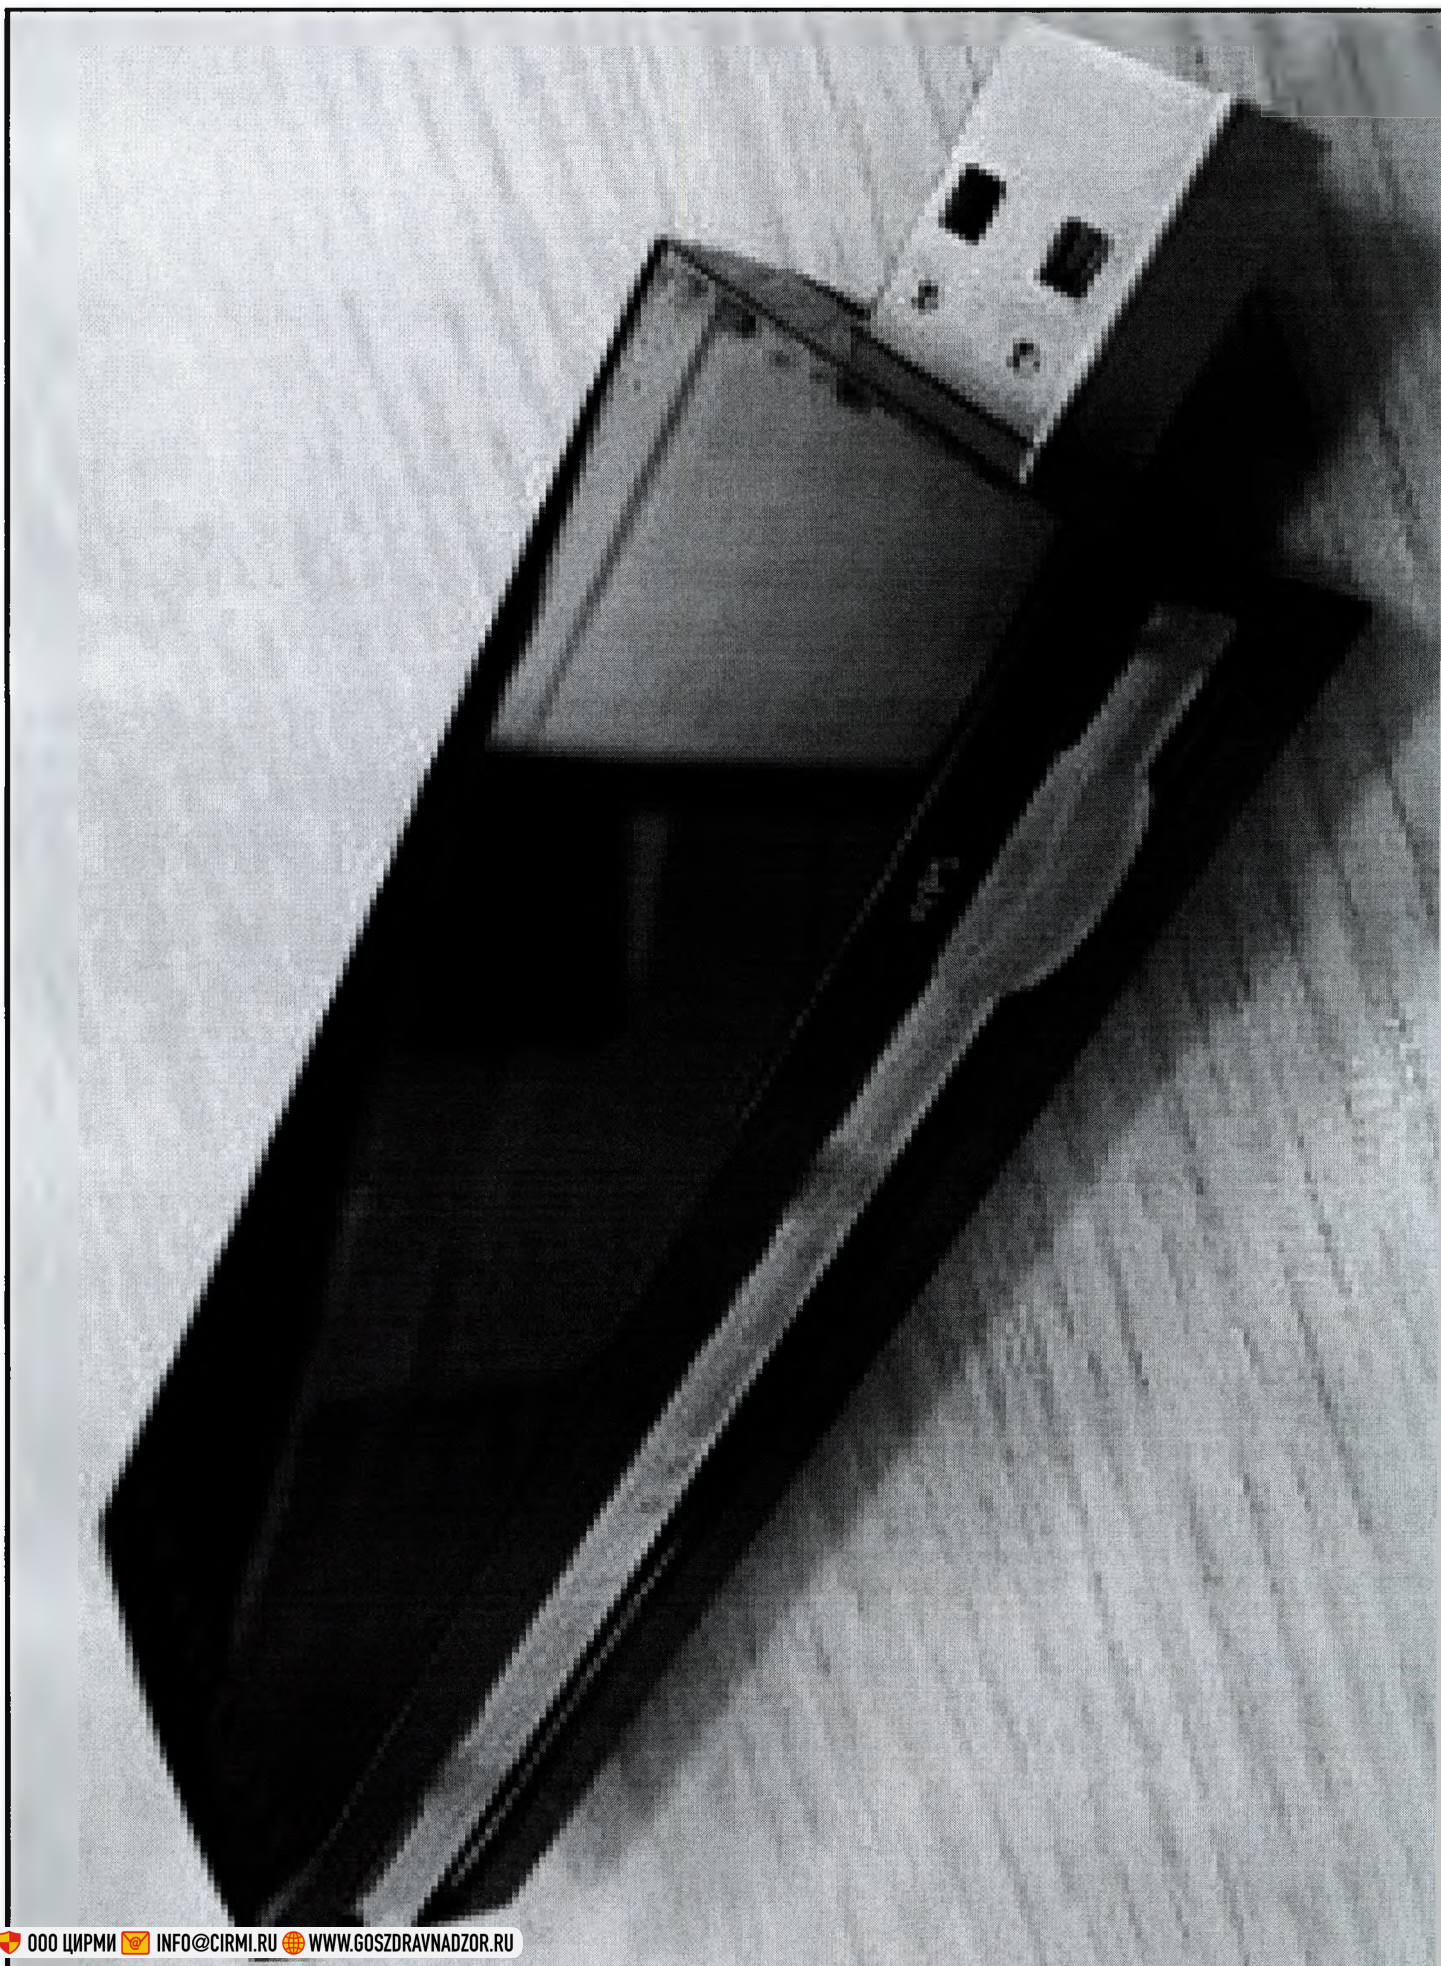

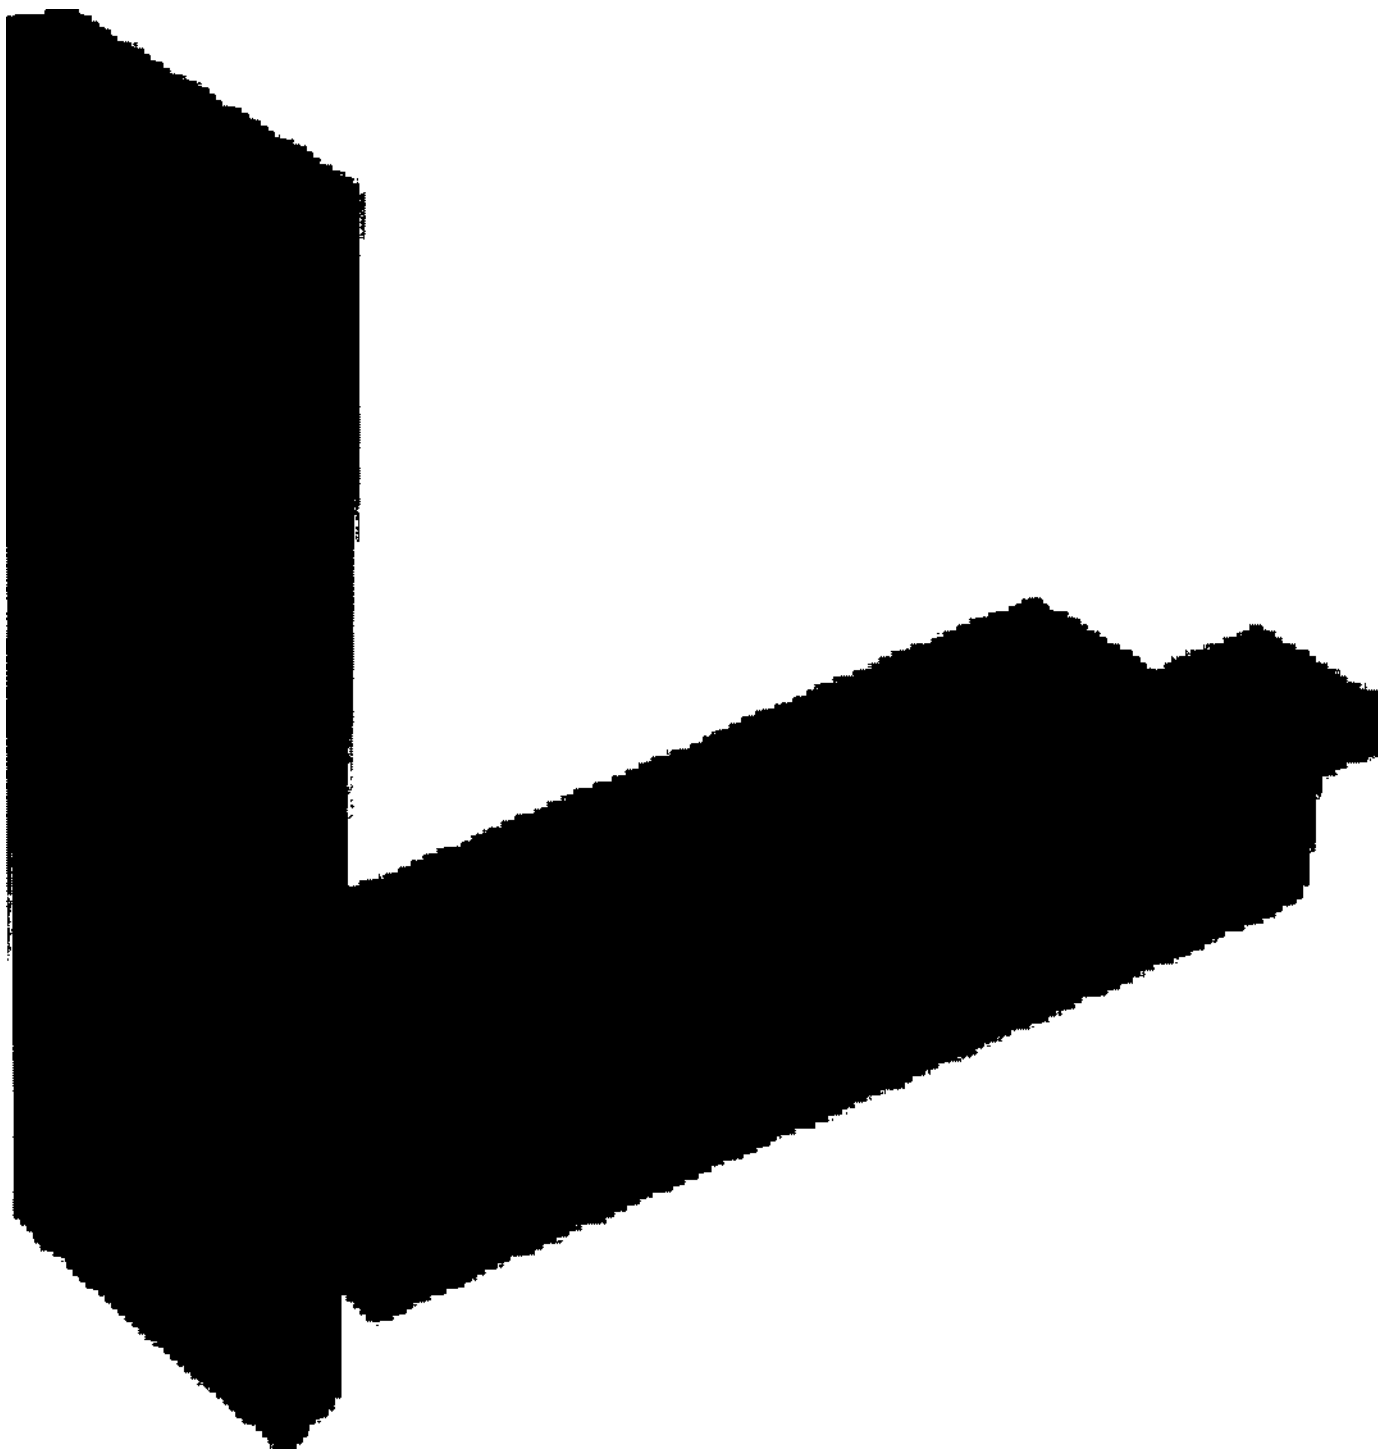

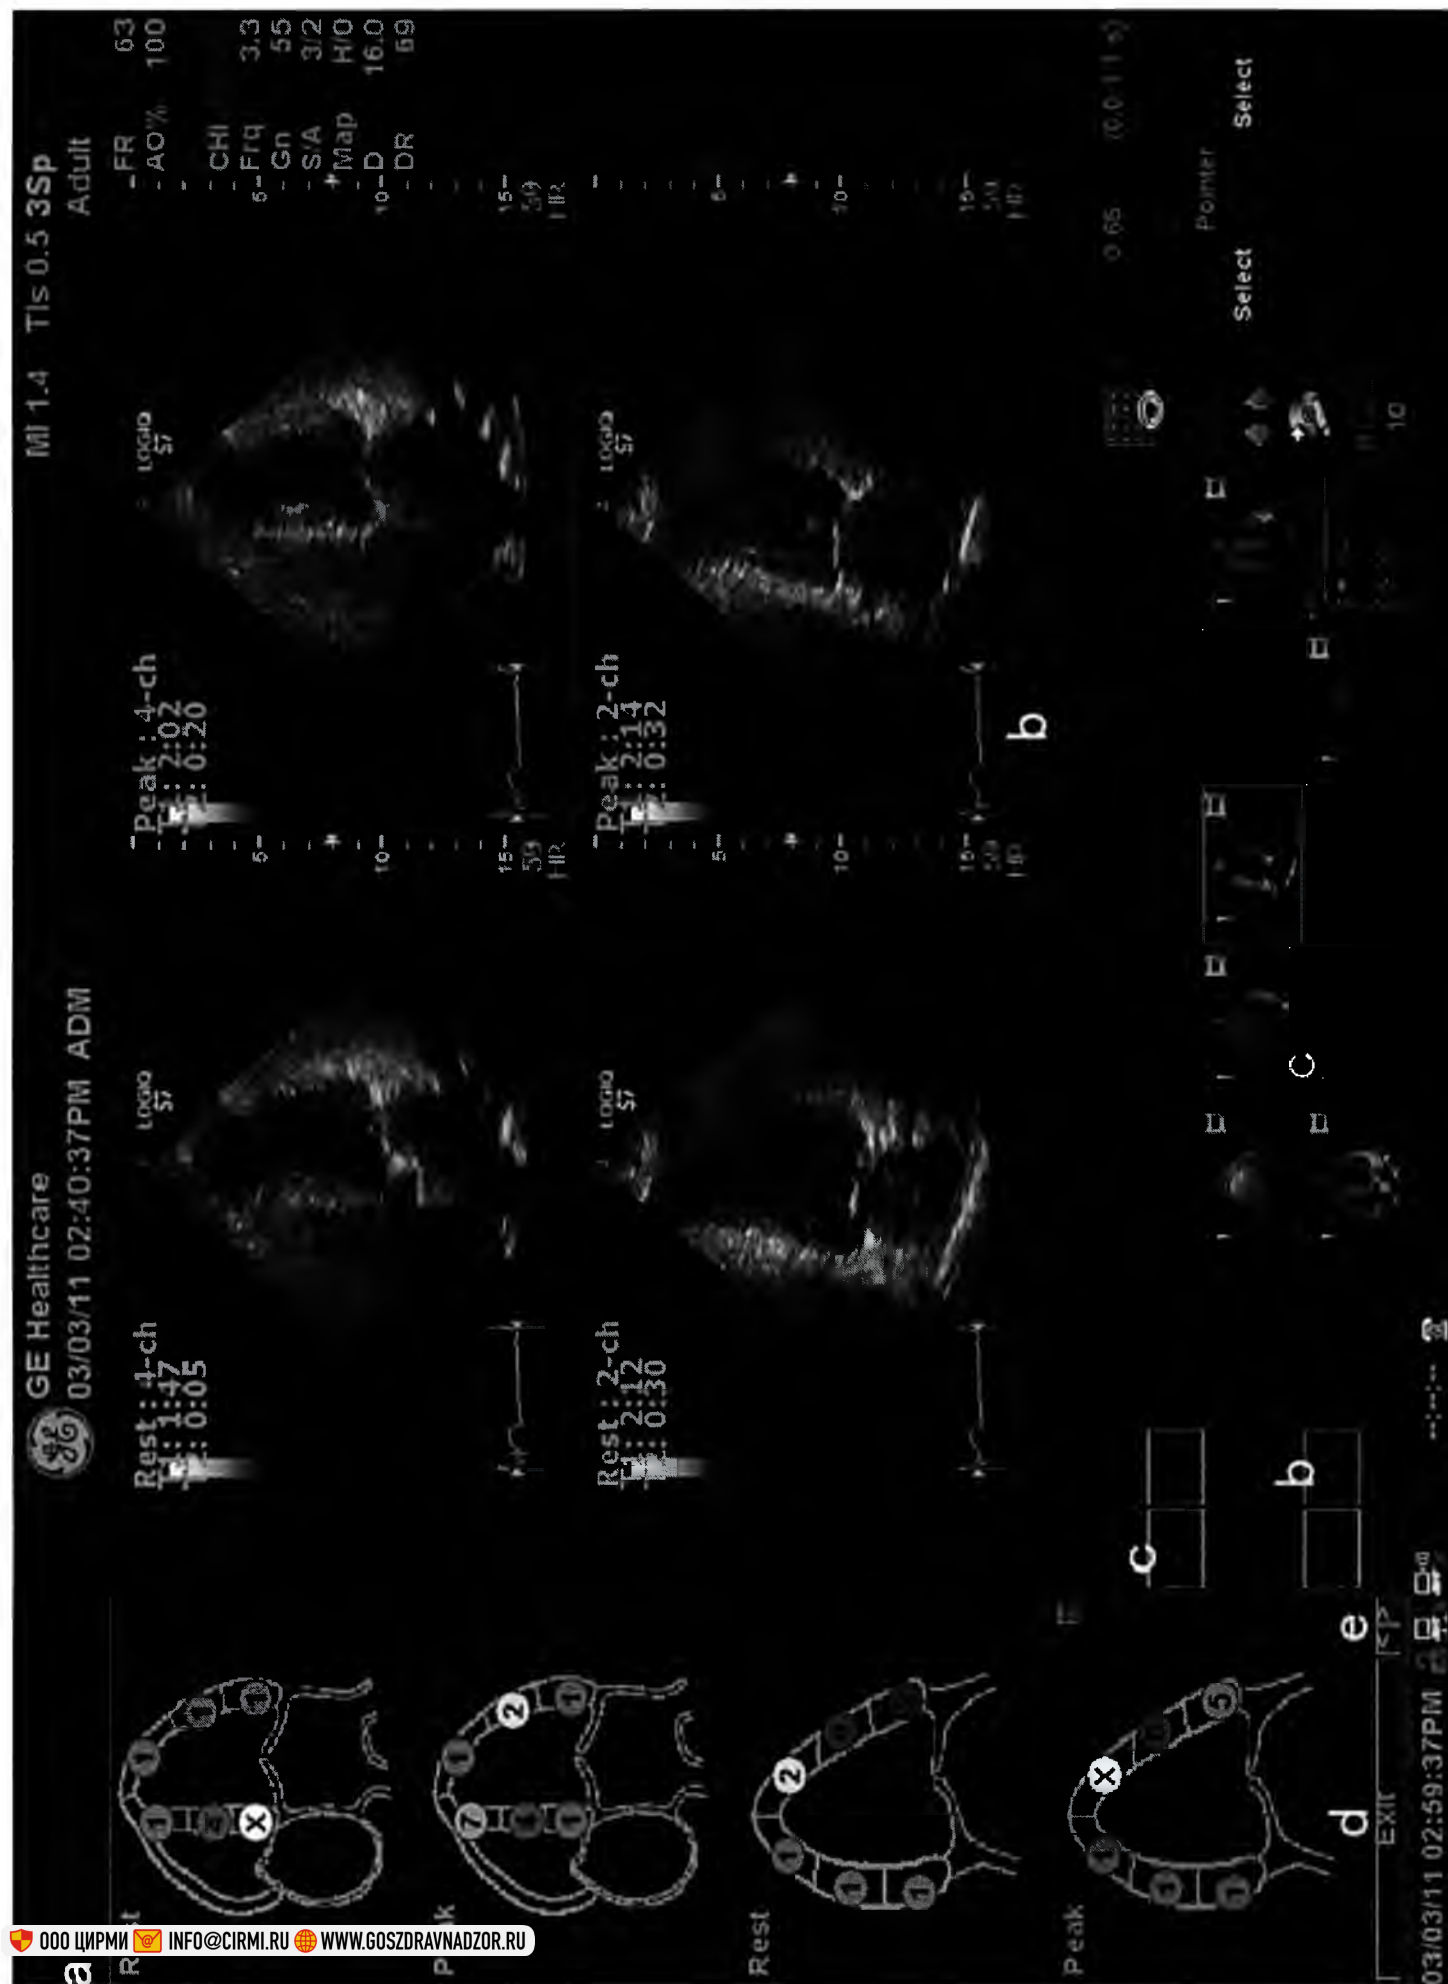



GE Healthcare

Patient, Name

MI 1.2 TIs 1.8 3Sp

03/02/11 06:04:48PM ADM 123456789

Adult

Cardiac

Worksheet Direct Rep.

Dimension

Area

Volume

Mass

Shunts

PISA

LA/Ao

Mitral Valve

RV/LV

AVA

LOGIQ
S717
-17
cm/sFR 100
-AO% 100CHI
Frq 3.3
Gn 54
D 16.0TVI
5-Frq 3.1
Gn 10
L/A 0/0
PRF 1.4
S/P 1/3

10°

15°


139.539 (1.1:5.4 s)


Start
FrameEnd
Frame


Run


13

71. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме тканевого Допплера – TVI, активируемый электронным ключом

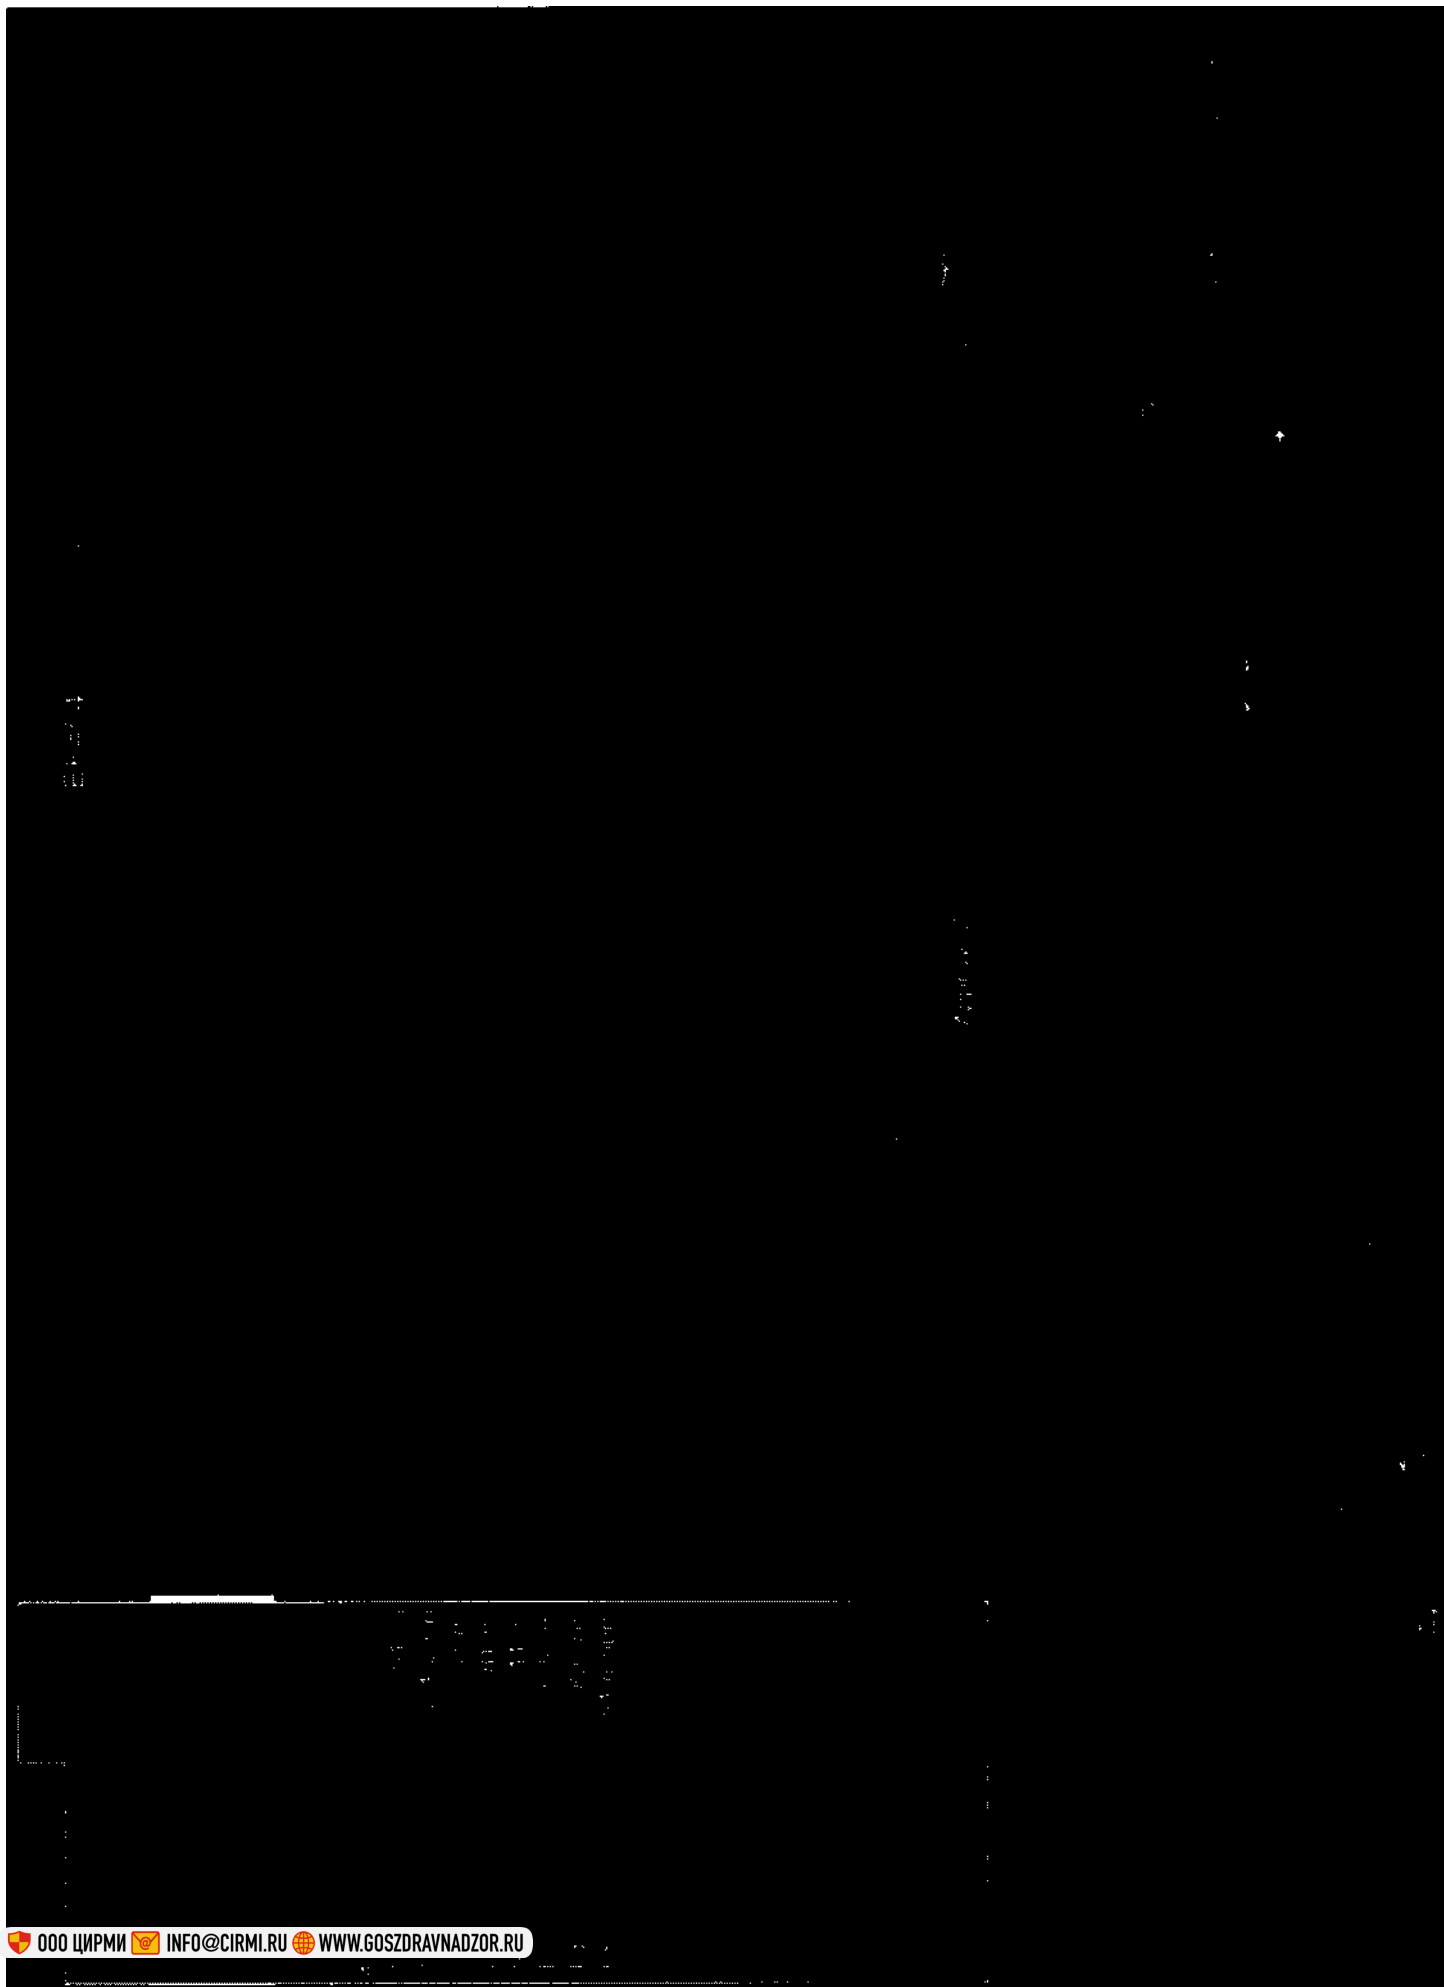


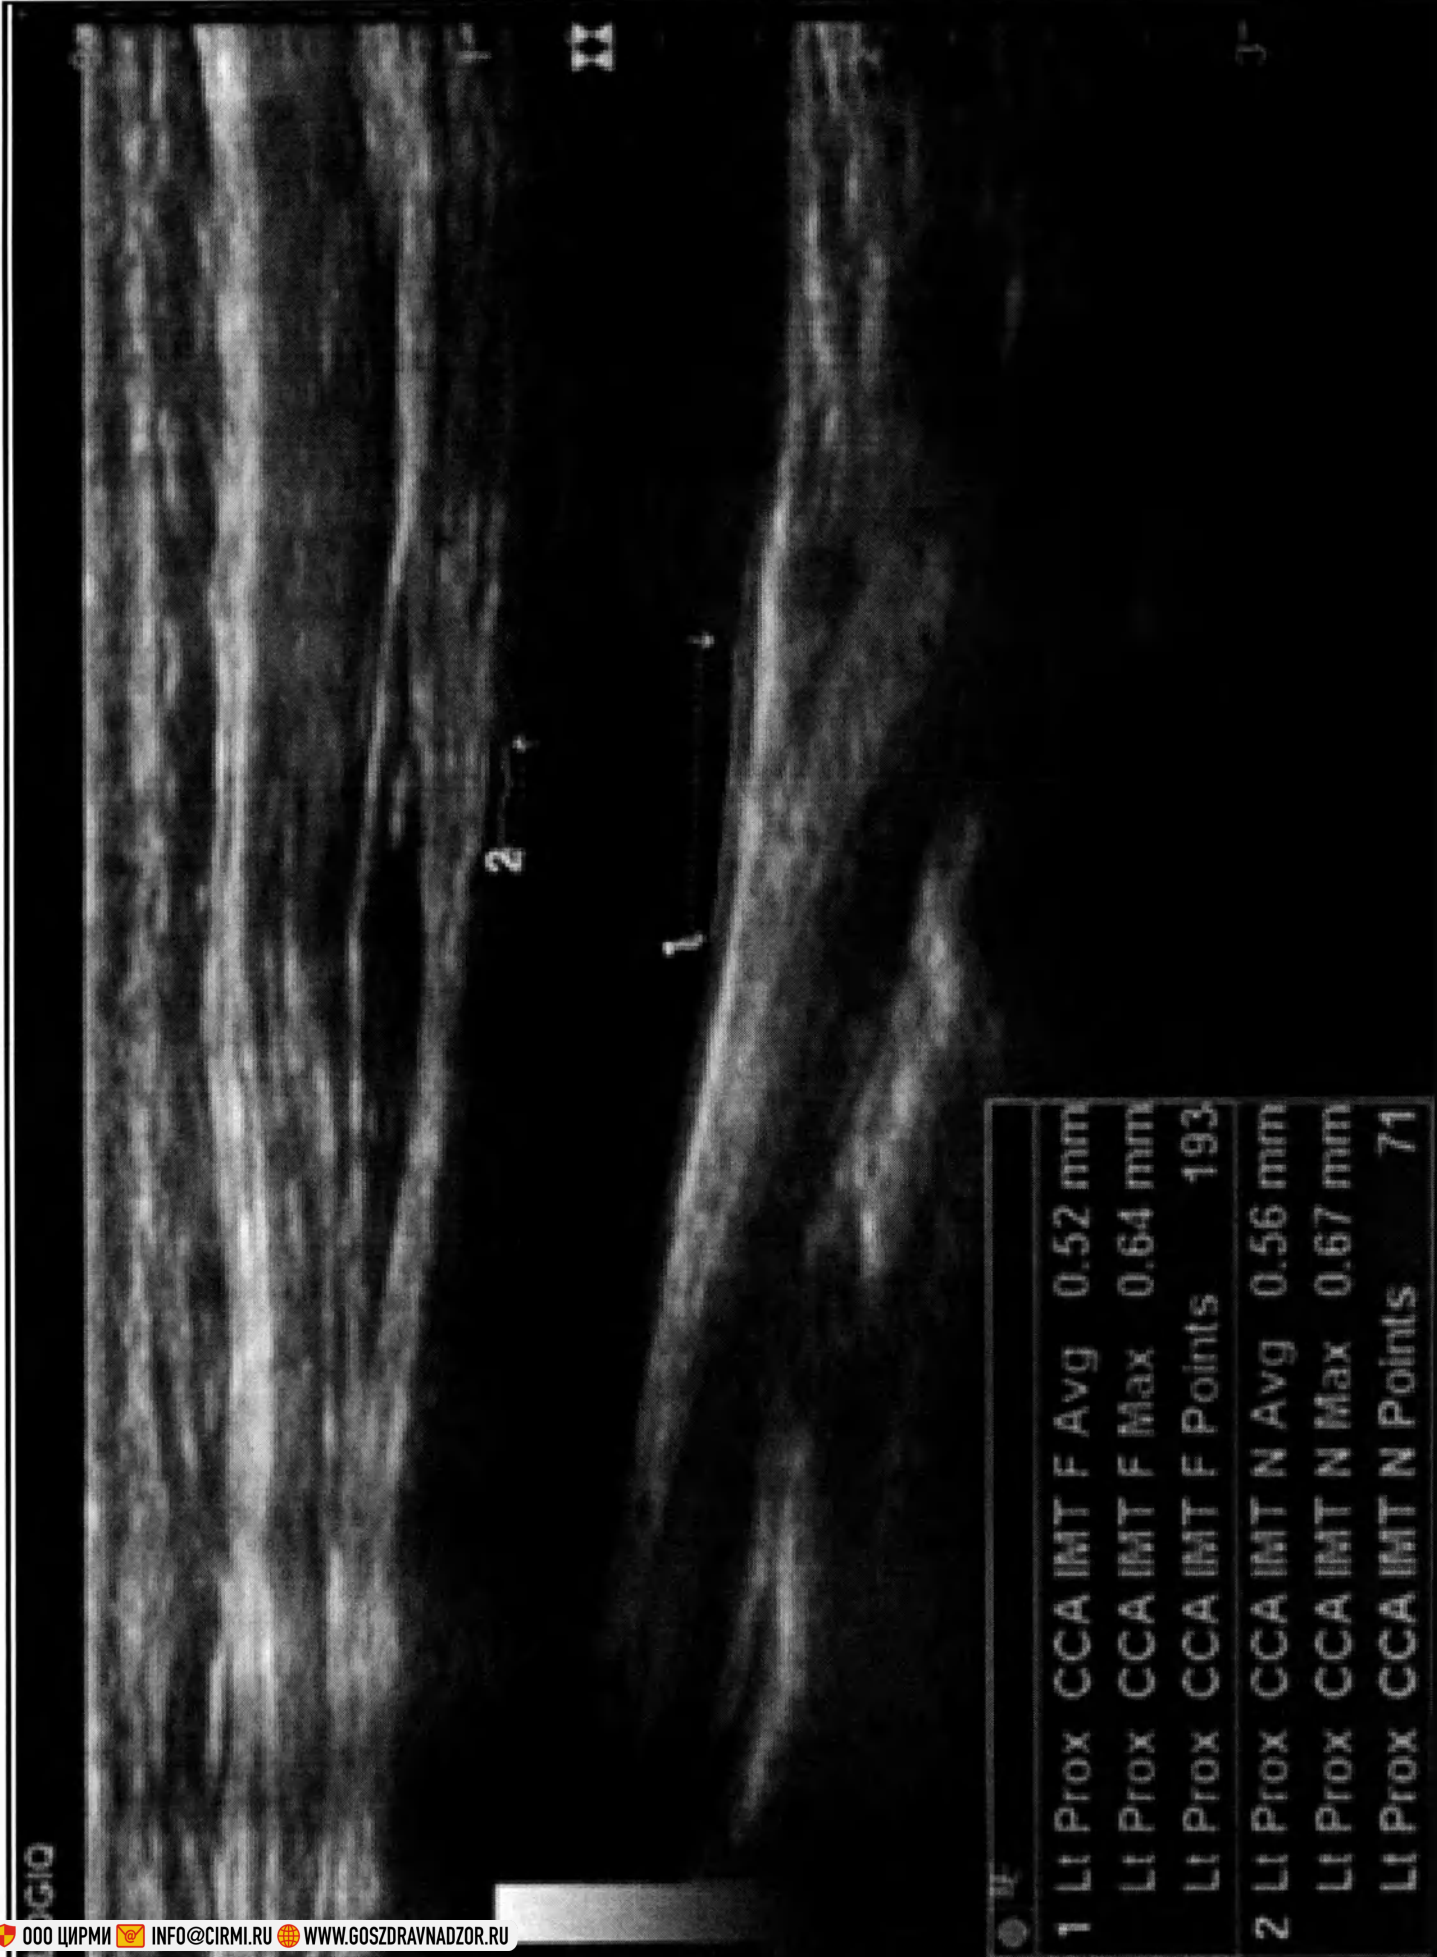

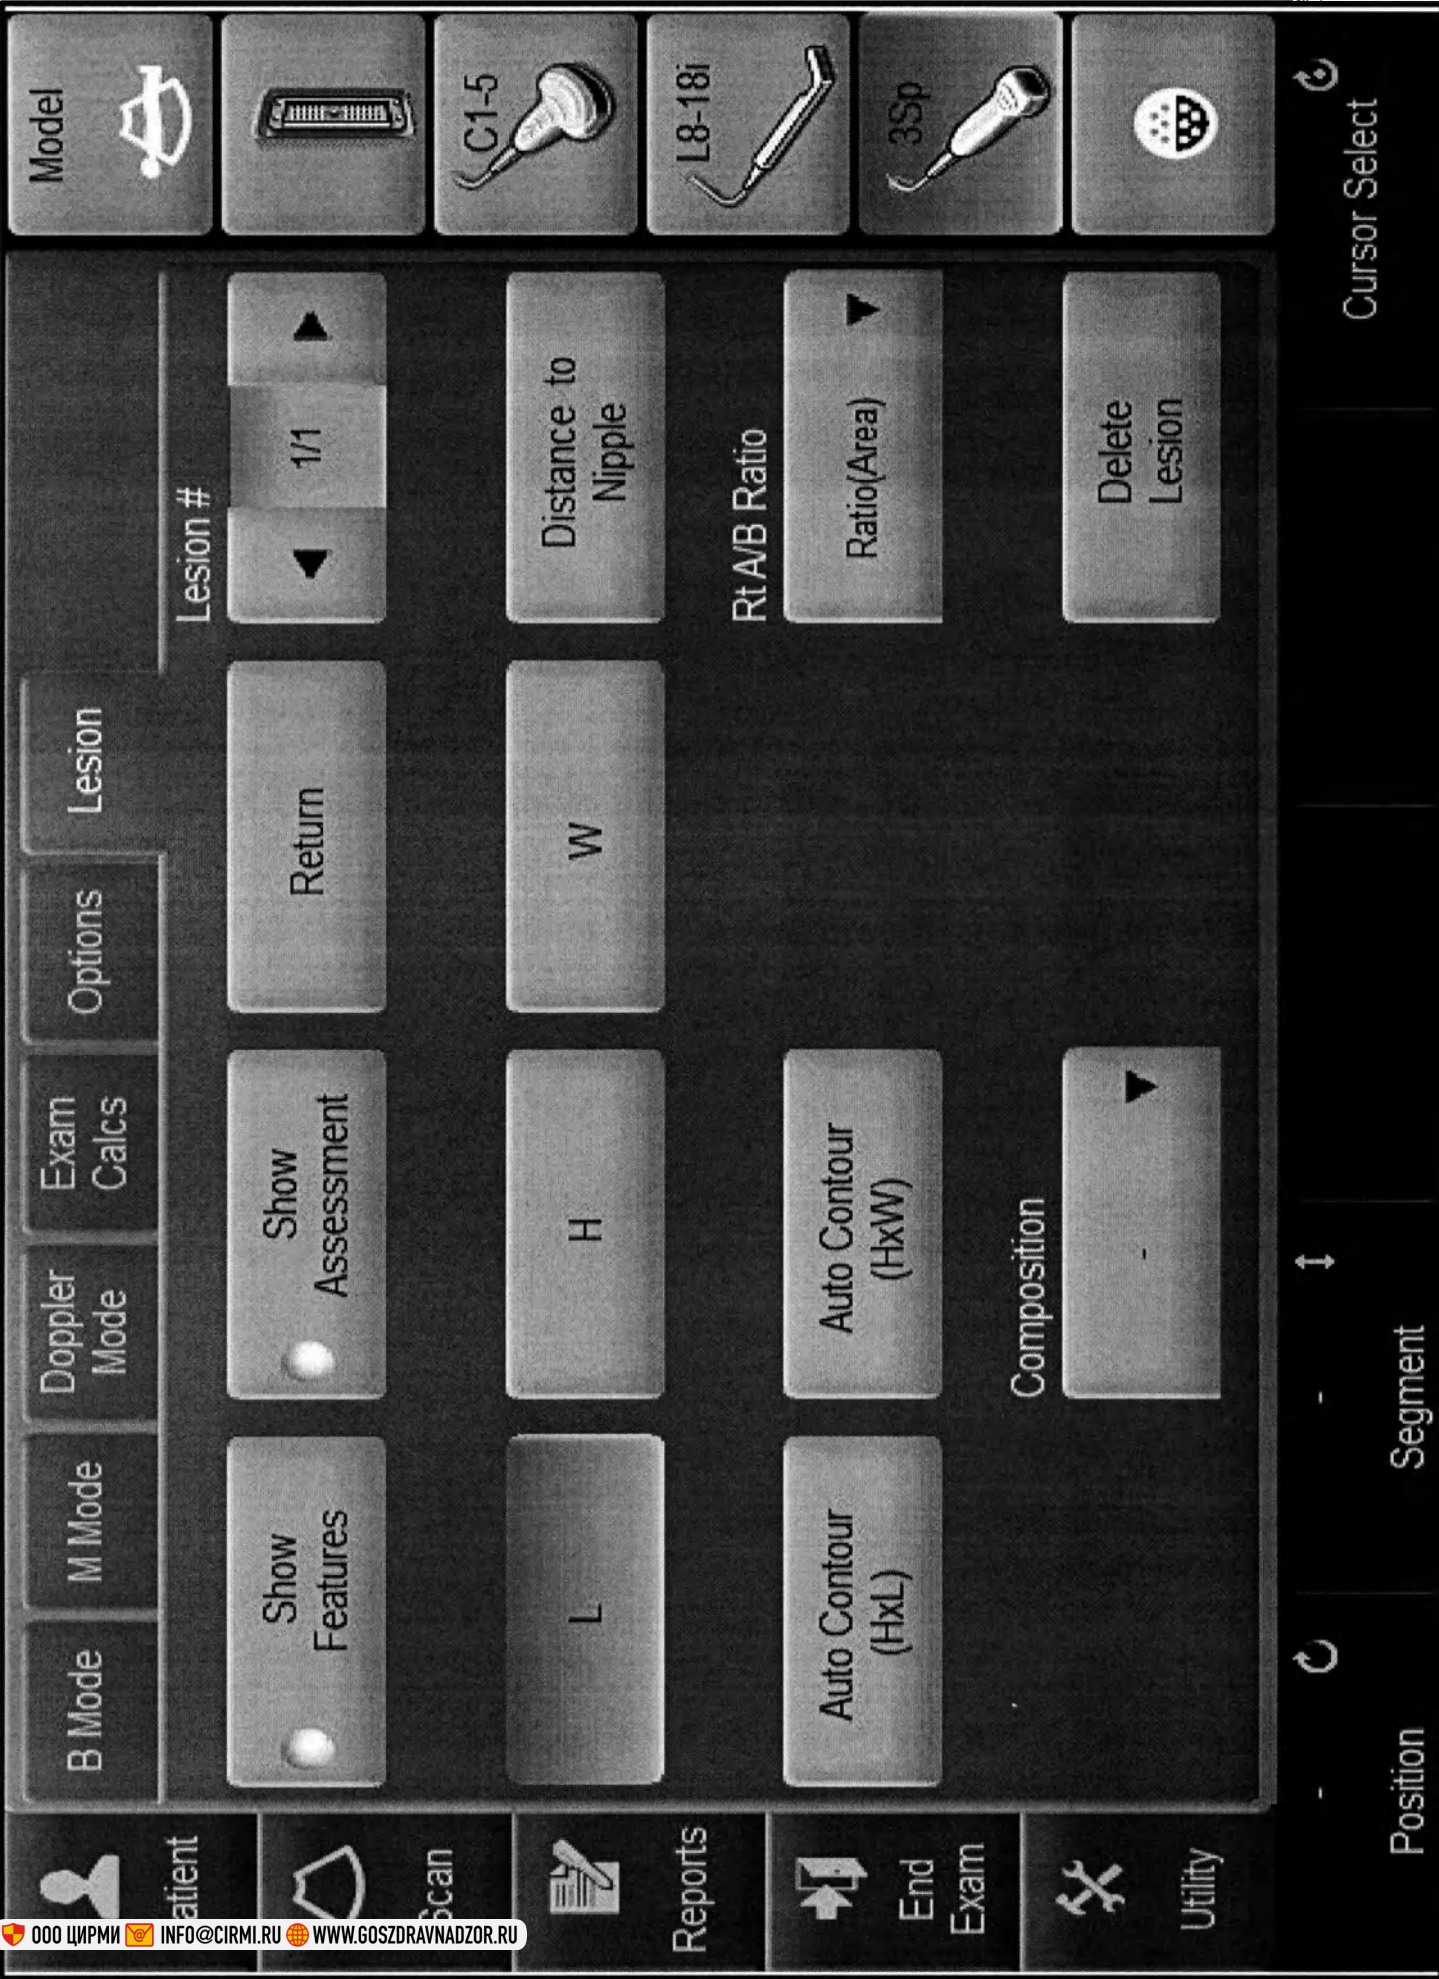


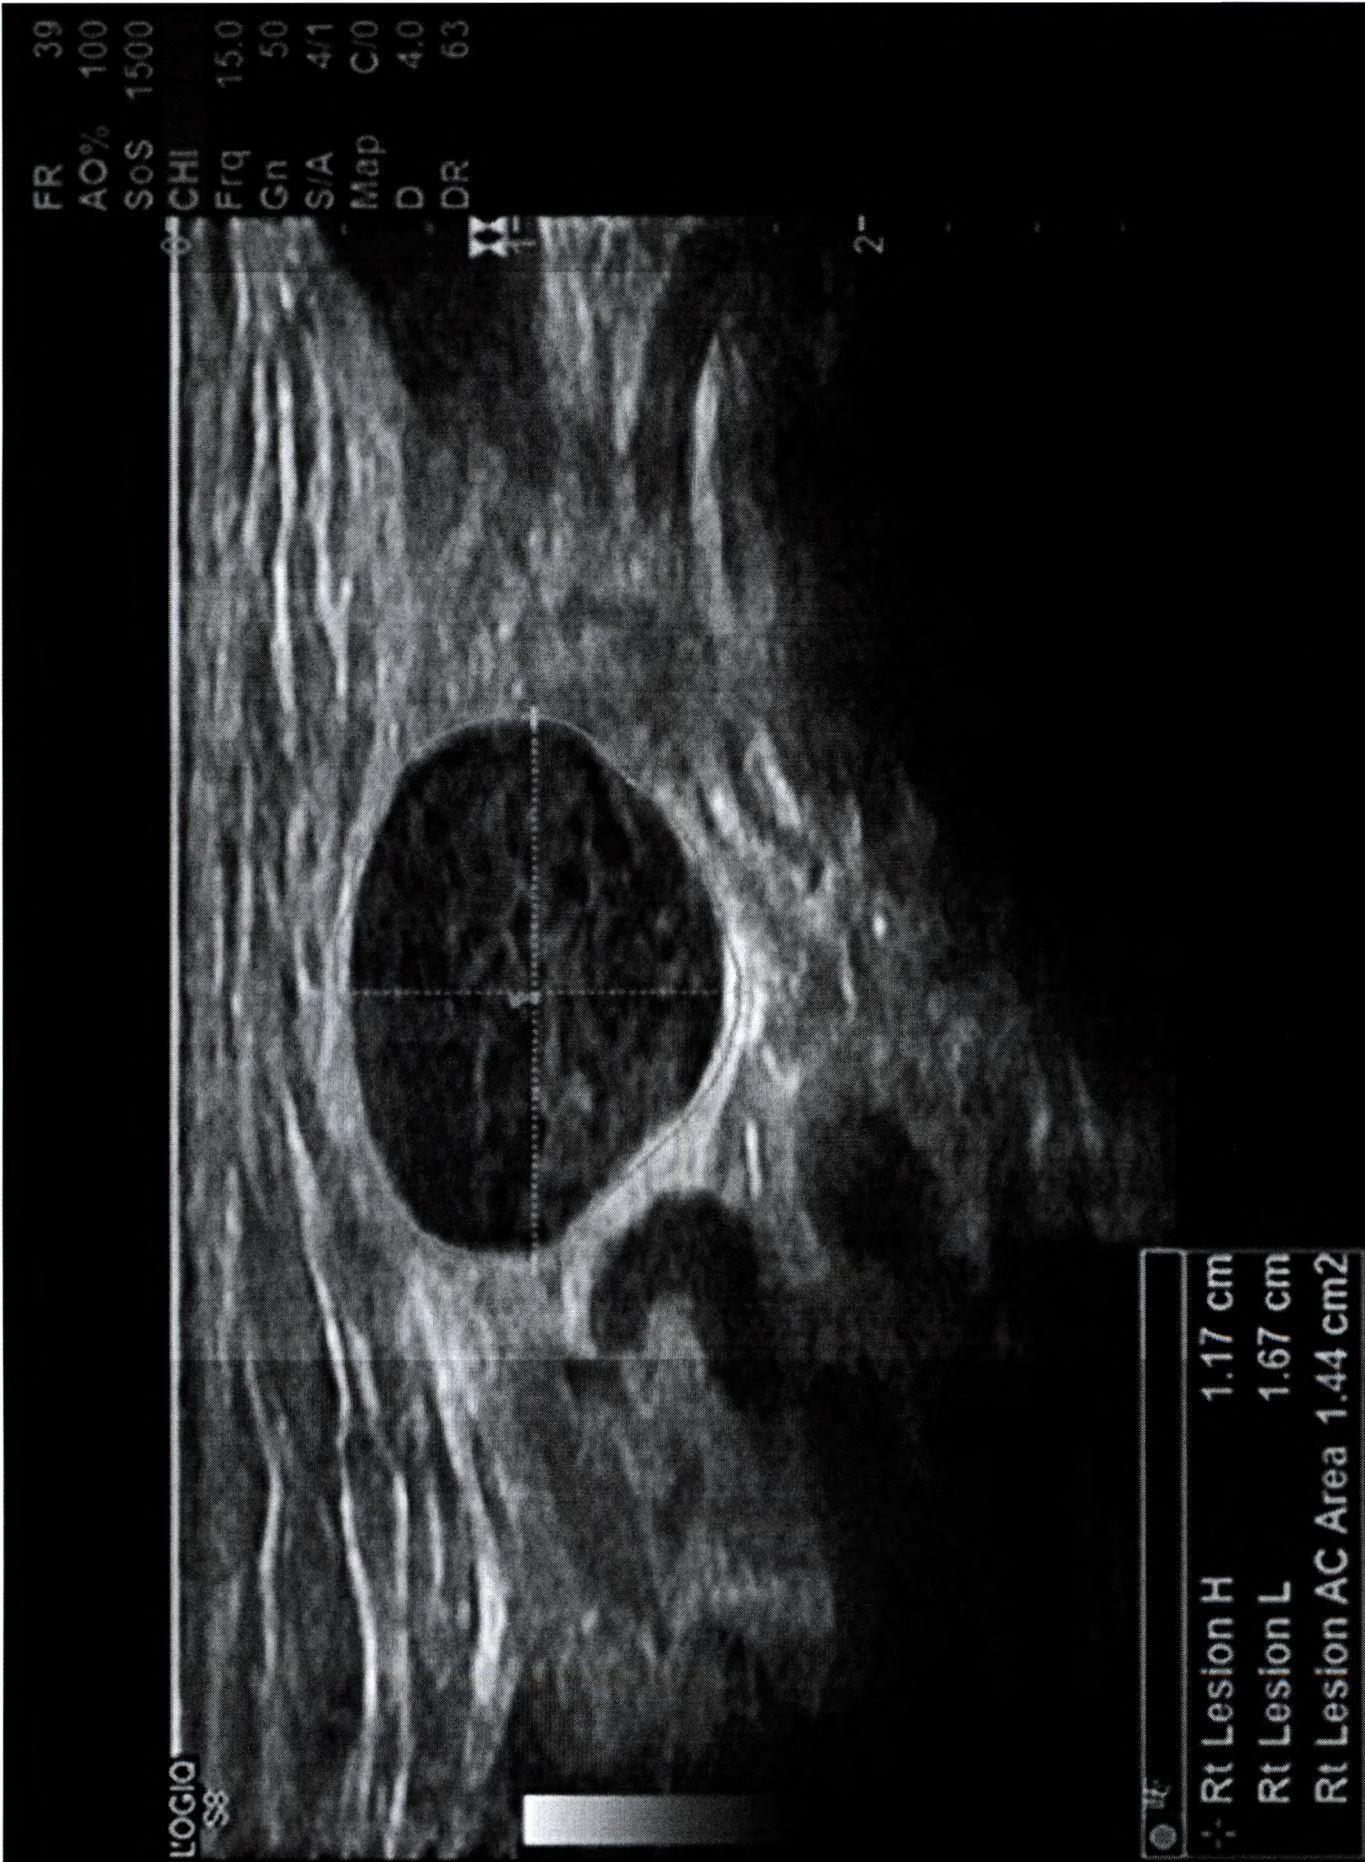

- 76. Модуль программный встроенный для оценки и описания образований в щитовидной железе, активируемый электронным ключом

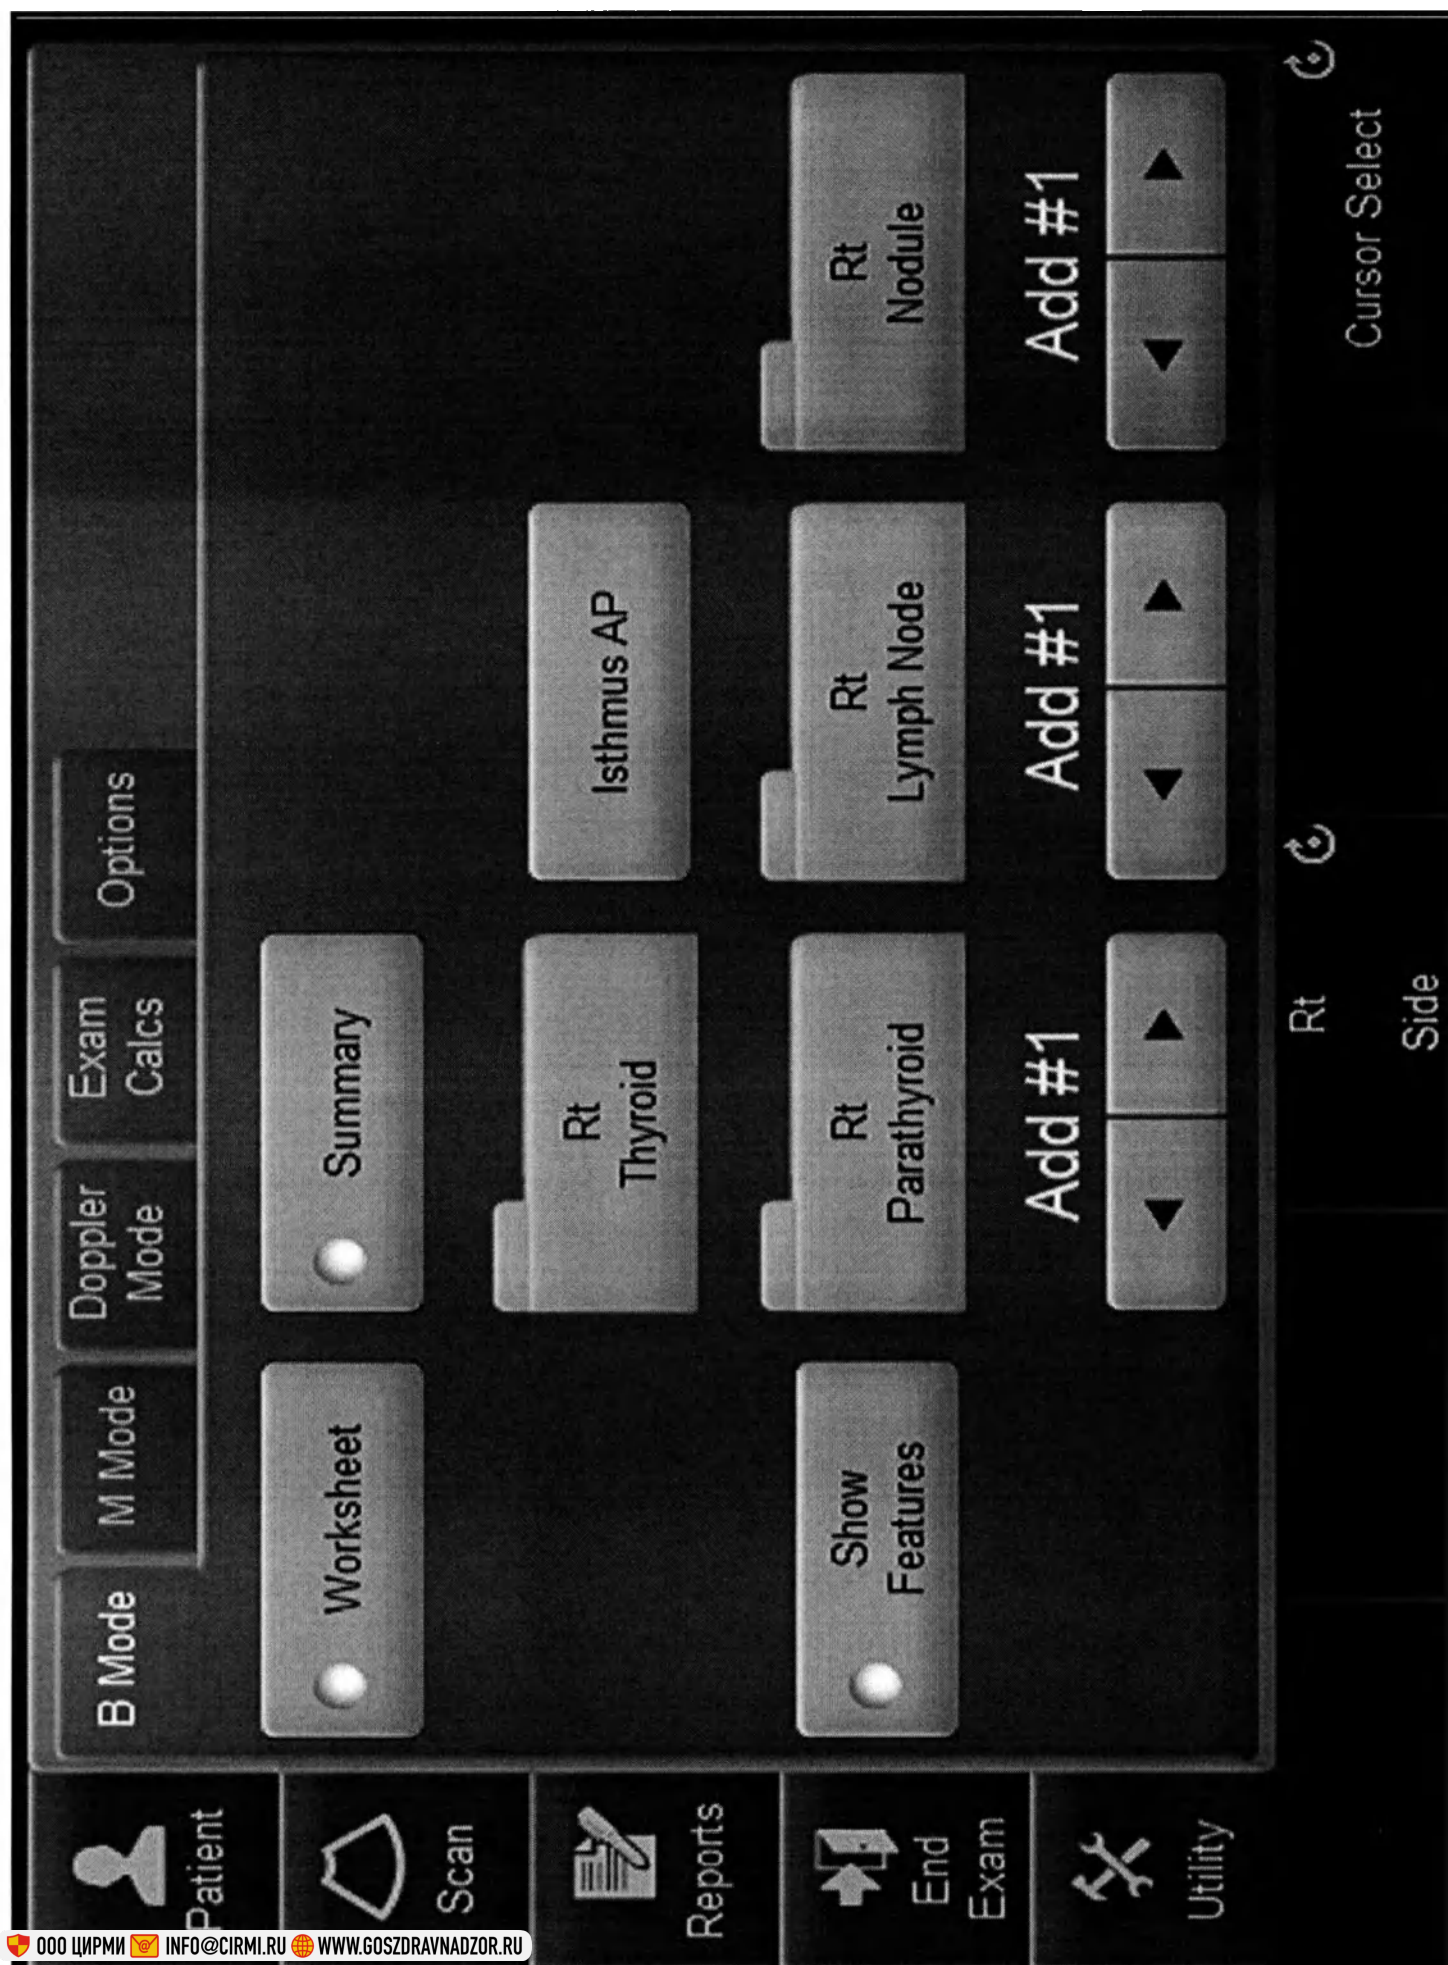



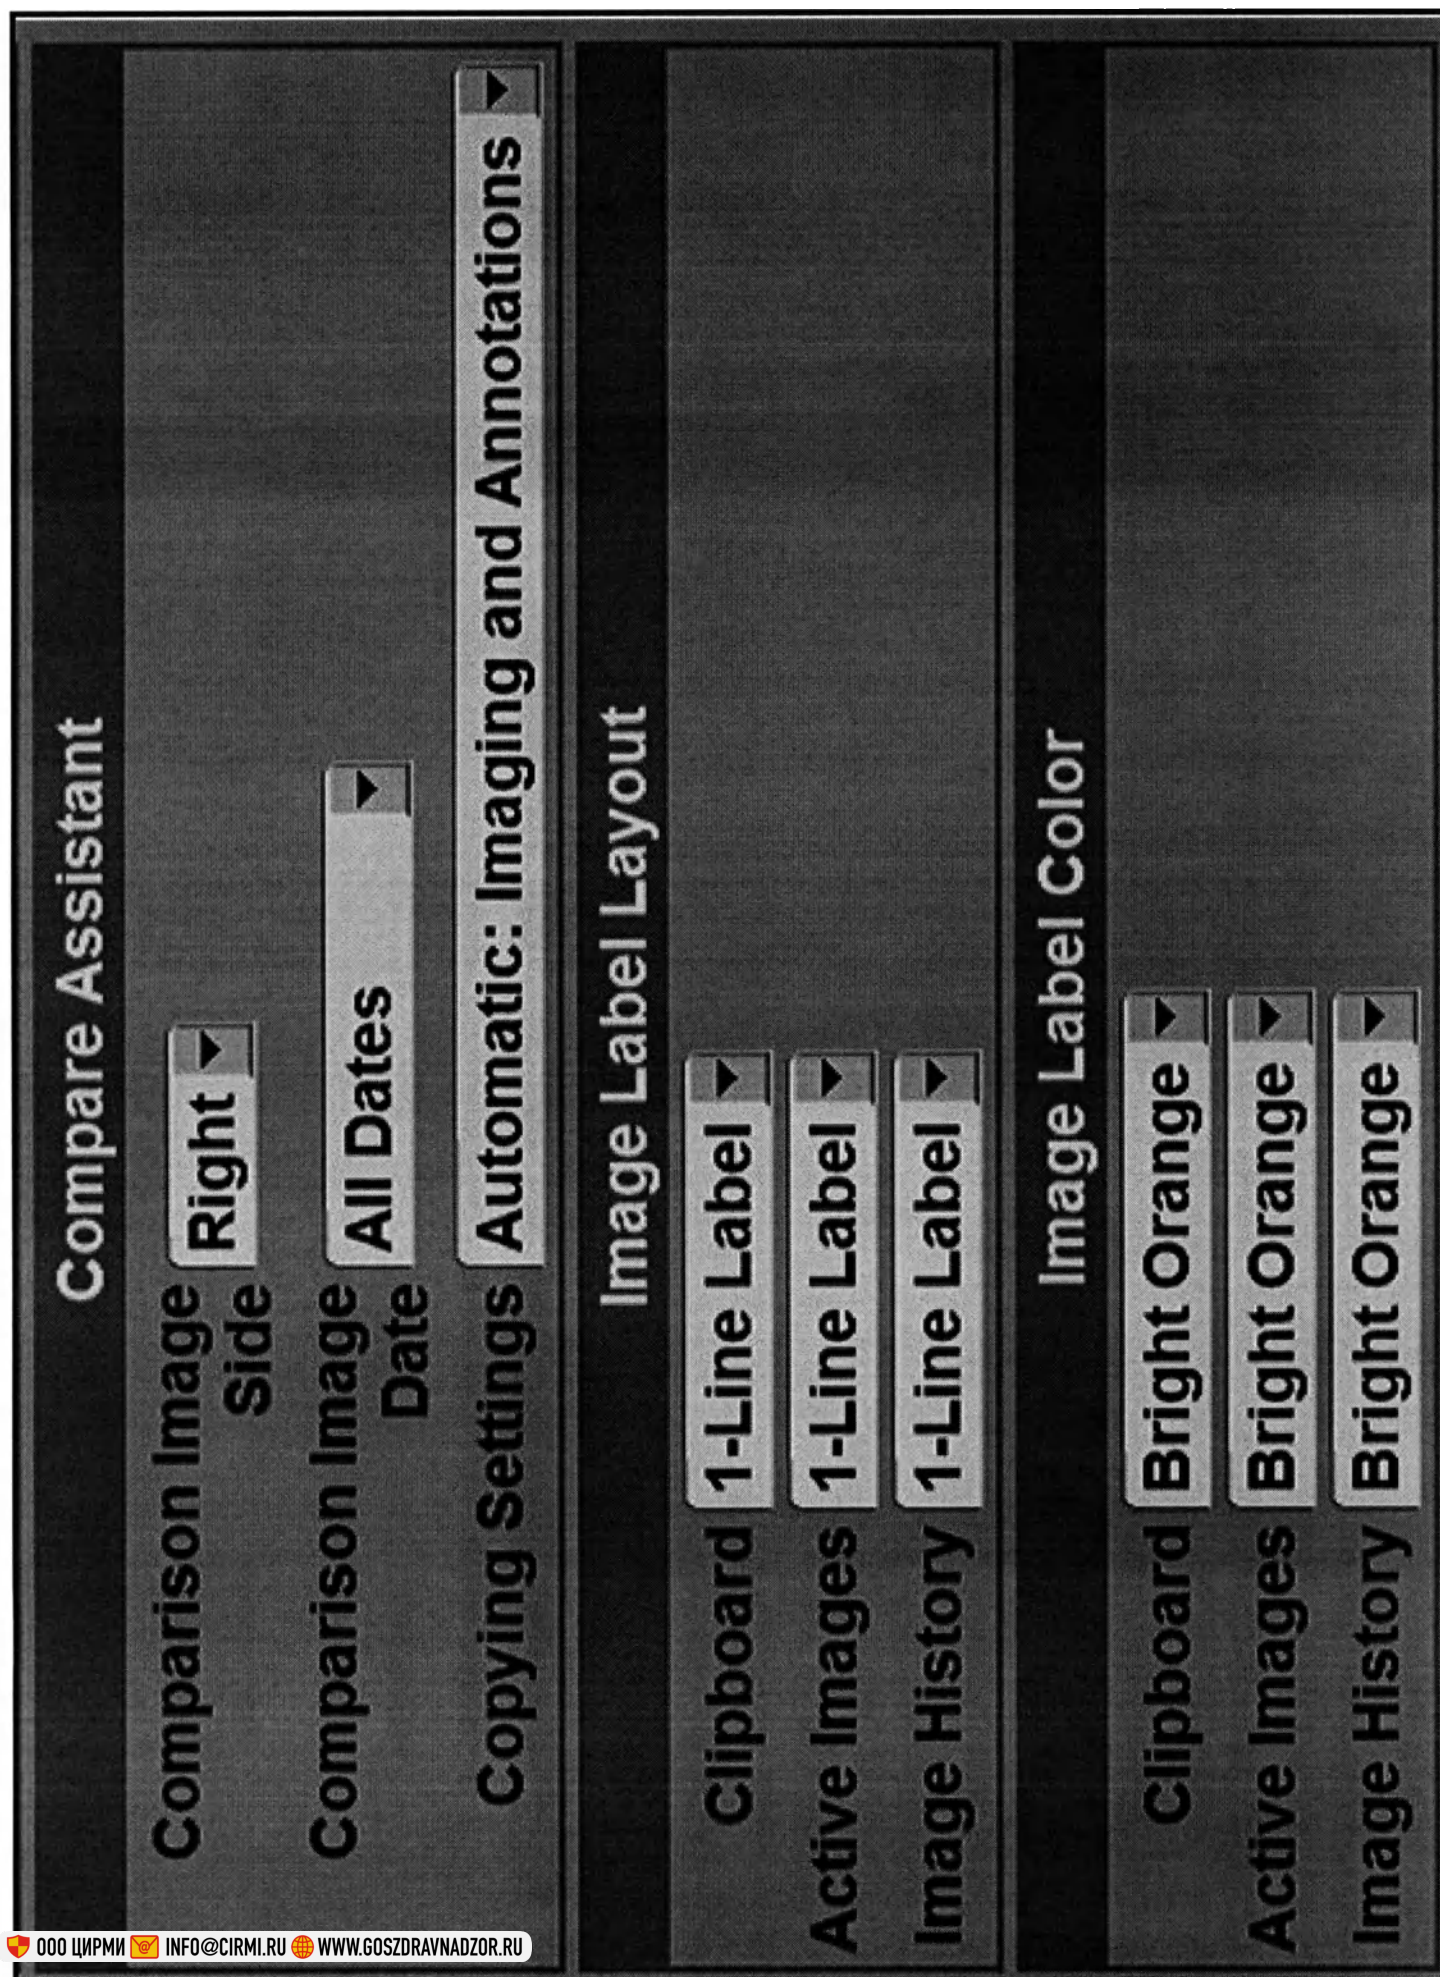





GE Healthcare

01/26/12 02:54:37PM ADM

MI 1.2 TIs 0.1 11L

Small Parts

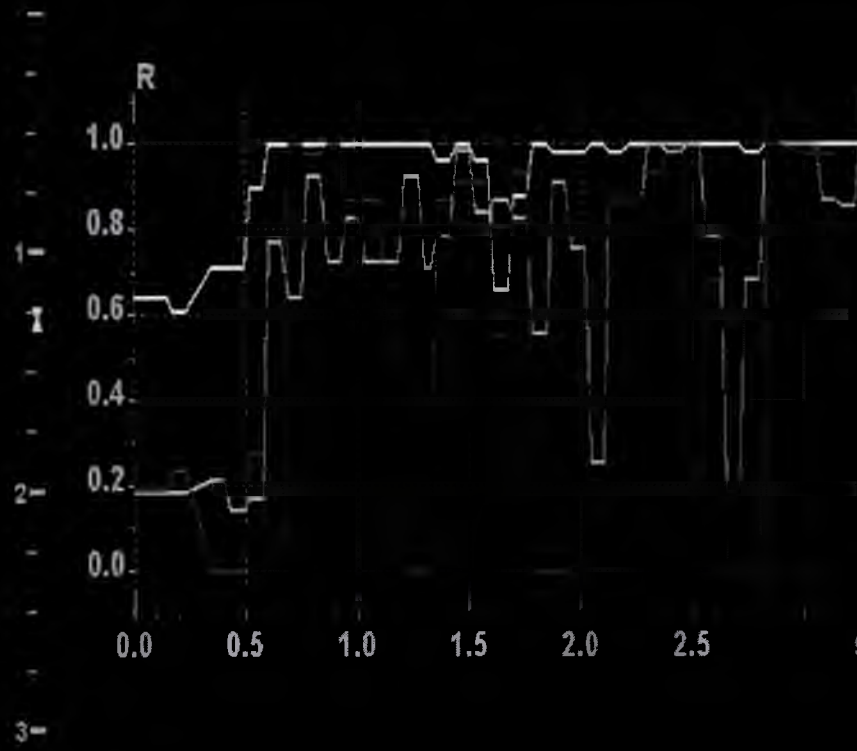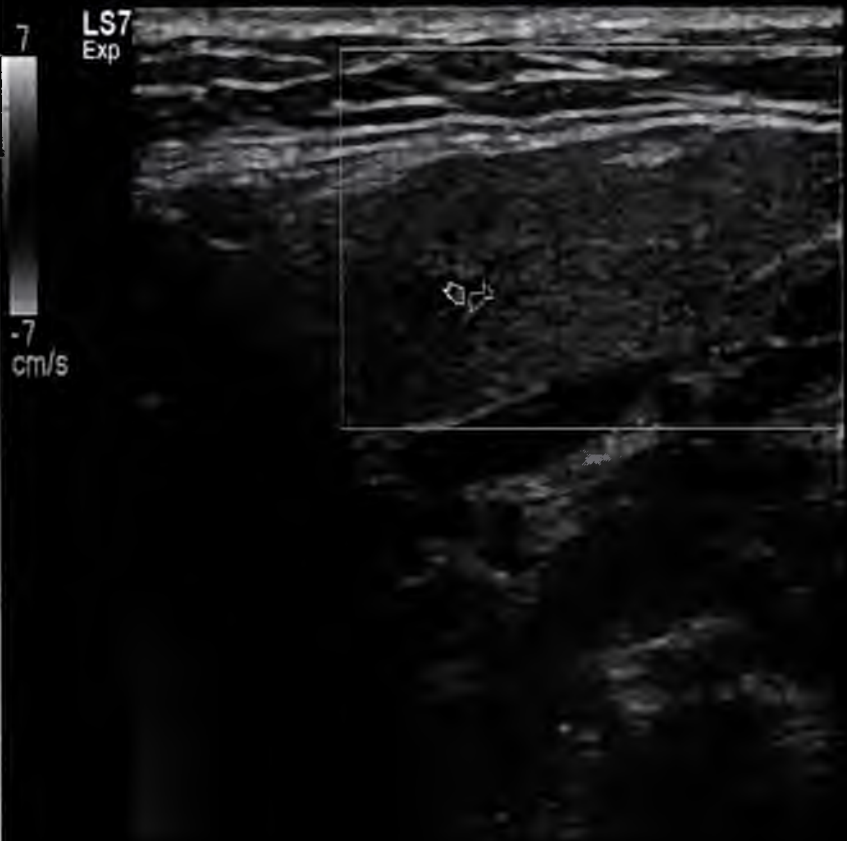



FR 12
AO% 100
B
Frq 11.0
Gn 52
D 3.5
CF
Frq 5.0
Gn 18.0
L/A 4/0
PRF 1.0
WF 127
S/P 1/16

Ratio	Area (mm2)	MaxRatio	Time of MaxRatio	MinRatio	Time of MinRatio
1.000	0.552	1.000	0.605	0.610	0.173
1.000	0.702	1.000	2.306	0.143	0.432


79. Модуль программный встроенный для количественной оценки кровотока, активированный электронным ключом




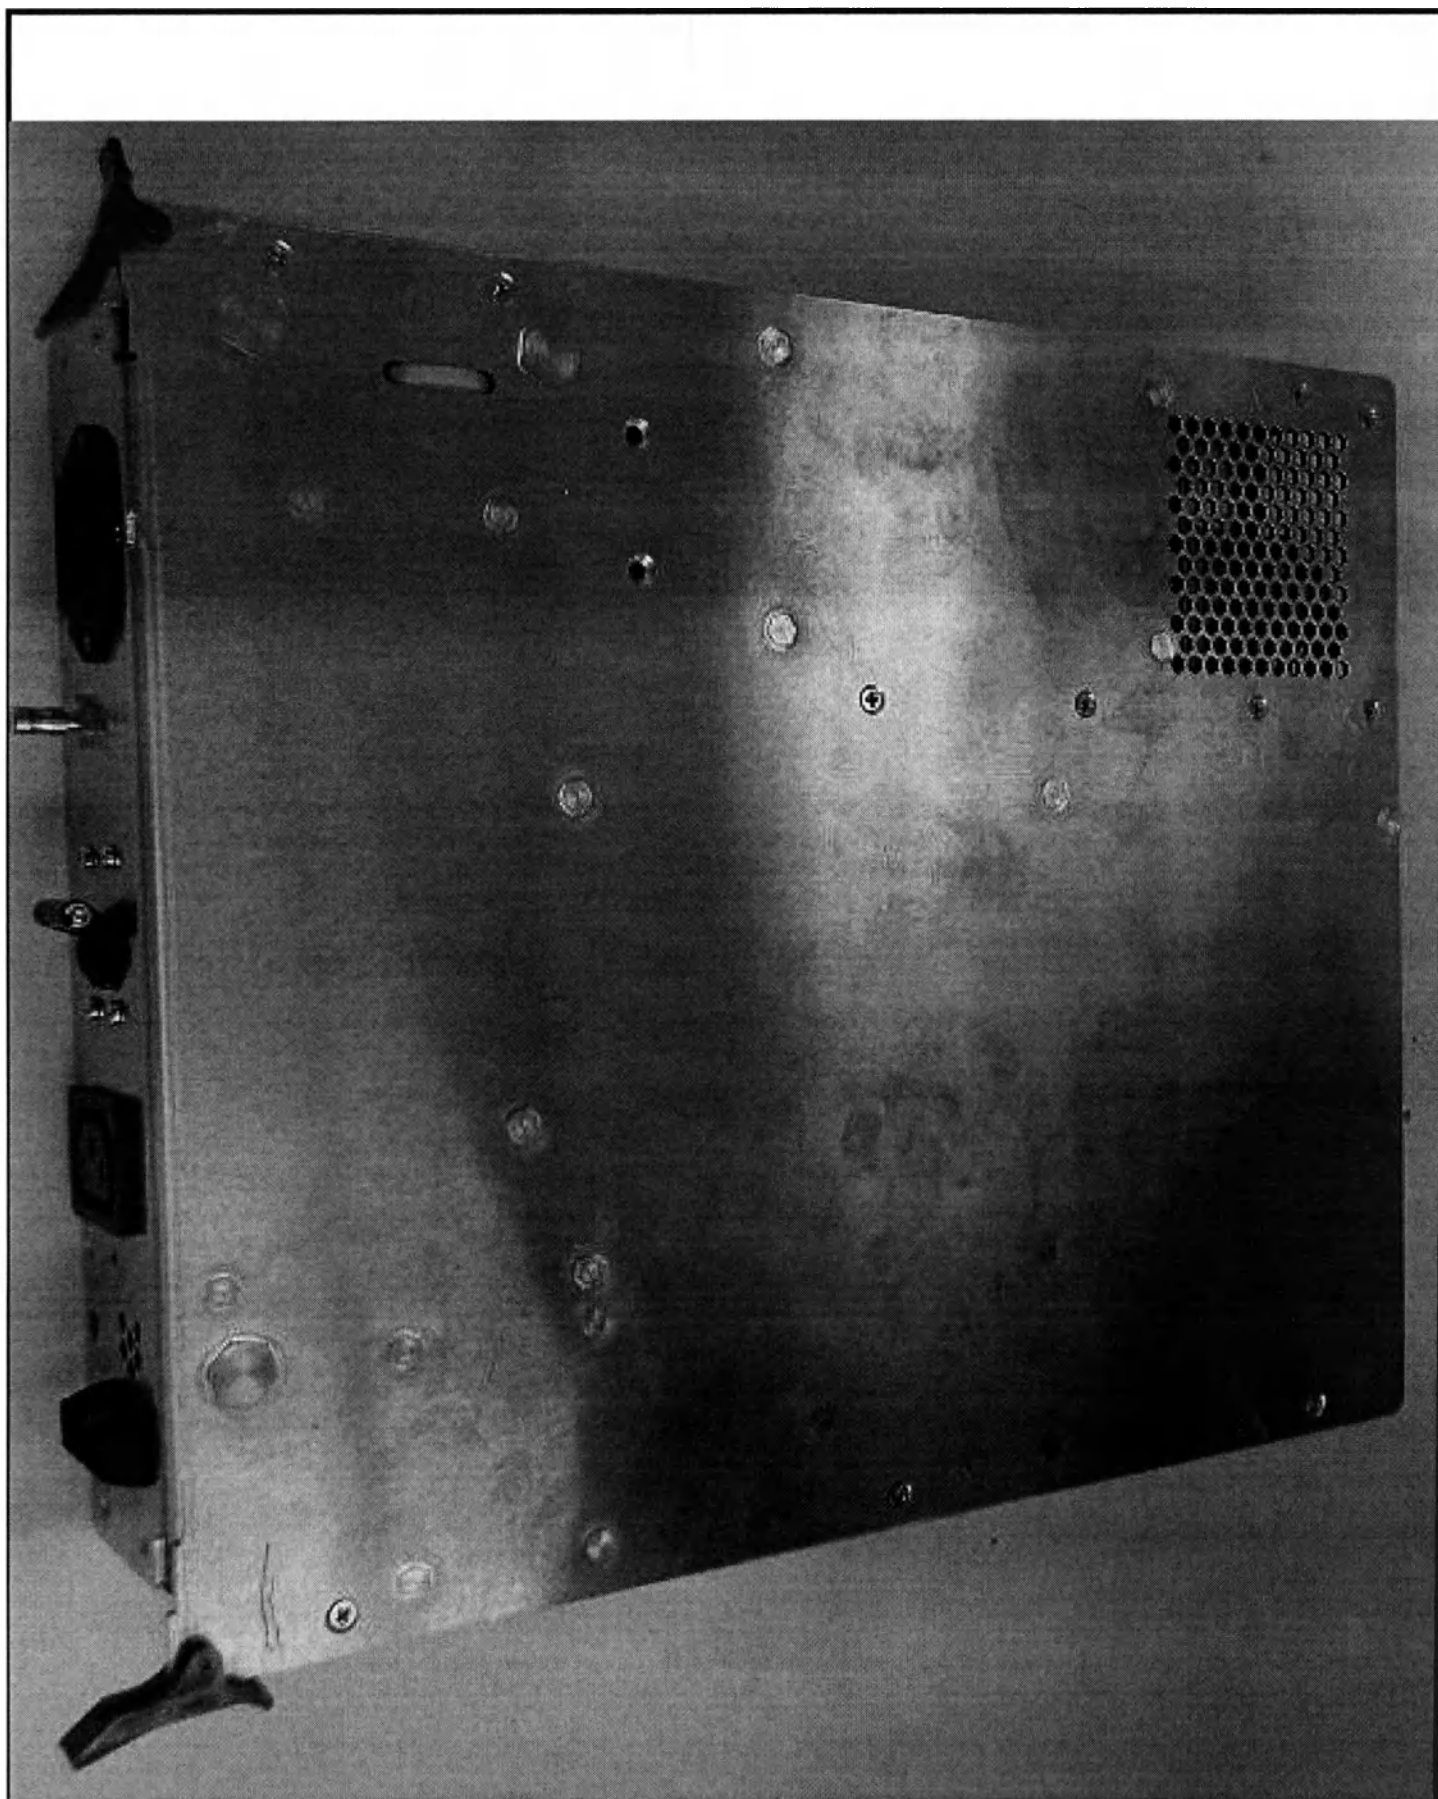


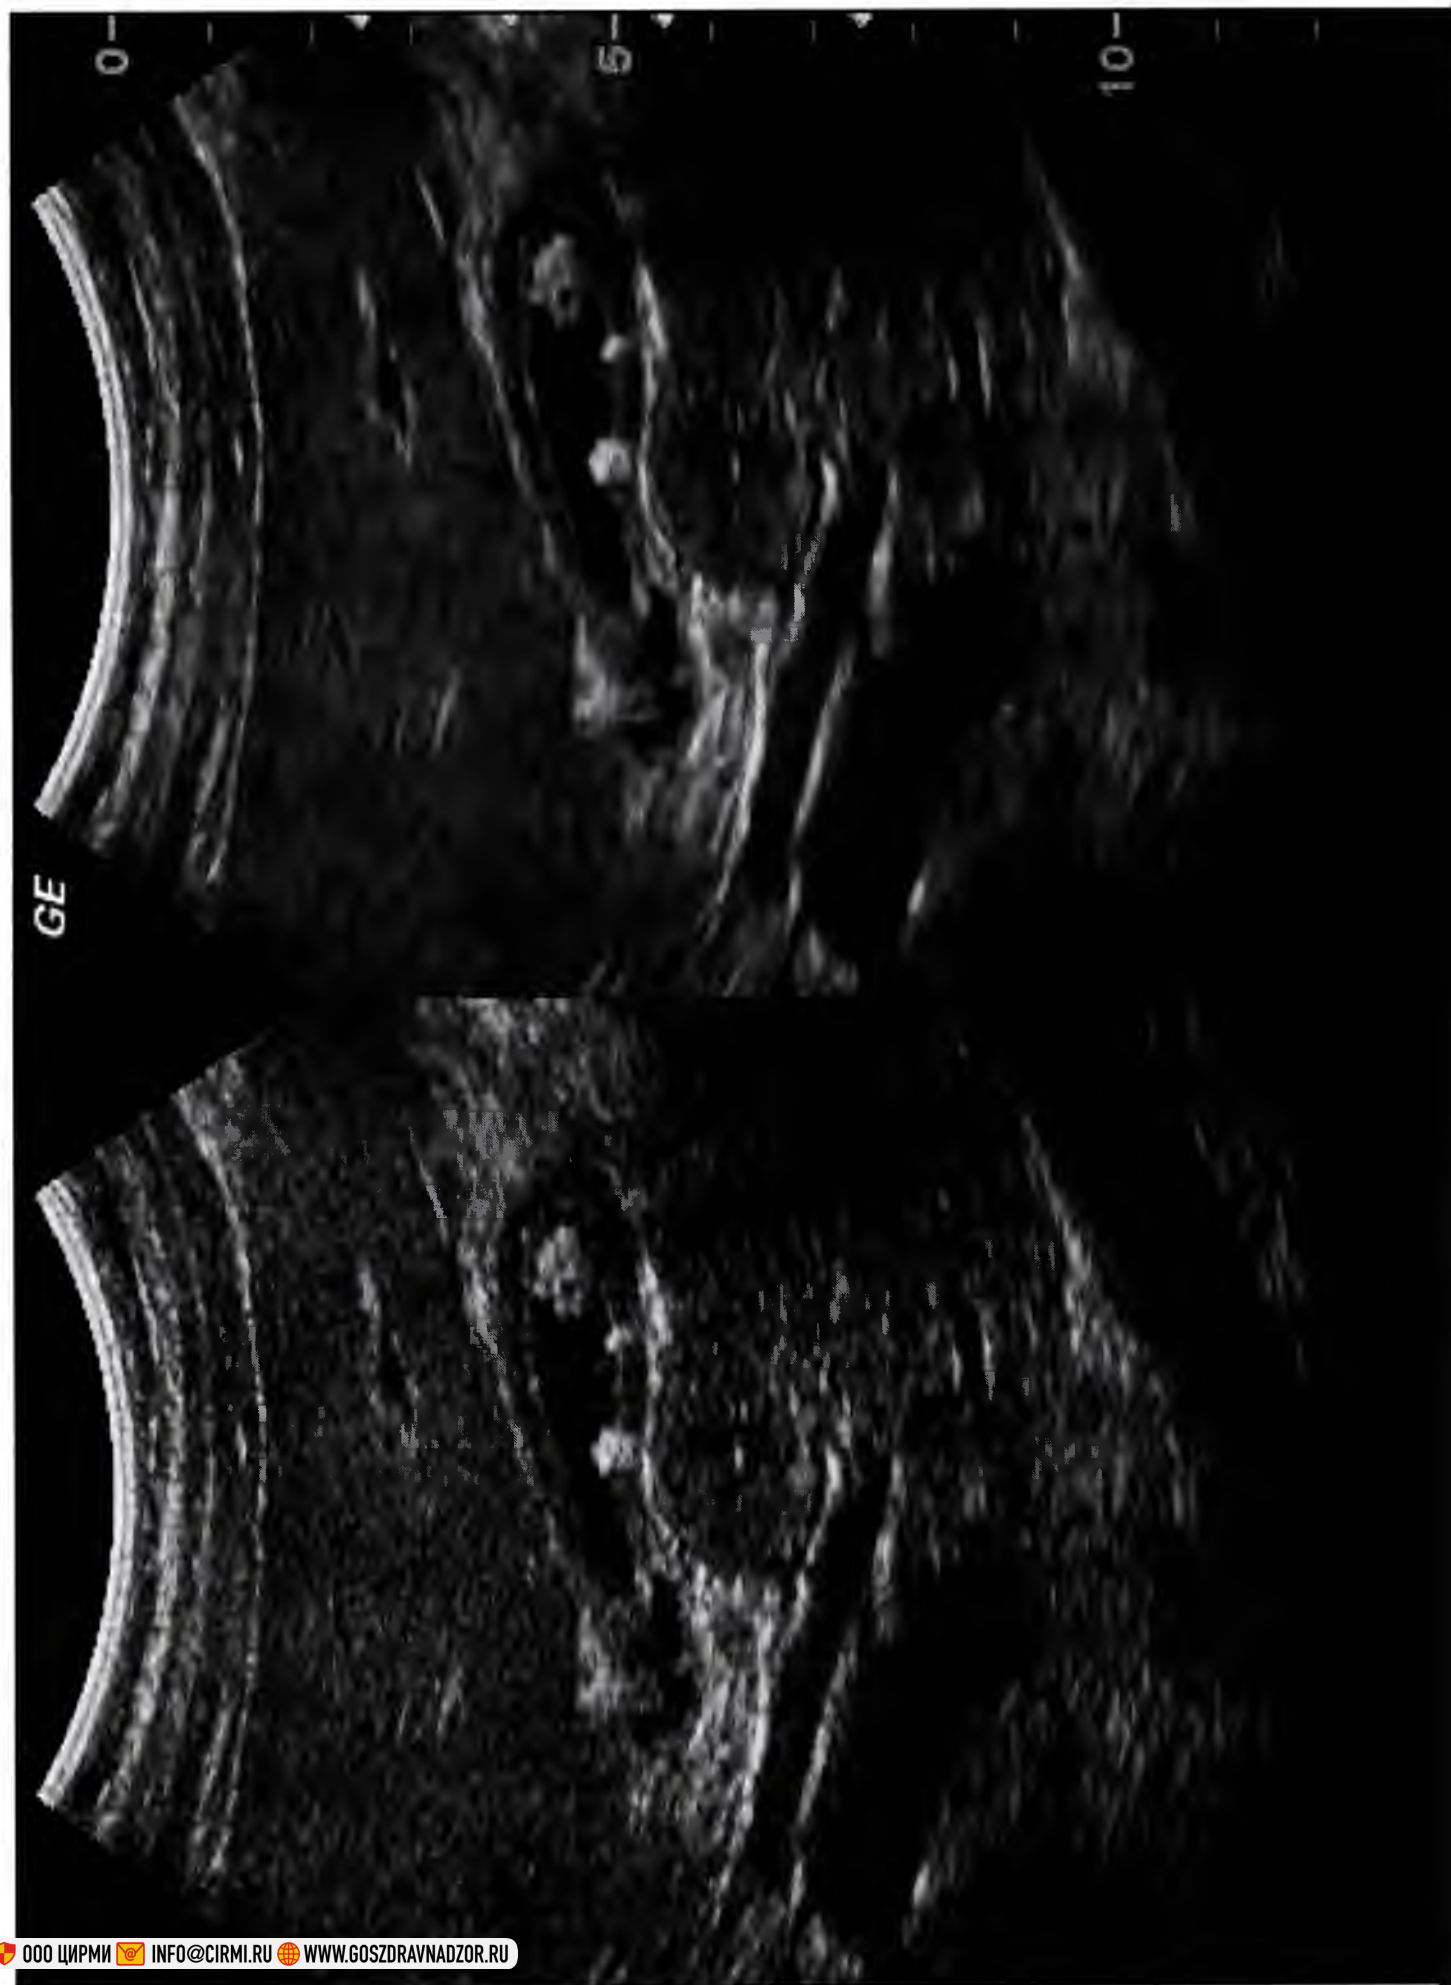


82. Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового доплера для карандашных датчиков – Pencil CW

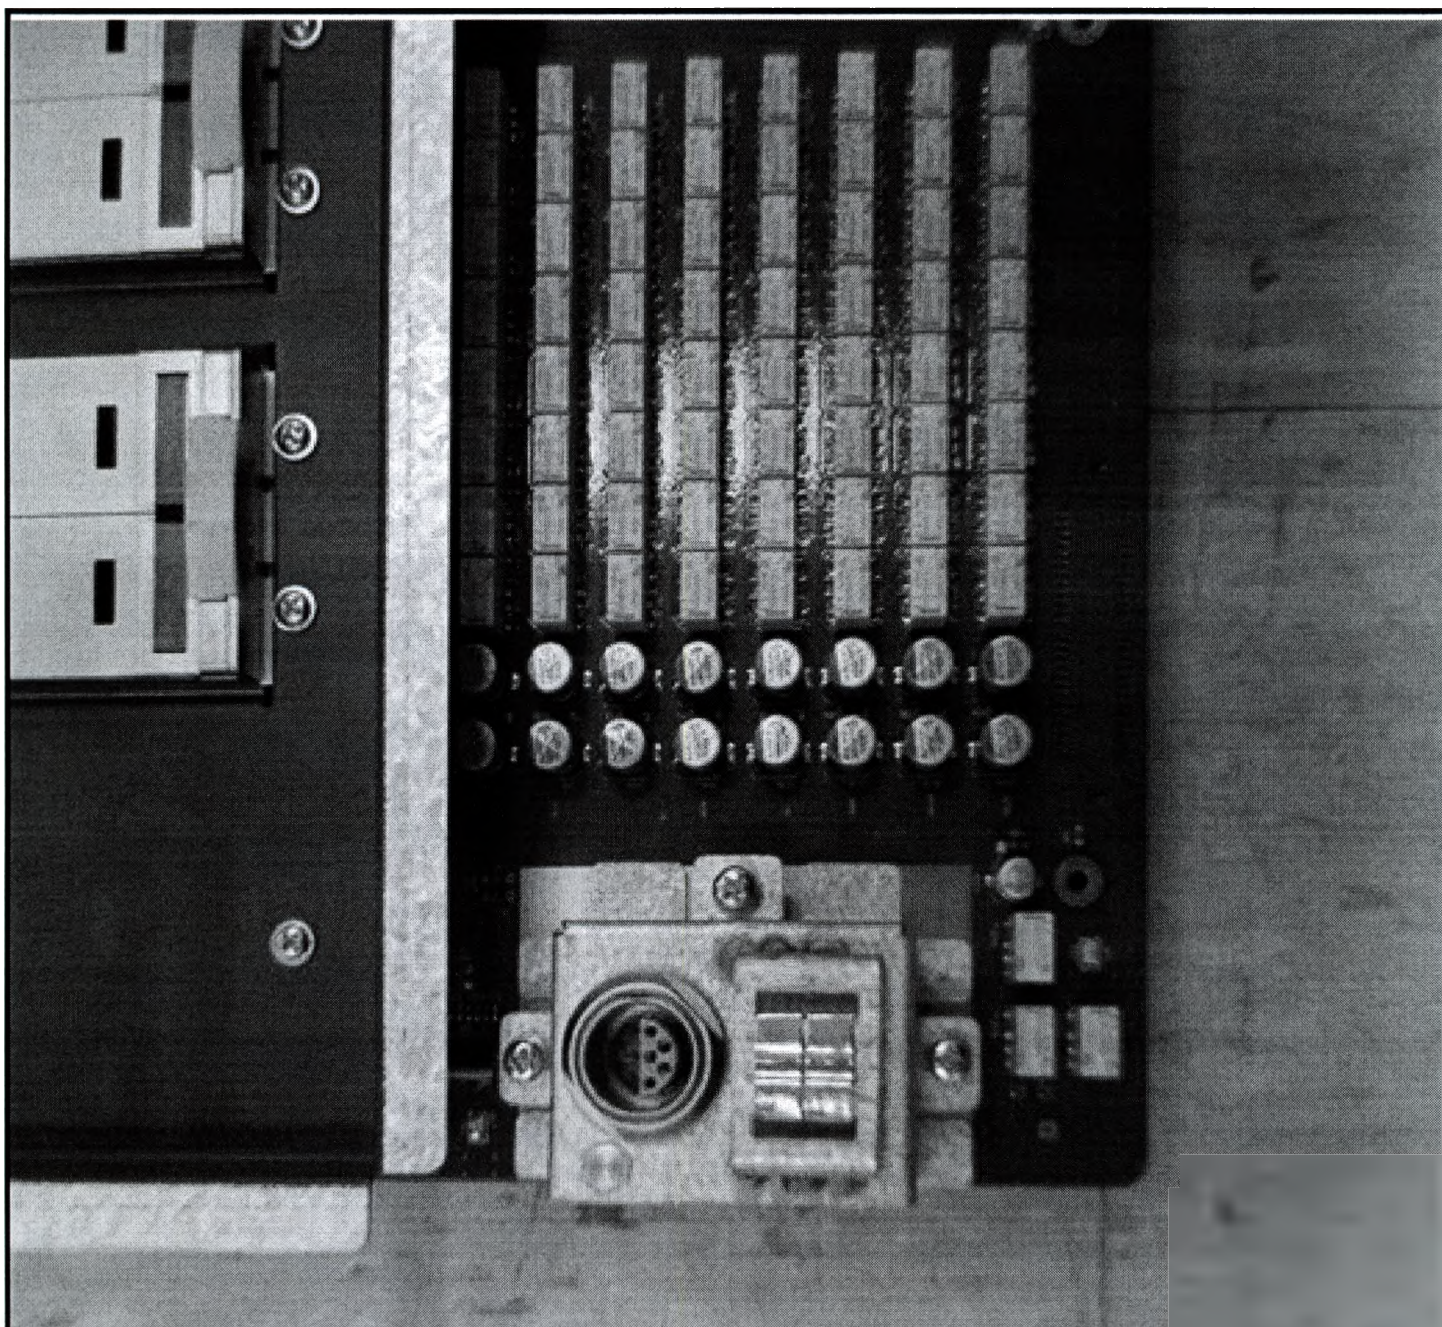

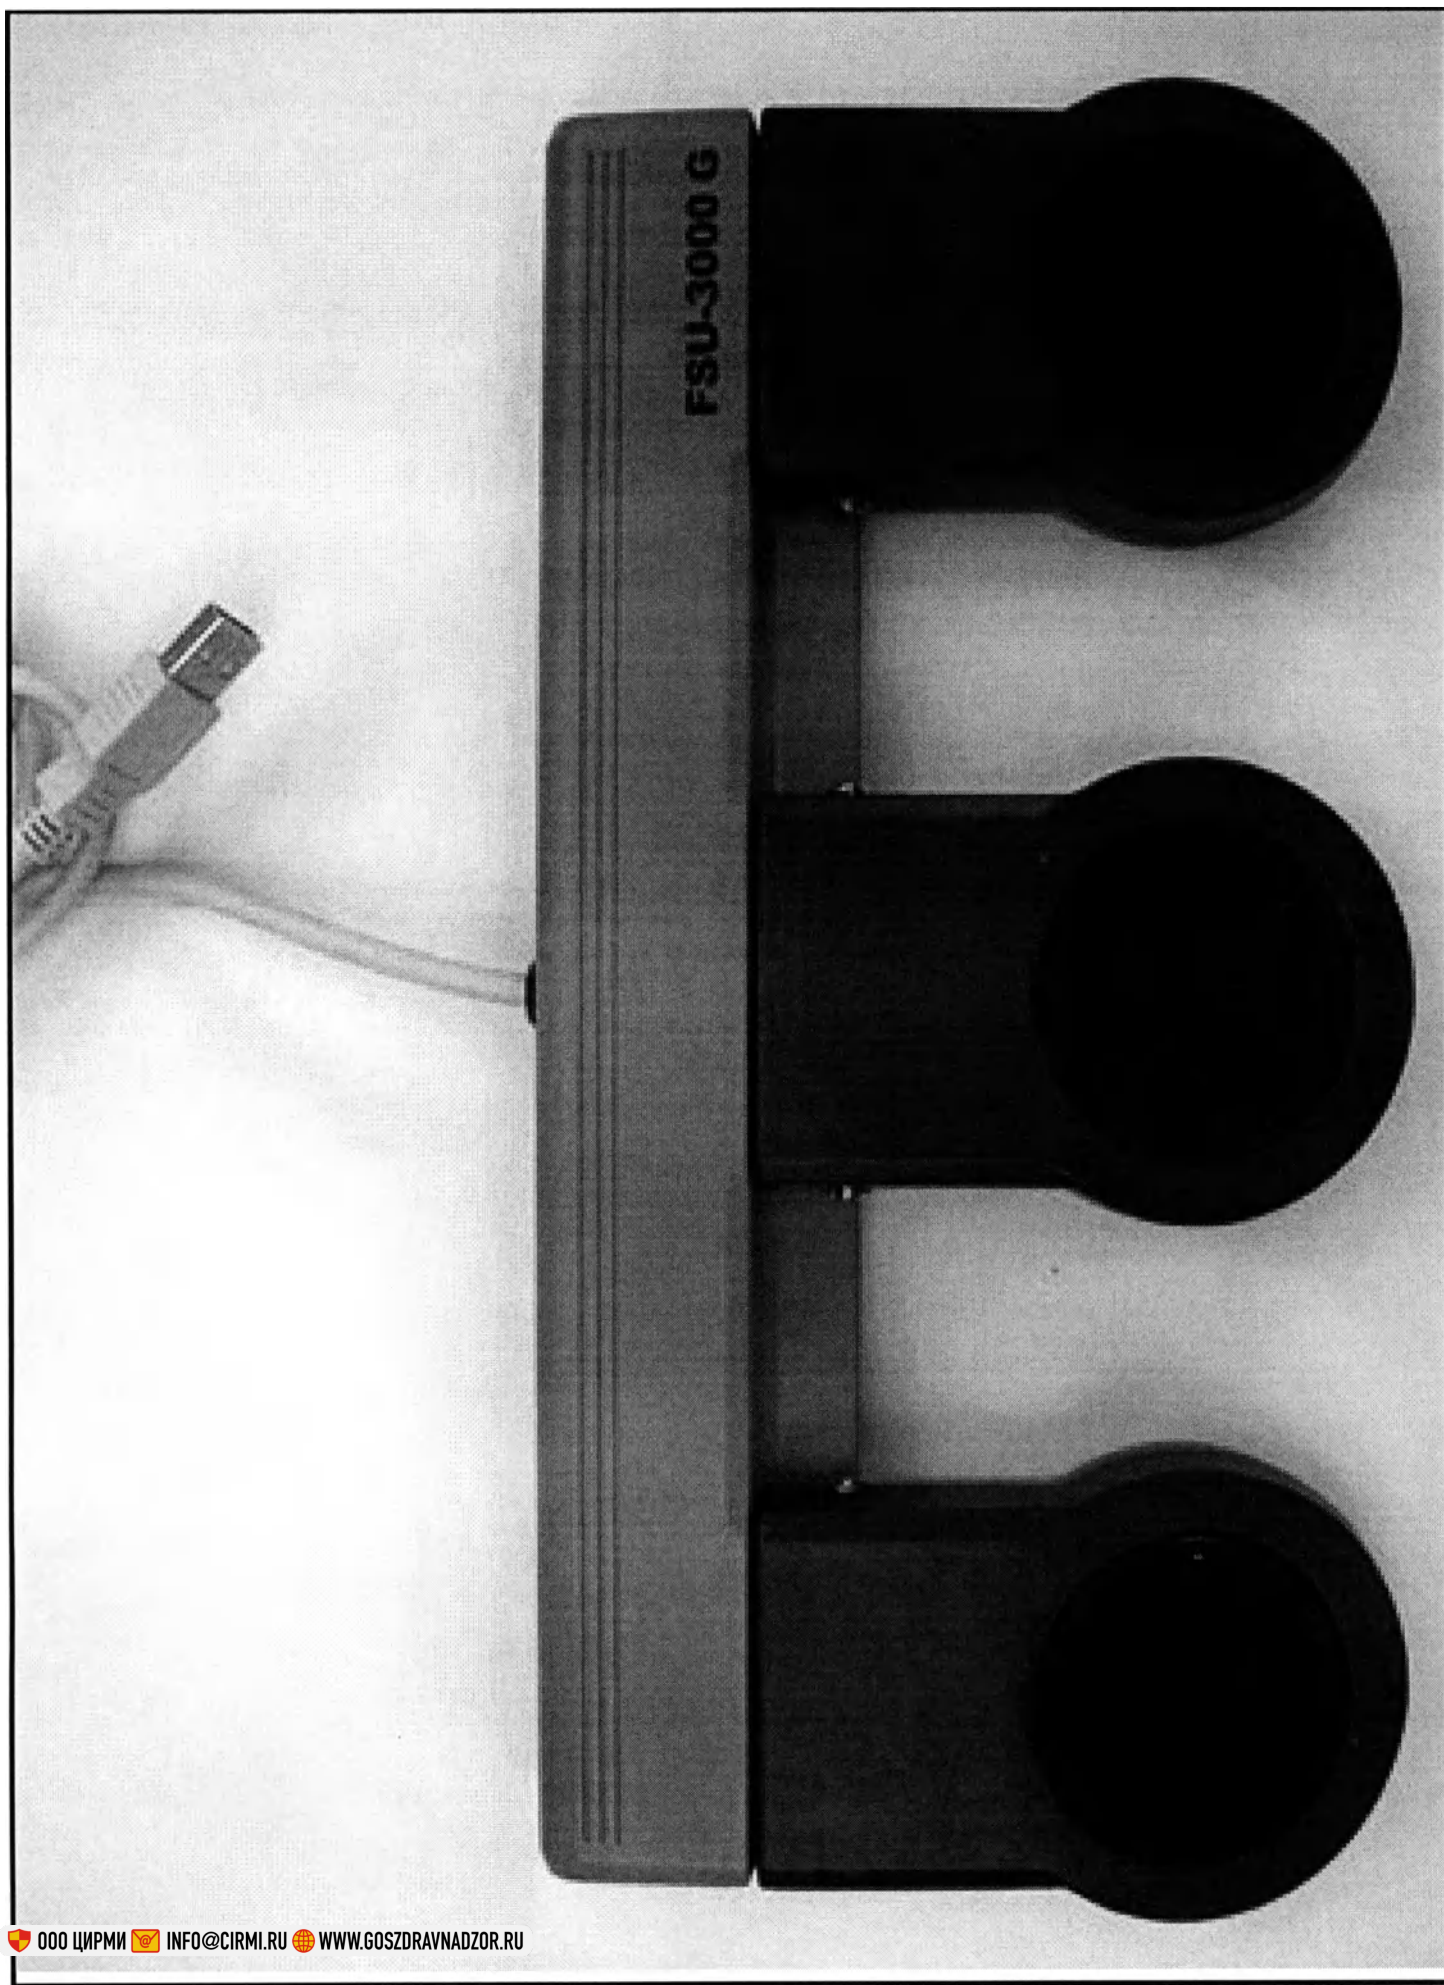


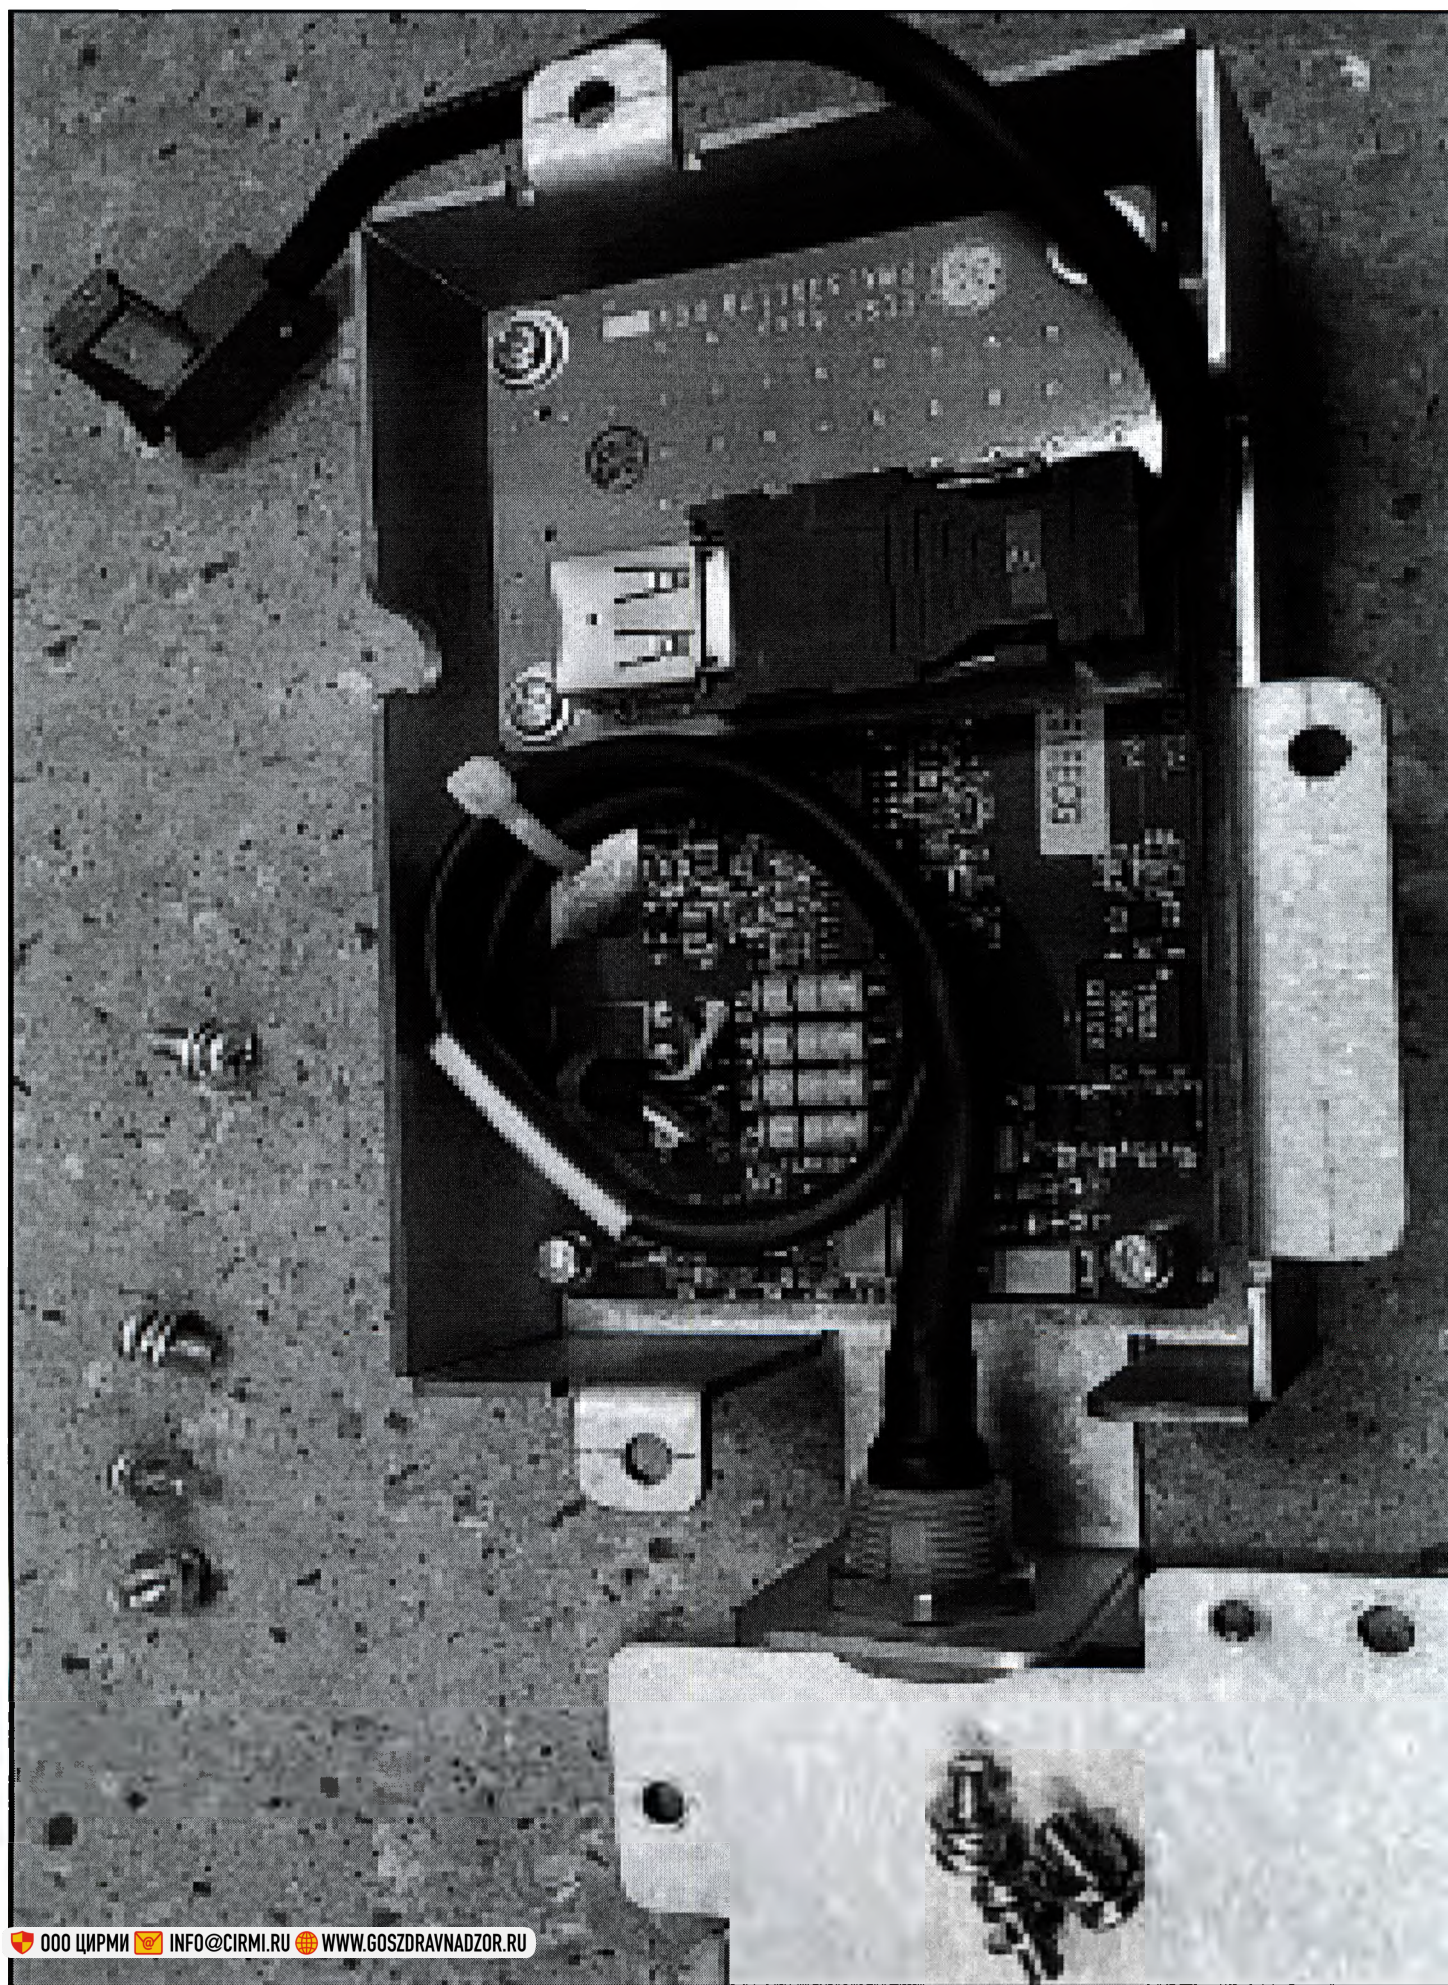

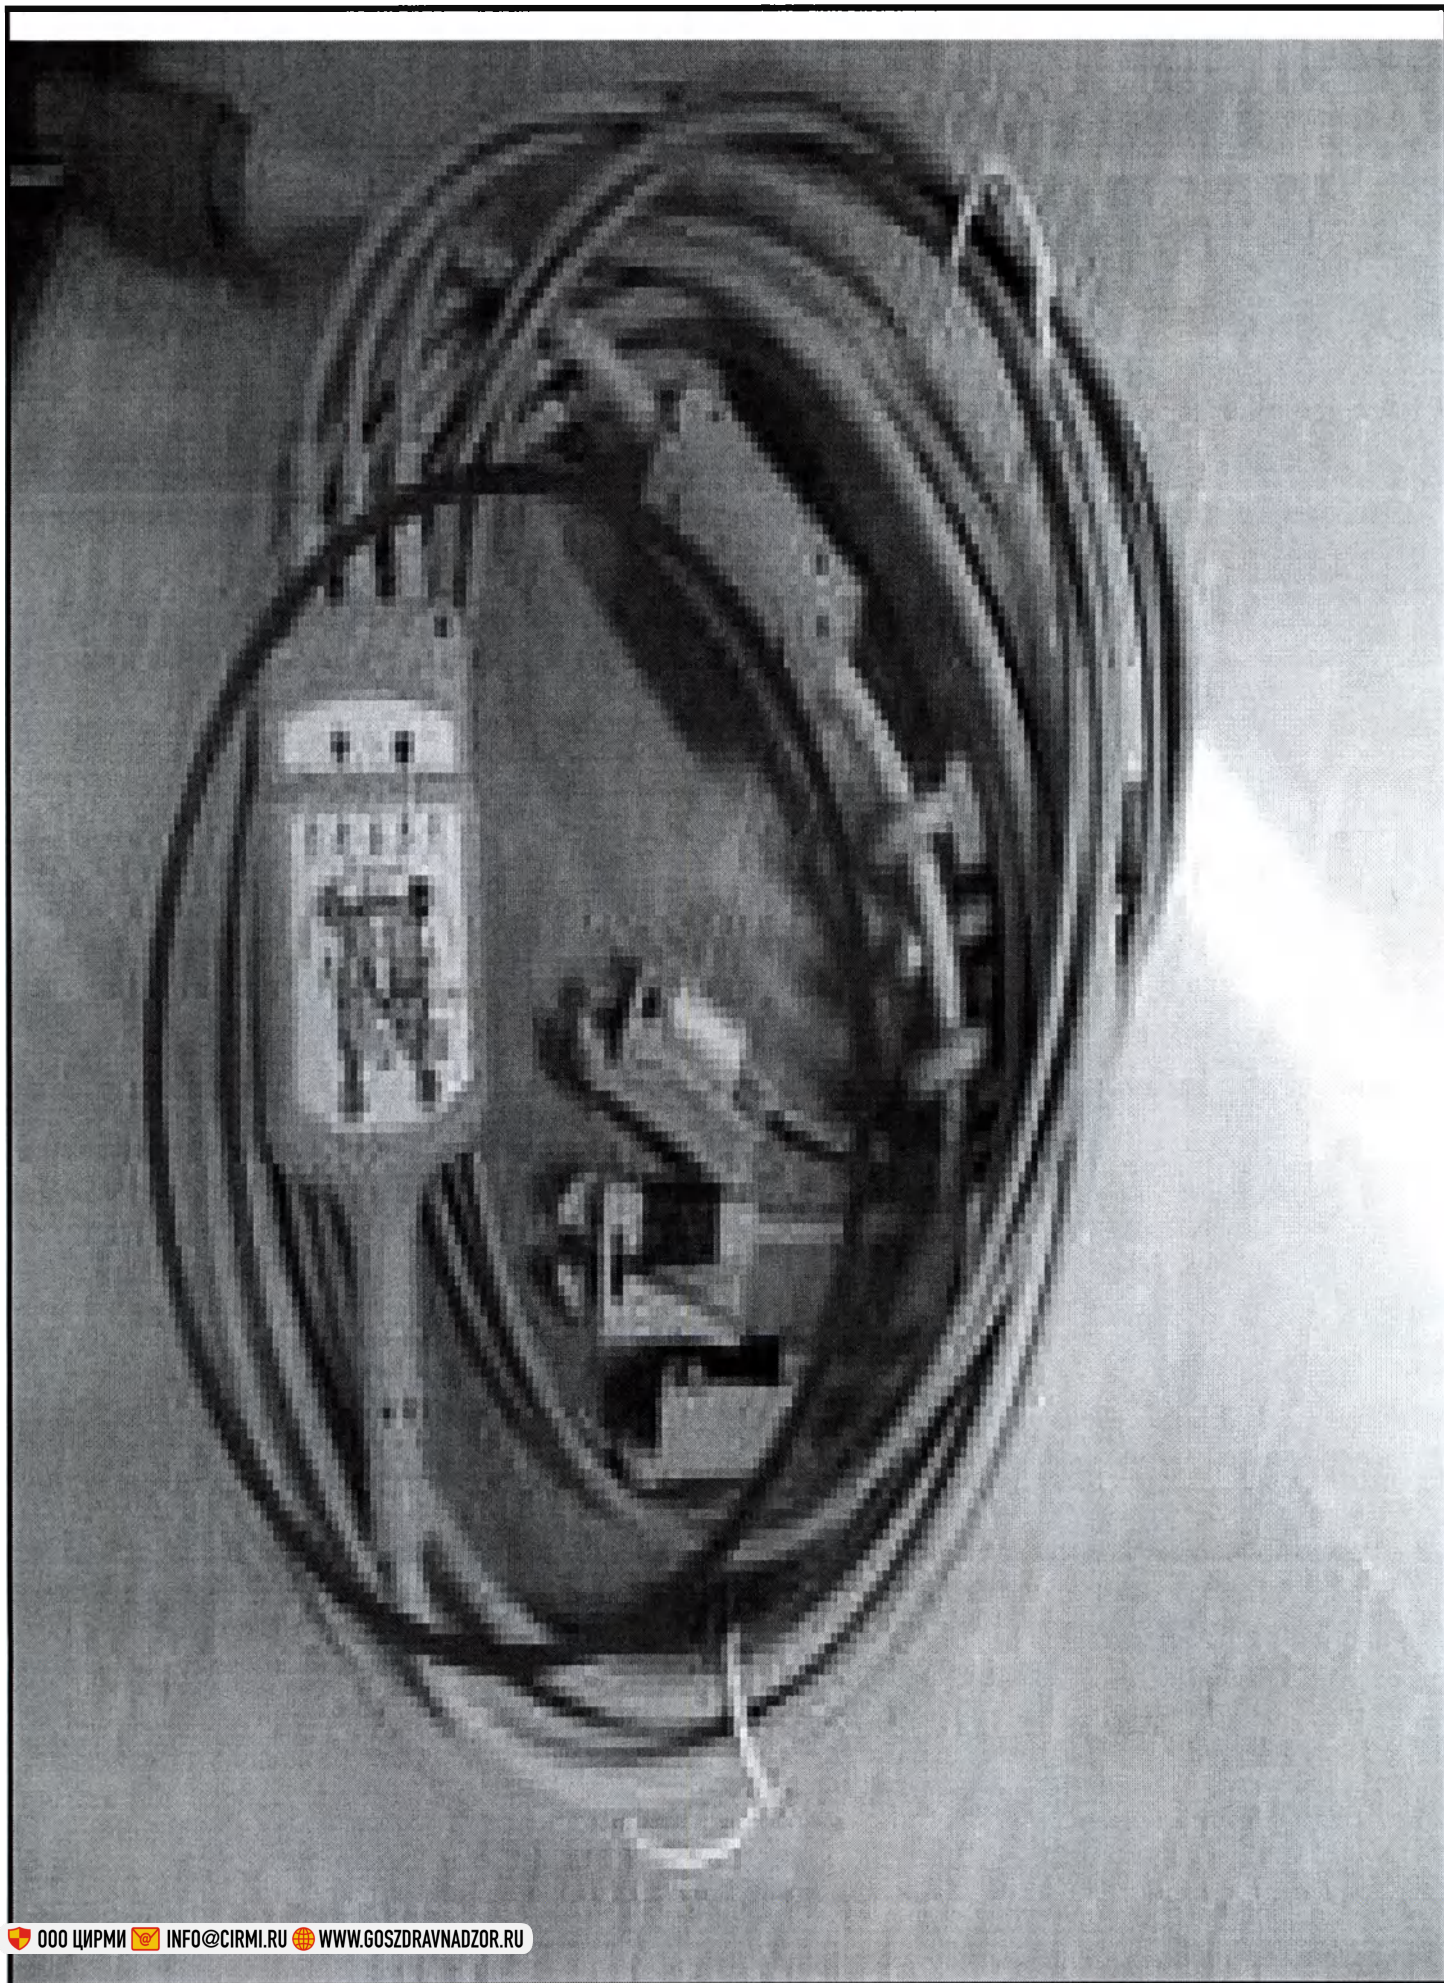







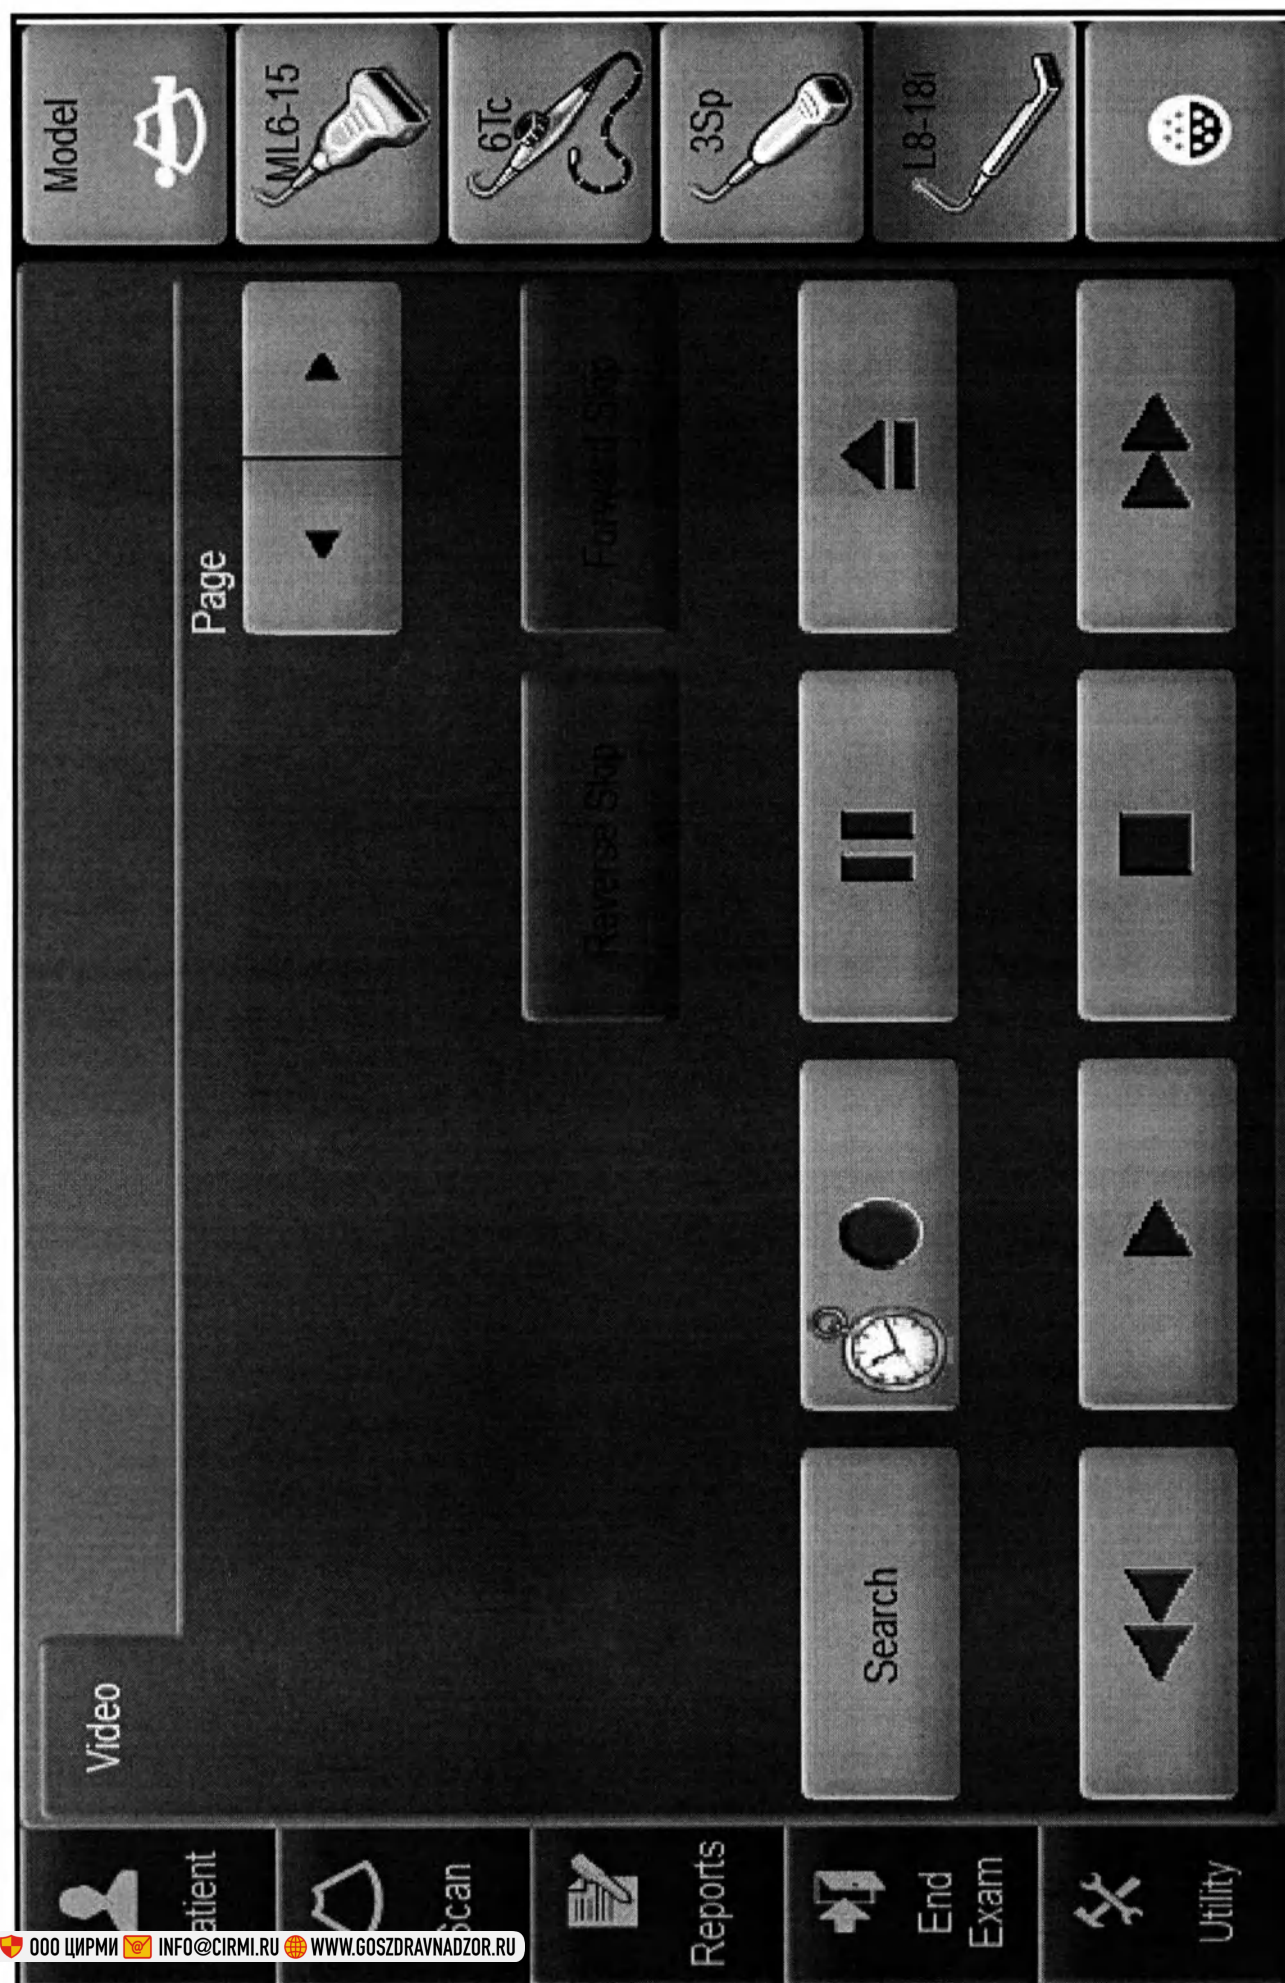




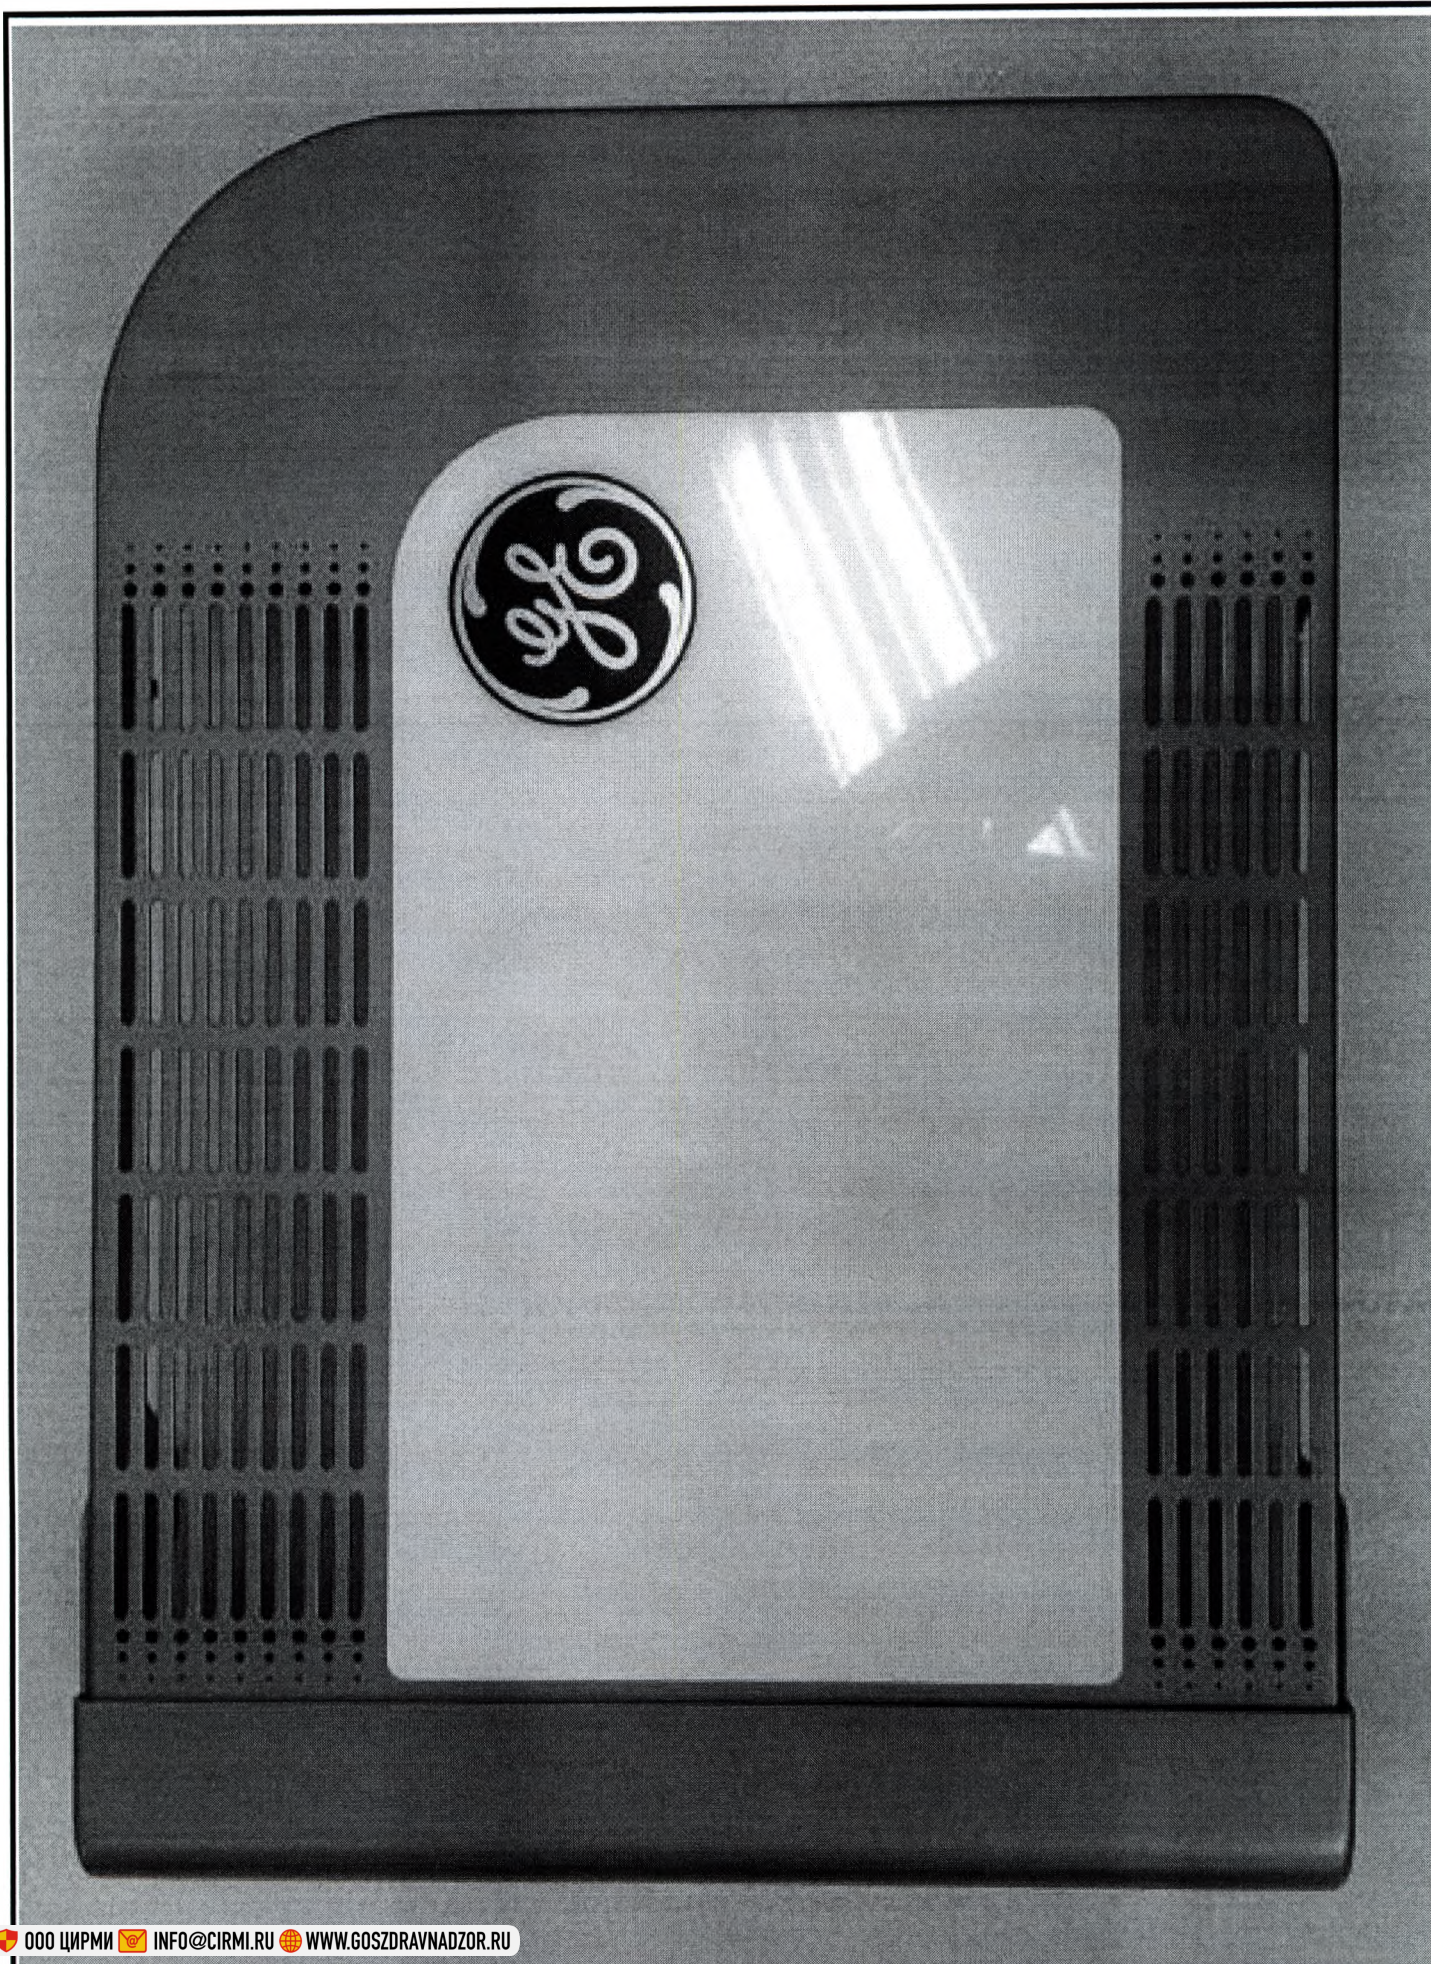


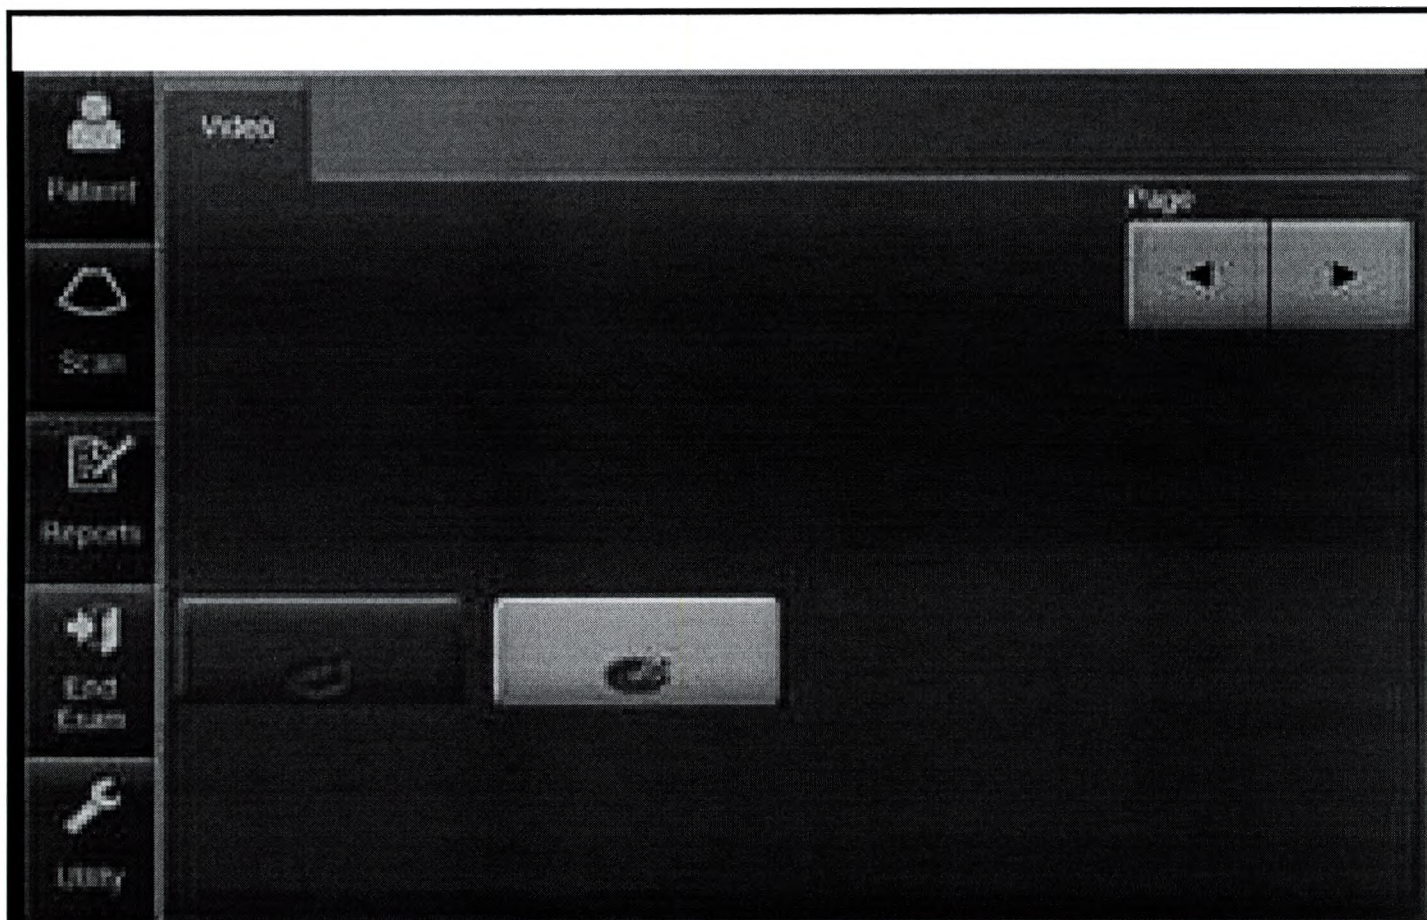




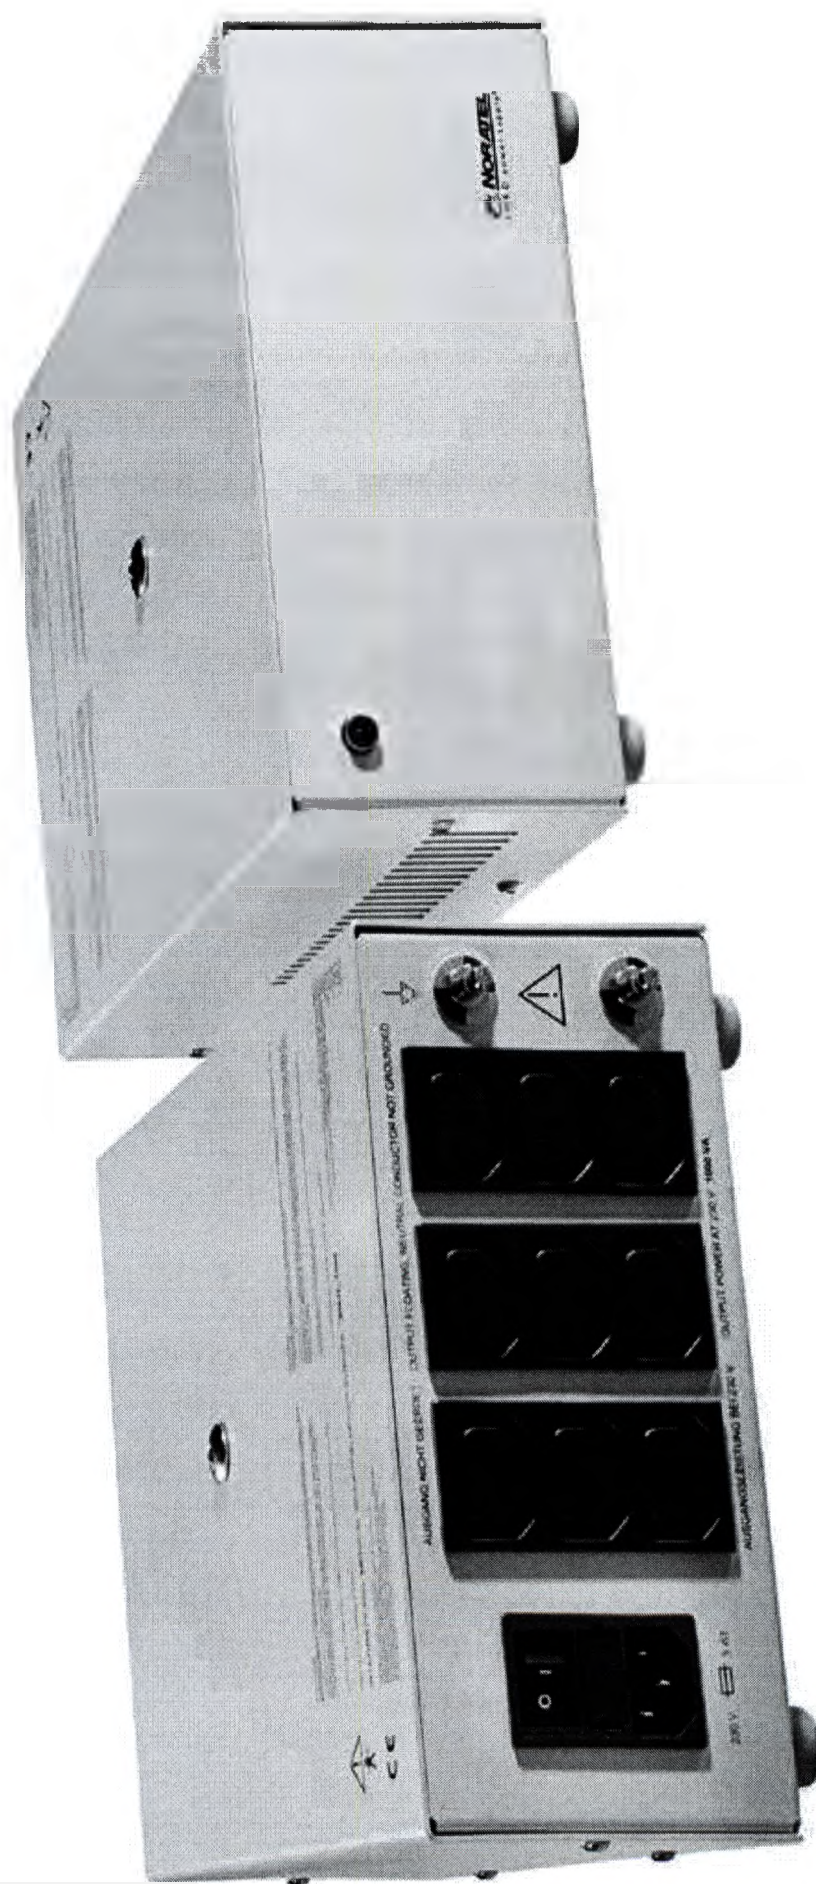




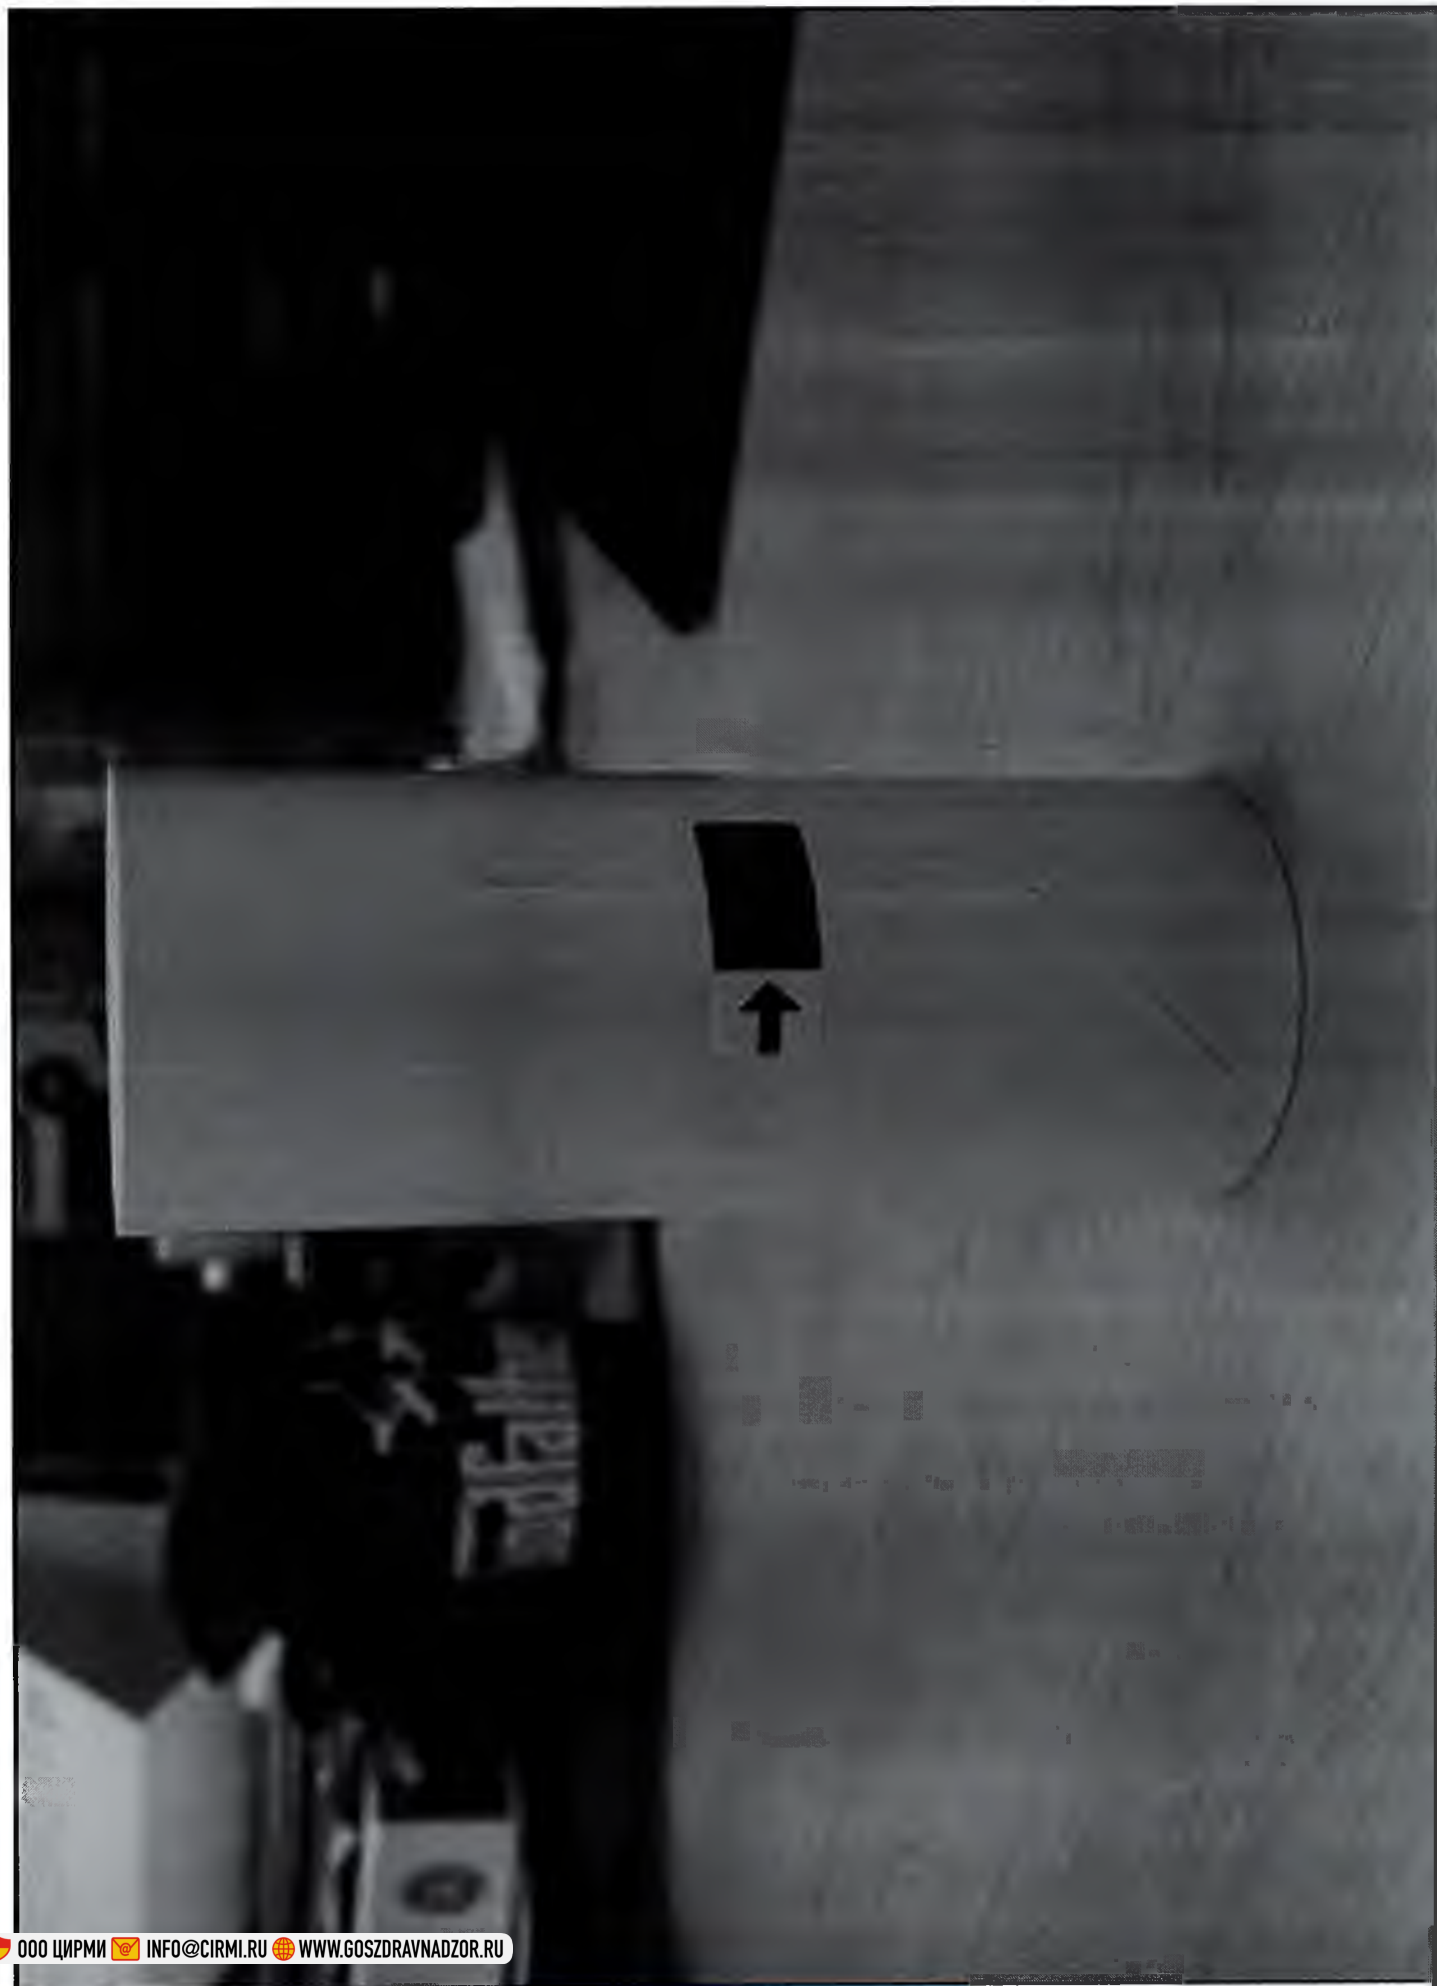




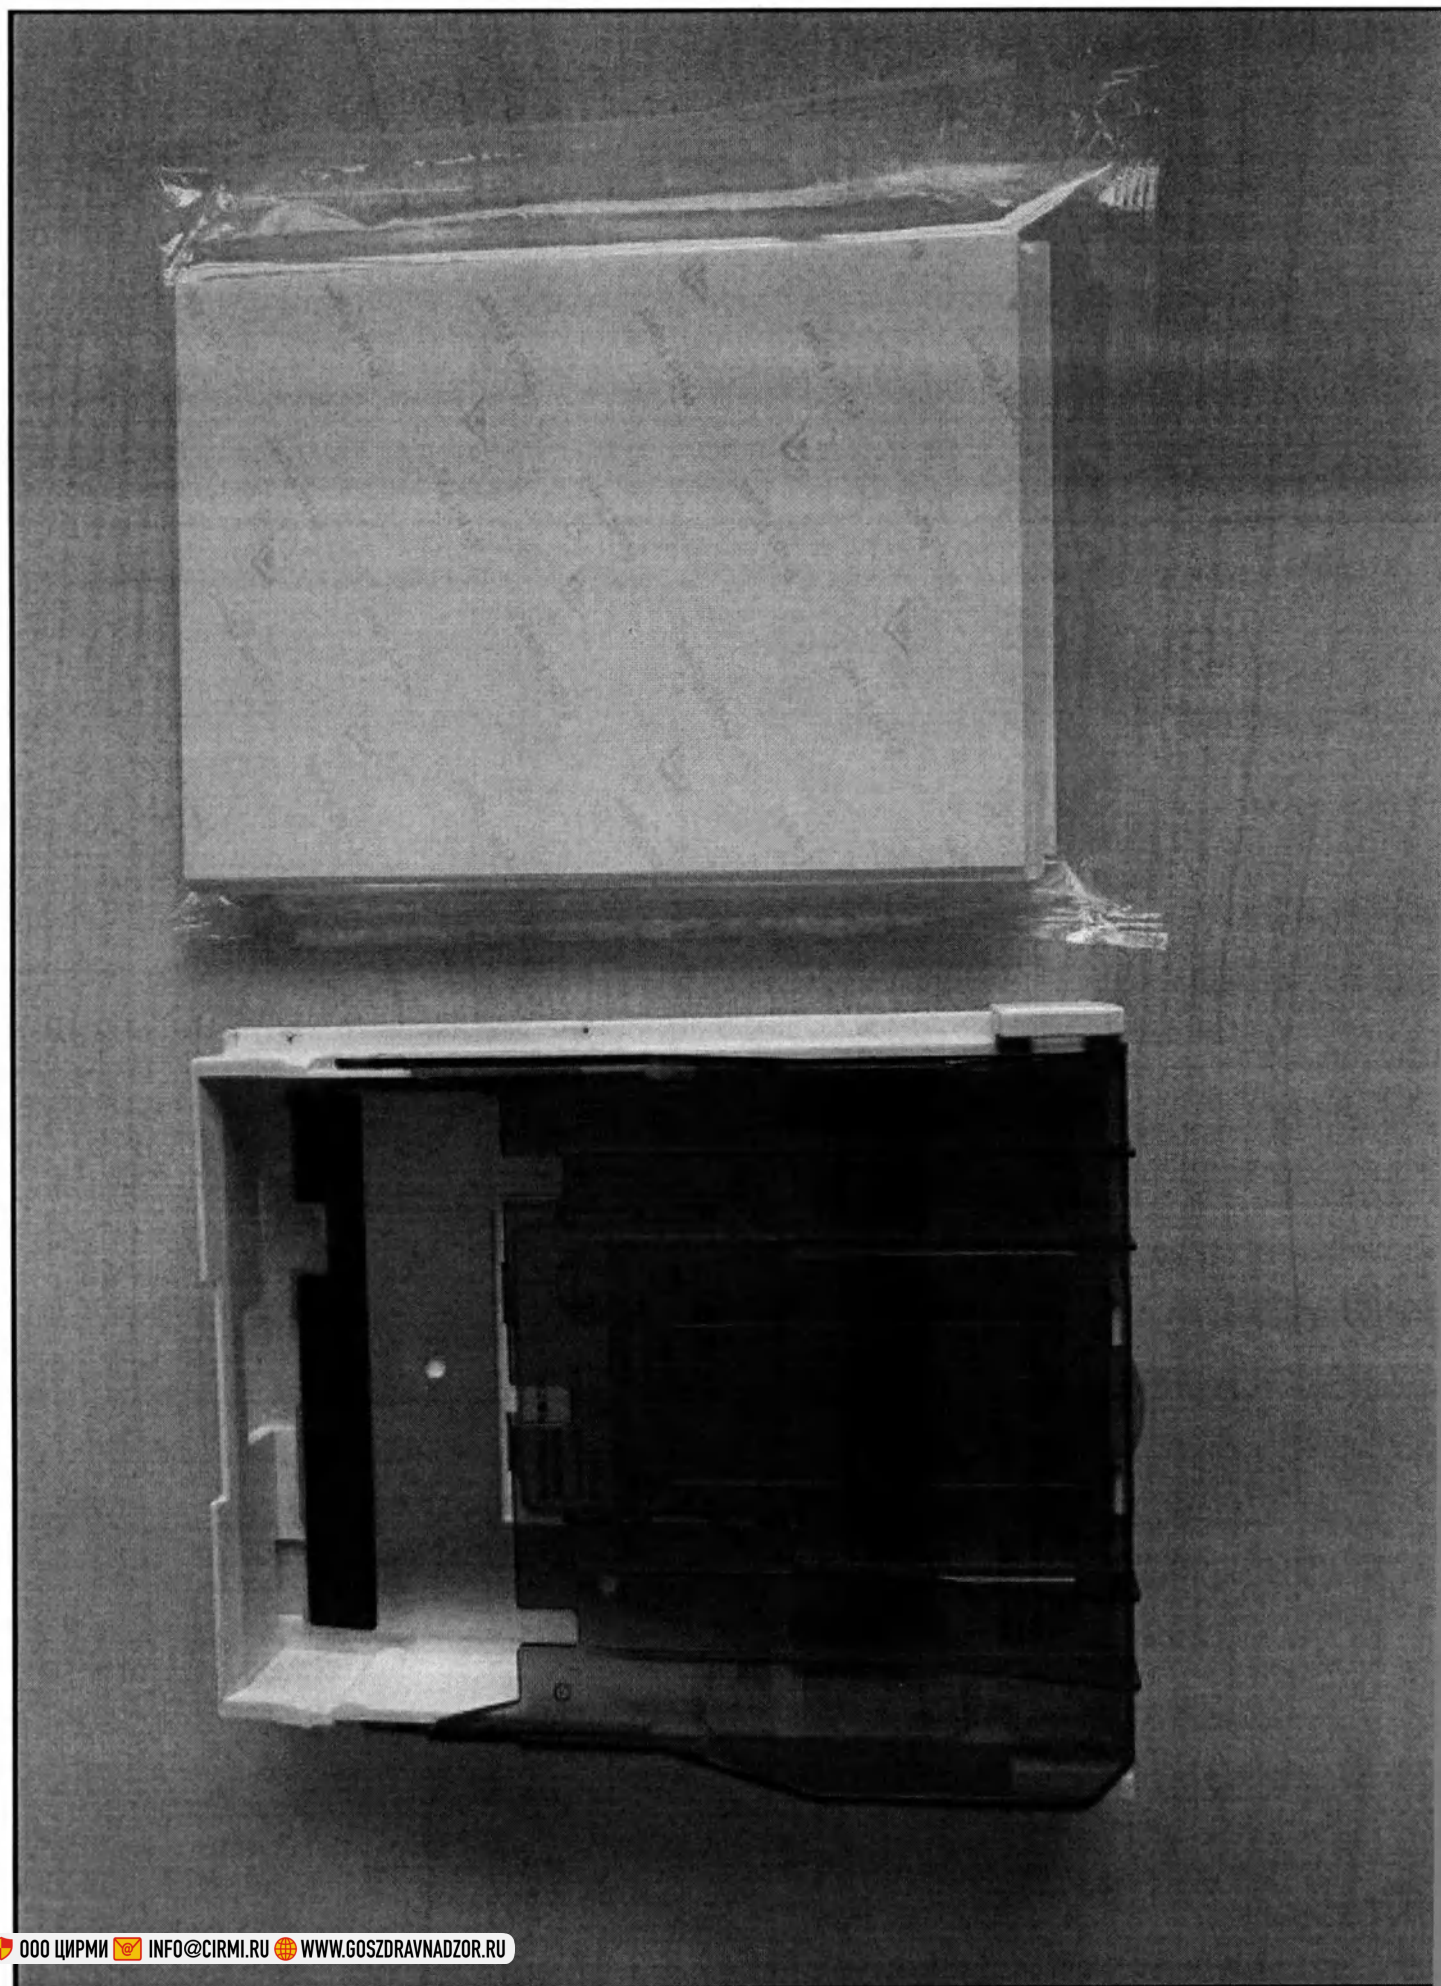

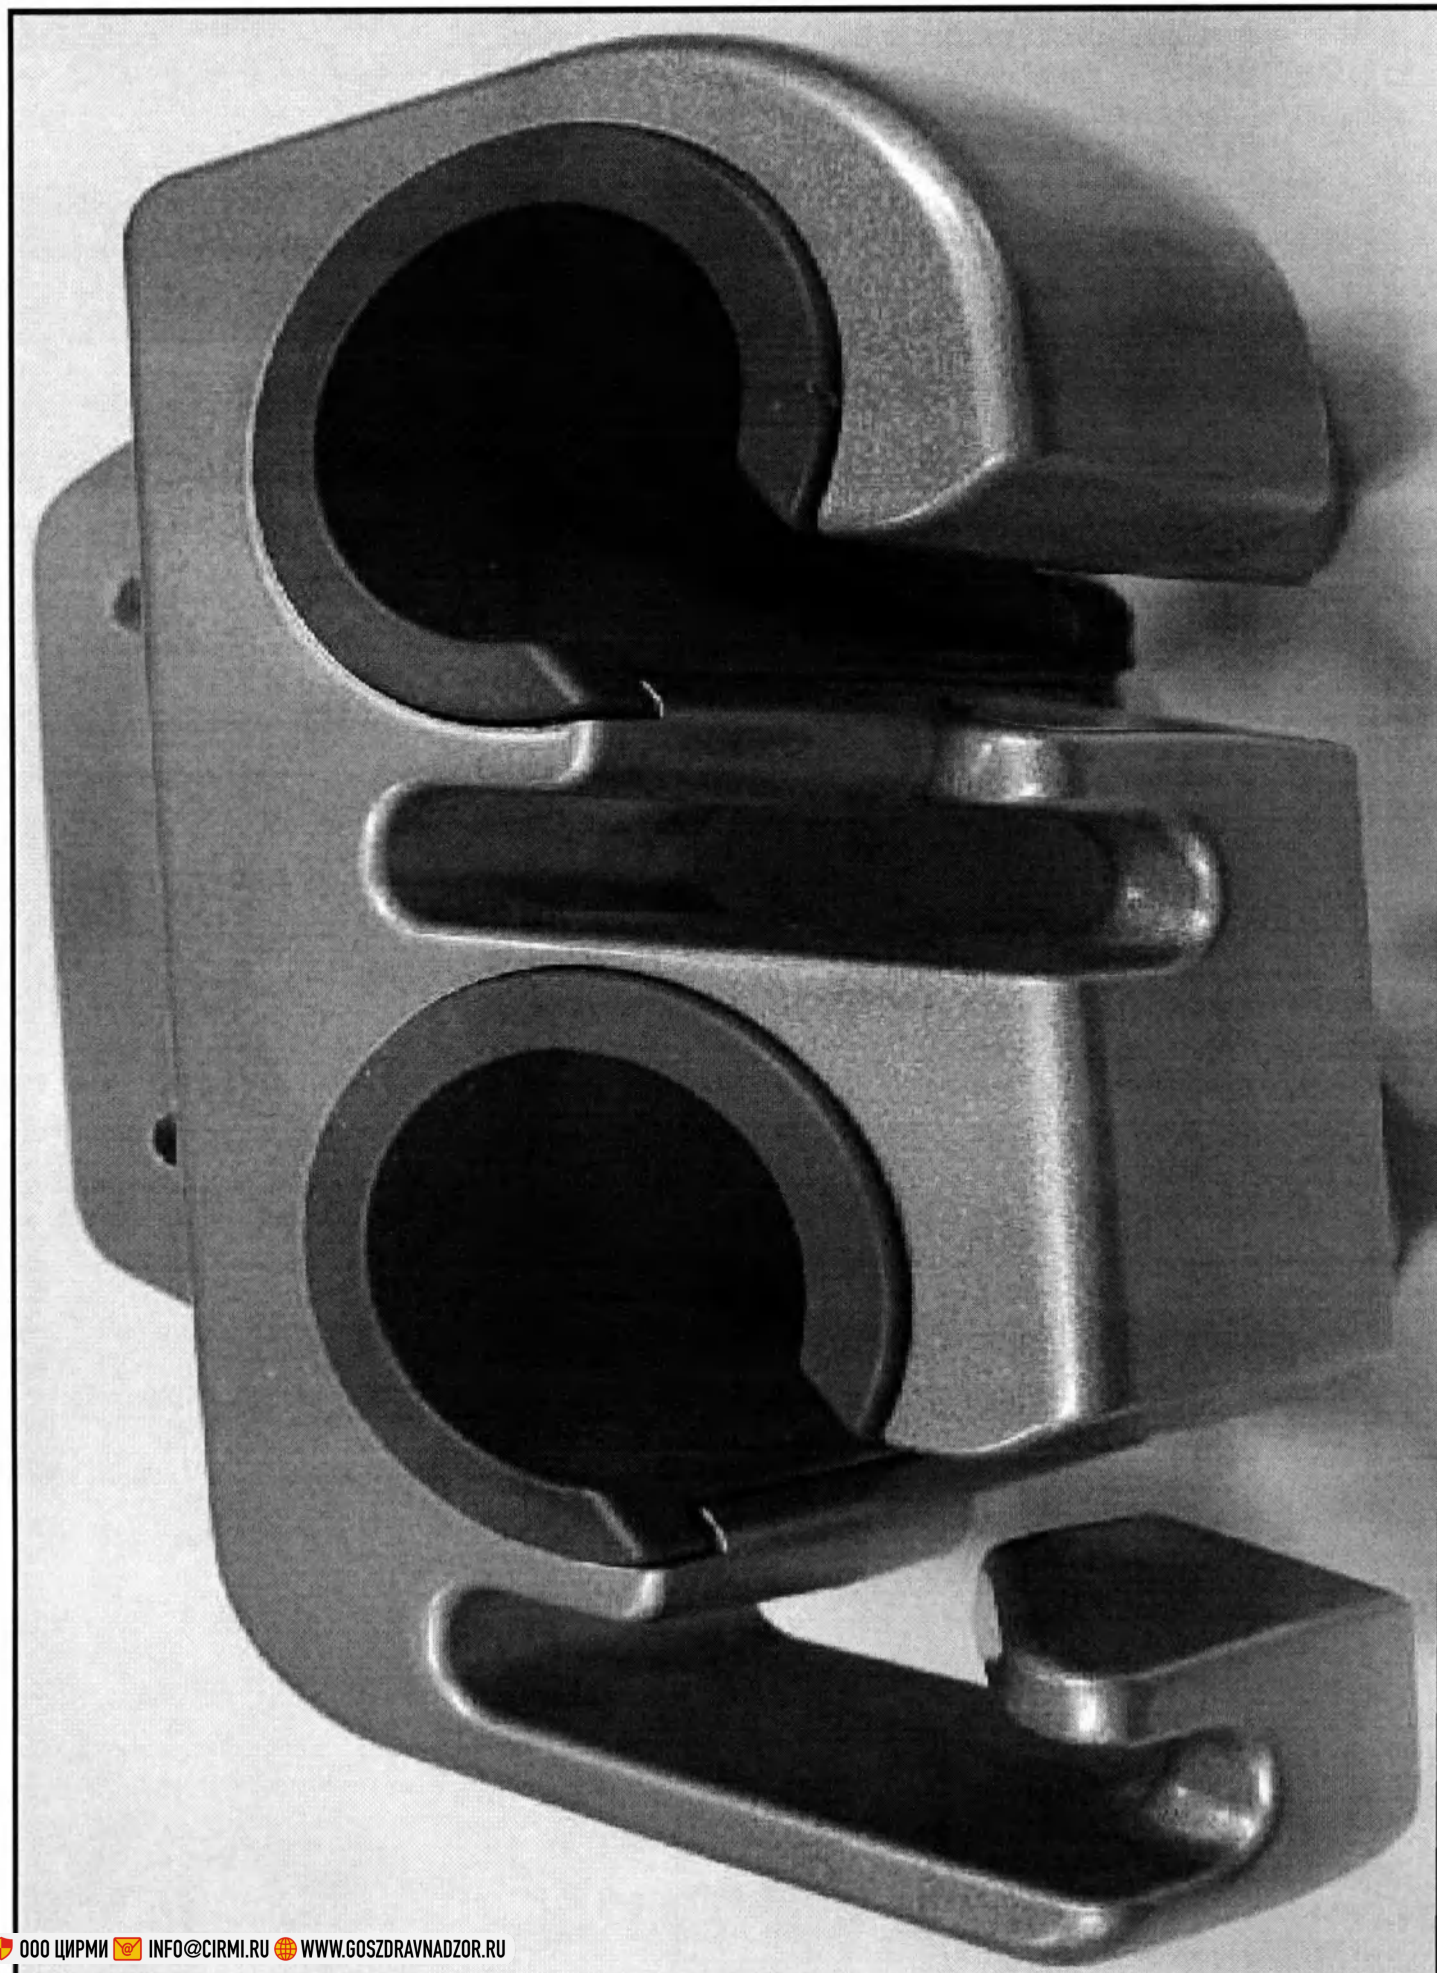




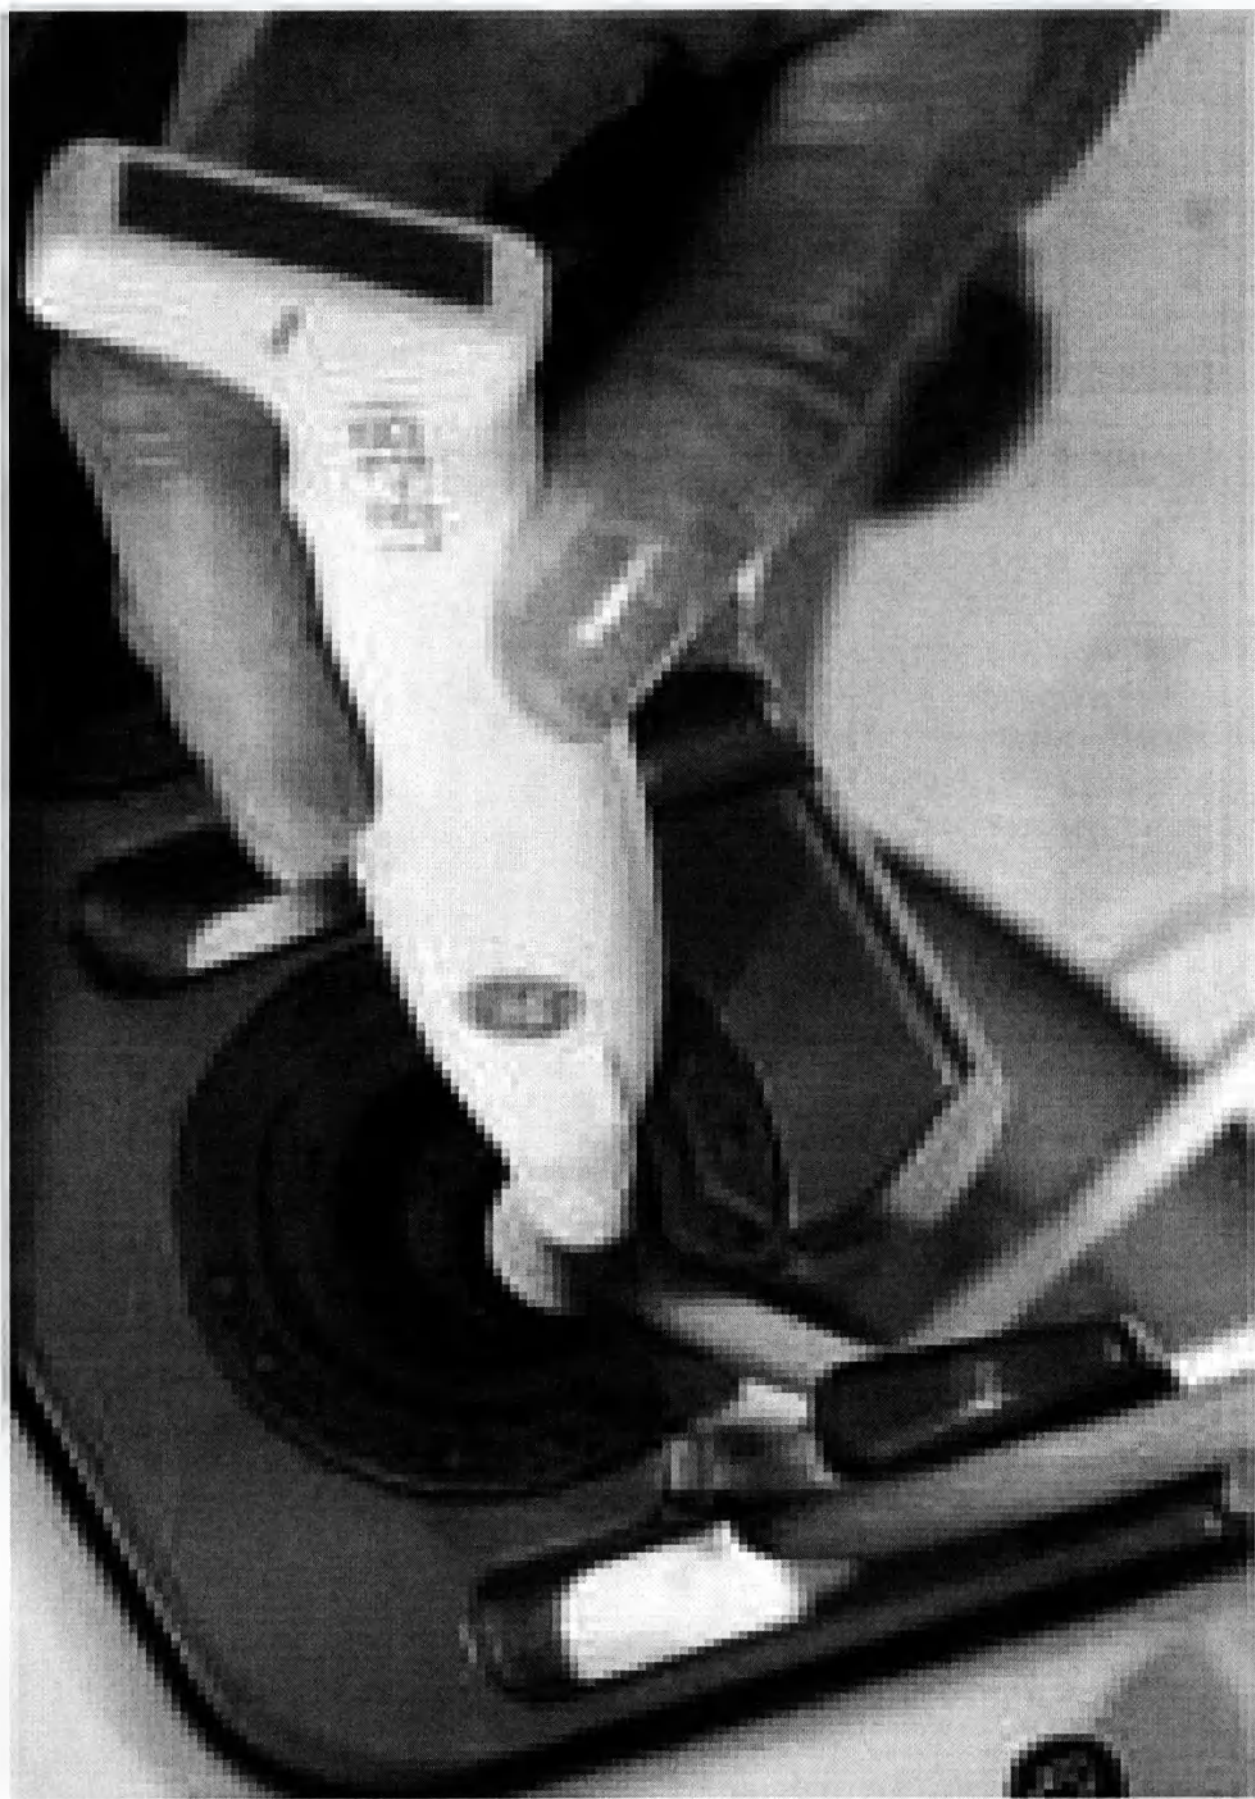








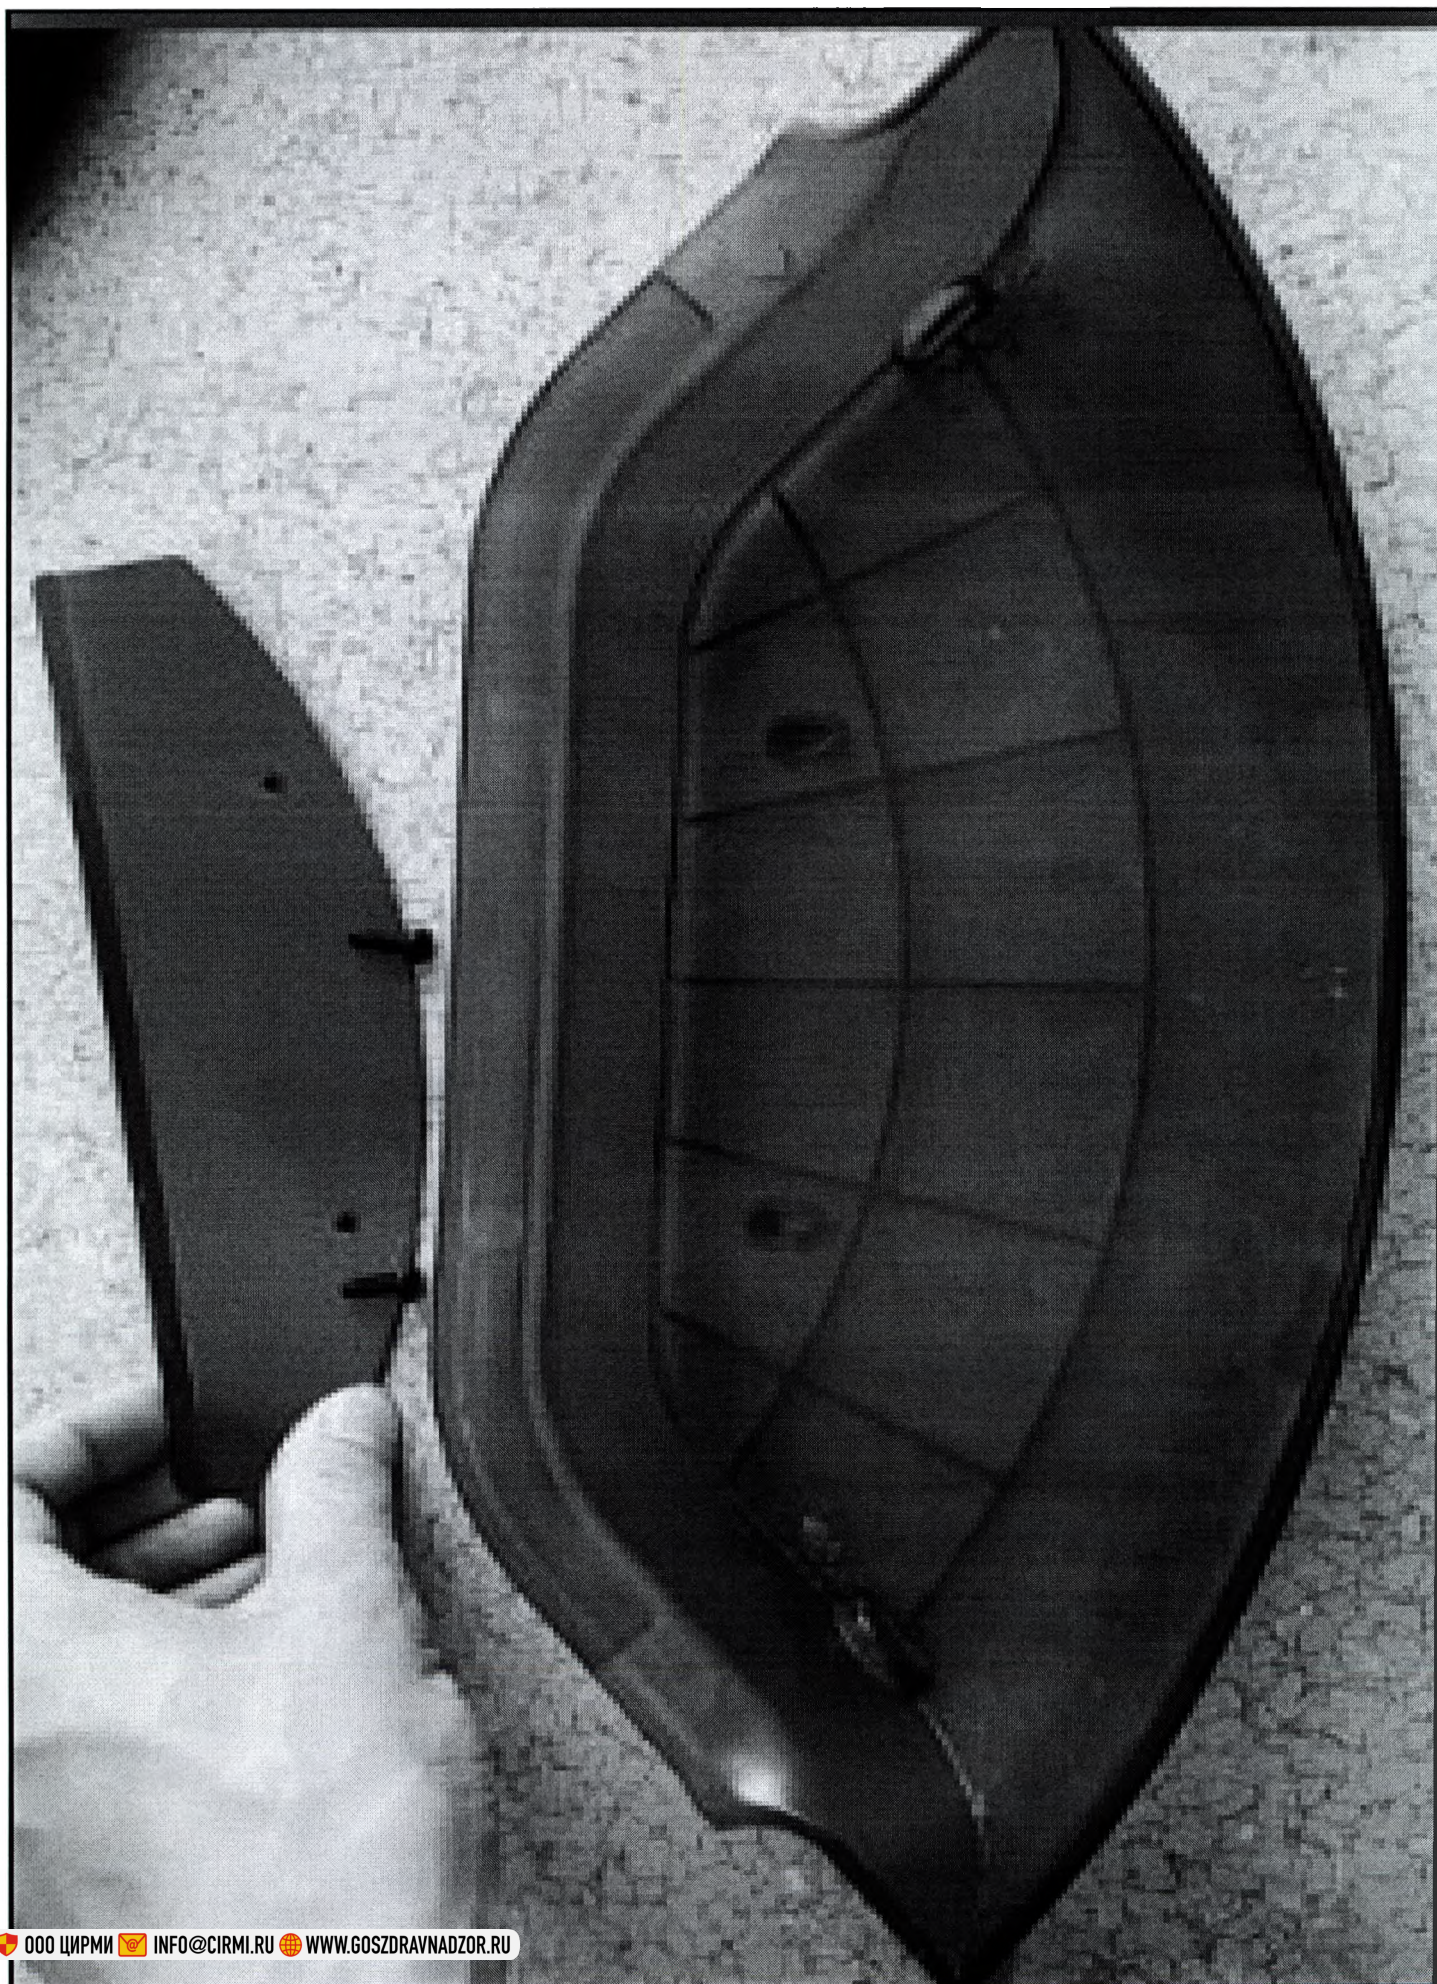



Rear handle

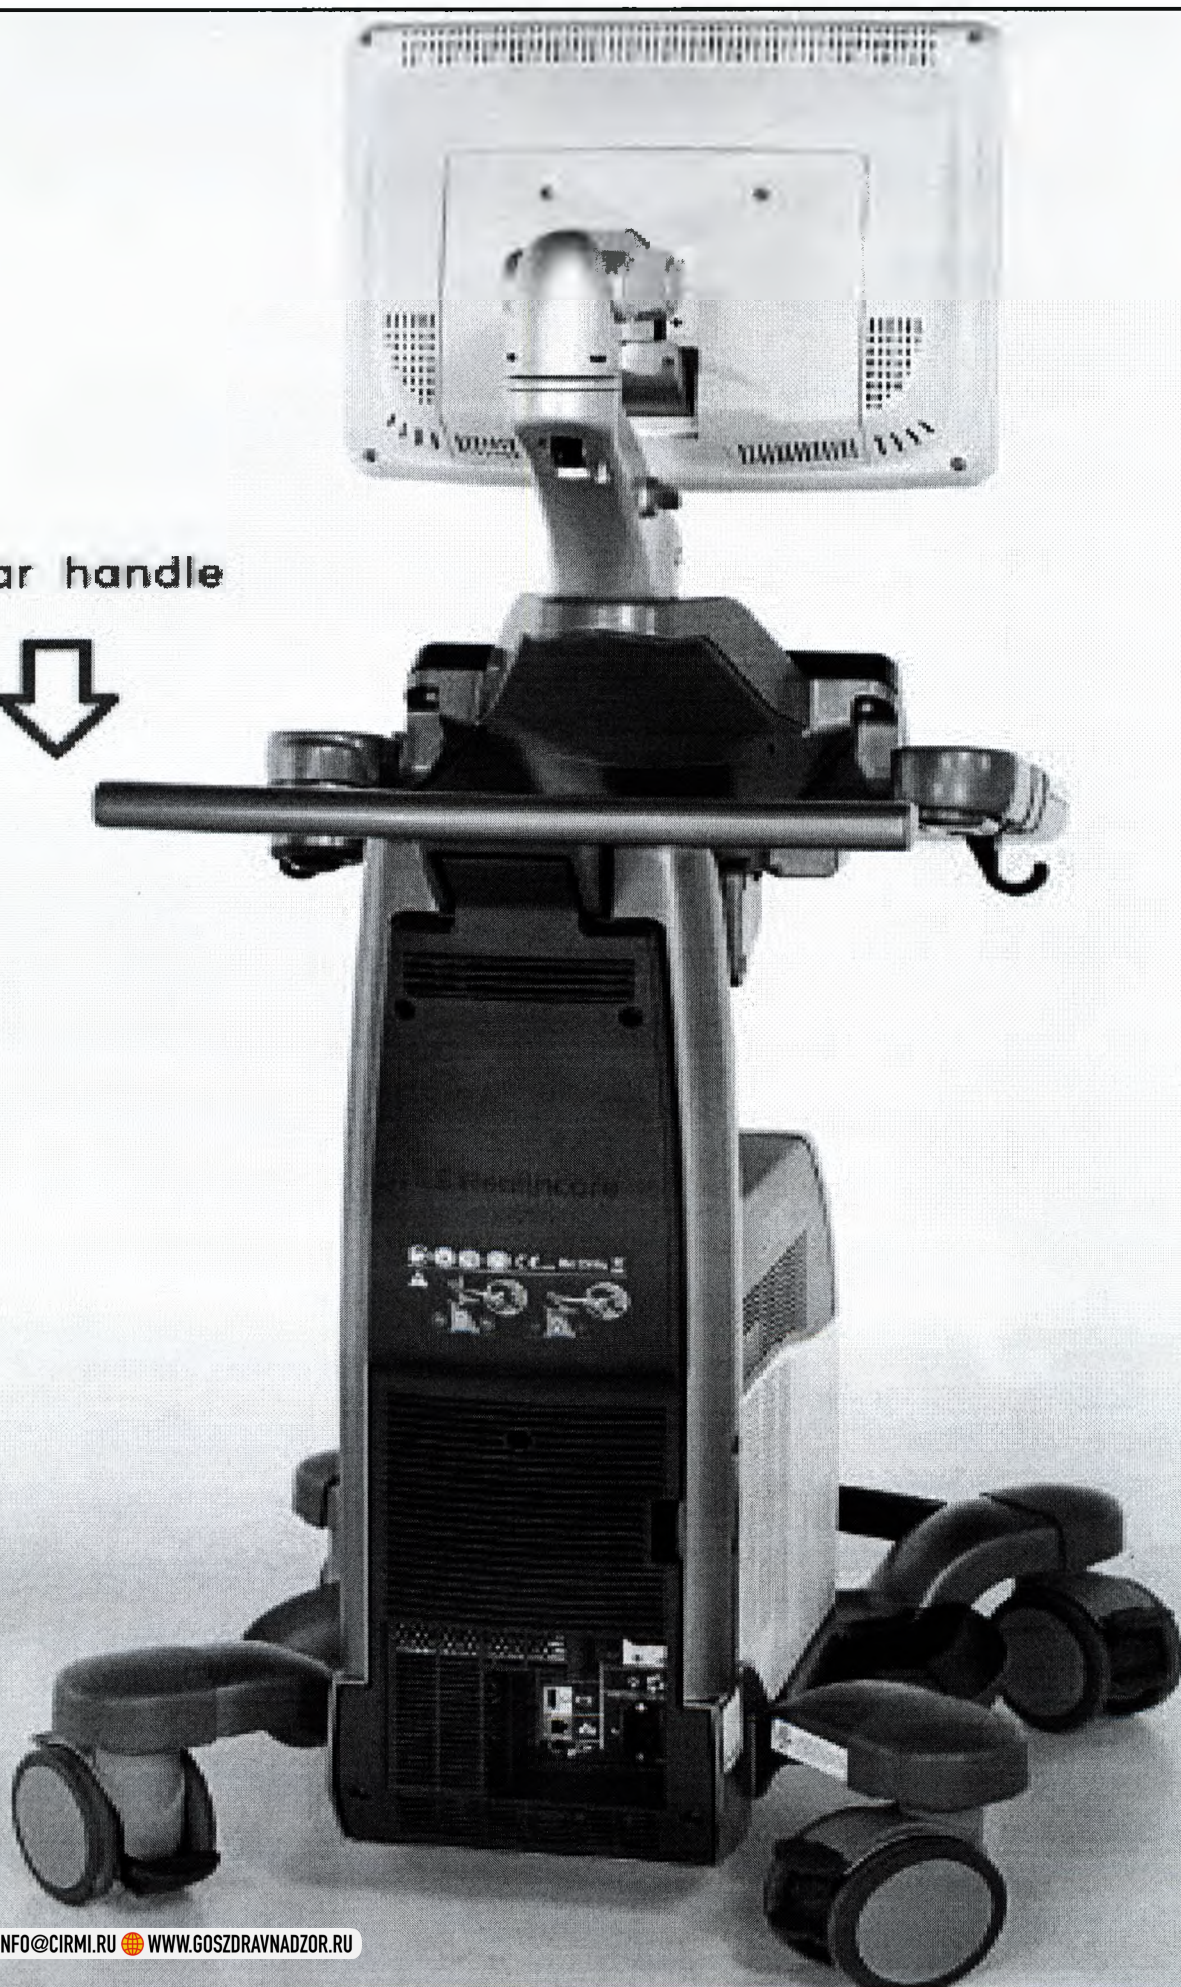













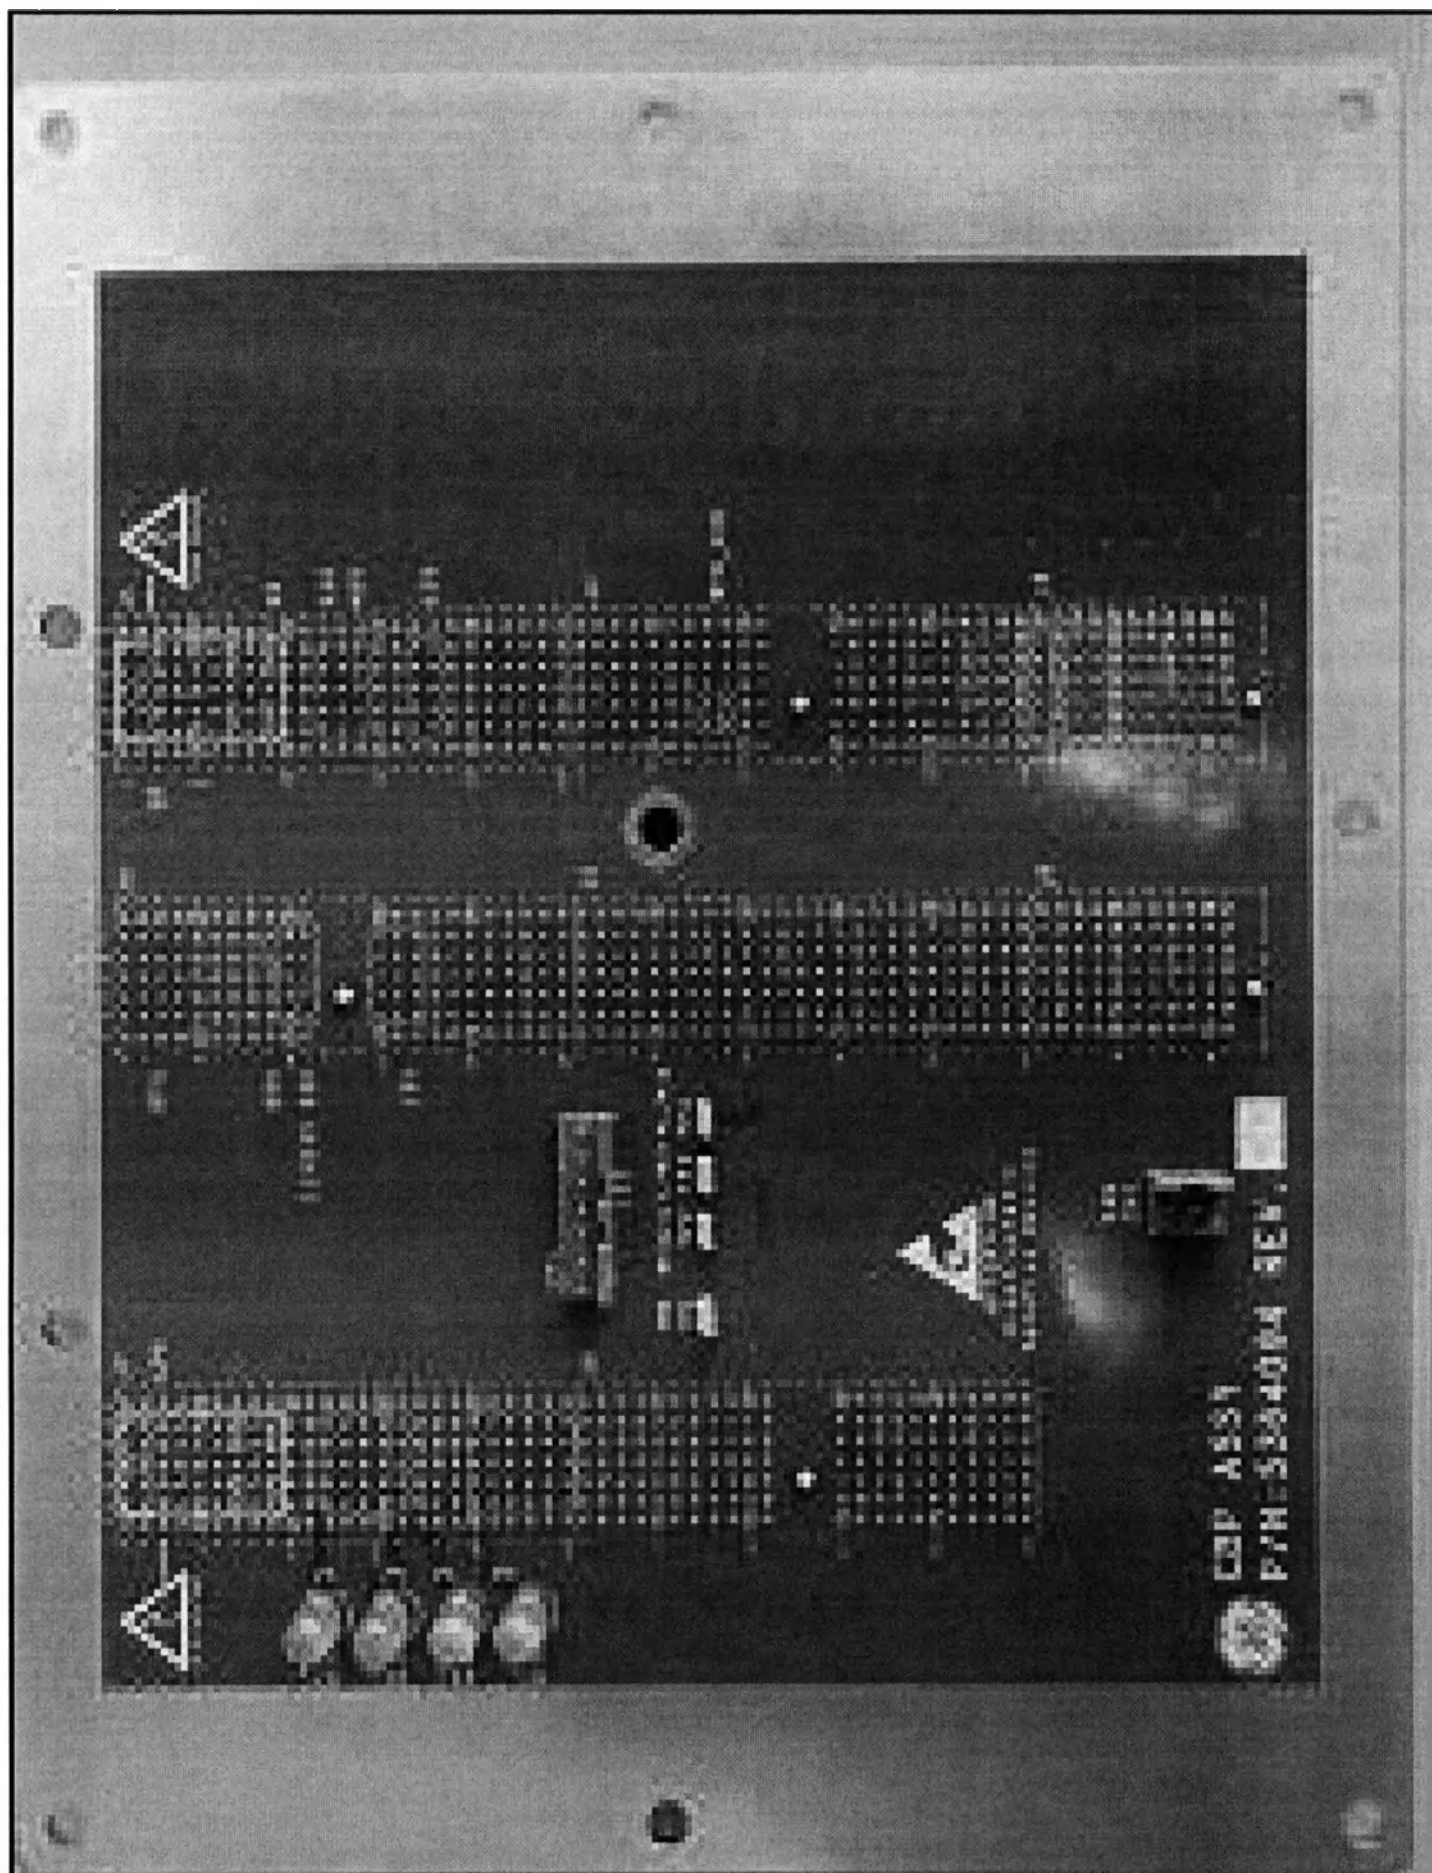



QBP ASSY
P/N: 5204004 REV.



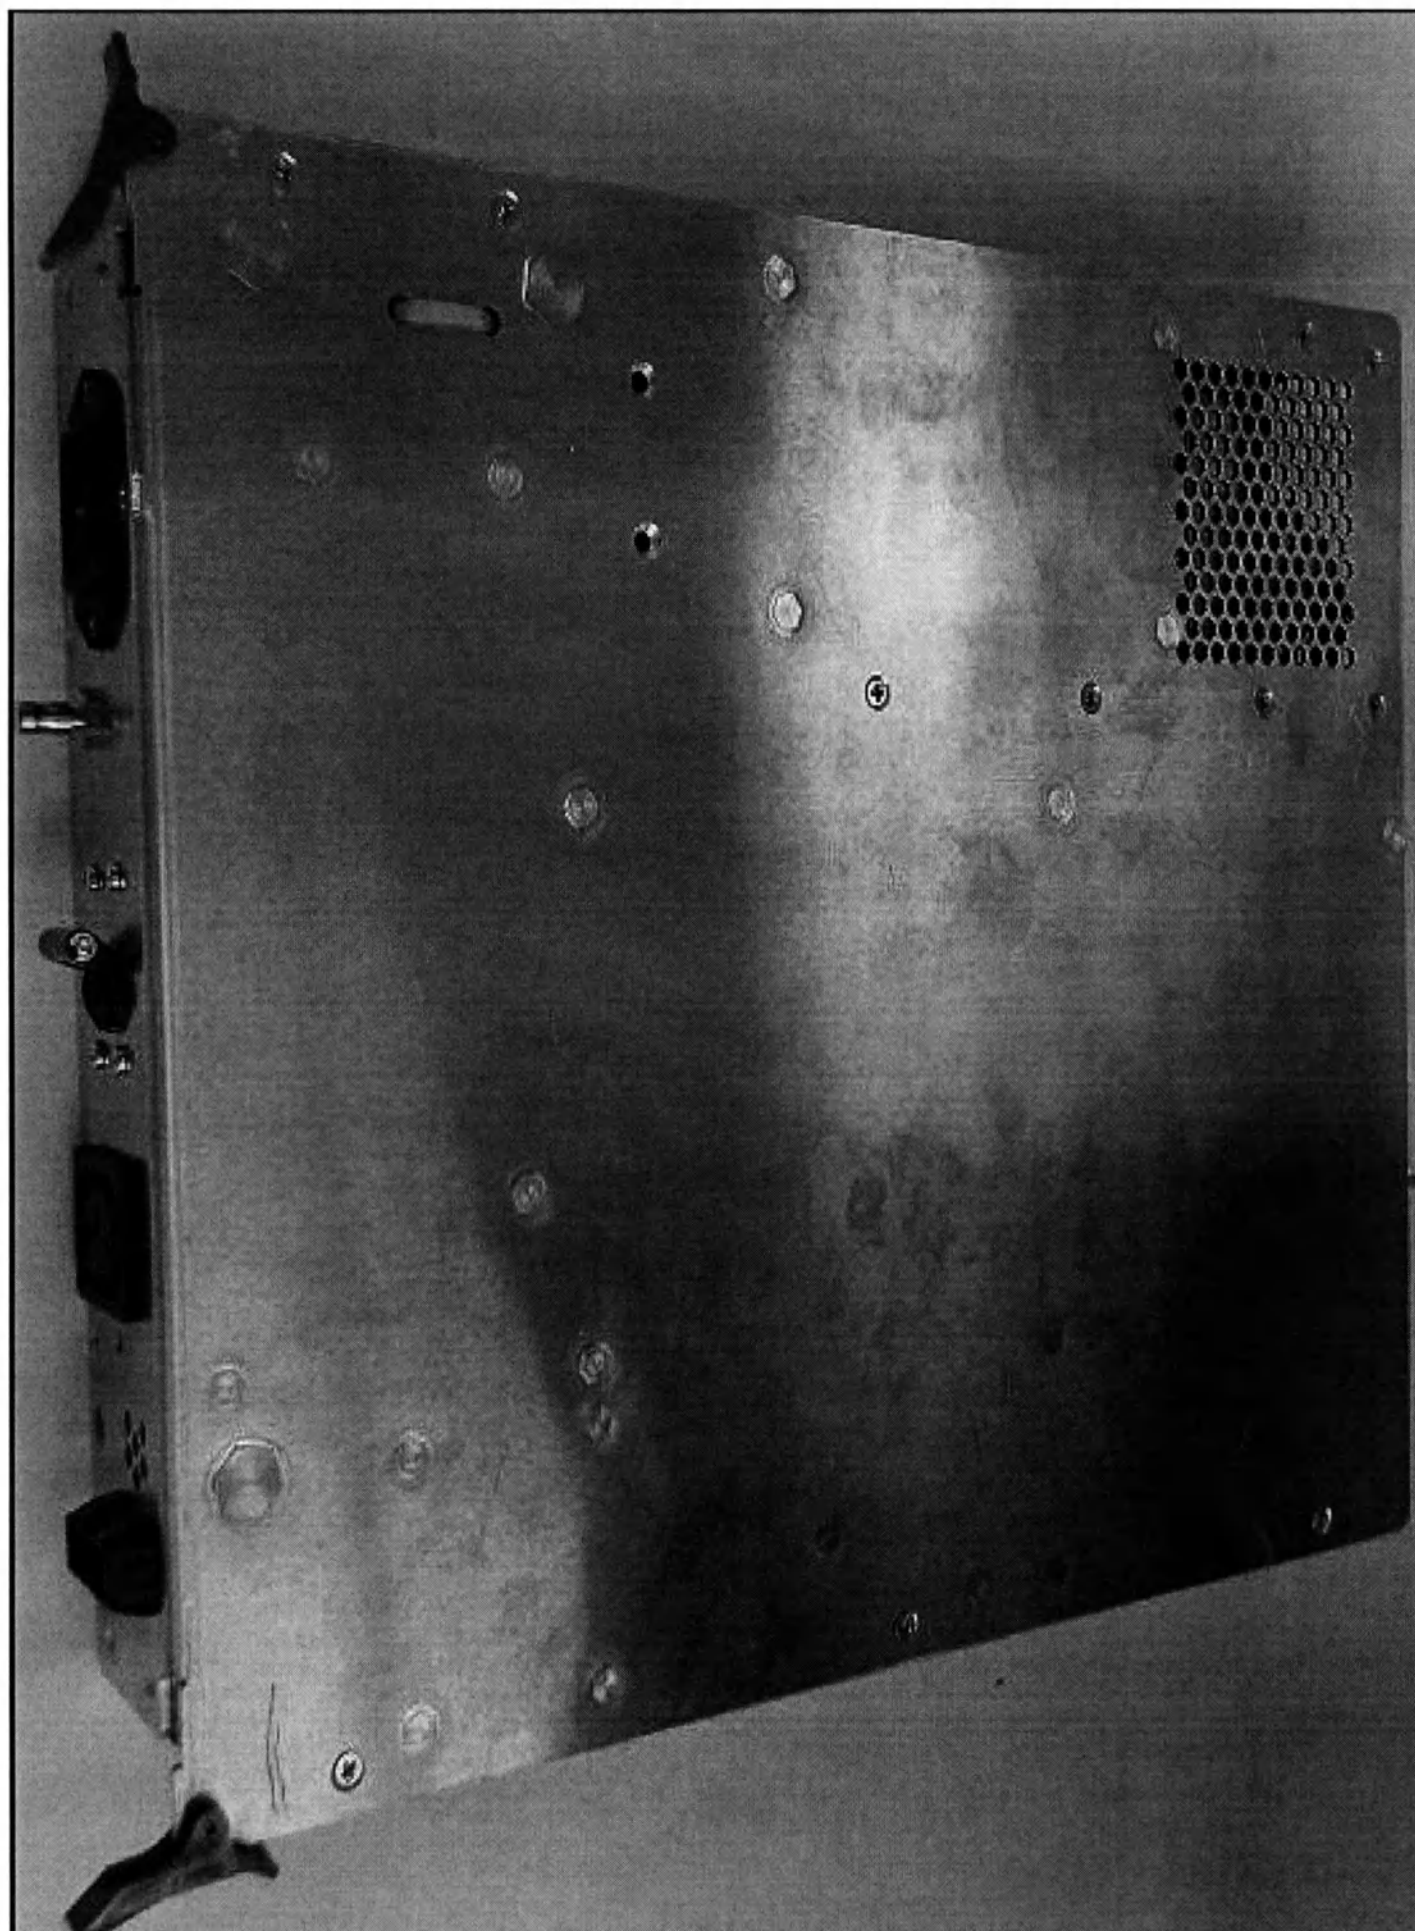


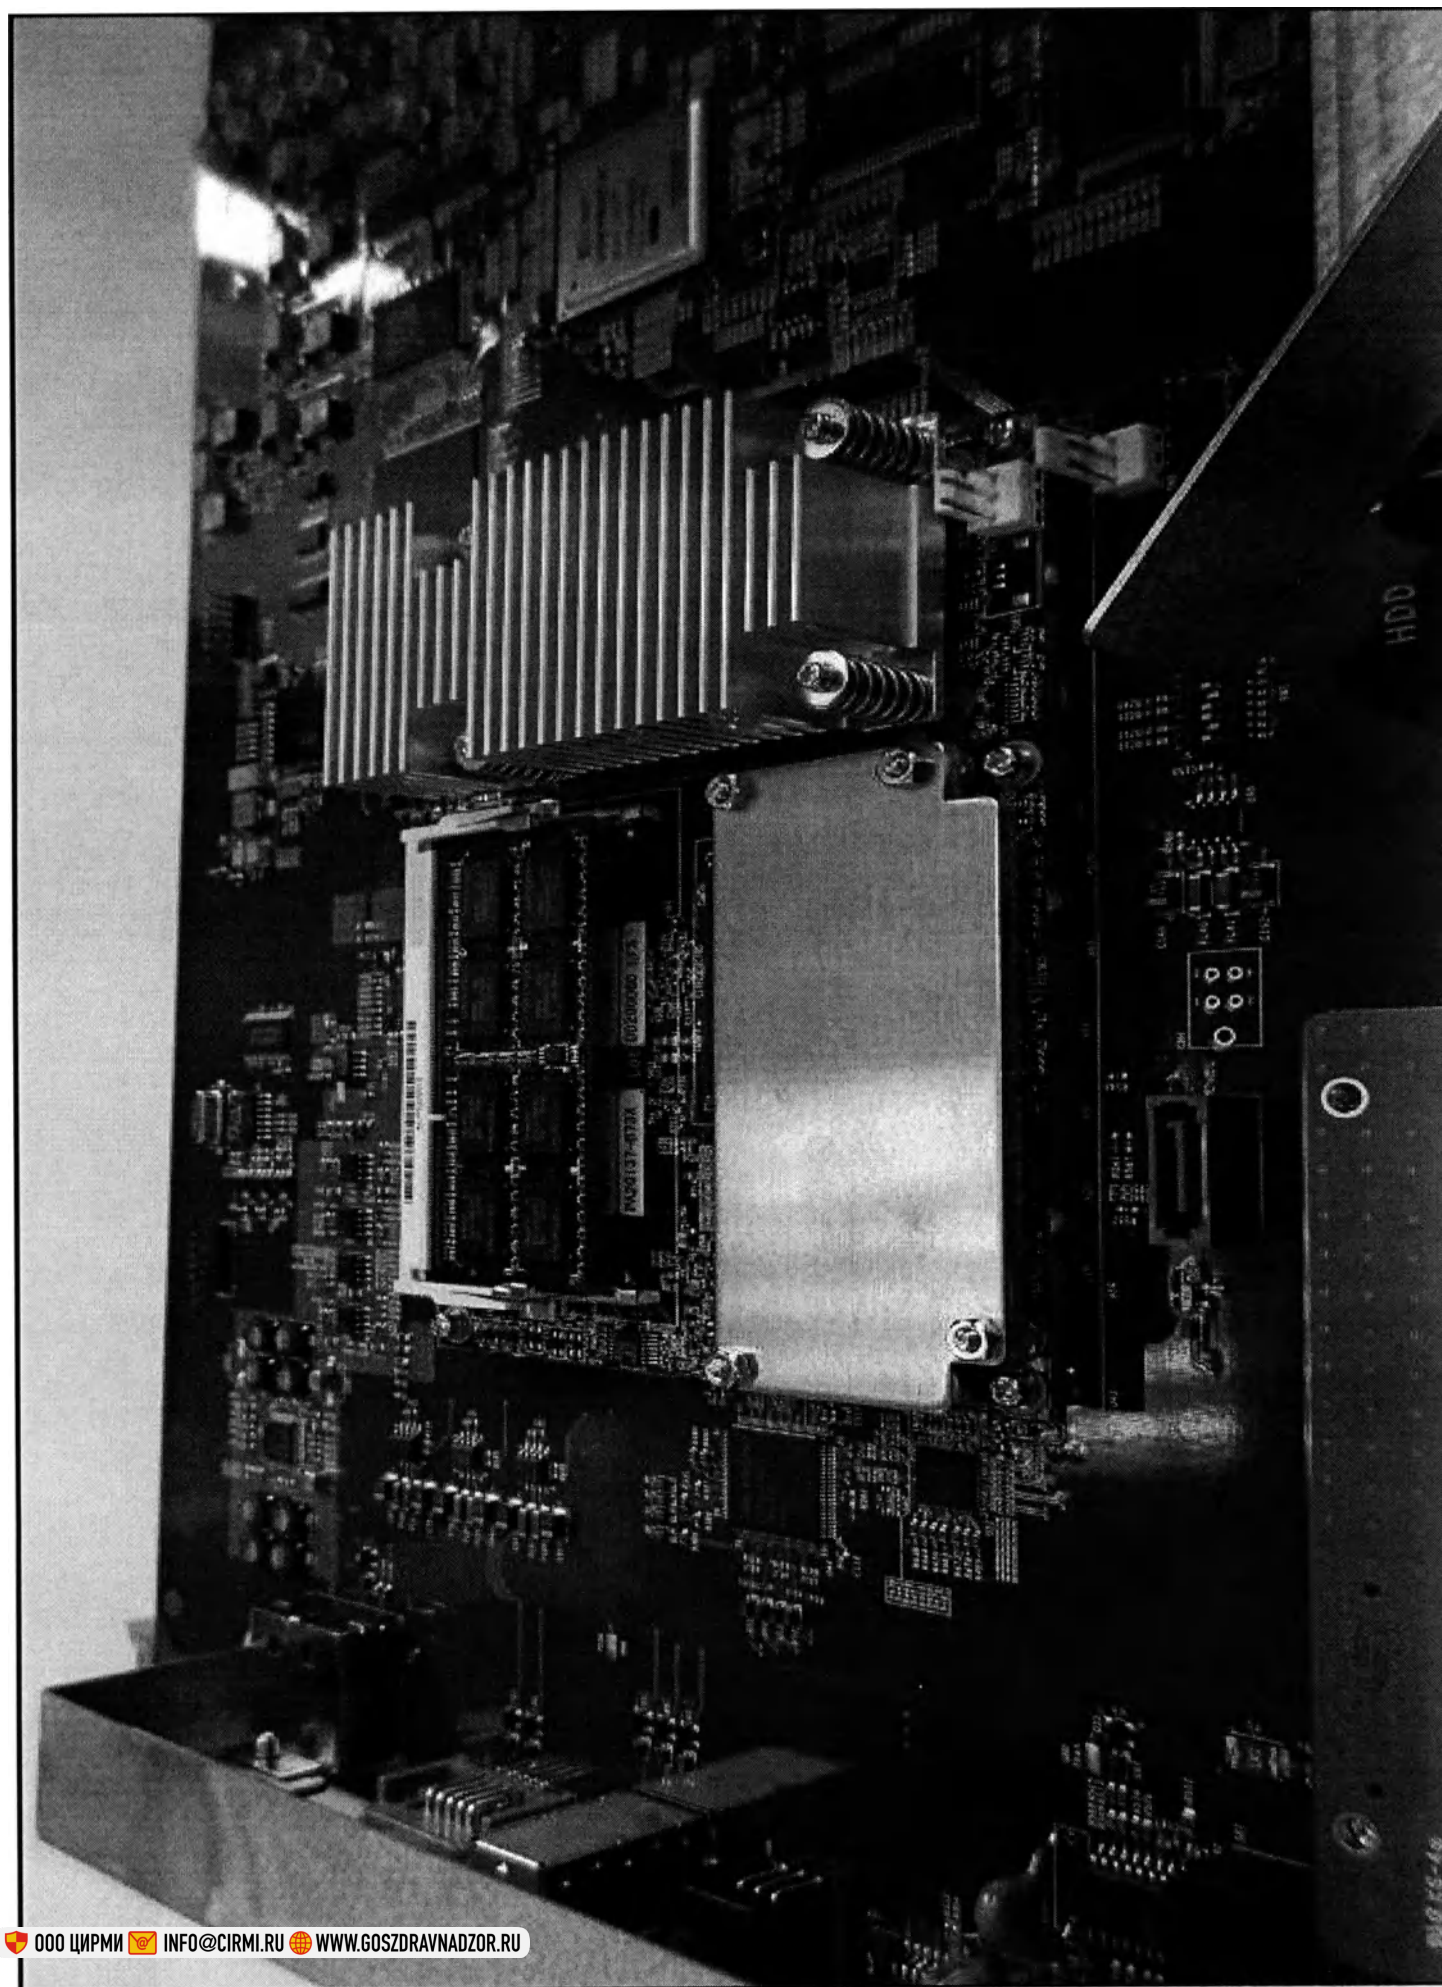


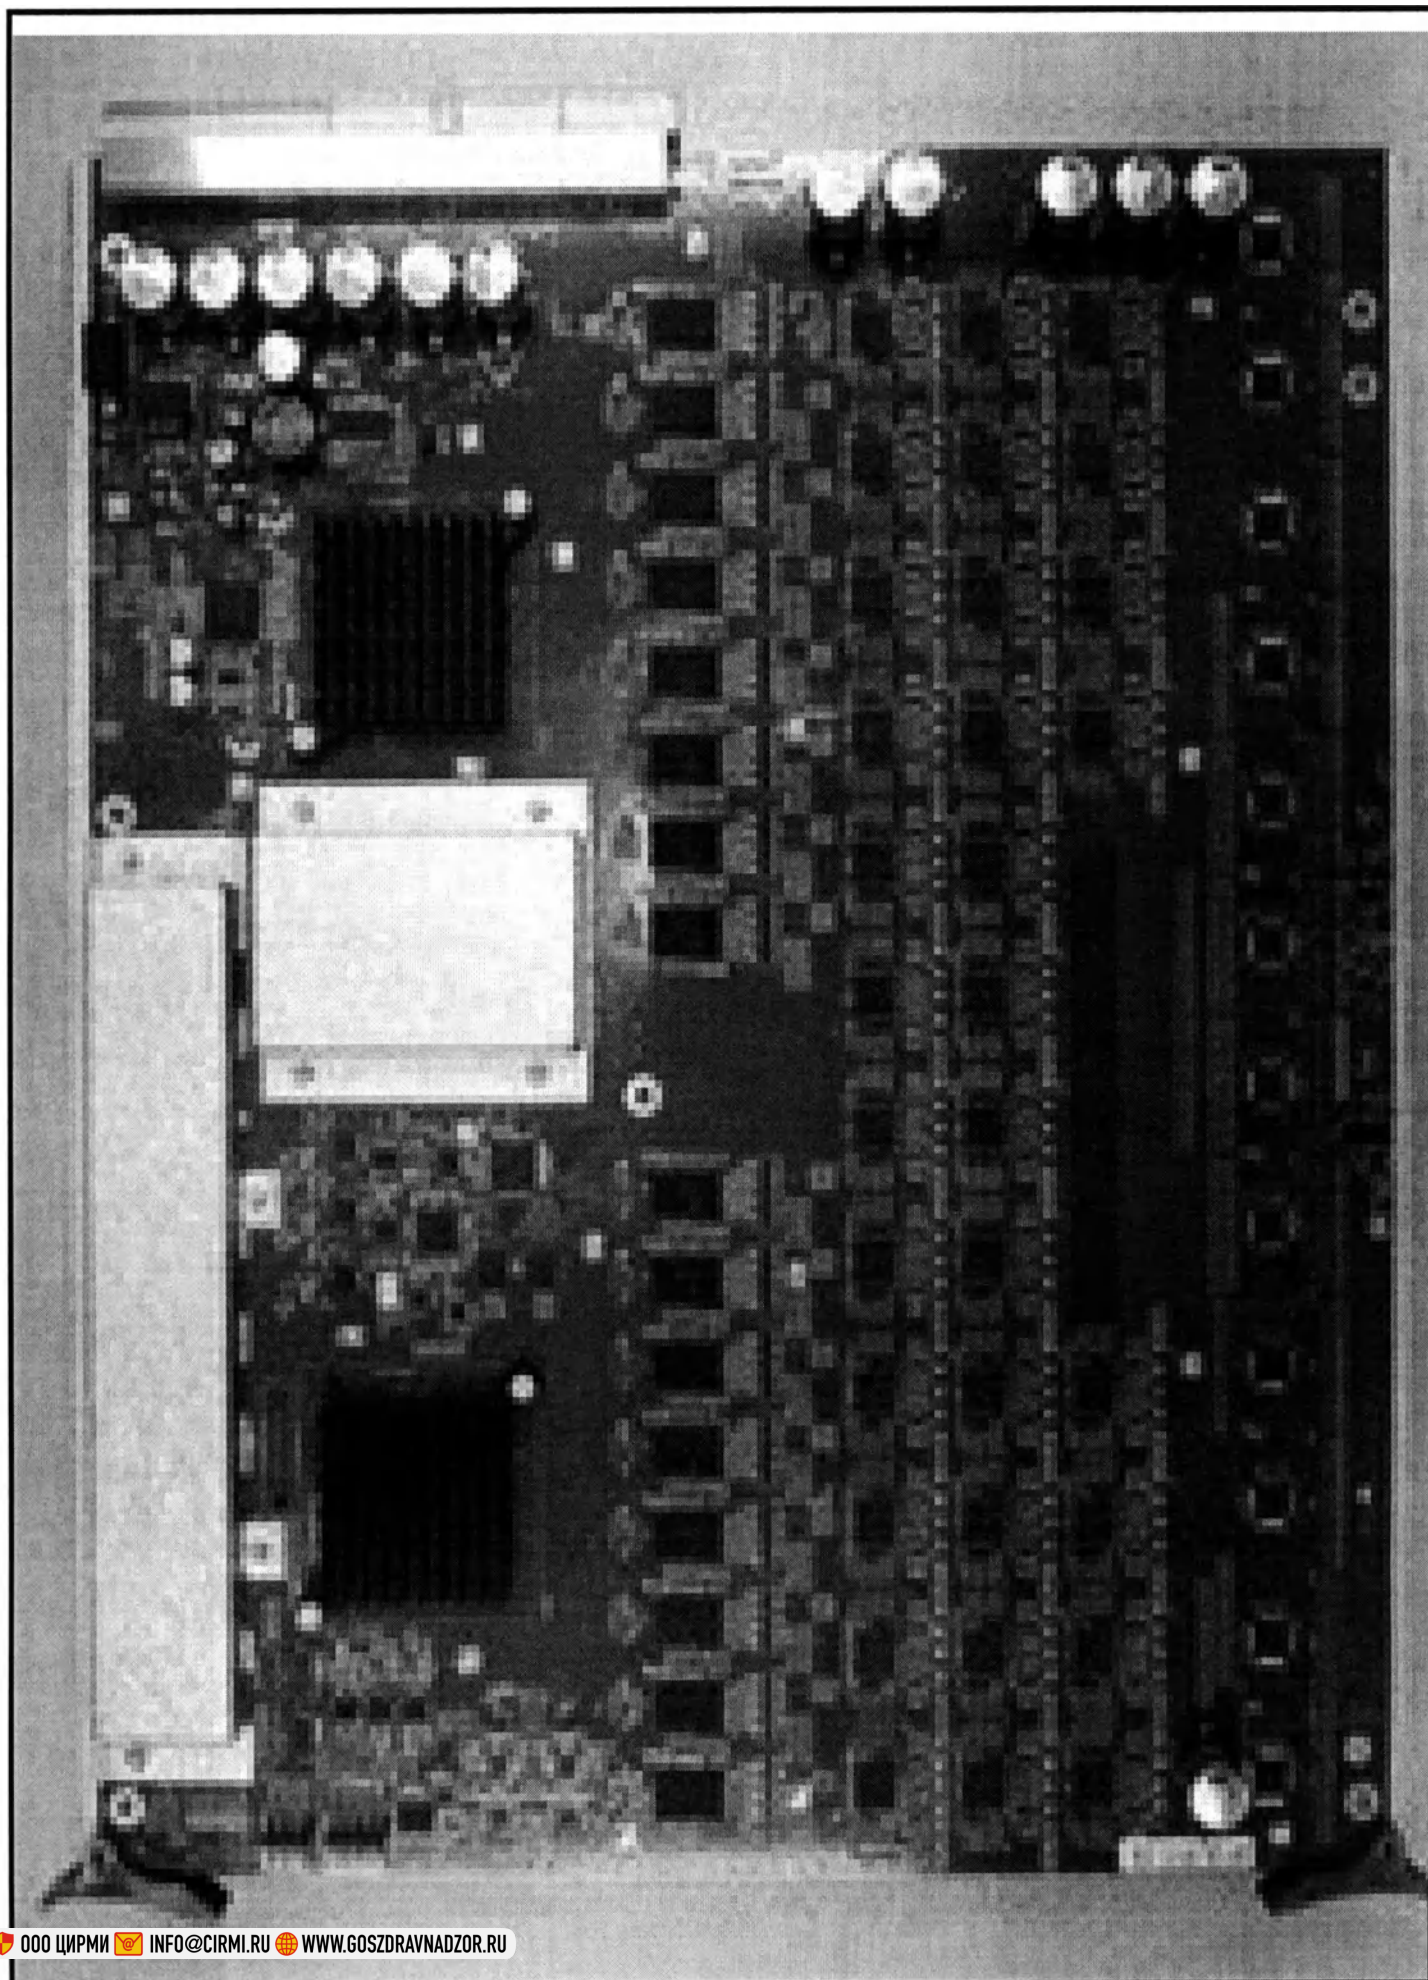

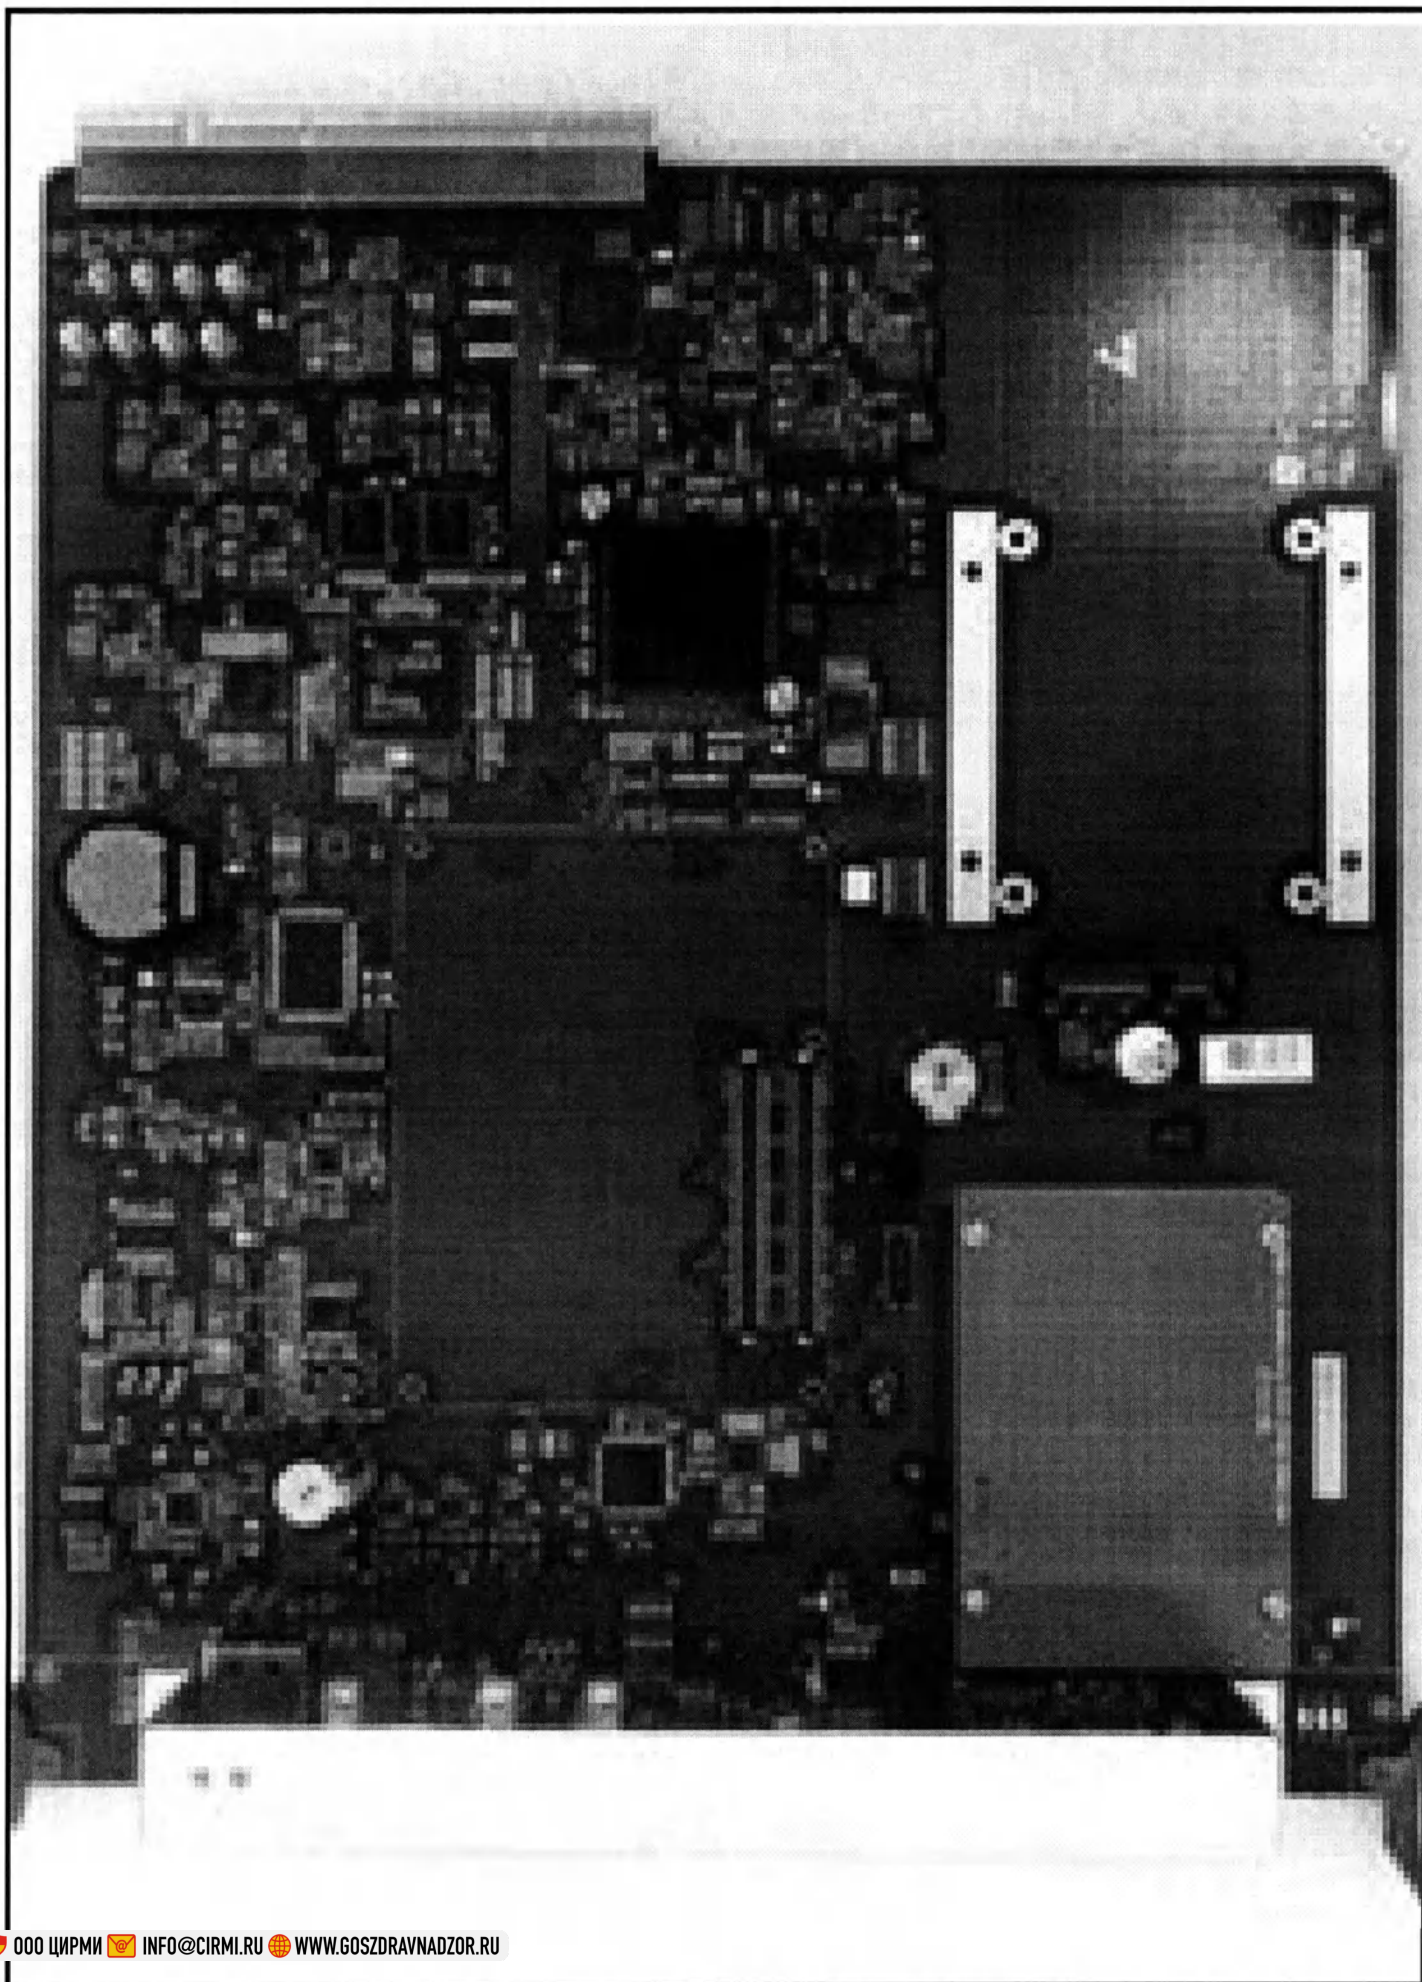


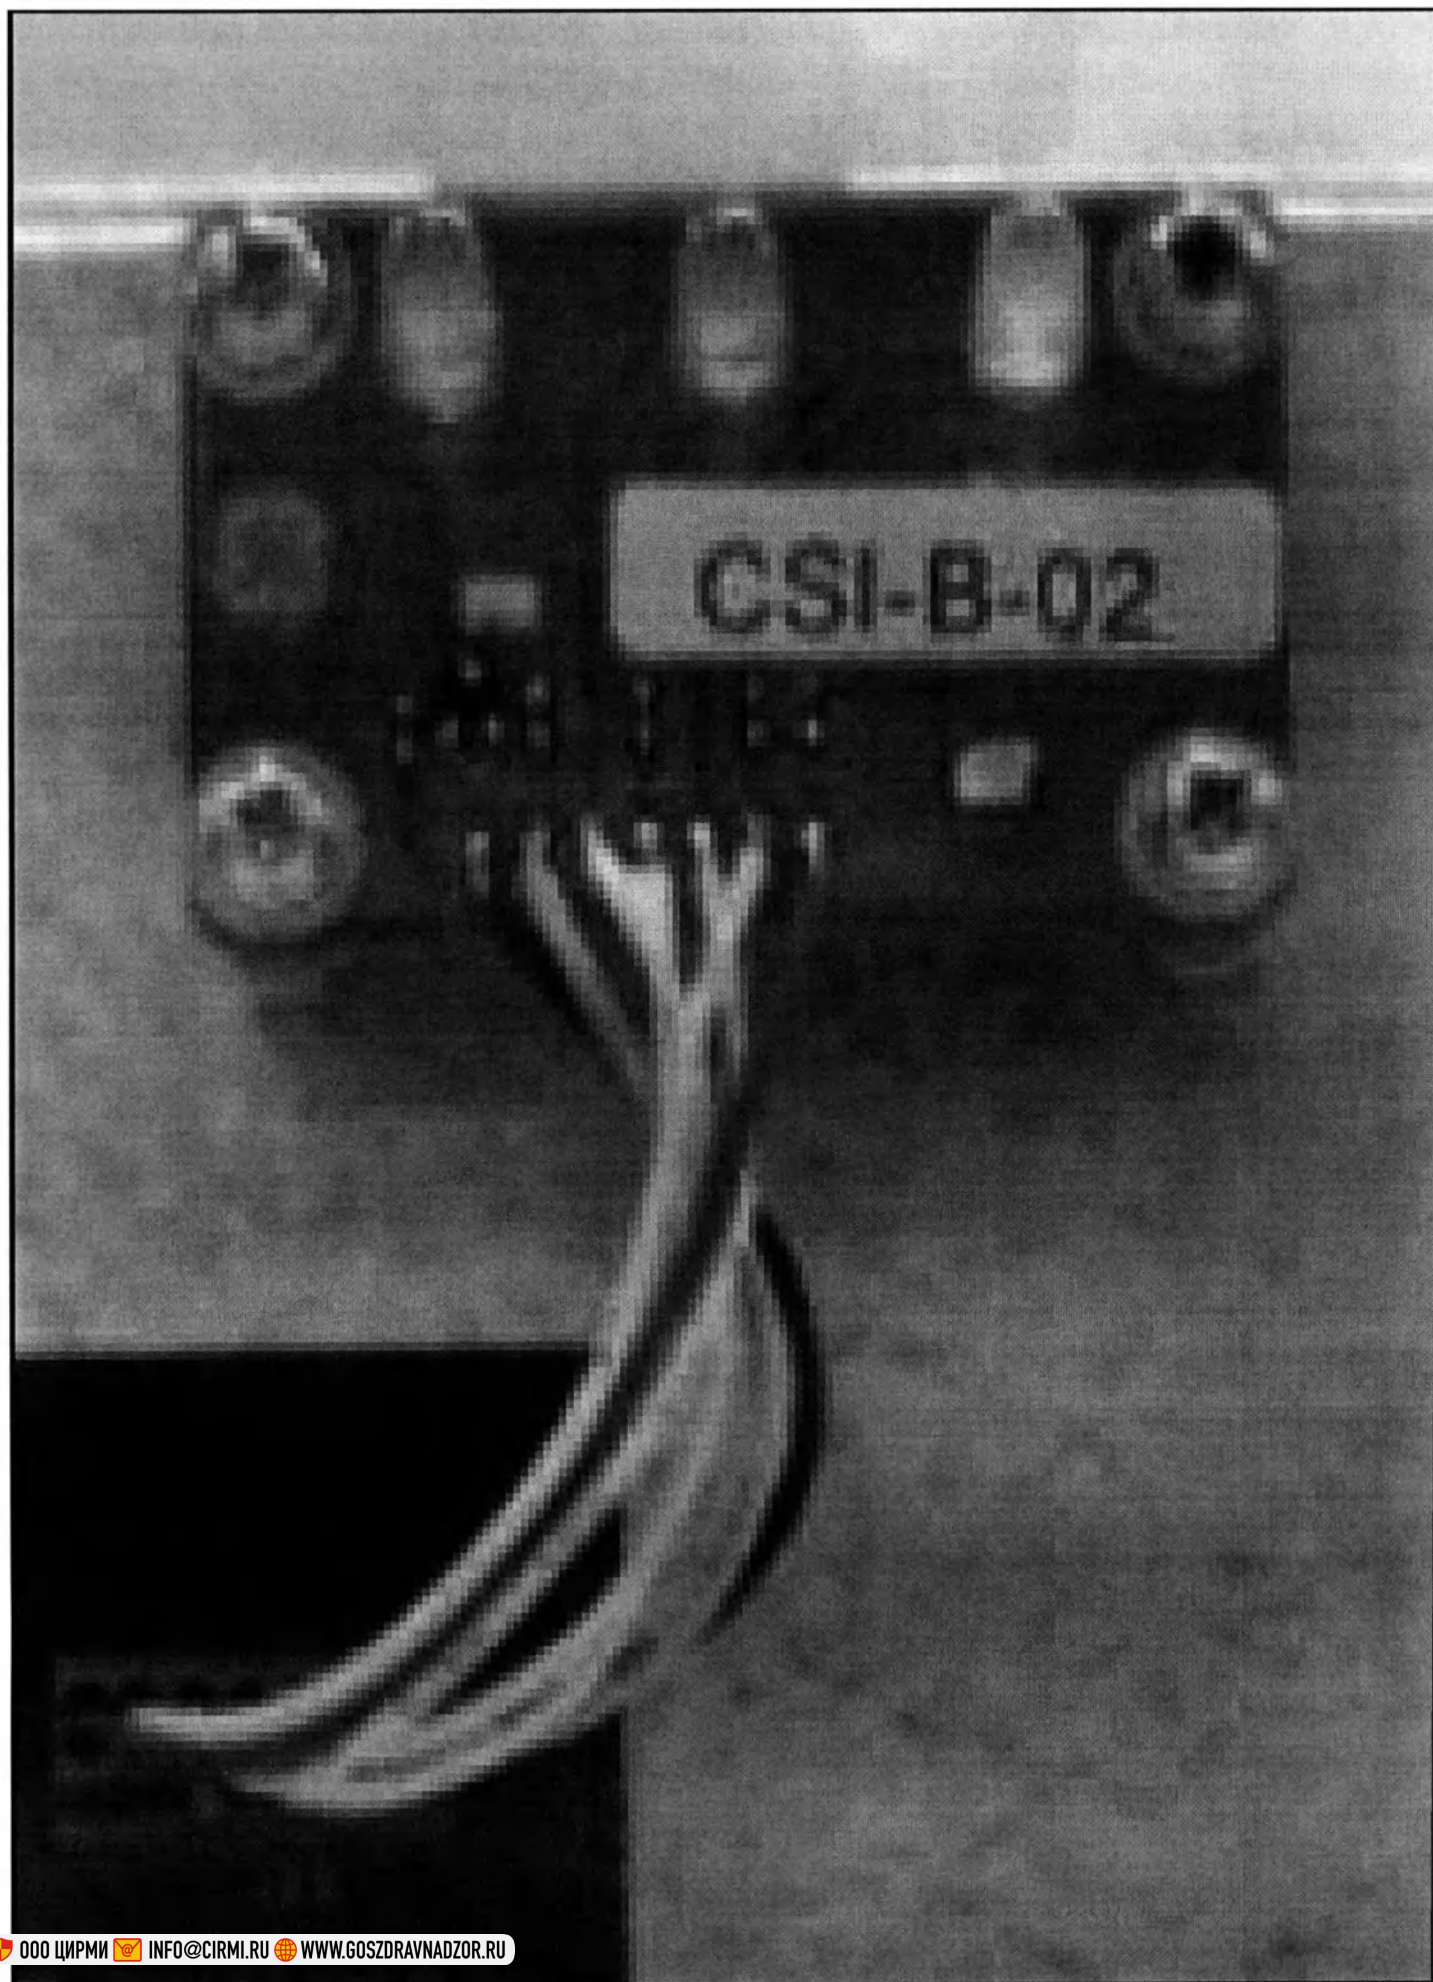

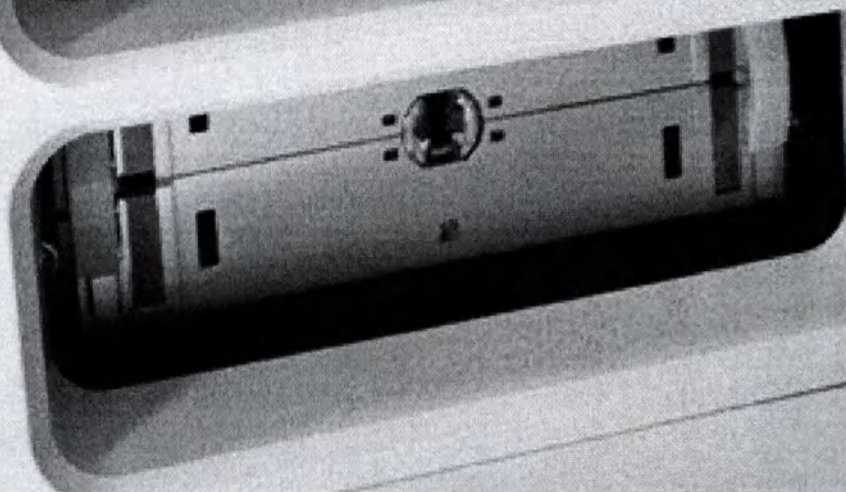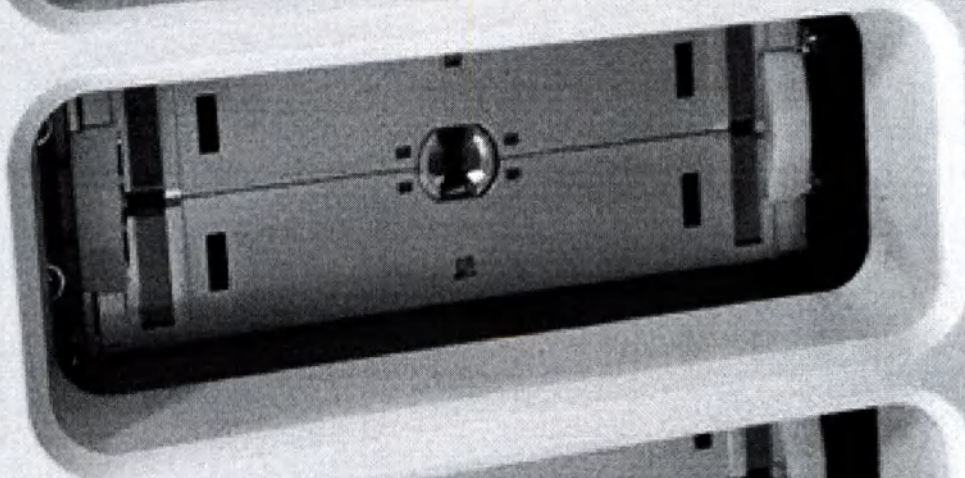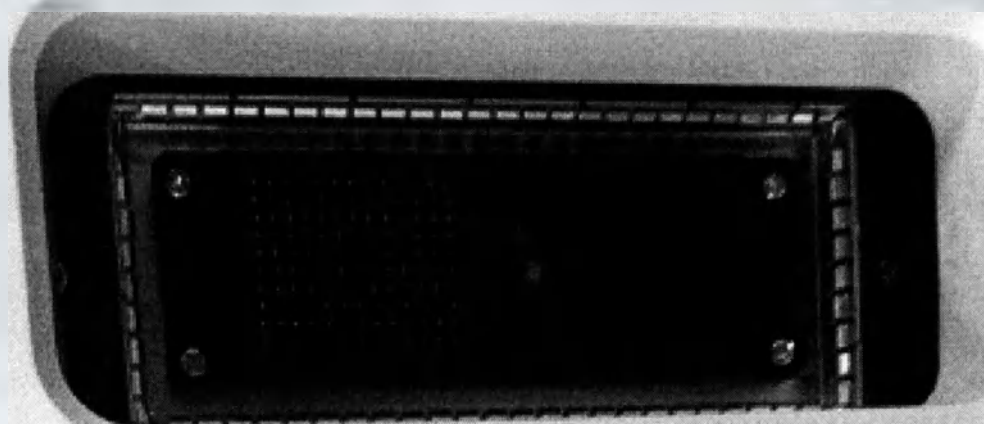

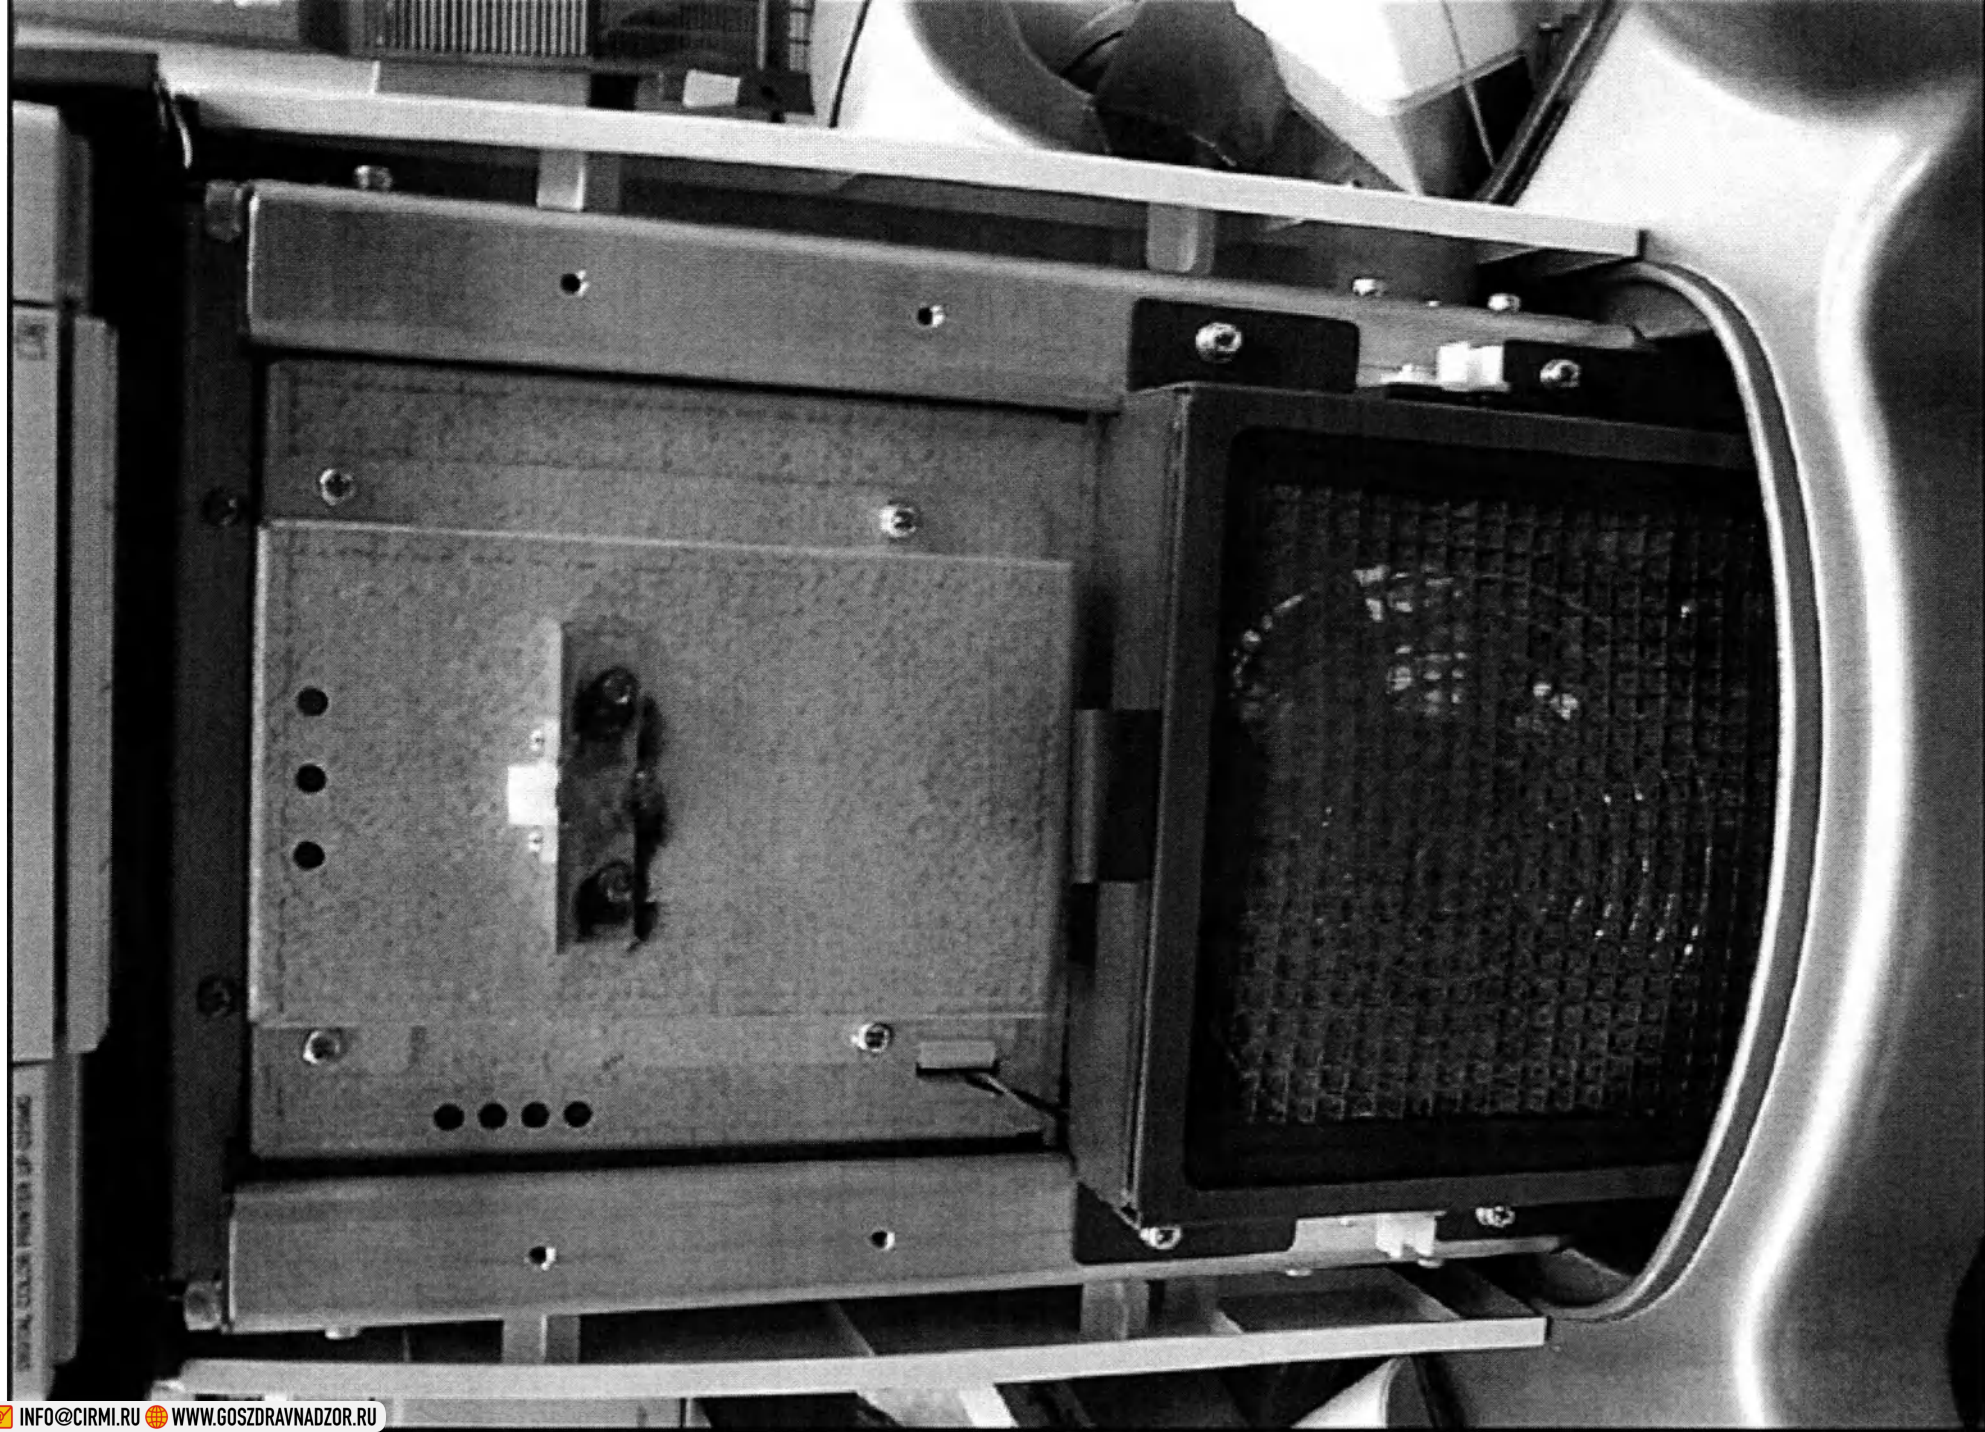



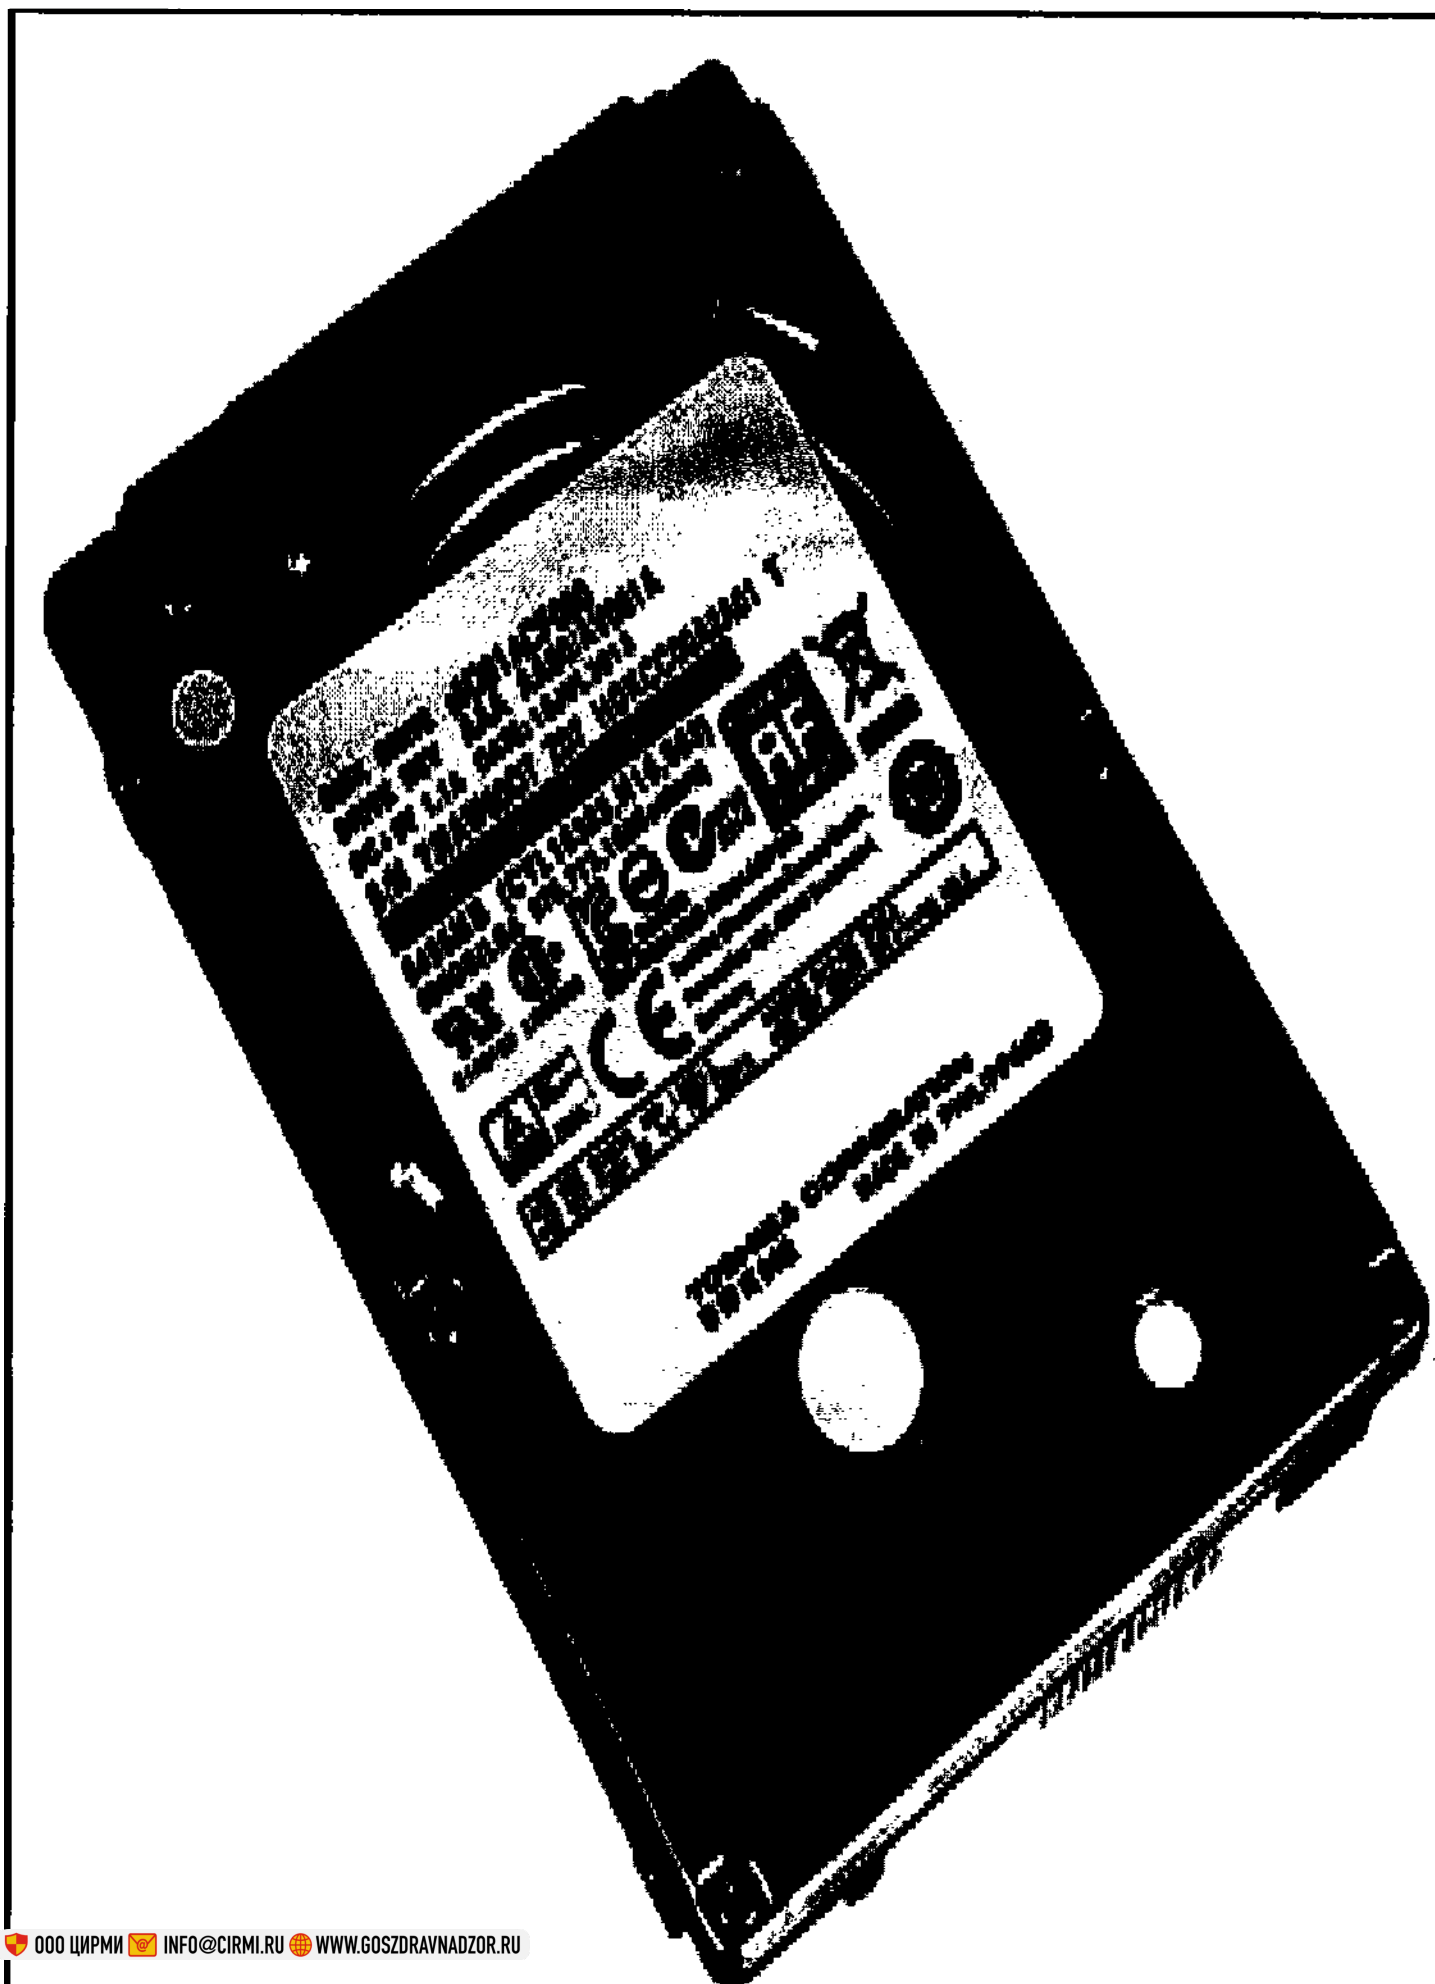



ПРОШТО
Листов 130

