

Фотографии медицинского изделия:


Электростимулятор NeuroTrac в следующих исполнениях: MyoPlus 2, MyoPlus 4, с принадлежностями.

«Верити Медикал Лтд.» / «Verity Medical Ltd», Unit 7, Upper Slackstead Farm, Farley Lane, Braishfield, Romsey, Hampshire SO51 0QL, United Kingdom.

Содержание:


1. Электростимулятор NeuroTrac MyoPlus 2
2. Электростимулятор NeuroTrac MyoPlus 4
3. Электрод поверхностный 50 x 50 мм (4 шт.)
4. Электрод поверхностный круглый диаметром 50 мм (4 шт.)
5. Электрод поверхностный 100 x 50 мм (4 шт.)
6. Электрод поверхностный круглый диаметром 30 мм (4 шт.)
7. Электрод поверхностный 40 x 40 мм (4 шт.)
8. Электрод поверхностный 90 x 50 мм (4 шт.)
9. Электрод поверхностный 90 x 40 мм (4 шт.)
10. Электрод ректальный длина 108.5 мм, диаметр 19.6 мм
11. Электрод вагинальный длина 74.5 мм, диаметр 28 мм
12. Кабель для подключения электродов
13. Кабель для подключения электрода референсного
14. Батарейка 2AA (4 шт.)
15. Набор Wireless kit для работы с программным обеспечением NeuroTrac
16. Адаптер беспроводной для работы с программным обеспечением NeuroTrac
17. Руководство по эксплуатации NeuroTrac MyoPlus 2/4
18. Руководство по работе с программами NeuroTrac MyoPlus 2/4
19. Руководство пользователя по размещению электродов
20. Руководство по использованию программного обеспечения NeuroTrac
21. Кейс для переноски

Генеральный директор
ЗАО «ИнфоМед»




/ О.Н. Вязьмин




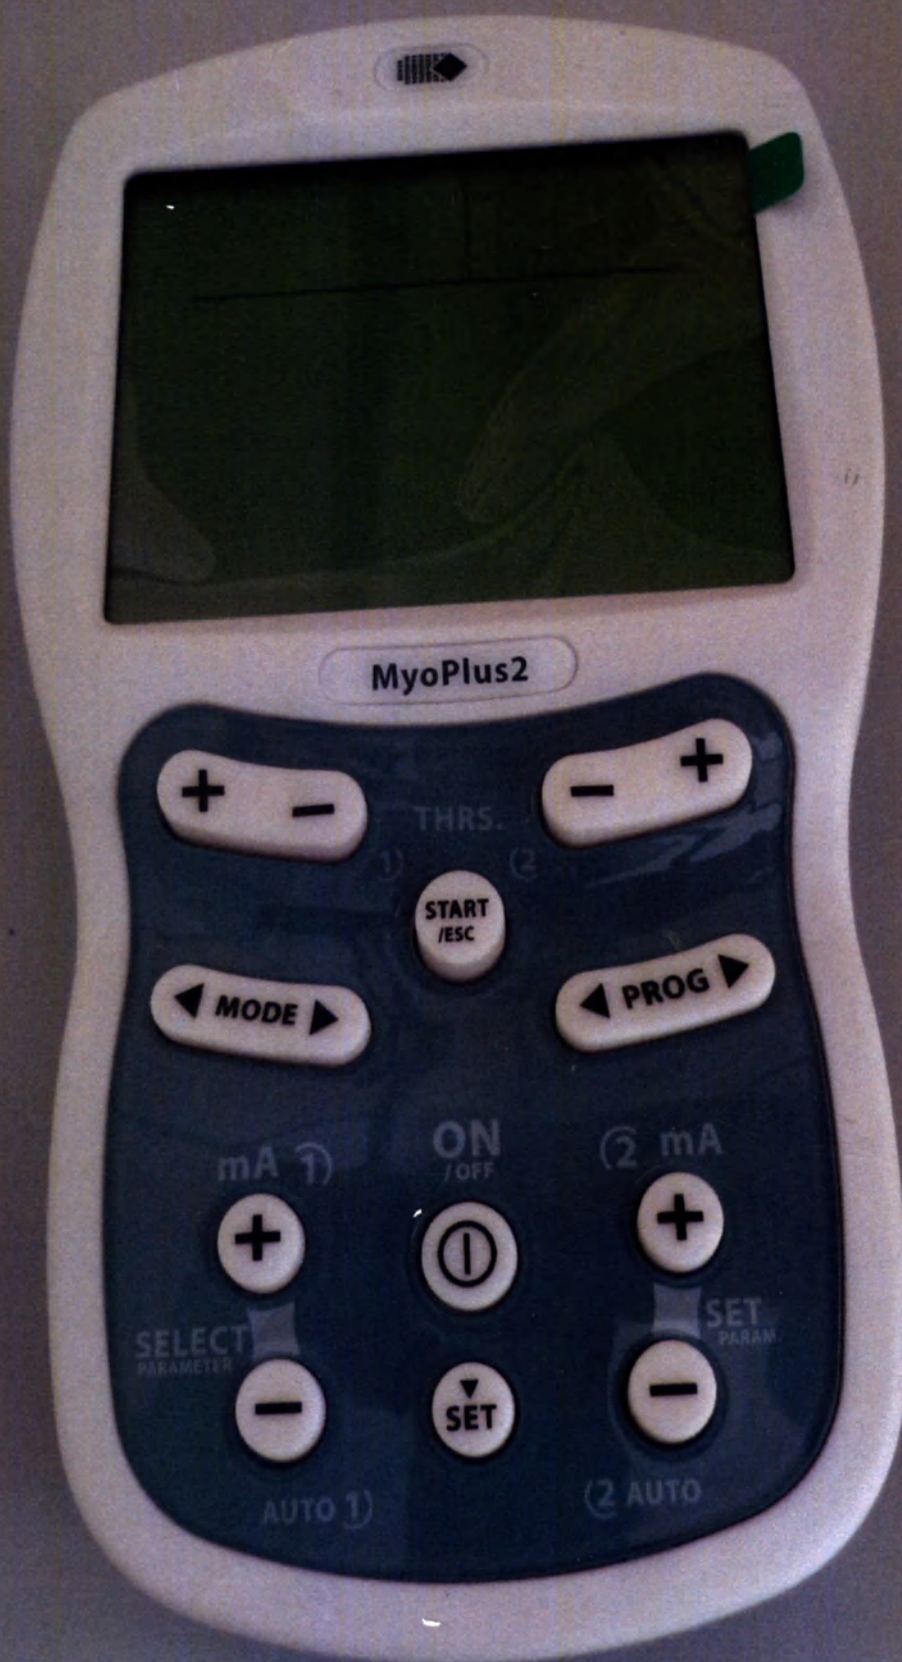


1. Электростимулятор NeuroTrac MyoPlus 2

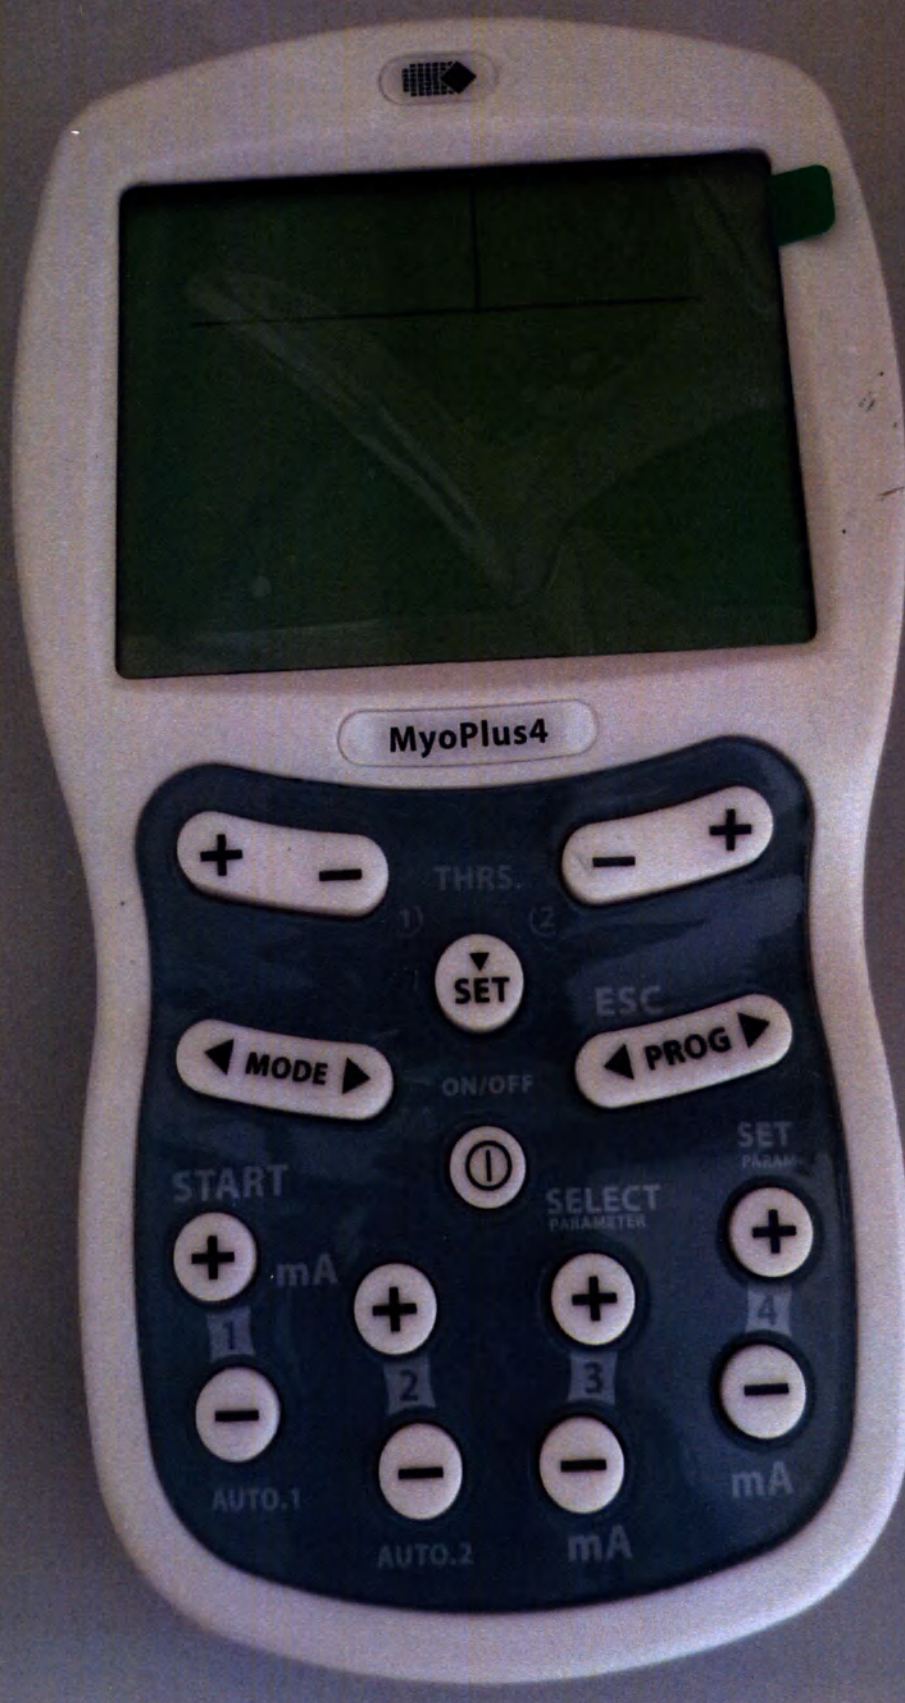

2. Электростимулятор NeuroTrac MyoPlus 4

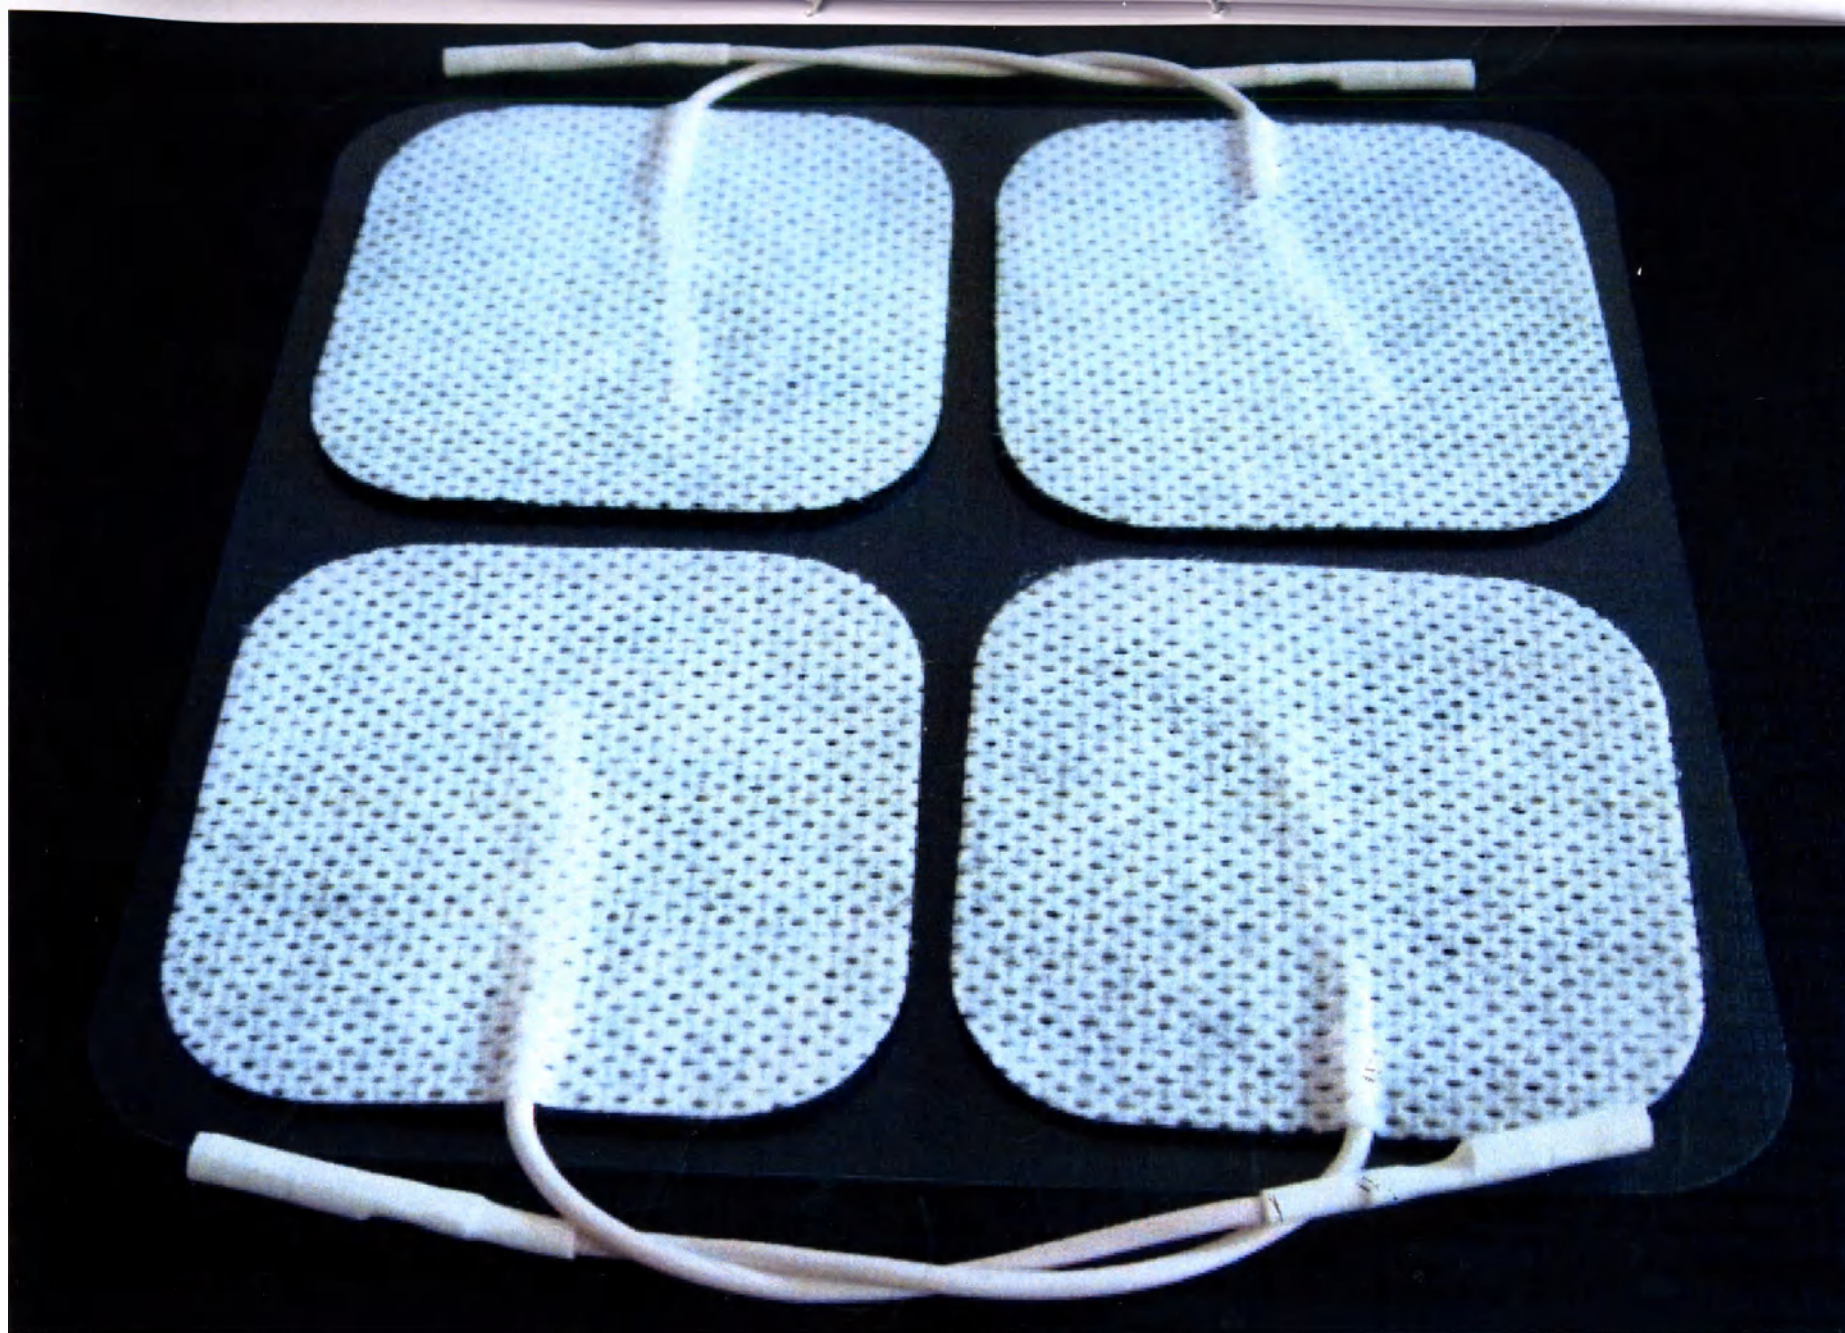

3. Электрод поверхностный 50 x 50 мм (4 шт.)

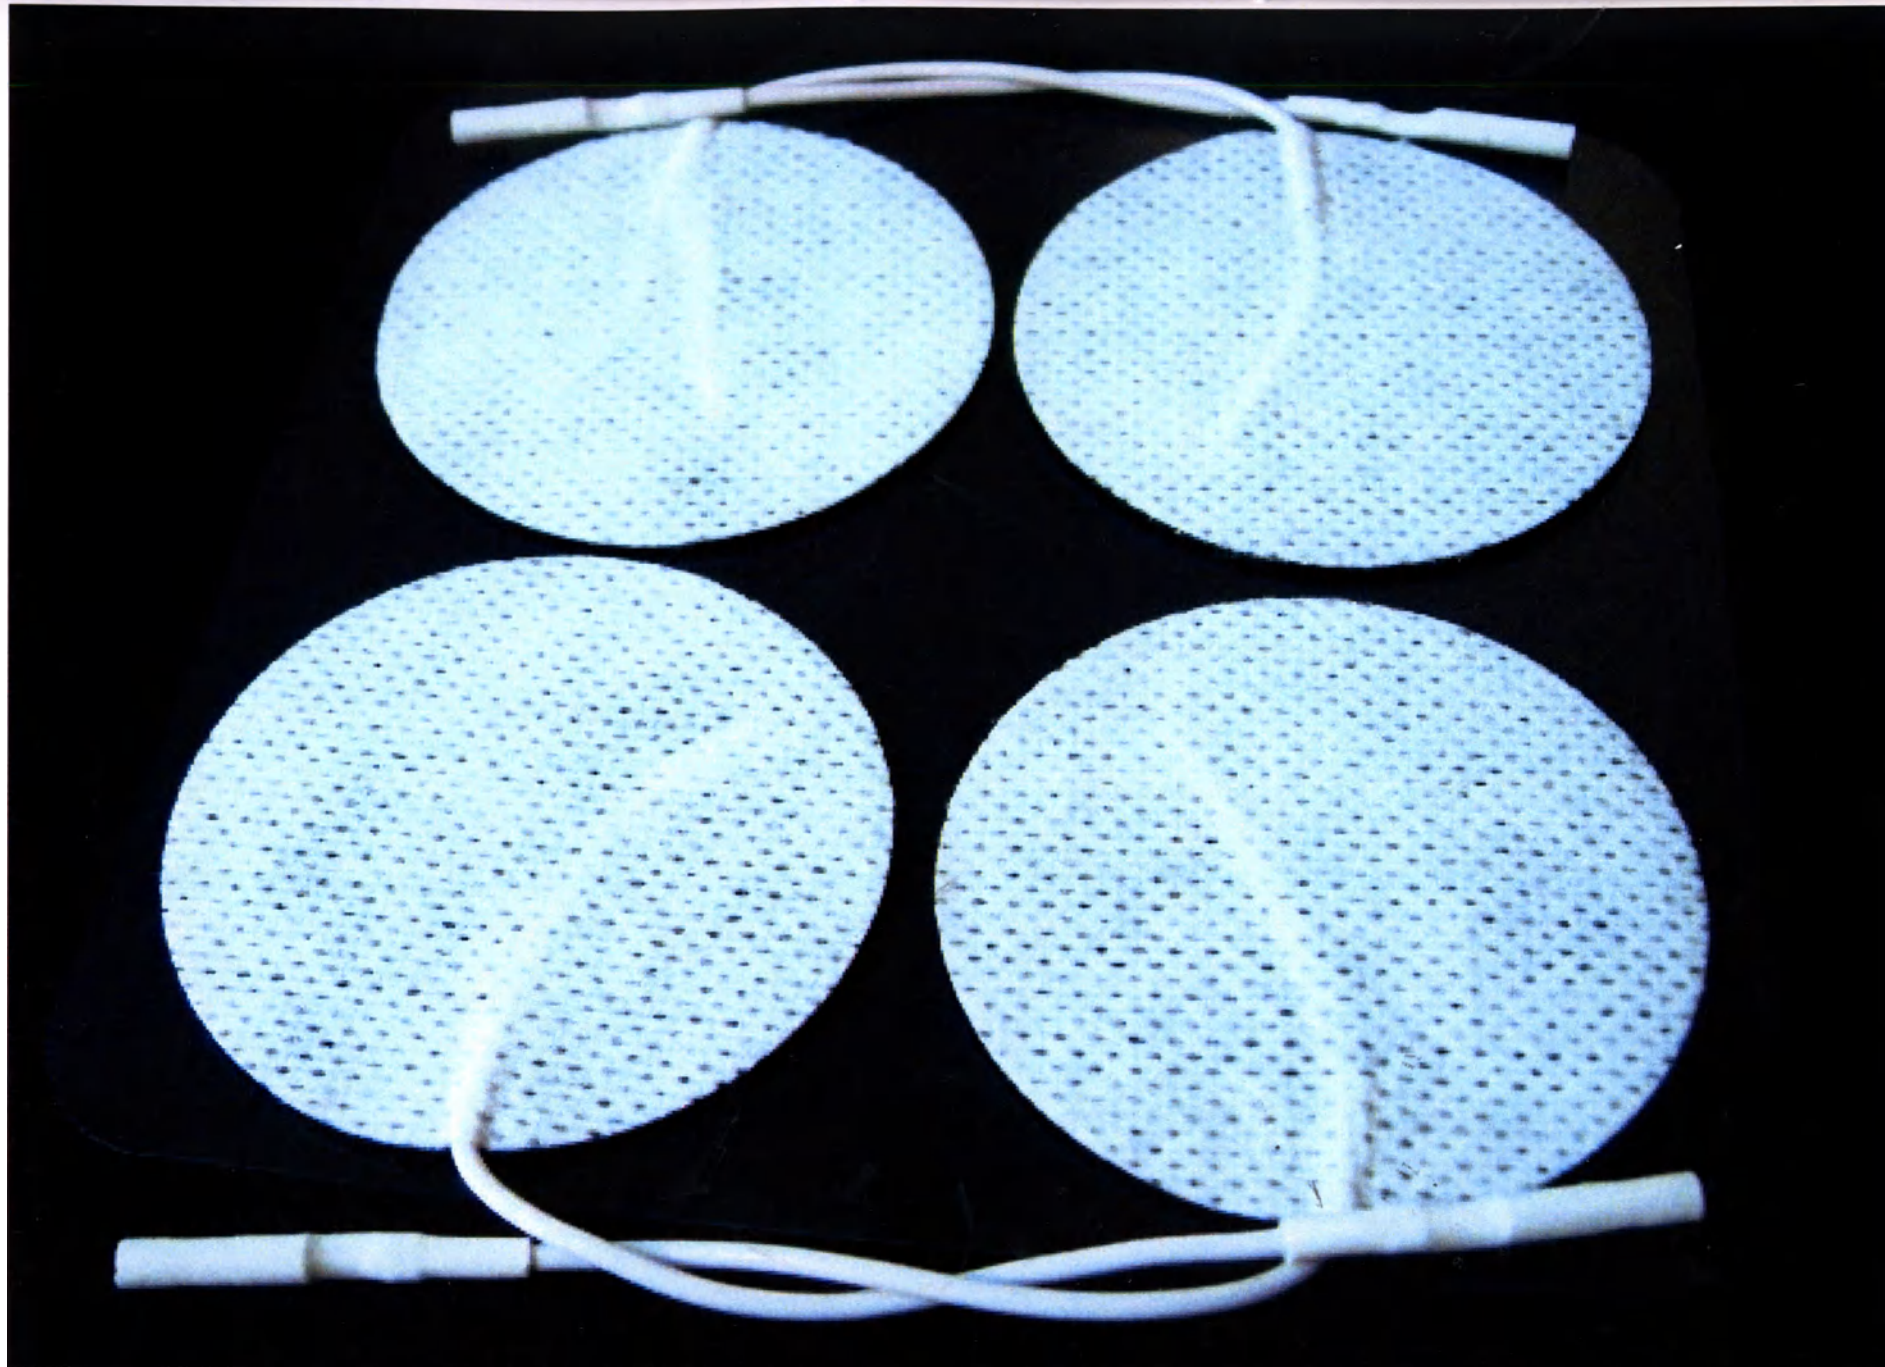


4. Электрод поверхностный круглый диаметром 50 мм (4 шт.)


24.03.2017



5. Электрод поверхностный 100 x 50 мм (4 шт.)

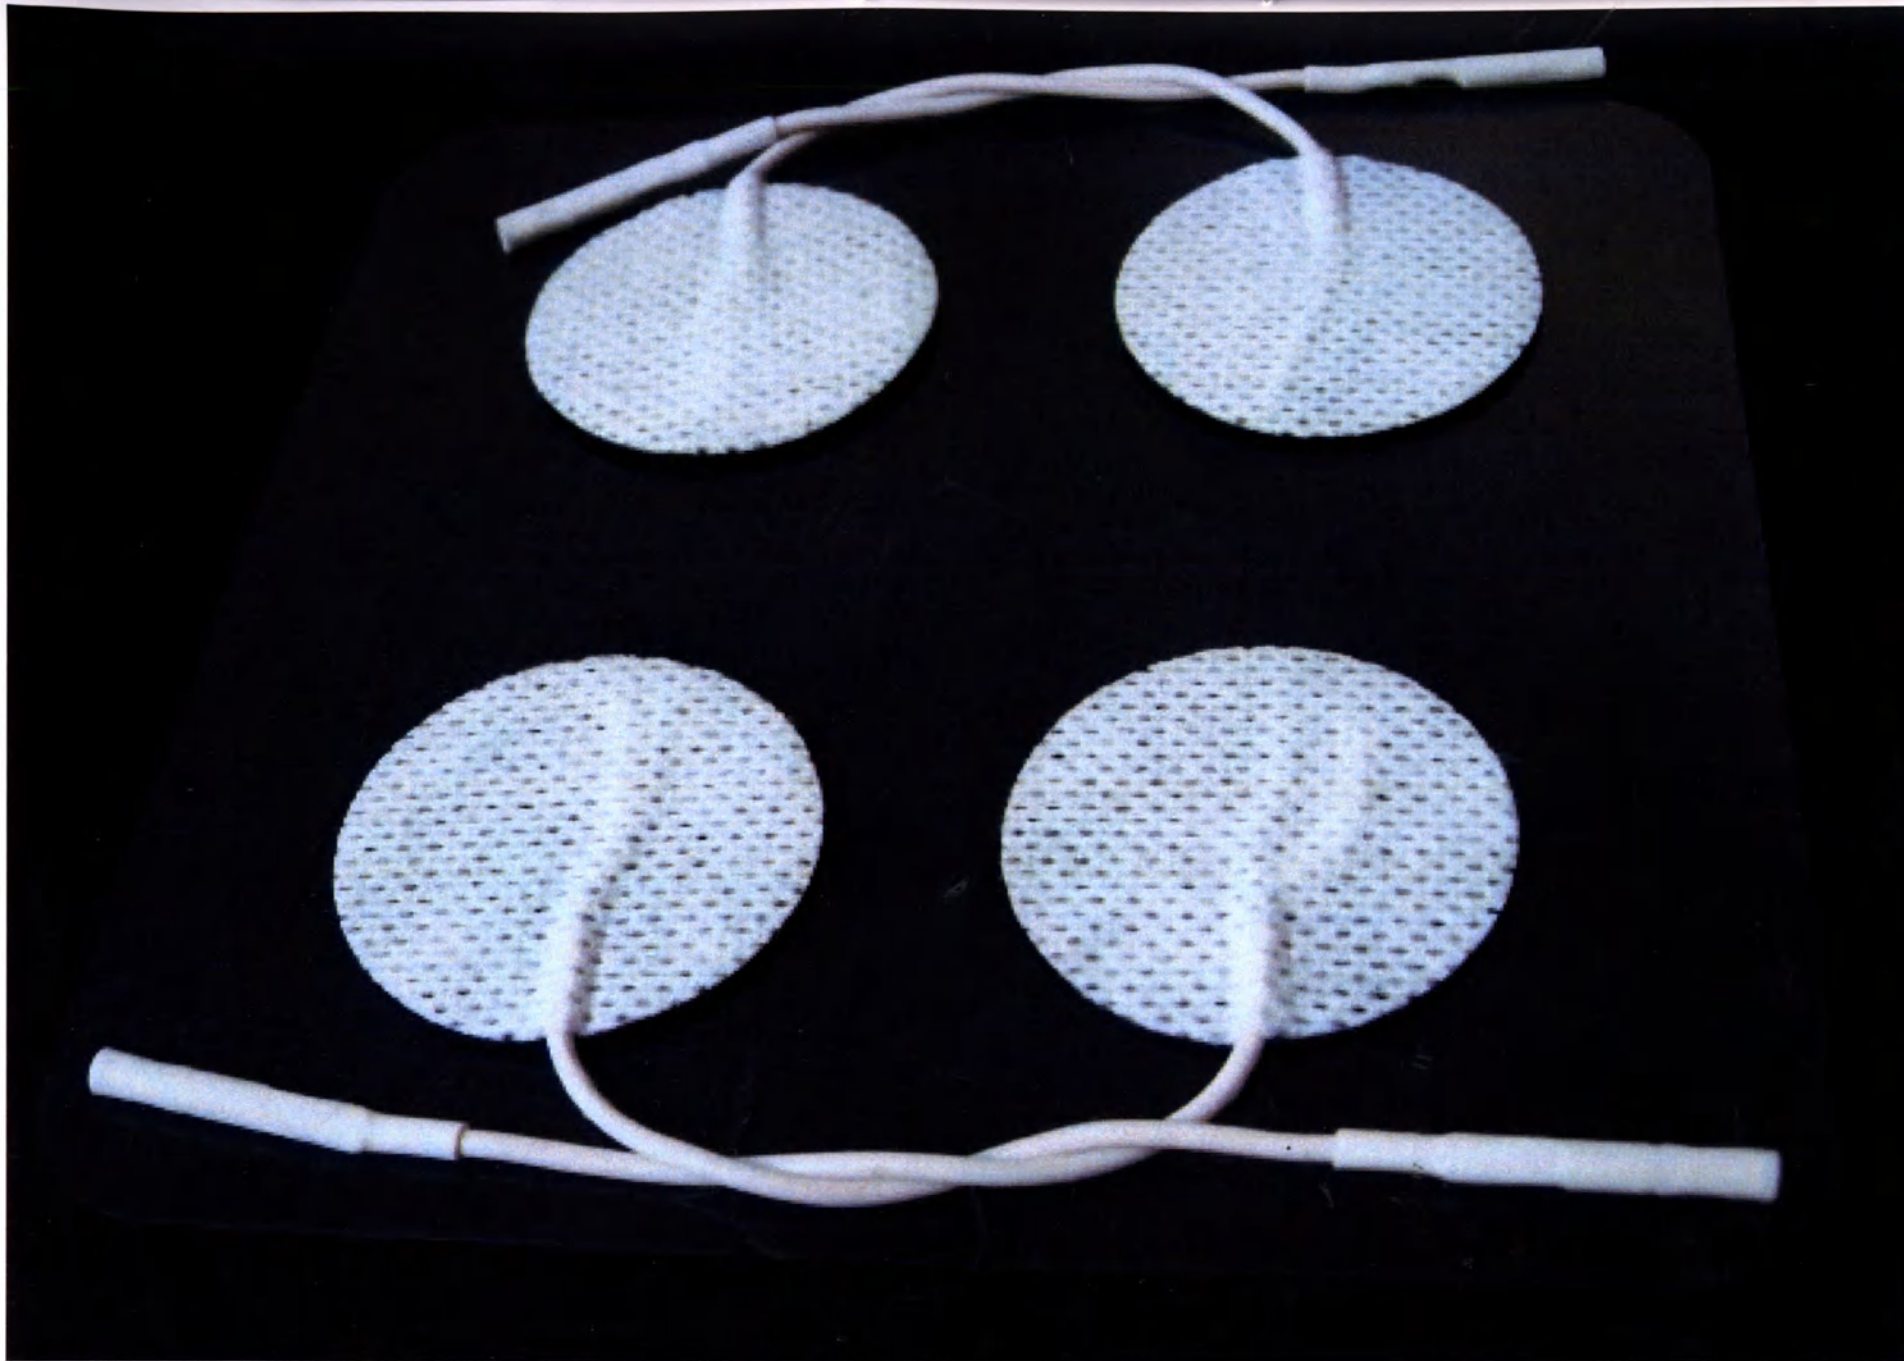

6. Электрод поверхностный круглый диаметром 30 мм (4 шт.)

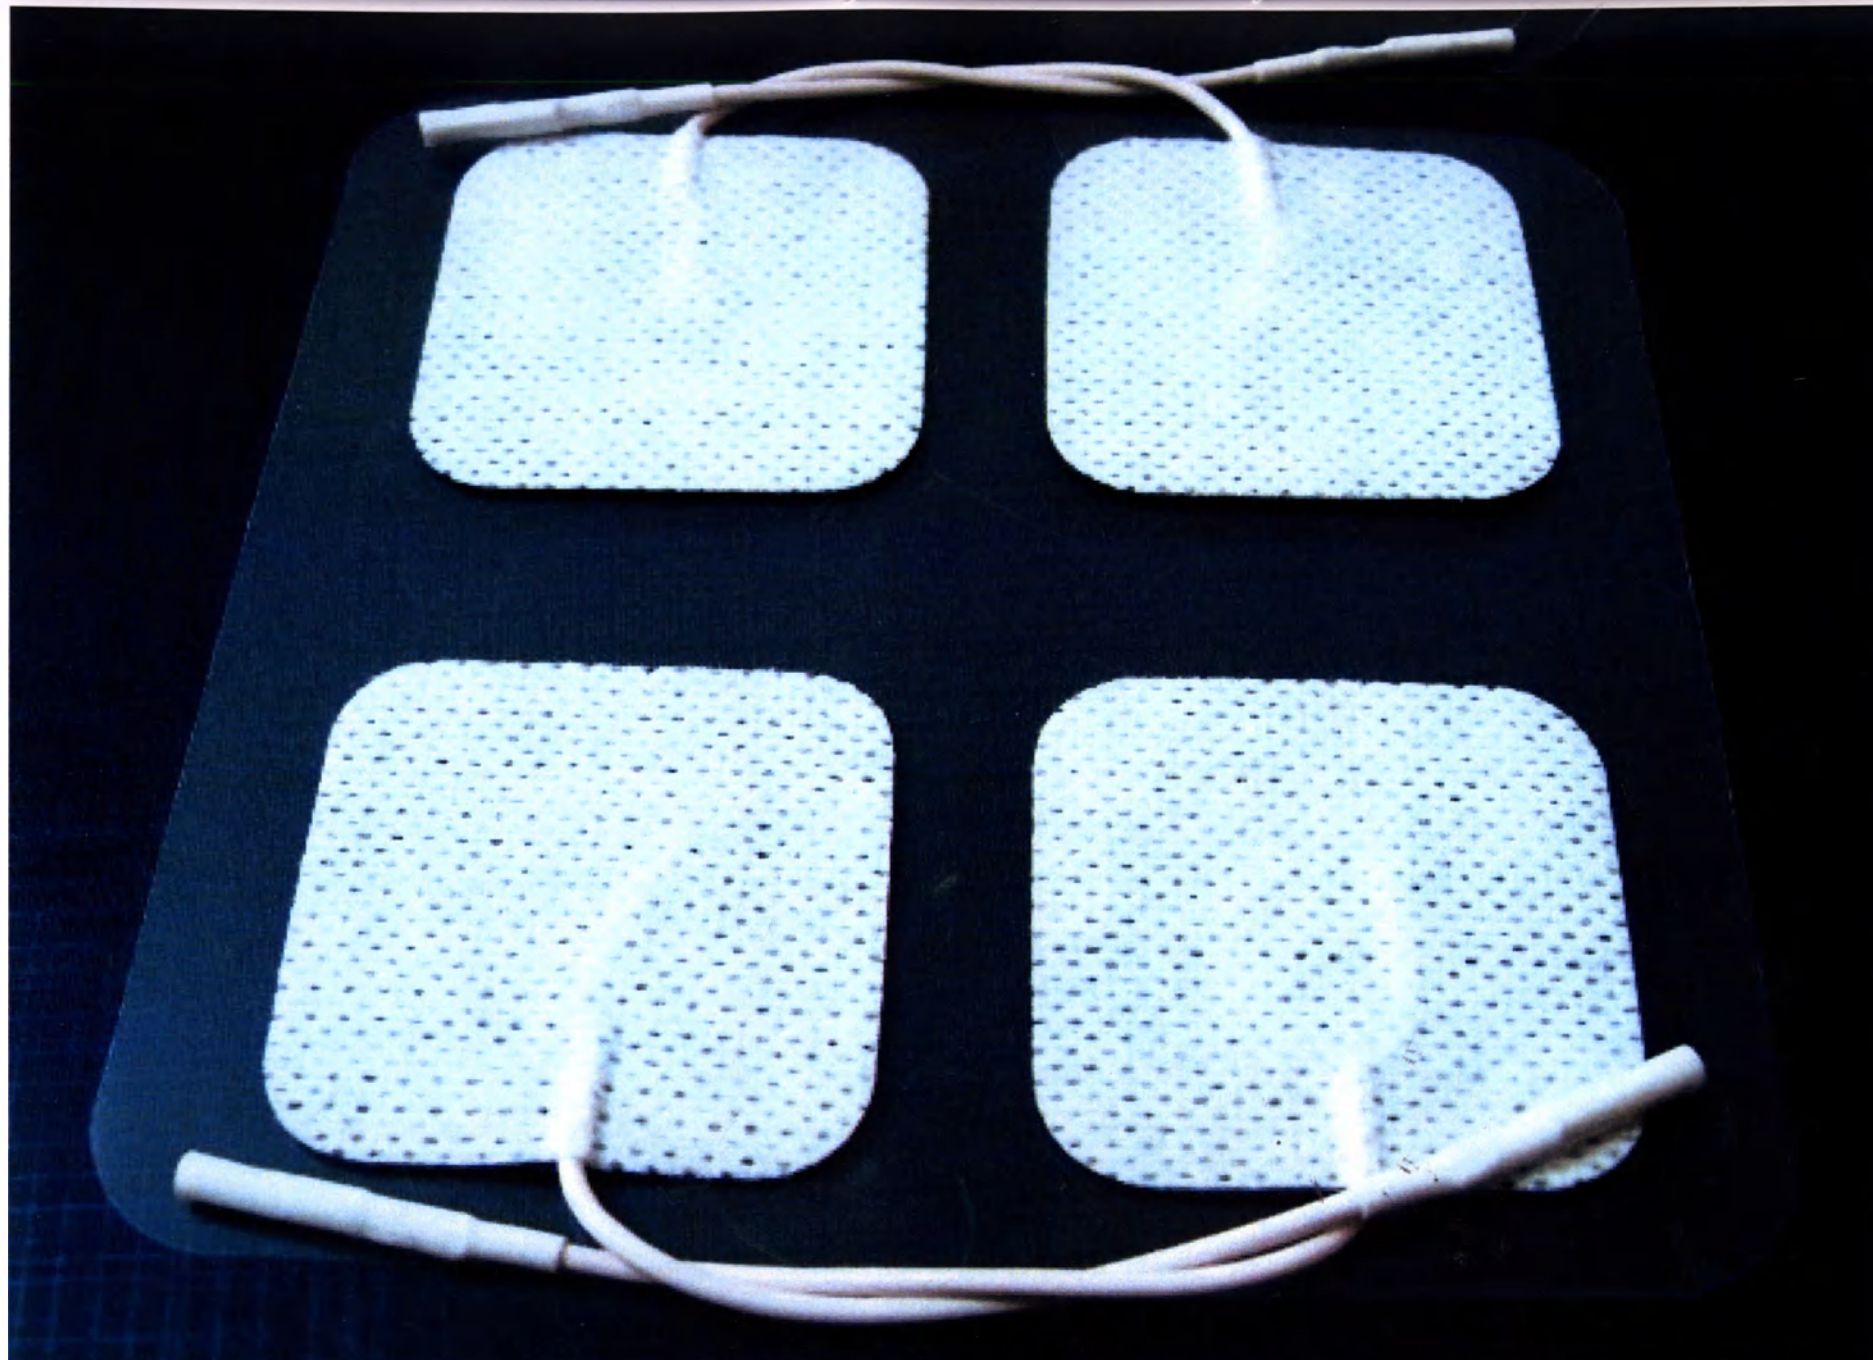

7. Электрод поверхностный 40 x 40 мм (4 шт.)




8. Электрод поверхностный 90 x 50 мм (4 шт.)



9. Электрод поверхностный 90 x 40 мм (4 шт.)




10. Электрод ректальный длина 108.5 мм, диаметр 19.6 мм

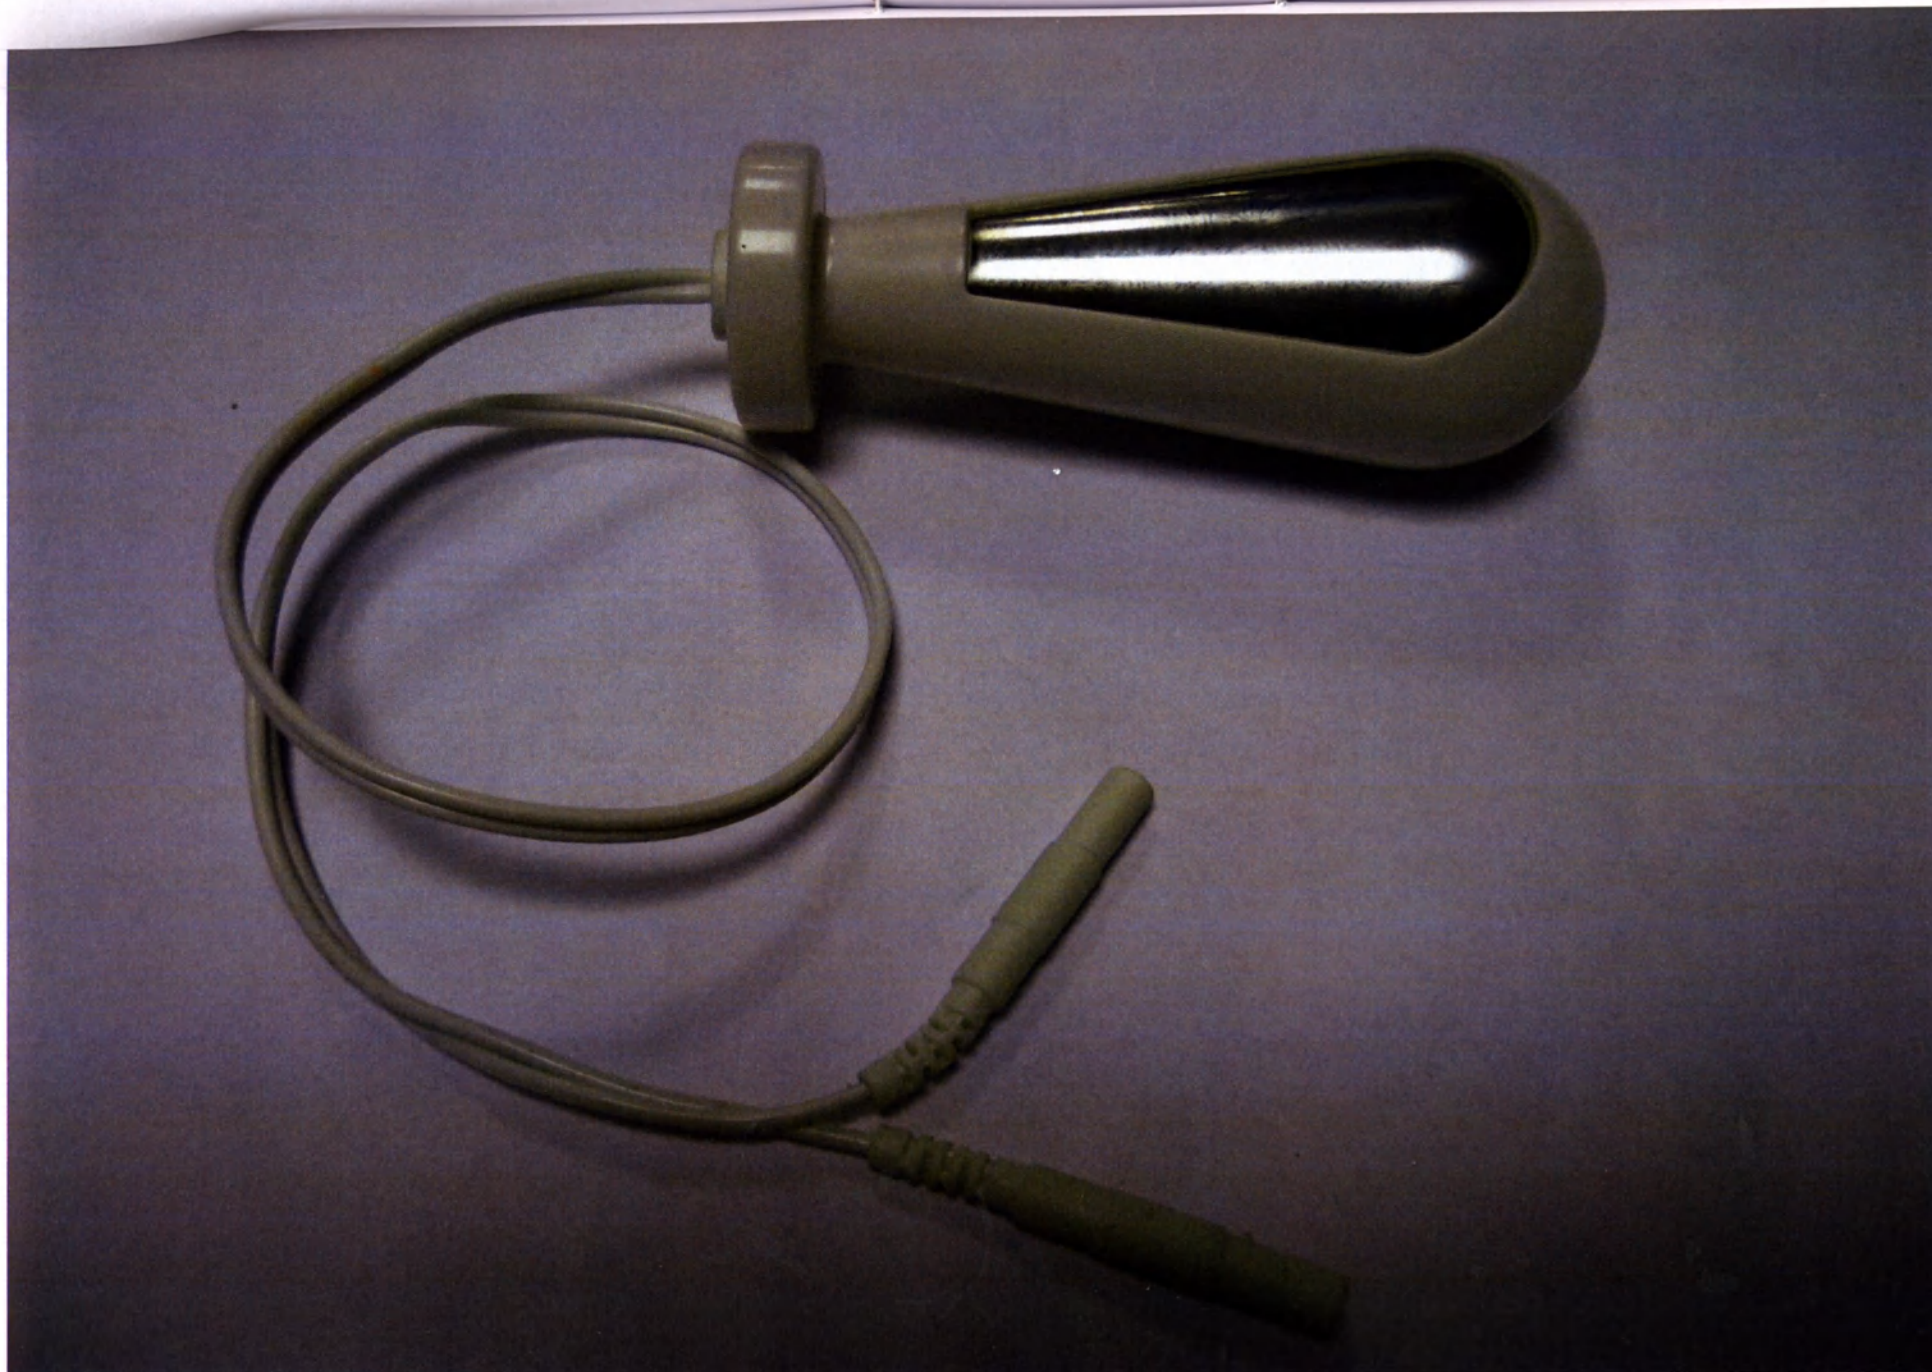

11. Электрод вагинальный длина 74.5 мм, диаметр 28 мм



12. Кабель для подключения электродов

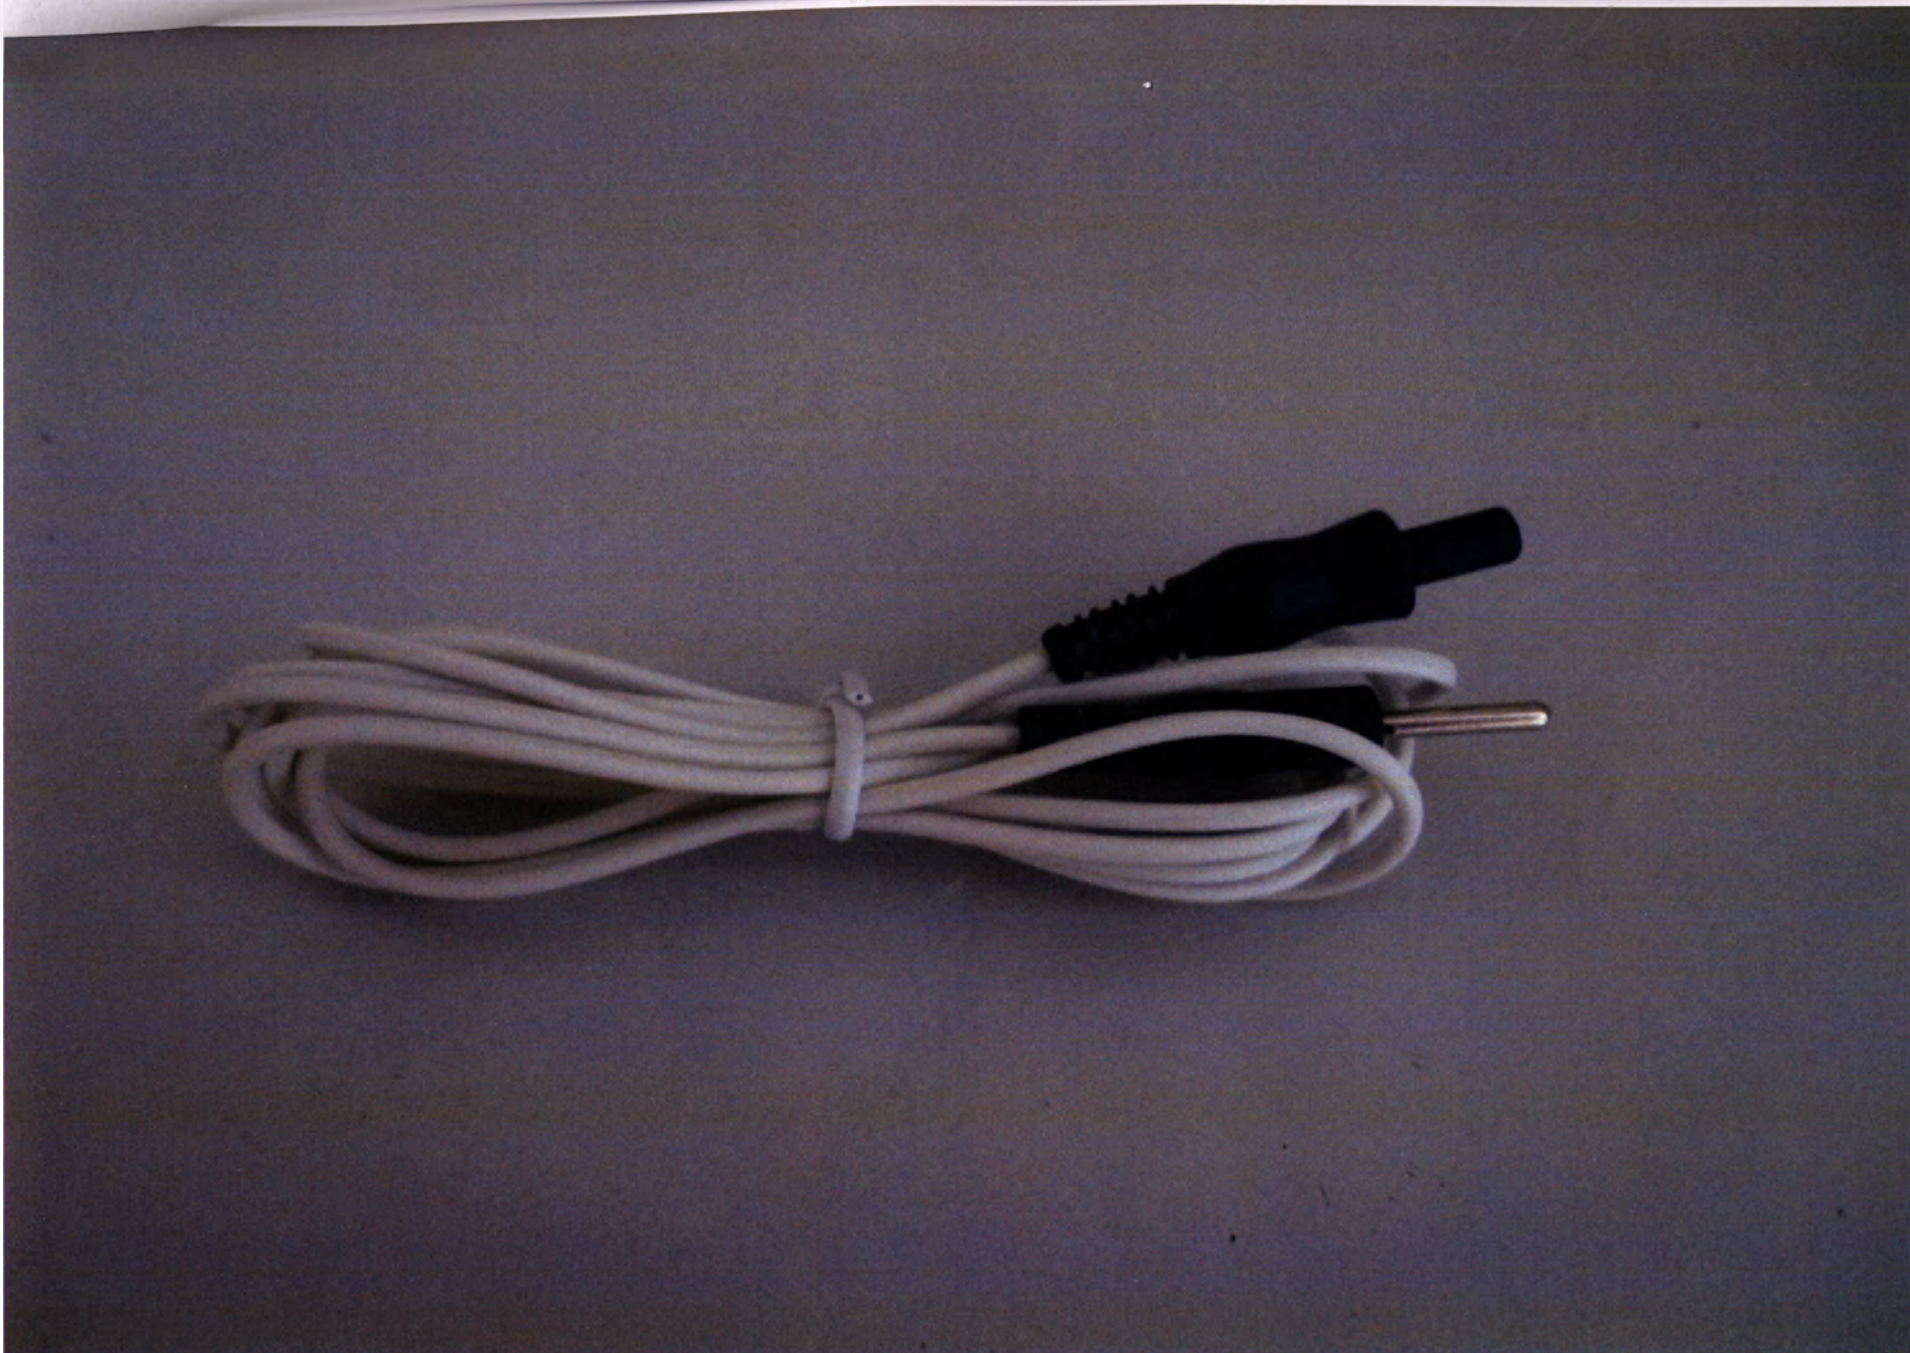

13. Кабель для подключения электрода референсного



14. Батарейка 2AA (4 шт.)

17341
24.03.2017



15. Набор Wireless kit для работы с программным обеспечением NeuroTrac



16. Адаптер беспроводной для работы с программным обеспечением NeuroTrac

NeuroTrac® MyoPlus 2/4

ТРИ В ОДНОМ

Руководство по эксплуатации

Подробное описание прикладных протоколов находится на нашем web-сайте по адресу: www.veritymedical.co.uk



Два канала ЭМГ
Два канала СЭМГ (ETS)
Два канала НМС



Два канала ЭМГ
Два канала СЭМГ (ETS)
Четыре канала НМС

Рус

VM VERITY
MEDICAL LTD


NeuroTrac® MyoPlus 2/4

Руководство по работе с
программами





Neuromuscular Stimulation (NMS)

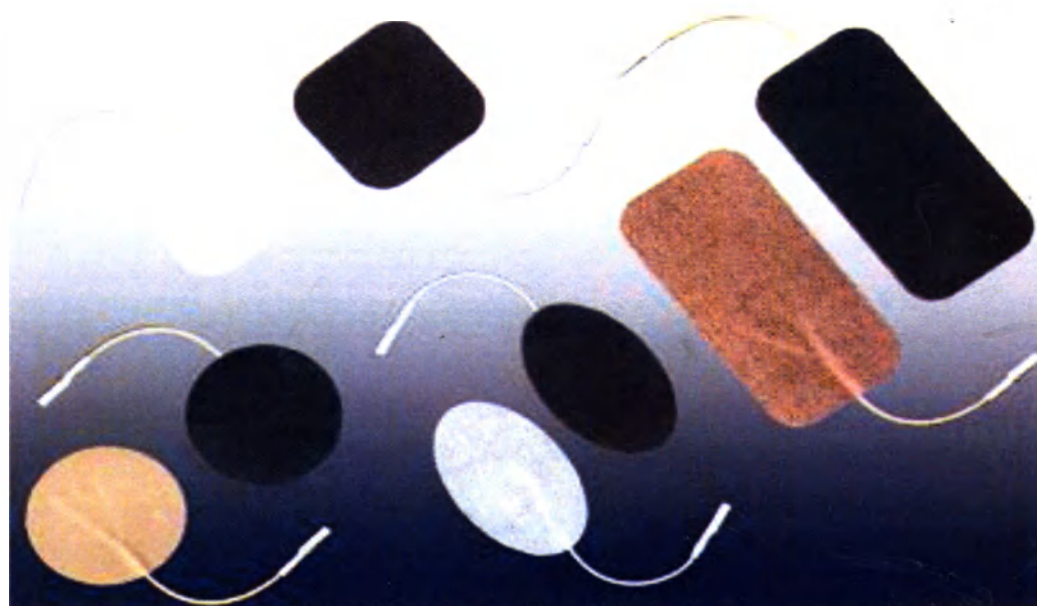


Electrode Placement Manual

Visit our website: www.veritymedical.co.uk
for detailed application protocols

VM VERITY
MEDICAL LTD

Программное обеспечение ПК NeuroTrac®

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

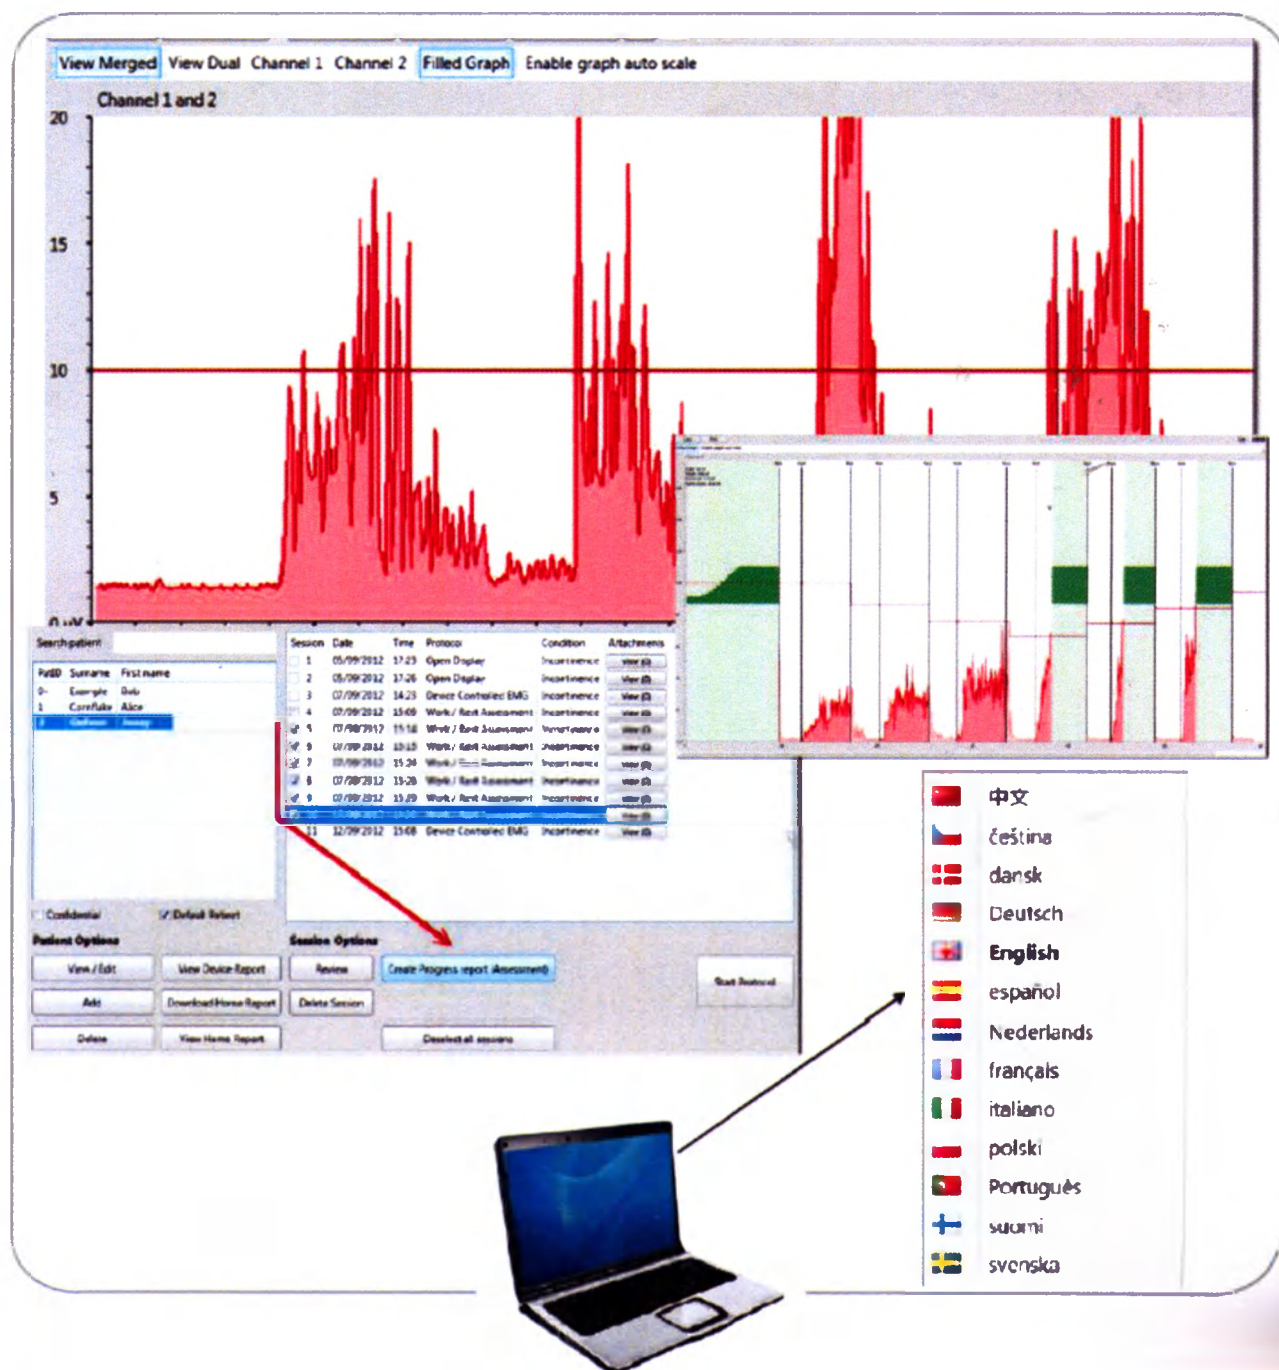

Адаптер беспроводной для работы с программным обеспечением NeuroTrac. Радиус действия до 10 м.

20. Руководство по использованию программного обеспечения NeuroTrac





Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено

печатью 22 (Двадцать два)⁹ листов

Генеральный директор

О. Н. Вязьмин *Вязьмин*

