

УТВЕРЖДАЮ



Директор
ООО «МедПер Консалтинг»

Ю. Н. Сергеева

«29» марта 2017 г.

От имени

ООО «Т-Мед»

(Наименование организации-заявителя)

По доверенности

от 26.05.2016 г.

№ бланка 50 АА 7970370,

сроком действия до 26.05.2019 г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

***ФИЗИОДИСПЕНСЕР TRAUS SIP10
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ***



2016

Физиодиспенсер TRAUS SIP10 с принадлежностями:

Фотографическое изображение 1:

Состав аппарата с педалью ножного управления FIP10




Фотографическое изображение 2:
Состав аппарата с педалью ножного управления FUS10



Фотографическое изображение 3:
Блок управления XIP-10



*Фотографическое изображение 4:
Шнур питания*

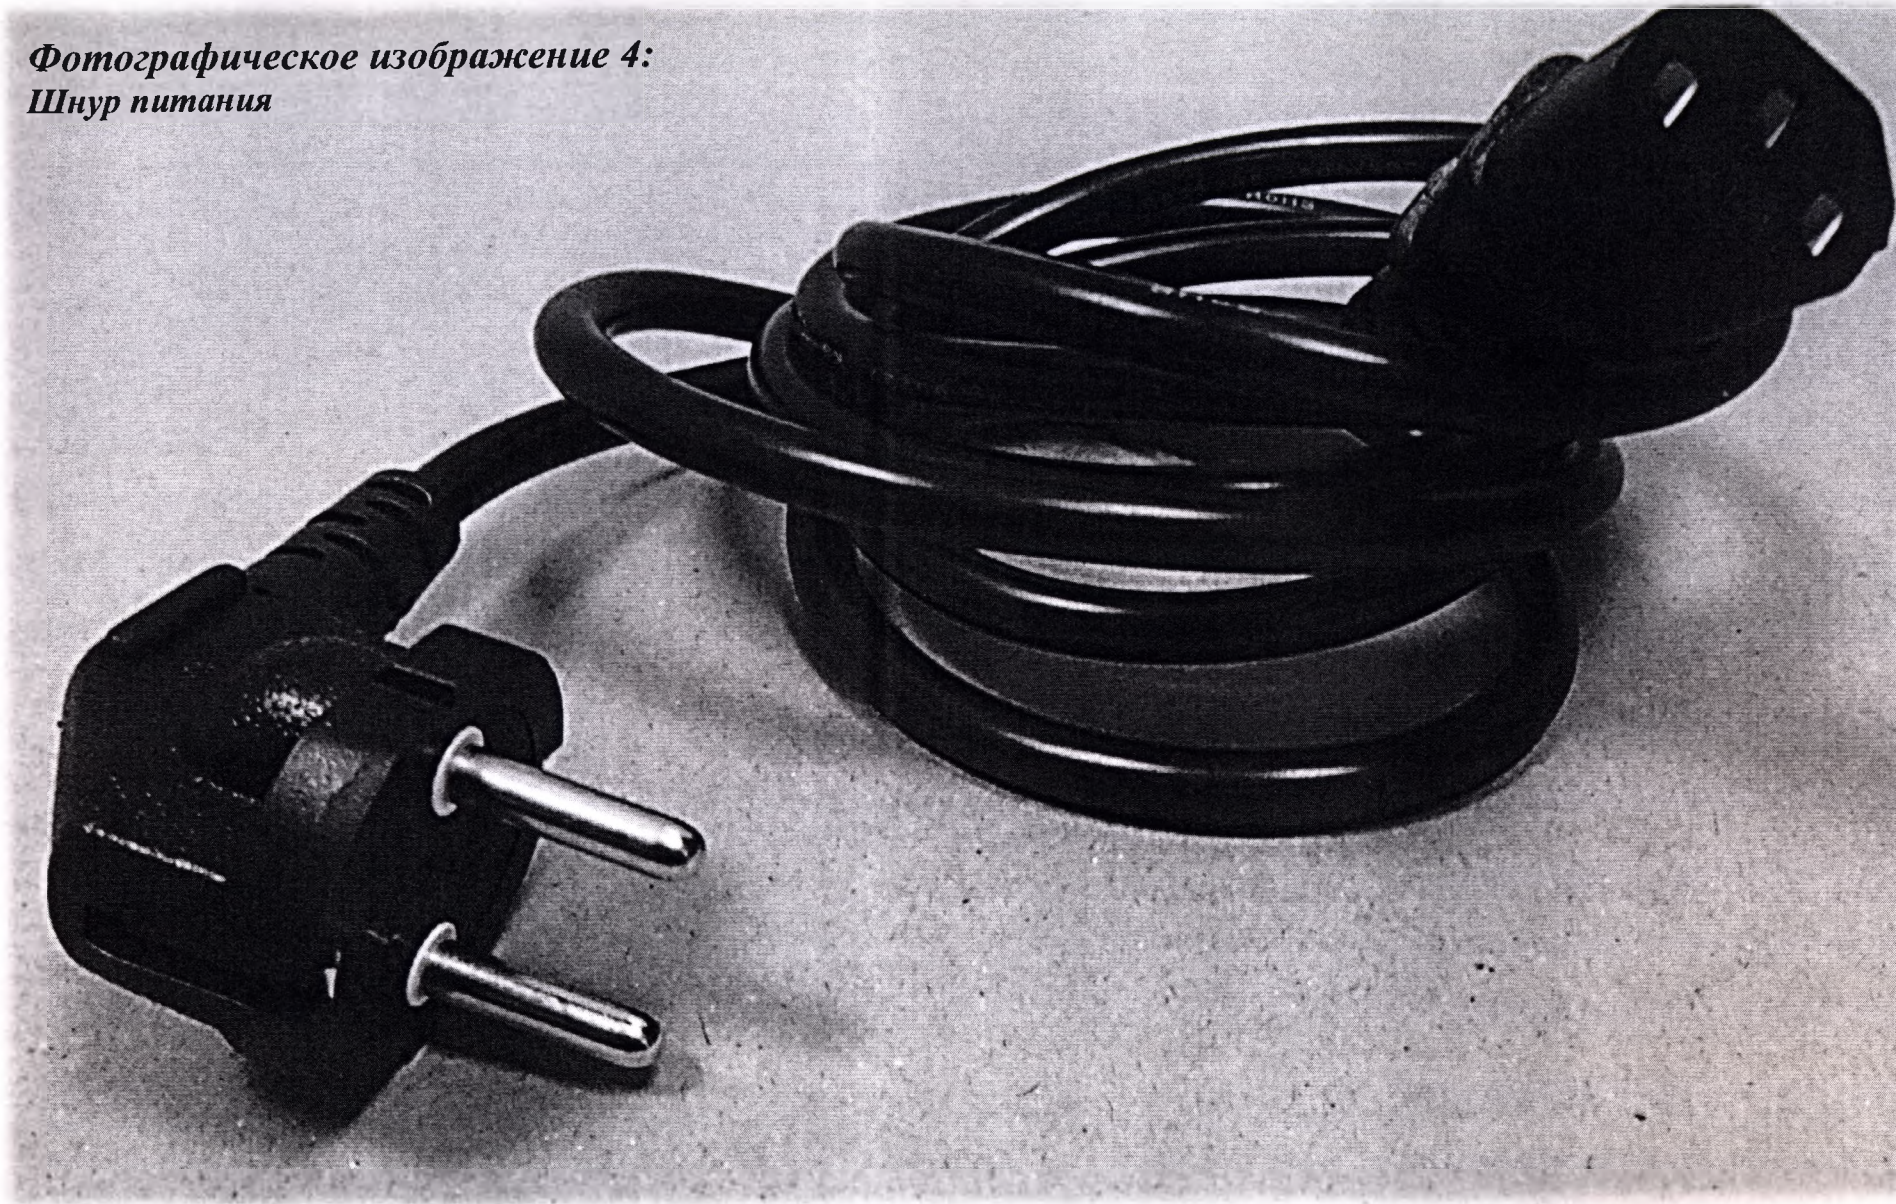

Фотографическое изображение 5:

Двигатель постоянного тока бесколлекторный для наконечников с подсветкой TRAUS MBP10SL / для наконечников без подсветки TRAUS MBP10SX с принадлежностями:


- кабель соединительный для двигателя постоянного тока бесколлекторного. TRAUS MBP10SL / TRAUS MBP10SX ;
- колпачок для защиты двигателя постоянного тока при стерилизации.



Фотографическое изображение 6:

Накопитель угловой микромоторный с подсветкой TRAUS CRB27LX (32:1) с принадлежностями:

- защитный колпачок;
- форсунка внутренняя для подвода инфузионного раствора.

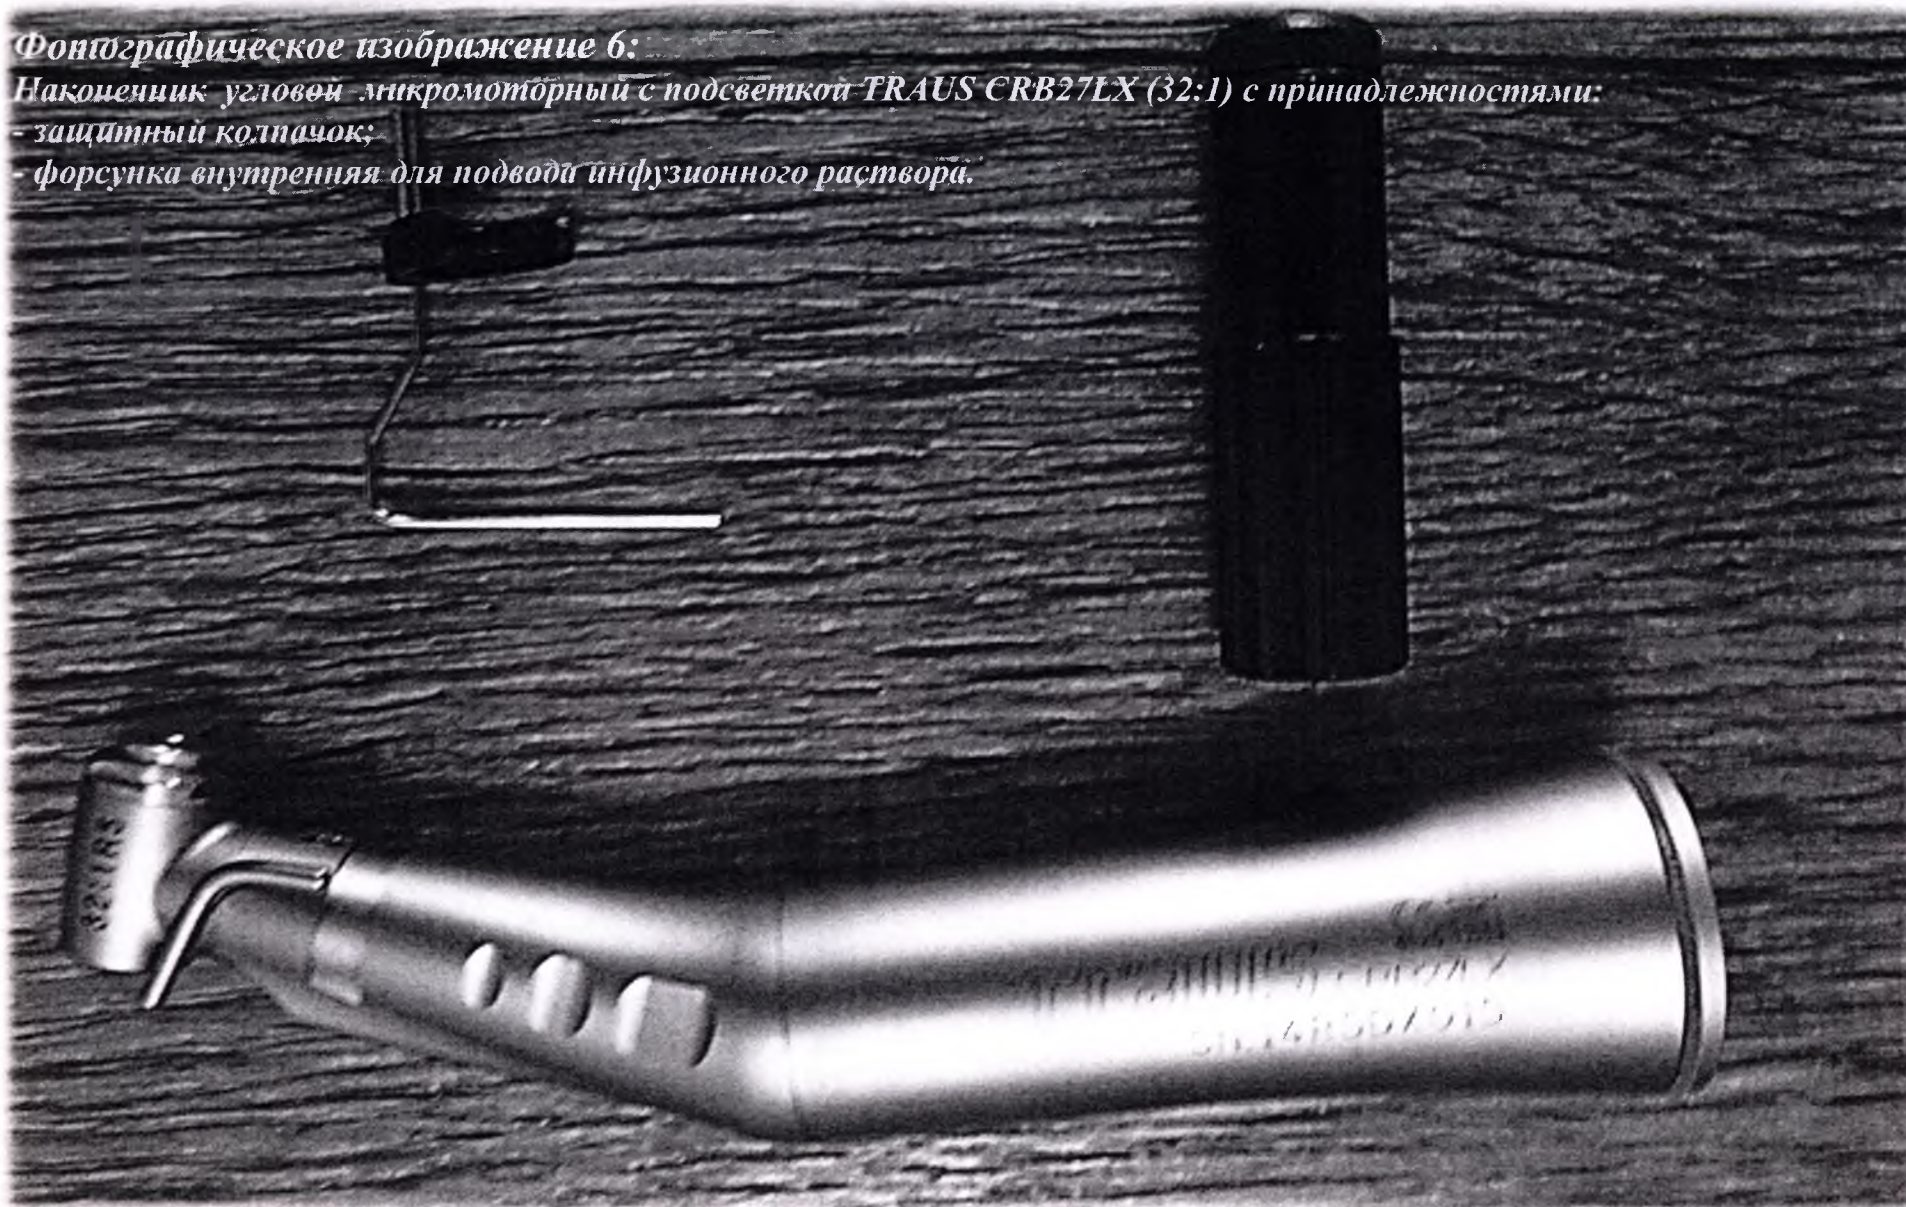

Фотографическое изображение 7:

Наконечник угловой микромоторный TRAUS CRB27XX (32:1) с принадлежностями:

- защитный колпачок;*
- форсунка внутренняя для подвода инфузионного раствора.*



Фотографическое изображение 8:


Педаль ножного управления FIP10 с принадлежностями:

- кронштейн педали;


- заглушка кронштейна (2 шт.)




Фотографическое изображение 9:
Педаль ножного управления FUS10

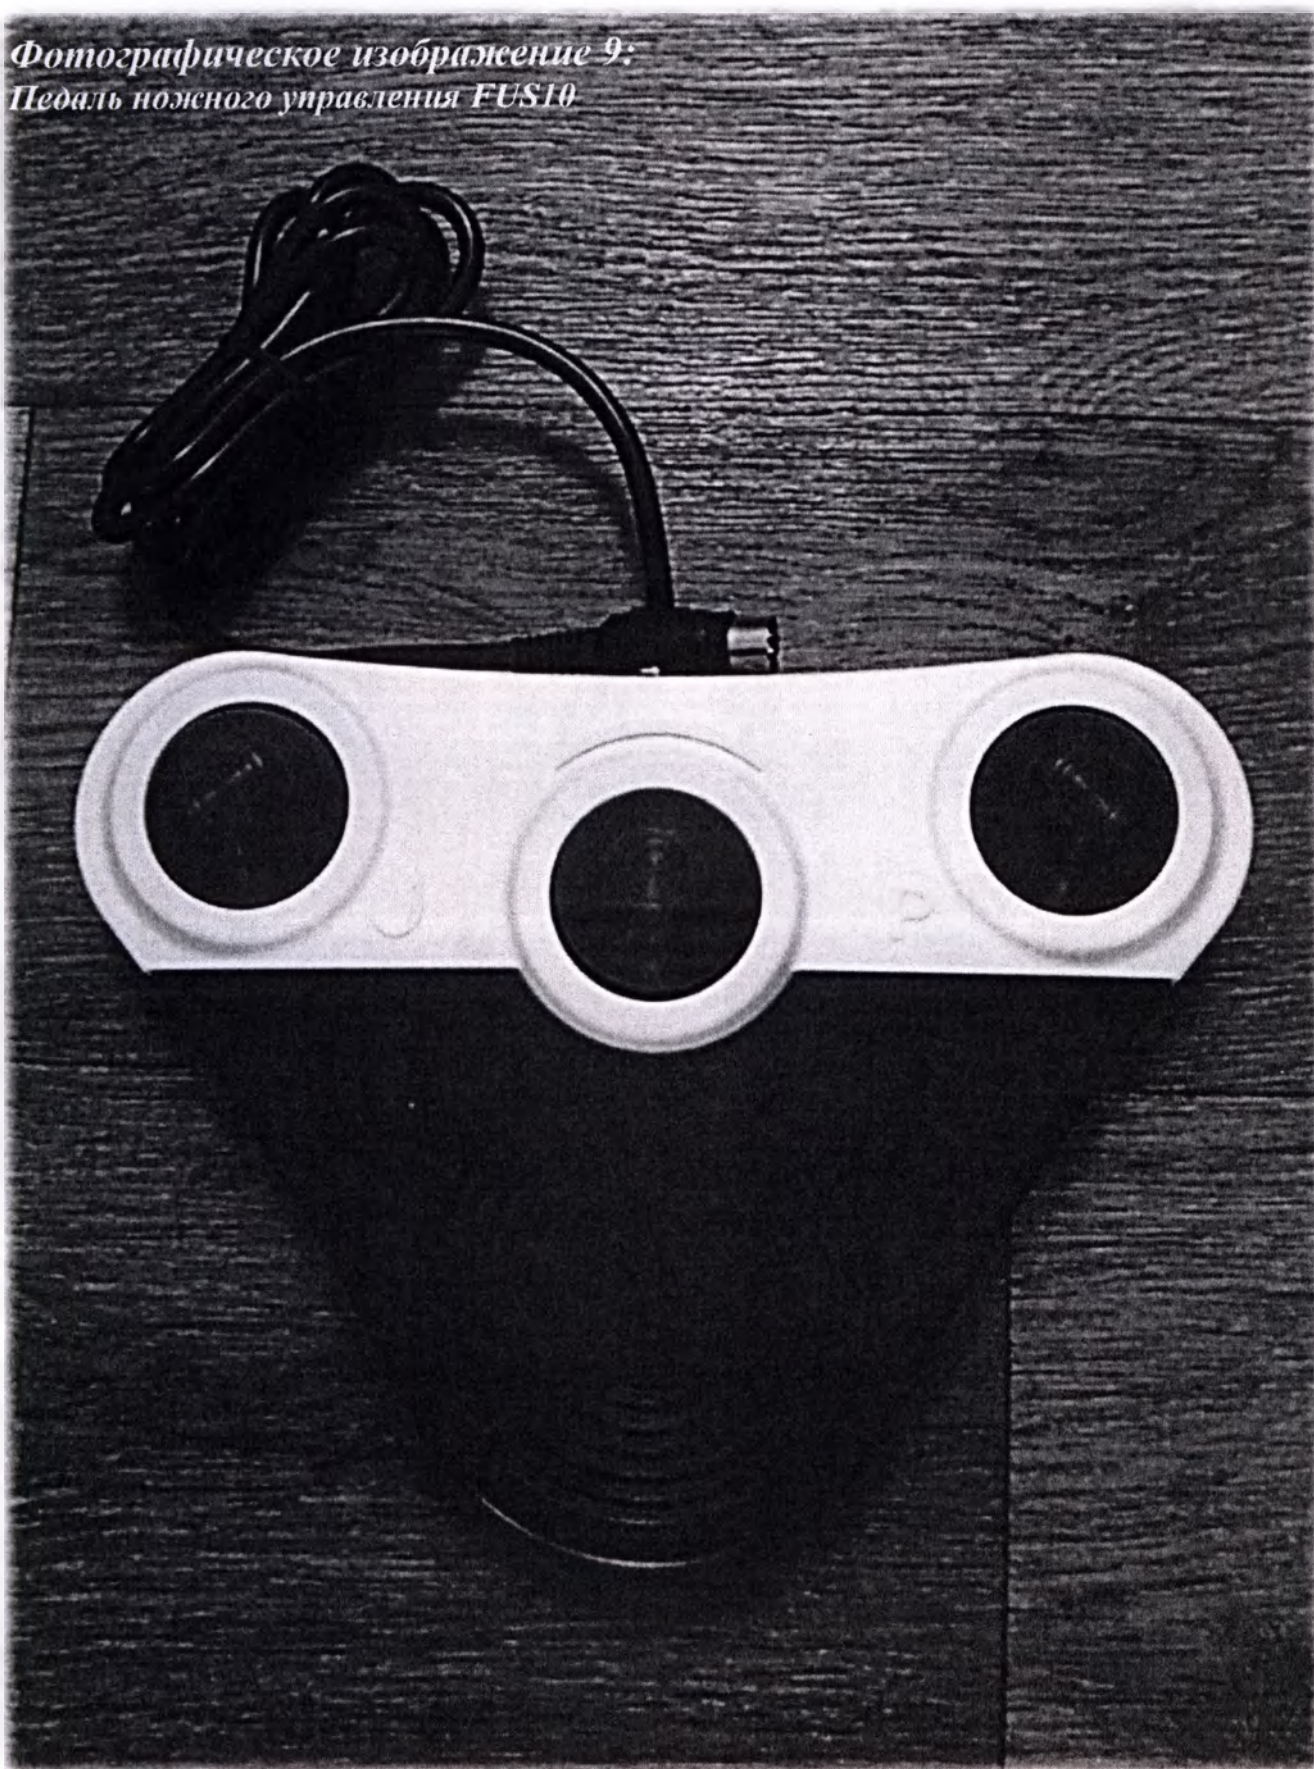

*Фотографическое изображение 10:
Держатель контейнера с инфузионным раствором*

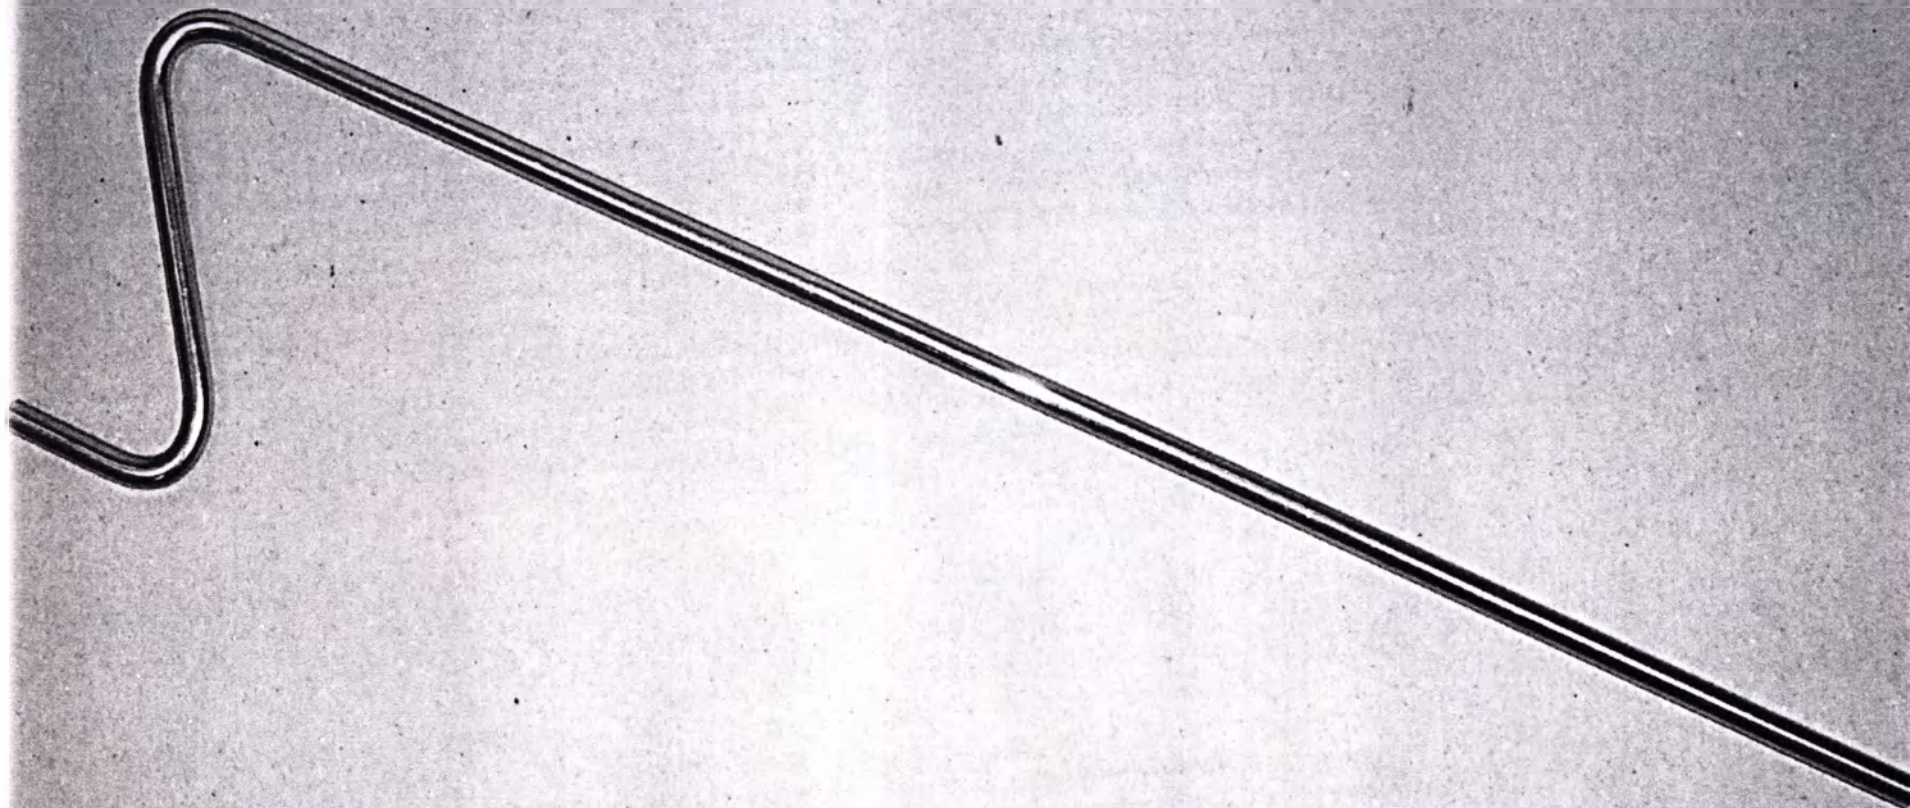

*Фотографическое изображение 11:
Подставка для двигателя постоянного тока*

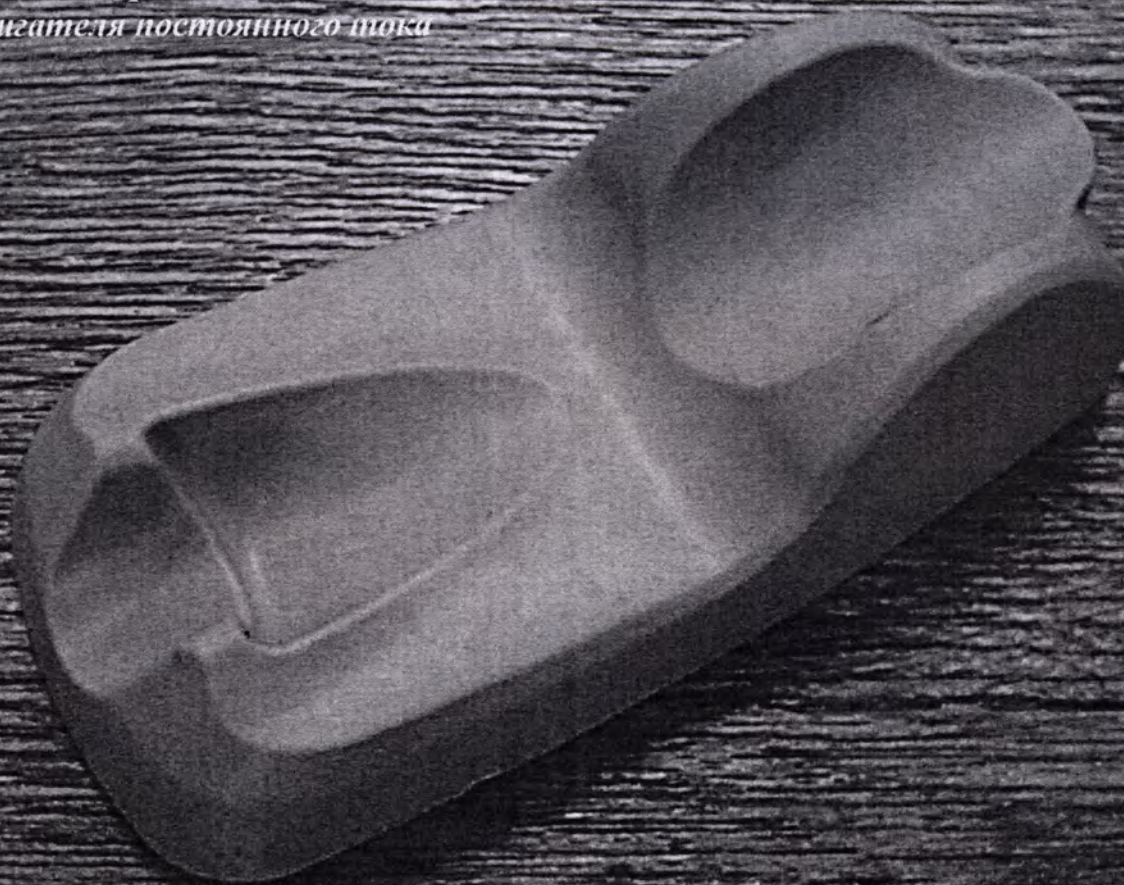

Фотографическое изображение 12:

Набор для ирригационной системы физиодиспенсера стерильный в составе:

- Трубка ирригационная;
- V-Трубка:

OMNIA
Disposable Medical Devices

Manufacturer
Omnia S.p.A.
Via F. Delmevo, 190xx
43036 Fidenza (PR) - Italy
tel +39 0524 527453
fax +39 0524 529256
www.omniaspa.eu
info@omniaspa.eu

Distribuidor para España y Portugal
Omnia España, S. L.
Plaça Francesc Macià, 8 - 8º D
08028 Barcelona - Spain
tel +34 93 45 405 31 18
fax +34 93 45 438 31 42
www.omniaspa.com
omniaspa@omnia-spa.es

Etichetta di tracciabilità removibile - Peeling labels for traceability

OMNIA

REF 32.F0244.00
13020801 2018-02

OMNIA

REF 32.F0244.00
13020801 2018-02

1- Irrigation tube set includes: irrigator
2- For use only if the packaging is open or damaged
3- Attention: no gas release is recommended
4- Attention: no gas release is recommended
5- Attention: no gas release is recommended
6- Attention: no gas release is recommended
7- Attention: no gas release is recommended

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist or physician

The product contains phthalates
Il prodotto contiene ftalati

Lot number
LOT 13020801
2018/02

Use by


CE

SPRINT 50


rev 02/5 set/2012

Does not contain natural rubber
Does not contain natural rubber

Attenzione: non legare il pontone blu: serve per
ricordare il deflusso all'ago del medicinale
Caution: use the final tip to connect: do not cut it

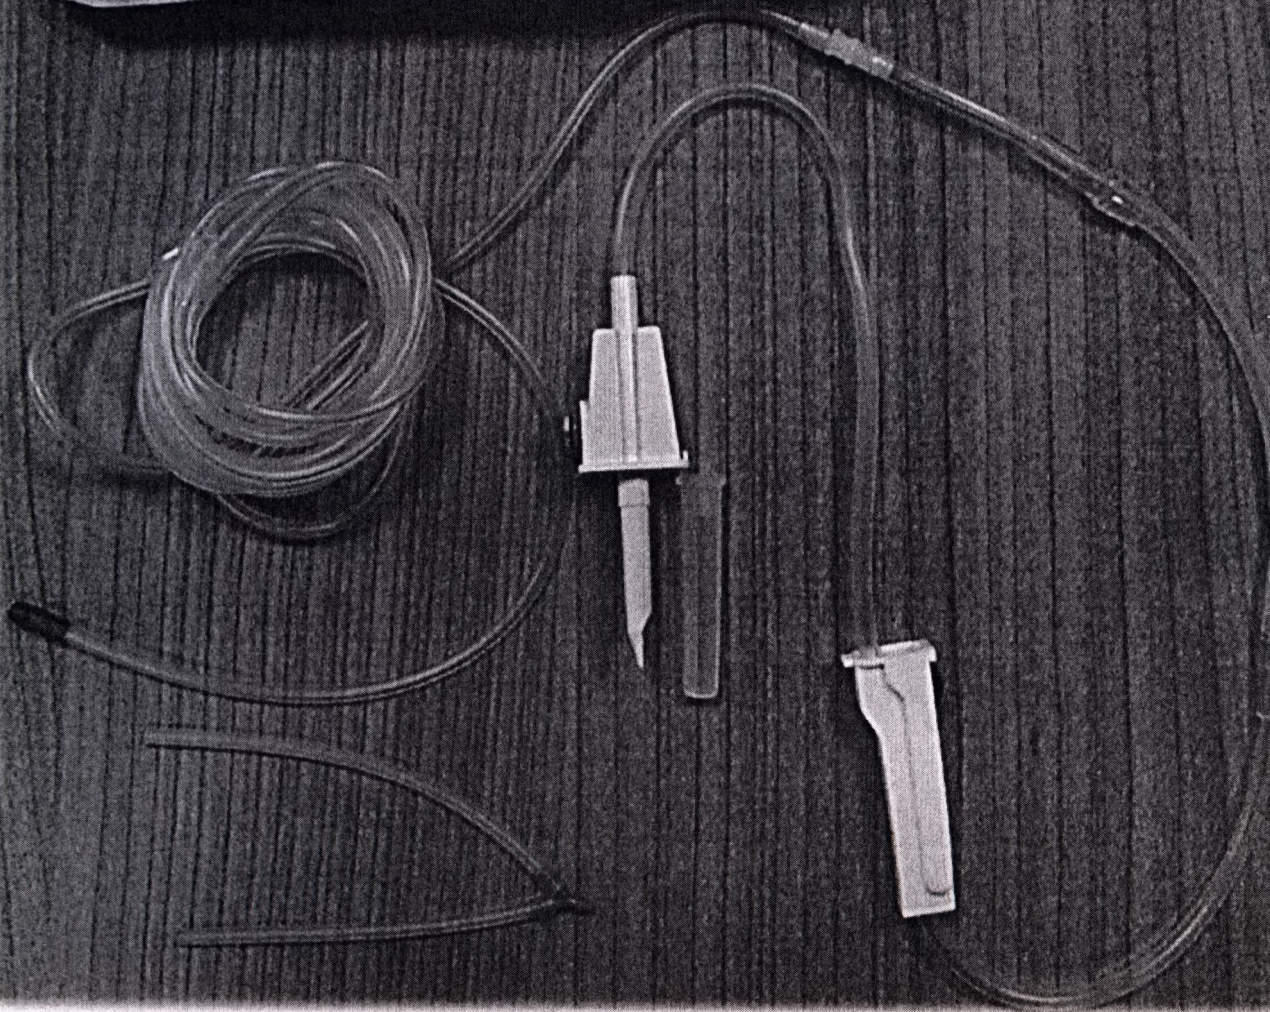


Фотографическое изображение 13:
Держатель-зажим Y-Трубки и держатель трубки ирригационной (10 шт.)

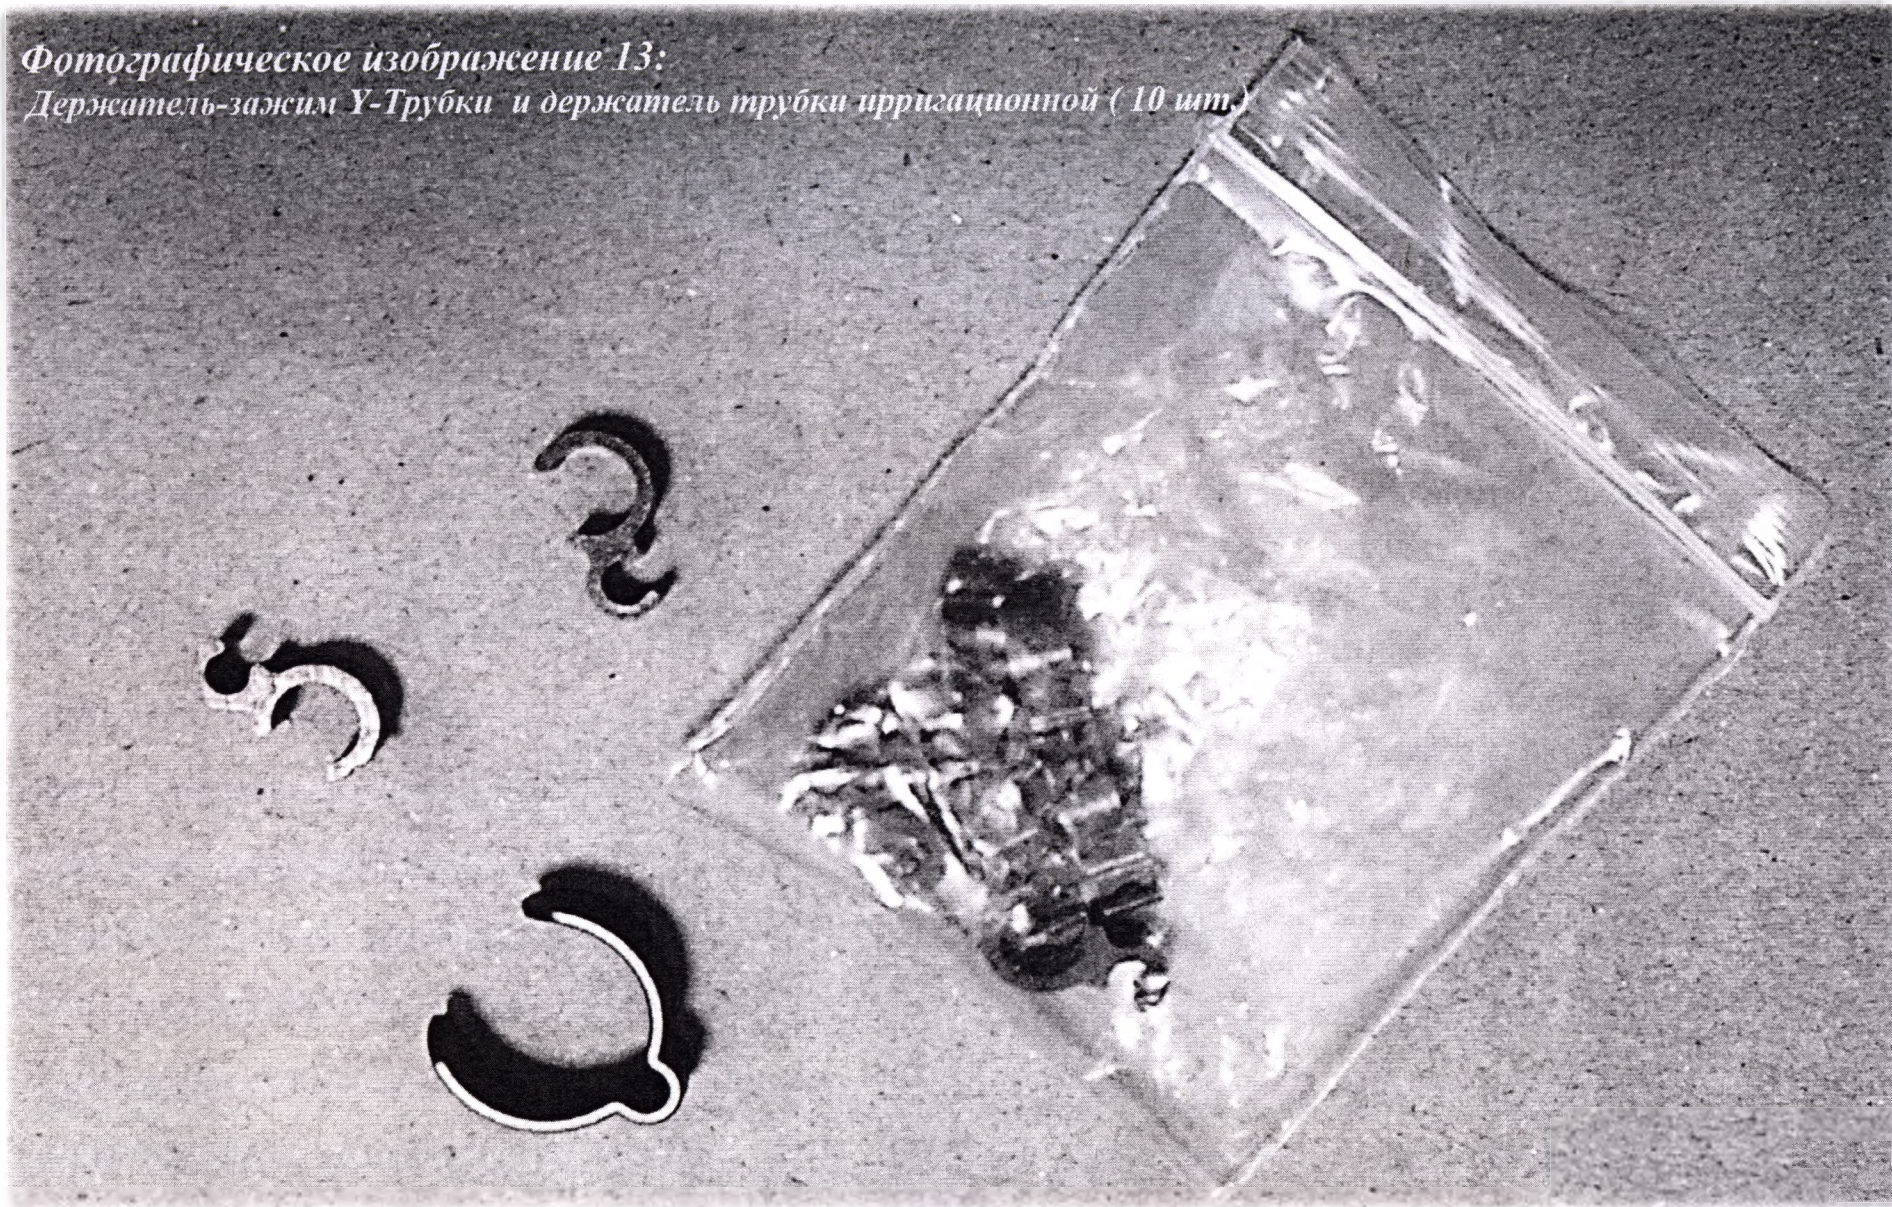

Фотографическое изображение 14:
Инструкции по эксплуатации


TRAUS SIP10

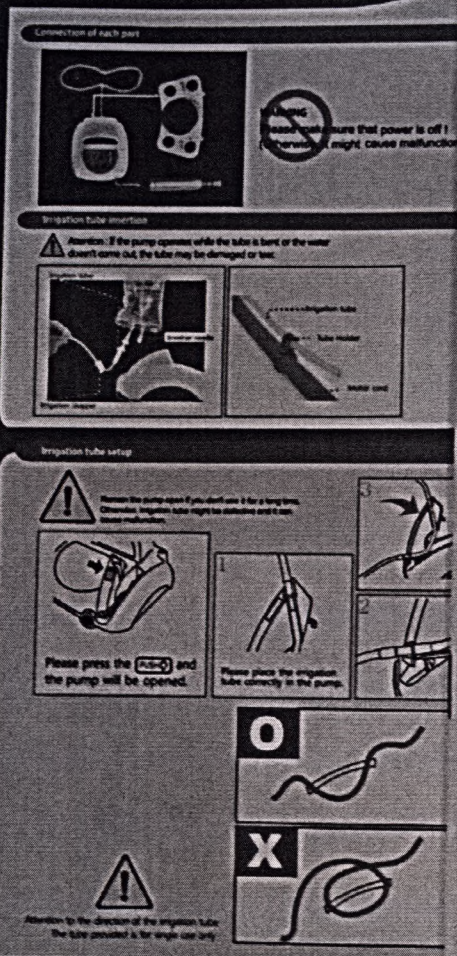

TRAUS

INSTRUCTION MA

FOOT T

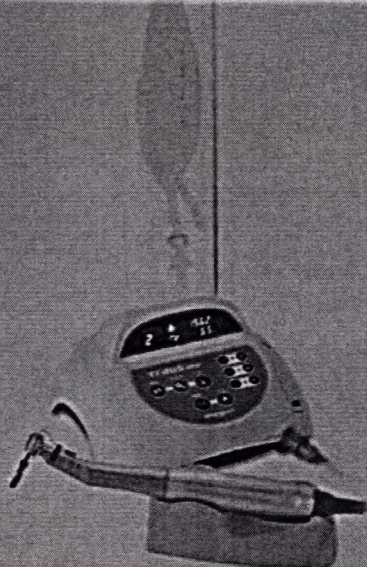

SAESHIN

TRAUS SIP10

INSTRUCTION MANUAL

TRAUS SIP10



SAESHIN

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью: 15 лист(а/ов)
Директор ООО "МедРег. Консалтинг" _____
И.В. Сергеева

