




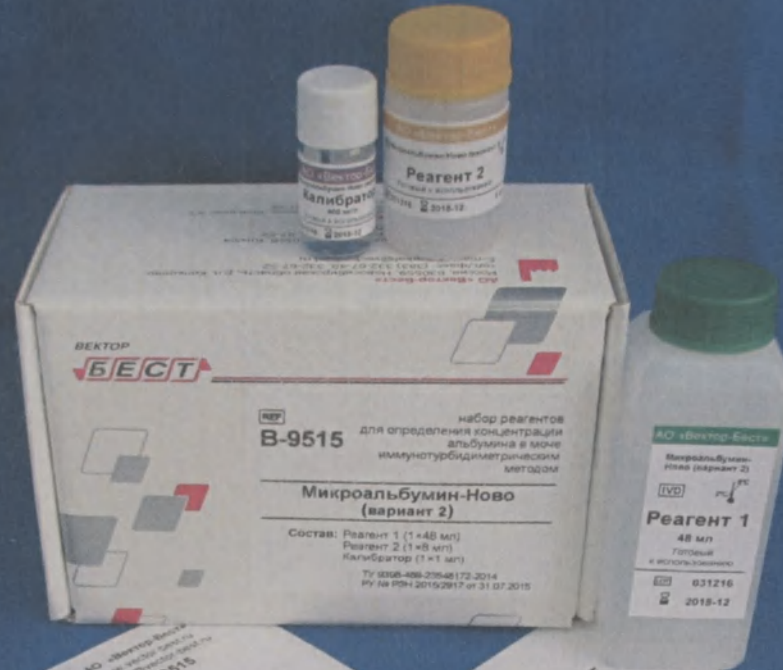

630659, Новосибирская обл., г. Новосибирск, а/я 402
Паспорт № 4017-16
Микроальбумин-Ново (вариант 2)
набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче
иммунотурбидиметрическим методом

Хранить при температуре 2-8°C. Допускается хранение при температуре до 25°C не более 10 дней.

Номер серии 031216
Дата изготовления 2016-12
Дата выдачи паспорта 2016-12-27
Срок годности набора до 2018-12


Характеристика и нормы

РЕАКТИВНОСТЬ


ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для определения
концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом
Микроальбумин-Ново
(варианты 1, 2, 3, 4)


Торф может использоваться для определения альбумина в моче и в паспорте, готовый к использованию - 1 флакон (1,0 мл) (варианты 1 и 2);
- контрольный материал, уровень 1, (ММ) с известным содержанием альбумина в контрольном материале (вариант 1);
- контрольный материал, уровень 2, (ММ) с известным содержанием альбумина в контрольном материале (вариант 1);
По согласованию с потребителем дополнительно предоставляется паспорт для построения калибровочного графика.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

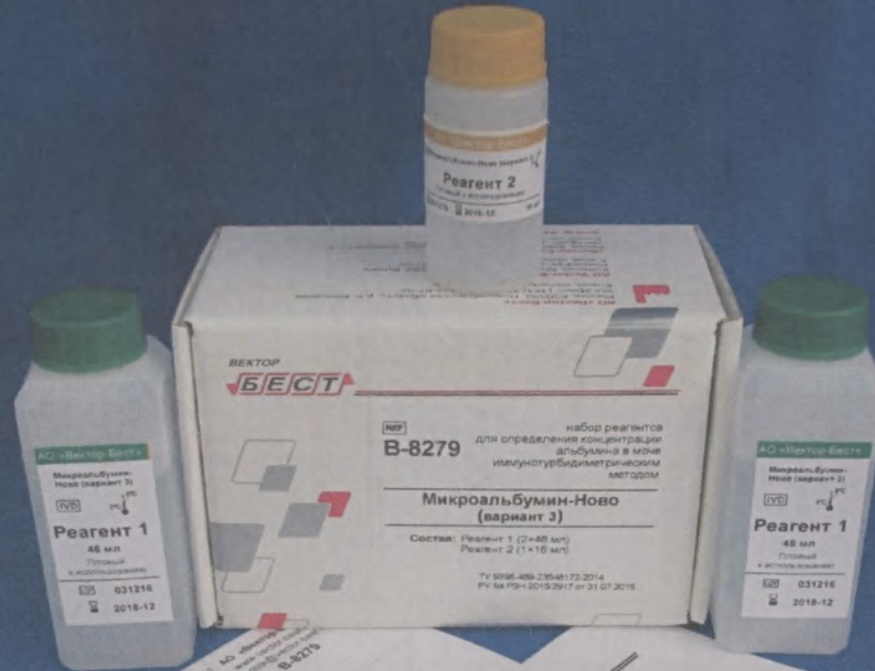

Актин директор
ектор-Бест»

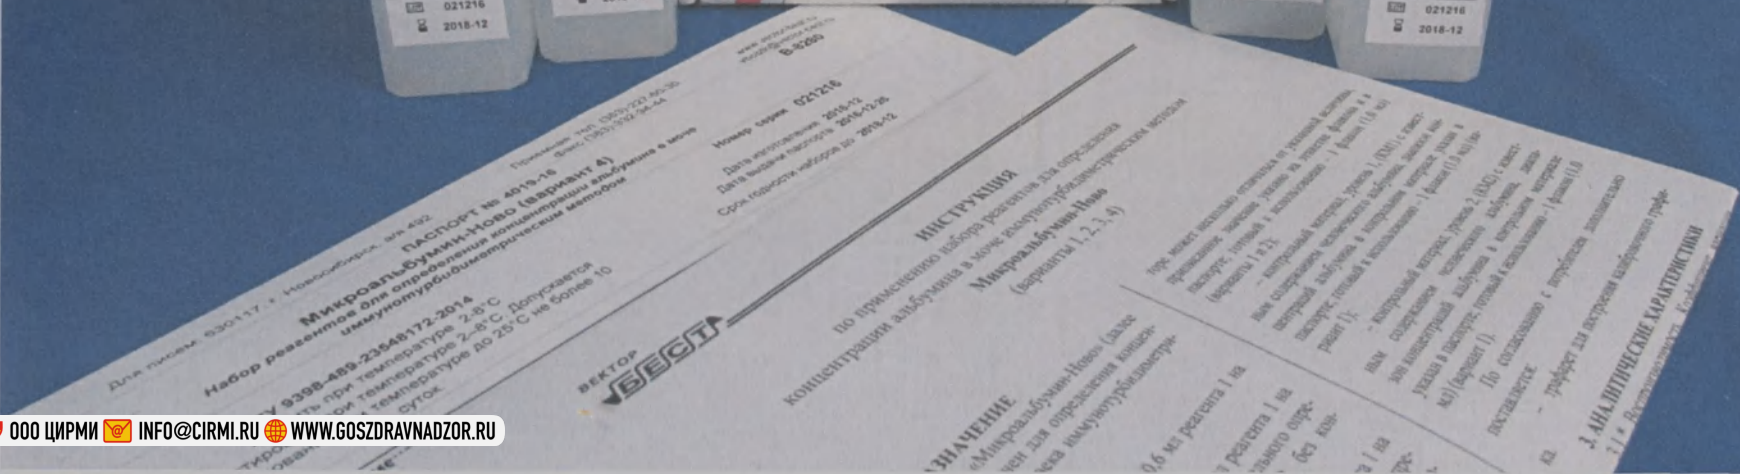

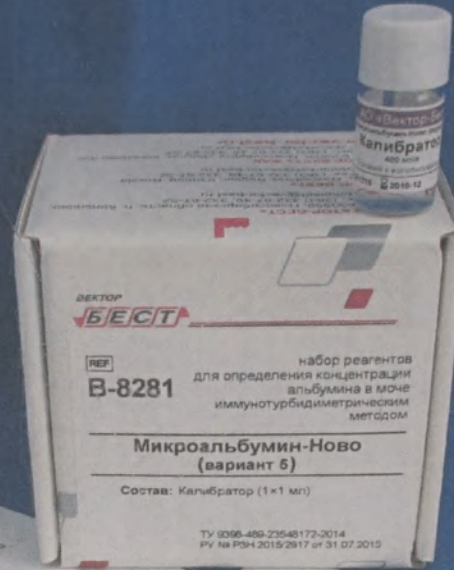

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Микроальбумин-Ново (вариант 5)
ПАСПОРТ № 4108-16
для определения концентрации альбумина в моче
иммунотурбидиметрическим методом

№ 3096-489-23546172-2014
Применять при температуре 2-8°C. Допускается хранение до 25°C не более 10 суток.

Микроальбумин-Ново (вариант 5)
набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом

Состав: Калибратор (1x1 мл)


ТУ 3096-489-23546172-2014
РД № Р94.2015/2817 от 31.07.2015

Микроальбумин-Ново (вариант 5)
ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для определения концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом

Характеристики и нормы

Медицинское значение:
НЕОБХОДИМОЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ
365) мл, кювета с длиной оптического пути 10 мм (12-14)
весовая аналитика 37±0,5°C;
сменными каноническими плазматическими осадками со
жидкости 10-100 мкл, 20-200 мкл и 100-100 мкл;
температура, поддерживаемая температурой 37±0,5°C;
перчатки медицинские диагностические одноразовые;
таймер;
вода дистиллированная;
физиологический раствор (0,9% NaCl);
набор реагентов «Микроальбумин-Ново» (вариант 5);
2, 3 или 4).

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА И РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

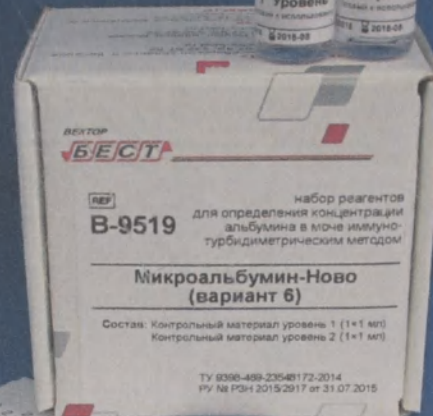

ПАСПОРТ № 3856-16
Микроальбумин-Ново (вариант 6)
для определения концентрации альбумина
в моче методом имунотурбидиметрическим методом

Номер серия 020818
Дата изготовления 2016-08
Дата выдачи паспорта 2016-09-21
Срок годности набора до 2018-08

ІНСТРУКЦІЯ
до набору реагентів для визначення
мочовини в мочі імунотурбидиметричним методом
Мікроальбумін-Ново
(варіант 6)

по применению набора реагентов для определения
концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом
МикроАльбумин-Ново
(вариант 6)

4.5. Химический анализ

4.6. Запрещается прием пищи, жевание жевательных средств и курение в помещениях для работы с опасными трансформаторами и трансформаторными аппаратами.

4.7. Для изготовления традиционных контактных разъемов образцы из материала, сформированного из расплава, подвергают механической обработке на станках с ЧПУ (сверление, шлифование).

4.1. Указание для выбора режима расчета: $\alpha = 0.1$ (для расчета с учетом влияния температуры на свойства материала)