


«Вектор-Бест»


04 2019 г.





ВЕКТОР

БЕСТ

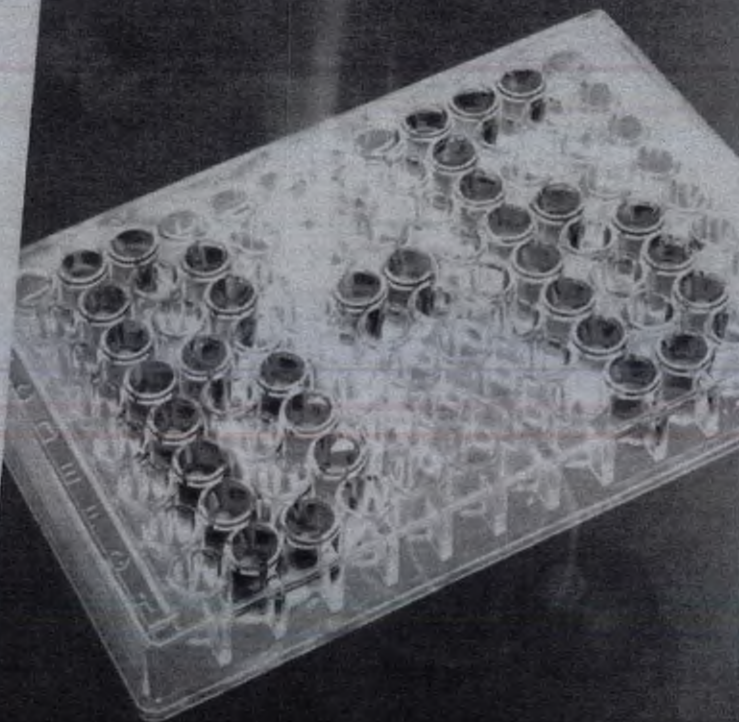

REF

D-0555

набор реагентов
для иммуноферментного
выявления HBsAg

**Вектоген В – HBs-антиген
(комплект 1)**

LOT 2532

СОСТАВ:

LOT

1. Планшеты с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	2 шт.	319032
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	3918
3. Слабopоложительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	591
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 2,5 мл	3306
5. Конъюгат, концентрат	1 фл. 1,4 мл	9588
6. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 14,0 мл	4281
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2805
8. Субстратный буферный раствор	2 фл. по 13,0 мл	539
9. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл. 1,5 мл	882
10. Стоп-реагент	1 фл. 21,0 мл	1297
Принадлежности:		
Плѐнка для заклеивания планшета	2 шт.	
Ванночки для реагентов	2 шт.	
Наконечники для пипеток	16 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 1))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«Вектор-Бест» _____ 04 _____ 2019 г.

BEKTOP

БЕСТ

REF **D-0555**

Σ 2×96

LOT **2532**

ТУ 9398-461-23548172-2014

РУ № РЗН 2015/2887 от 26.04.2017

2019-05-28

2021-05-28

**Вектоген В – HBs-антиген
(комплект 1)**

IVD



05552805210253201016


*Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют*

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 1))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2019 г.

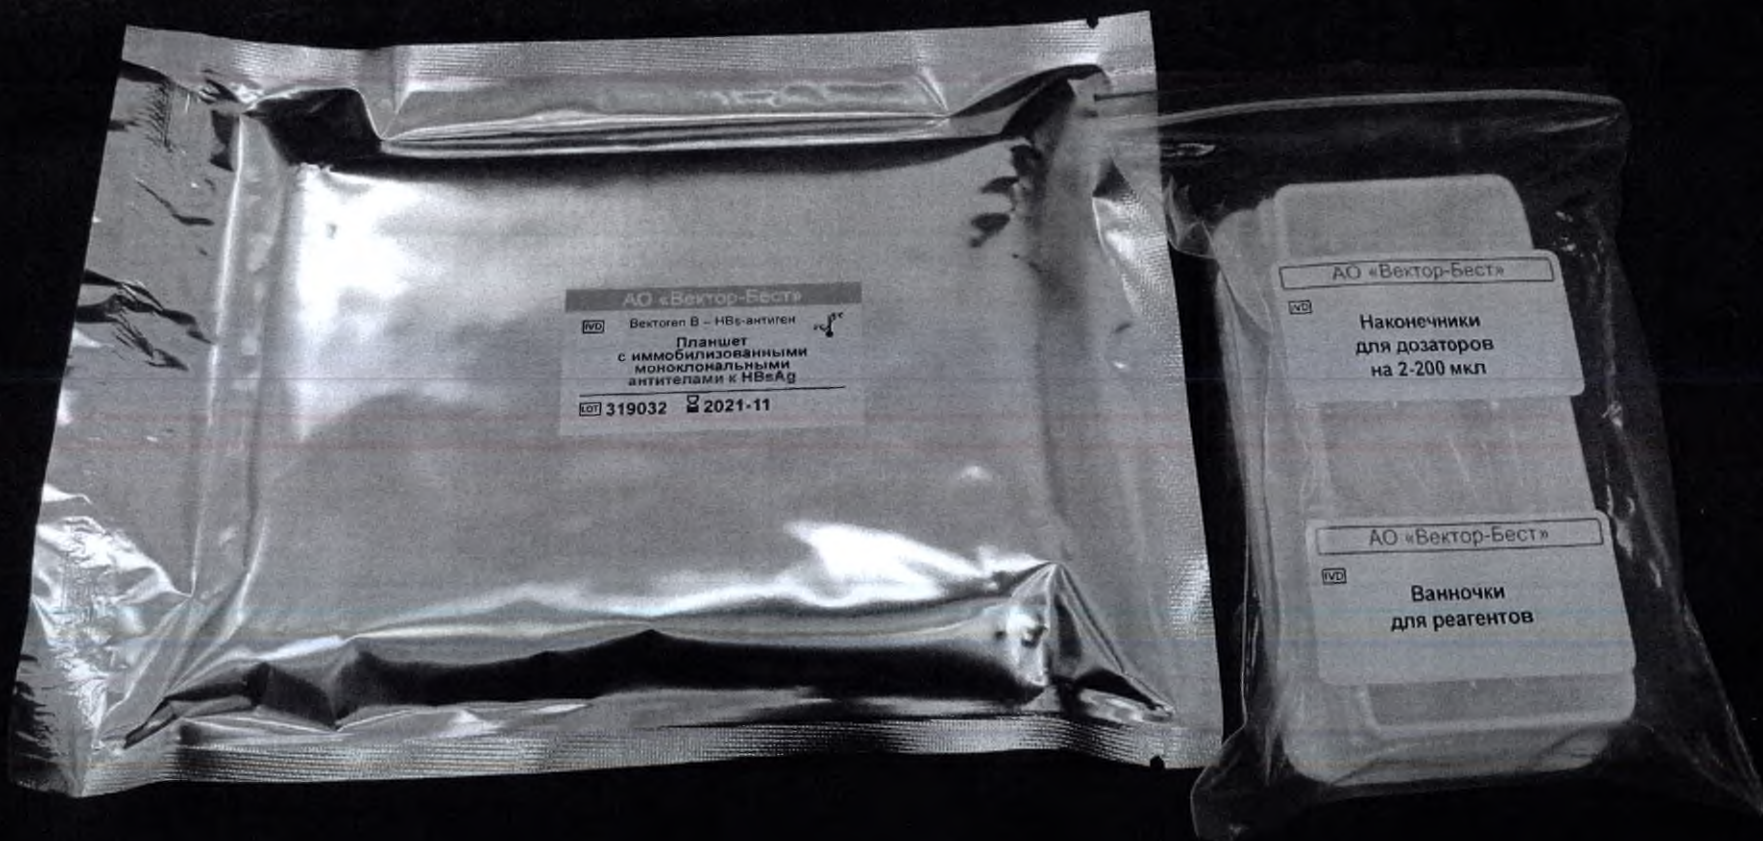

АО «Вектор-Бест»
Вектоген В – HBs-антиген
Планшет
с иммобилизованными
моноклональными
антителами к HBsAg
LOT 319032 2021-11

АО «Вектор-Бест»
Наконечники
для дозаторов
на 2-200 мкл

АО «Вектор-Бест»
Ванночки
для реагентов

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 1))» № 2

Генеральный директор Хусаинов М.Д.
АО «Вектор-Бест» 11/04 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 1))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
04 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 1))» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«Вектор-Бест»
2019 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 2))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
04 2019 г.





ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-0557

набор реагентов
для иммуноферментного
выявления HBsAg

Вектоген В – HBs-антиген
(комплект 2)

LOT 2547

СОСТАВ:

LOT

1. Планшеты разборные с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	2 шт.	319045
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	2 фл. по 1,5 мл	3978
3. Слабоположительный контрольный образец, инактивированный	2 фл. по 1,5 мл	592
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	2 фл. по 2,5 мл	3320
5. Конъюгат, концентрат	1 фл. 1,4 мл	9872
6. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 14,0 мл	4321
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2809
8. Субстратный буферный раствор	2 фл. по 13,0 мл	546
9. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл. 1,5 мл	884
10. Стоп-реагент	1 фл. 21,0 мл	1303

Принадлежности:

Плёнка для заклеивания планшета	4 шт.
Ванночки для реагентов	4 шт.
Наконечники для пипеток	32 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 2))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

2019 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

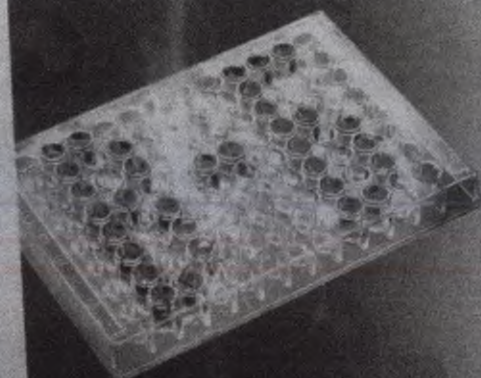

REF **D-0557**

Σ 192

LOT **2547**

ТУ 9398-461-23548172-2014

ПУ № РЗН 2015/2887 от 26.04.2017

2019-07-04

2021-07-04

Вектоген В – HBs-антиген
(комплект 2)

IVD



05570407210254701076


Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 2))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

07 2019 г.

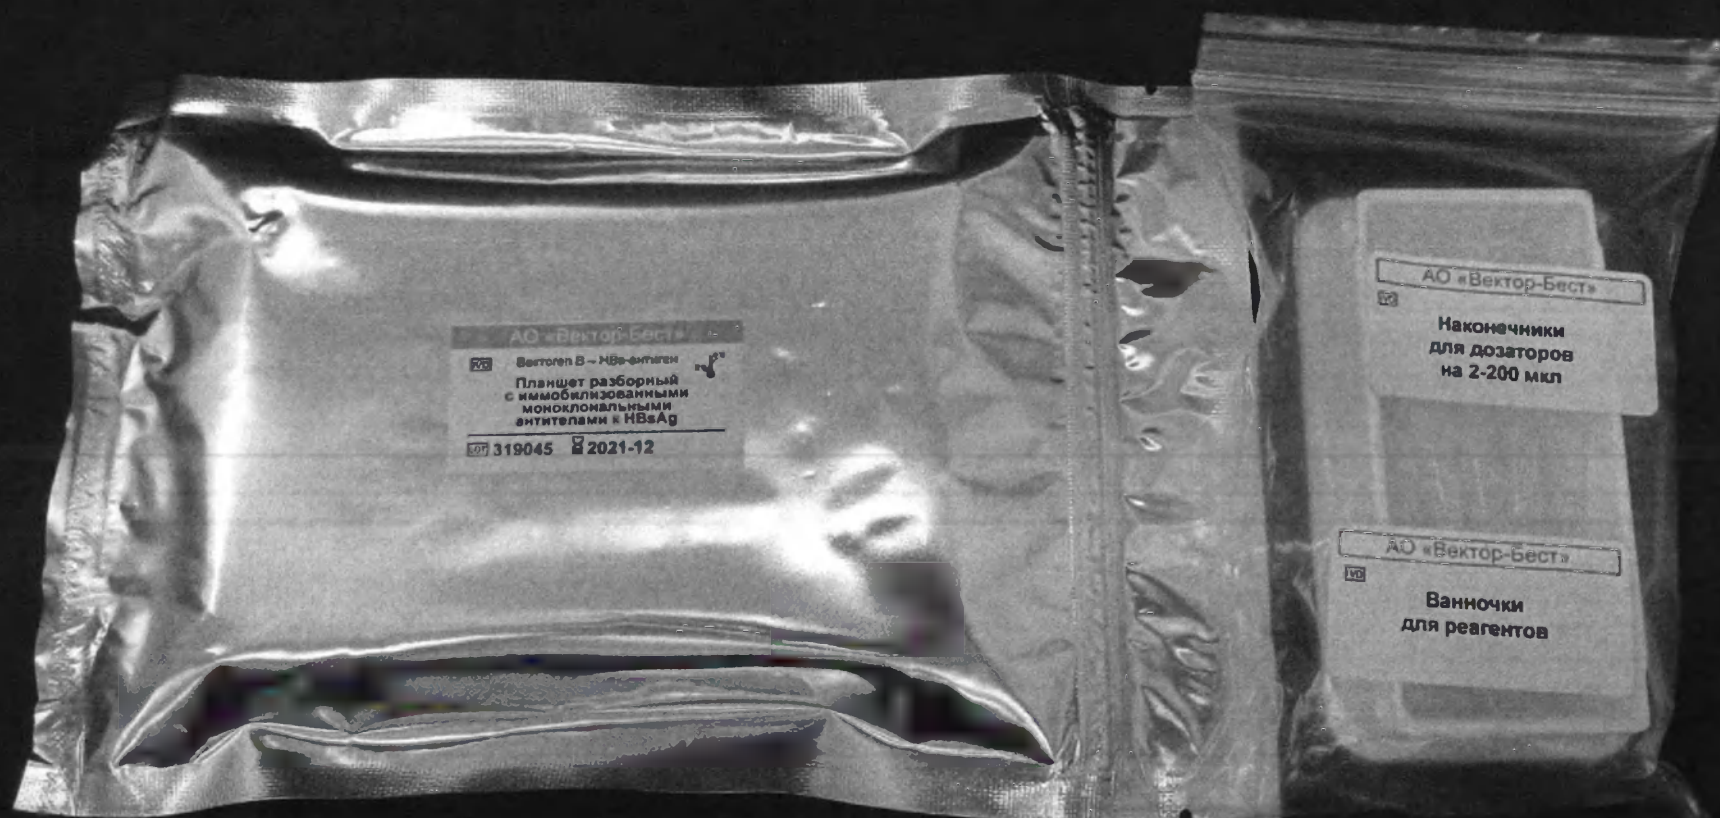


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 2))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 2))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

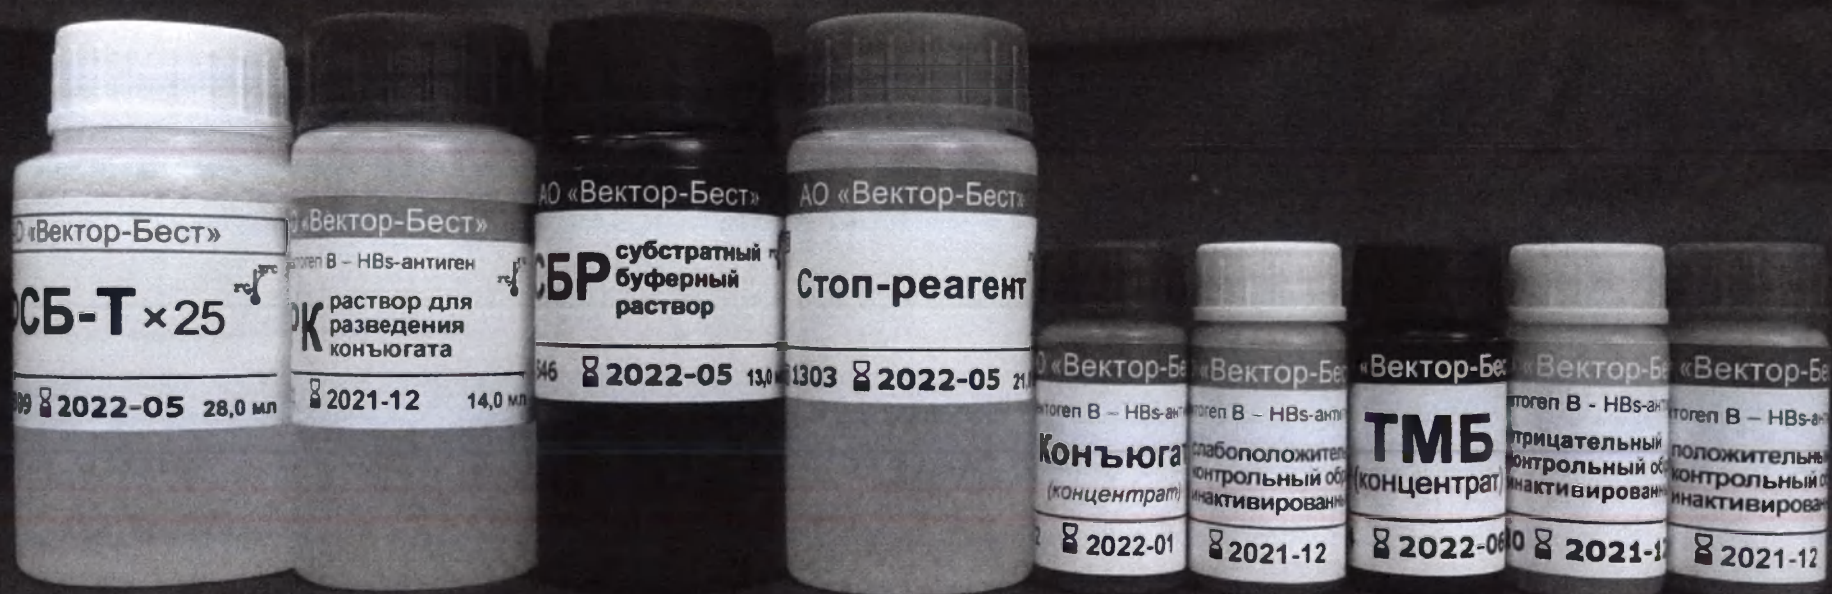

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 2))» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
04 2019 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 3))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


2019 г.





ВЕКТОР

БЕСТ

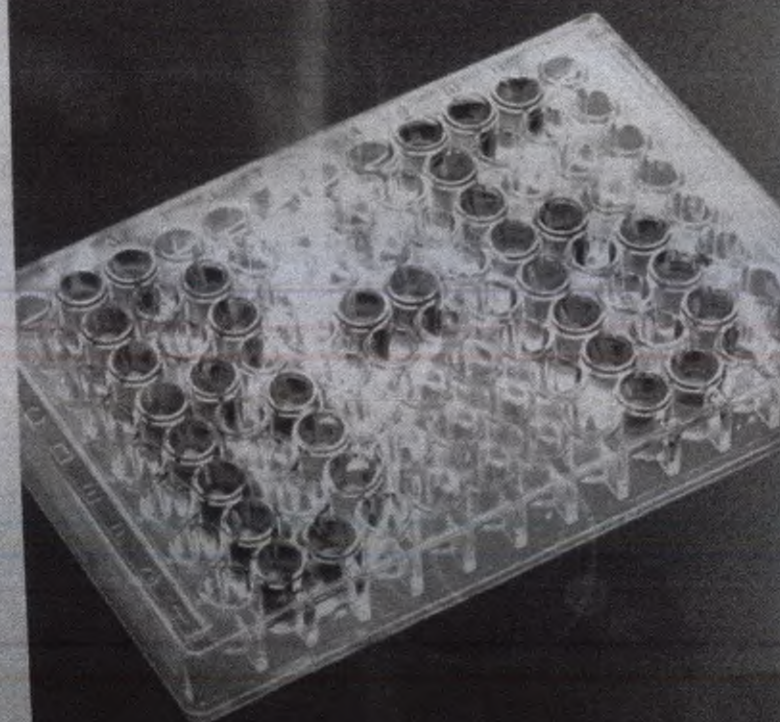

REF

D-0556

набор реагентов
для иммуноферментного
выявления HBsAg

**Вектоген В – HBs-антиген
(комплект 3)**

LOT 2542

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	1 шт.	319043
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	3959
3. Слабopоложительный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 1,5 мл	592
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл. 2,5 мл	3320
5. Конъюгат, концентрат	1 фл. 0,7 мл	9656
6. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 7,0 мл	4307
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2808
8. Субстратный буферный раствор	1 фл. 13,0 мл	546
9. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл. 1,5 мл	883
10. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	1296

Принадлежности:


Плѐнка для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночки для реагентов	2 шт.
Наконечники для пипеток	16 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 3))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



БЕКТОР
БЕСТ

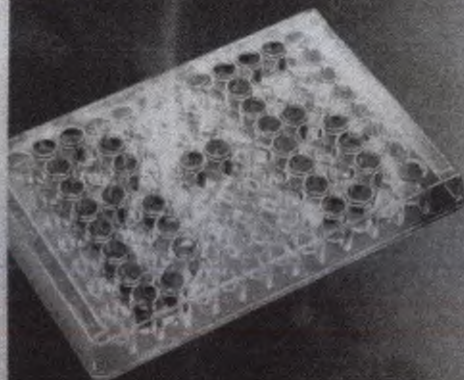

REF

D-0556

Σ 12×8

LOT

2542

ТУ 9398-461-23548172-2014

ПУ № РЗН 2015/2887 от 26.04.2017



2019-07-01



2021-07-01

Вектоген В – HBs-антиген
(комплект 3)

IVD



05560107210254200167

Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 3))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2019 г.

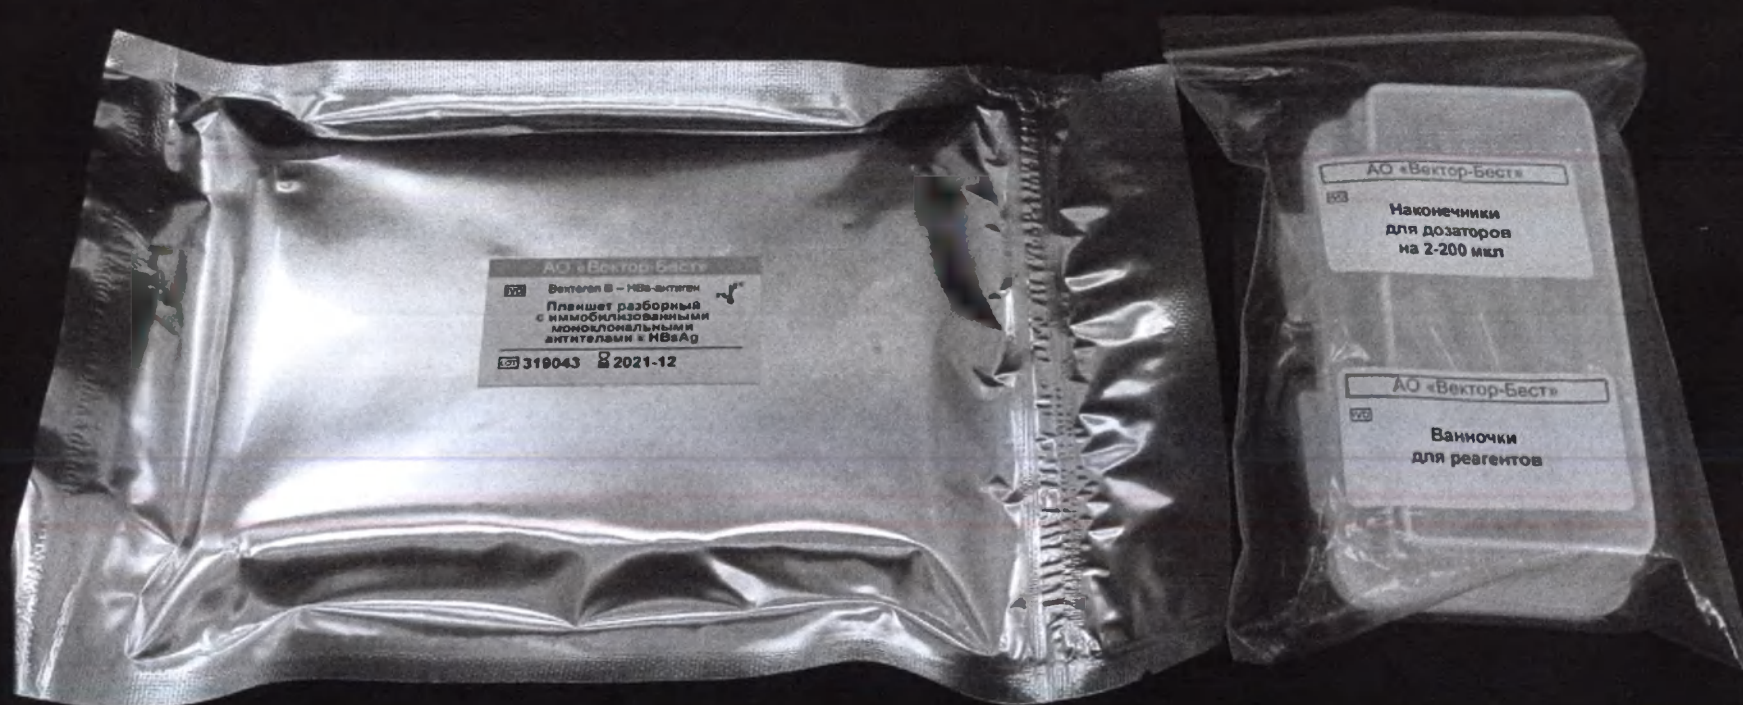

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 3))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»







2019 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 4))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.
04 2019 г.
Акционерное общество
«Вектор-Бест»
ВЕКТОР





ВЕКТОР

БЕСТ

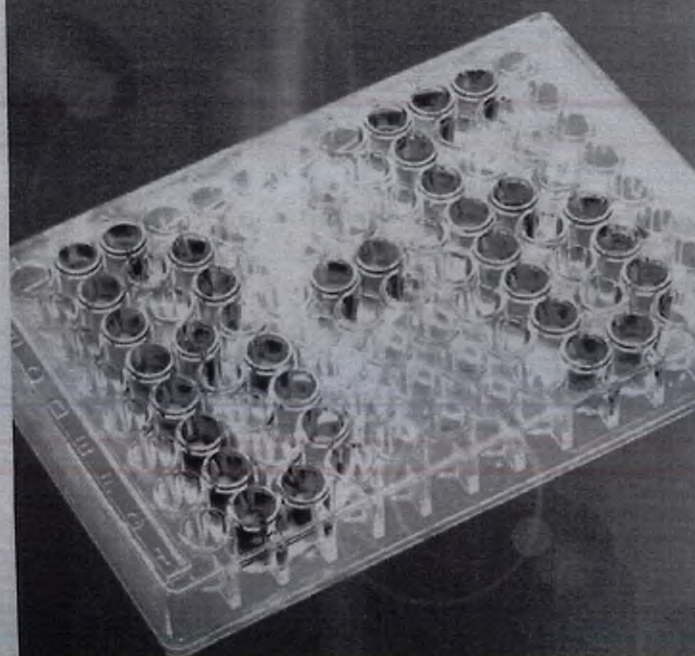

REF

D-0559

набор реагентов
для иммуноферментного
выявления HBsAg

**Вектоген В – HBs-антиген
(комплект 4)**

LOT 2546

СОСТАВ:

LOT

1. Планшеты разборные с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	5 шт.	319044
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	2 фл. по 1,5 мл	3959
3. Слабоположительный контрольный образец, инактивированный	2 фл. по 1,5 мл	592
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	2 фл. по 2,5 мл	3320
5. Конъюгат, концентрат	3 фл. по 1,4 мл	9848
6. Раствор для разведения конъюгата	3 фл. по 14,0 мл	4306
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 100 мл	2793
8. Субстратный буферный раствор	3 фл. по 20,0 мл	541
9. Тетраметилбензидин, концентрат	3 фл. по 1,6 мл	883
10. Стоп-реагент	3 фл. по 21,0 мл	1299

Принадлежности:

Плётка для заклеивания планшета	10 шт.
Ванночки для реагентов	10 шт.
Наконечники для пипеток	80 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 4))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

«11» 07 2019 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

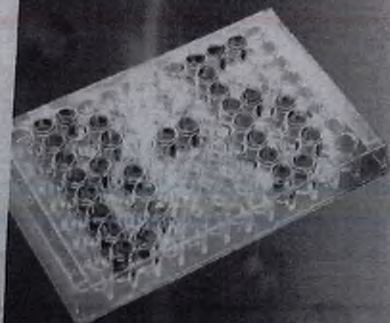

REF **D-0559**

Σ 480

LOT **2546**

ТУ 9398-461-23548172-2014

ПУ № РЗН 2015/2887 от 26.04.2017

2019-07-01

2021-07-01

Вектоген В – HBs-антиген
(комплект 4)

IVD



05590107210254600084

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 4))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

« 18 »

04

2019 г.

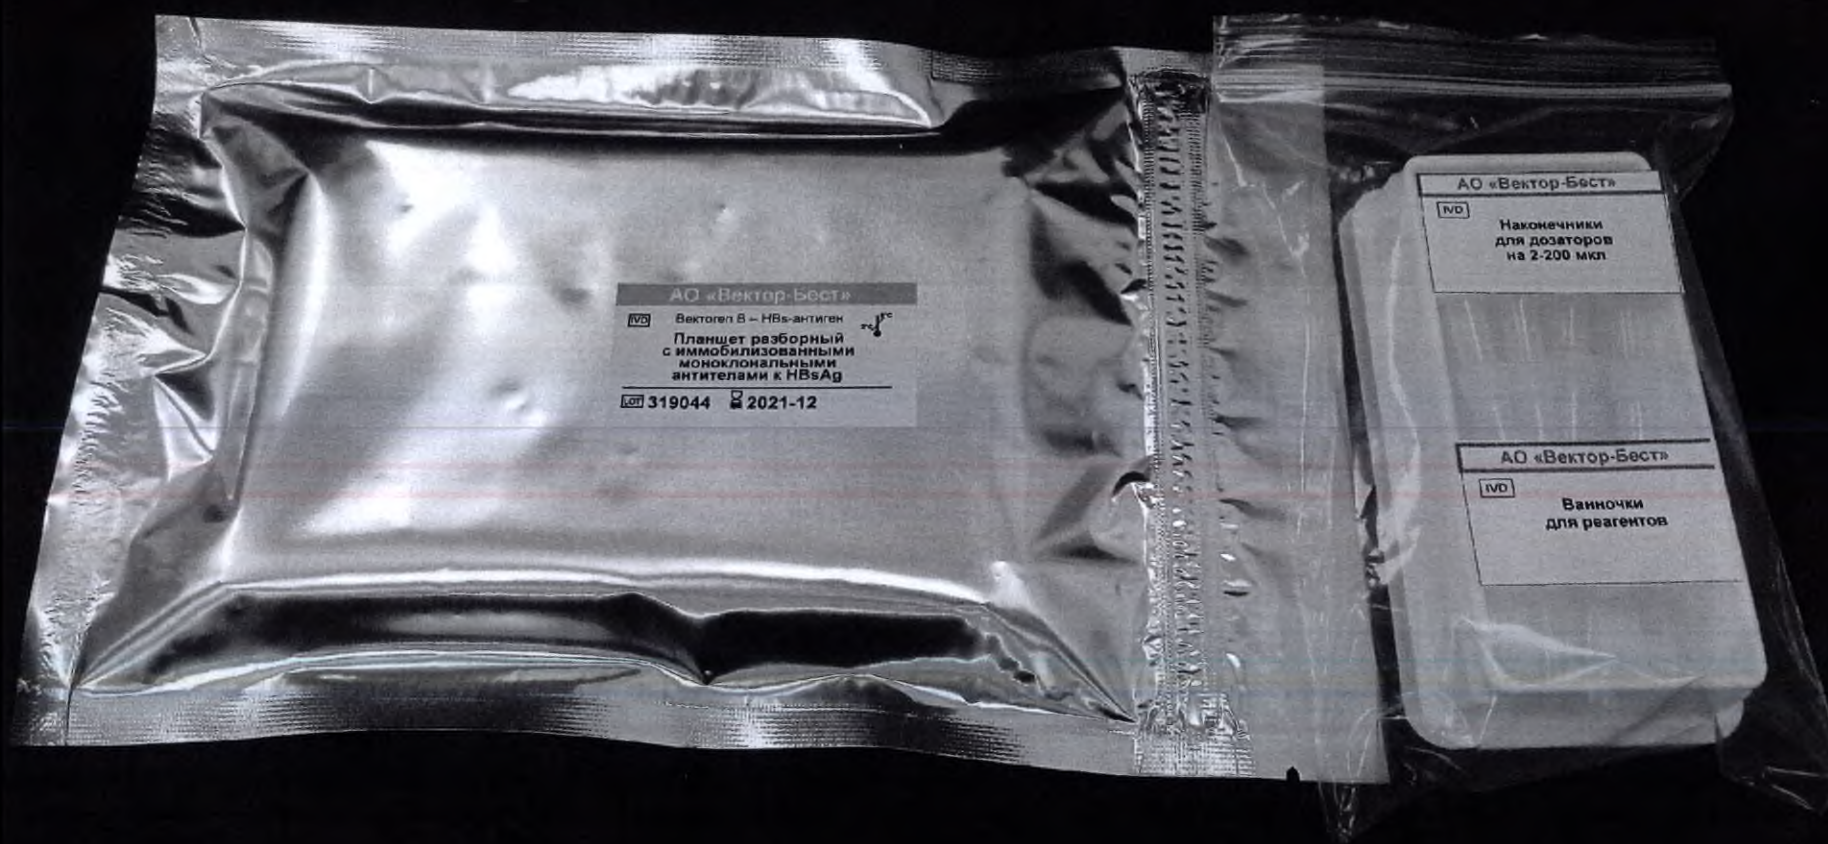

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 4))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

« 14 » 04 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектоген В-HBs-антиген (комплект 4))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
(Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 4))» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«11» 10/2019 г.

