

Макет маркировки медицинского изделия

Набор реагентов

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT

Форма 1: «IT-комплект» вариант 200

На 3 листах

Маркировка комплекта «IT-комплект» вариант 200



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT

ТУ 21.20.23-412-01897593-2020




Форма 1: «IT-комплект» вариант 200

V₂₀₀

Состав комплекта:

IT-mix SARS-CoV-2	1,0 мл x 1
IT-mix-E	1,0 мл x 1
C+ IT-SARS-CoV-2	0,1 мл x 1
C-	1,0 мл x 2



Следствие на товарный знак № 212724, № 321489 Регистрационный номер:

Маркировка реагентов, входящих в состав «IT-комплект» вариант 200

Наименование реагента	Маркировка
IT-mix SARS-CoV-2	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора IT-mix SARS-CoV-2 1,0 мл Серия Кат. № Дата изготоп. Срок годности Условия хранения -24°C -16°C AmpliSens
IT-mix-E	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора IT-mix-E 1,0 мл Серия Кат. № Дата изготоп. Срок годности Условия хранения -24°C -16°C AmpliSens
C+ IT-SARS-CoV-2	АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT C+ IT-SARS-CoV-2 0,1 мл Серия Кат. № Дата изготоп. Срок годности Условия хранения -24°C -16°C AmpliSens

С-		AmpliSens	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора	
			С- 1,0 мл Серия Кат. № Дата изгот. Срок годности Условия хранения -24°C -16°C	

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

Руководитель группы
стандартизации

должность



подпись

Пыпкина М.А.

Ф.И.О.

15.03.21

Дата

КОПИЯ ВЕРНА

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 3

лист 2

Руководитель подразделения развития и качества продукции
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 60/20 от 17.04.2020г.)

Е.А. Козлова



« 01 » 03 2021 г.
М.П.

Макет маркировки медицинского изделия

Набор реагентов

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT

Форма 2: «РИБО-преп» вариант 100 (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200

На 5 листах

Маркировка набора реагентов (упаковка 1 из 2)



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT

ТУ 21.20.23-412-01897593-2020




Форма 2: «РИБО-преп» вариант 100 (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200



Упаковка 1 из 2 включает:

«РИБО-преп» вариант 100 - 2 шт.




Свидетельство на товарный знак № 212774, № 321480

Регистрационный номер:

Маркировка комплекта «РИБО-преп» вариант 100 (комплект 1 из 3)



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT

ТУ 21.20.23-412-01897593-2020



Форма 2: «РИБО-преп» вариант 100 (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200



Комплект 1 из 3

«РИБО-преп» вариант 100

Состав комплекта:

Раствор для лизиса	30 мл x 1
Раствор для преципитации	40 мл x 1
Раствор для отмывки 3	50 мл x 1
Раствор для отмывки 4	20 мл x 1
РНК-буфер	1,2 мл x 8




Свидетельство на товарный знак № 212774, № 321480

Регистрационный номер:

Маркировка комплекта «РИБО-преп» вариант 100 (комплект 2 из 3)



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT

ТУ 21.20.23-412-01897593-2020



Форма 2: «РИБО-преп» вариант 100 (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200

200

Комплект 2 из 3

«РИБО-преп» вариант 100

Состав комплекта:

Раствор для лизиса	30 мл x 1
Раствор для преципитации	40 мл x 1
Раствор для отмывки 3	50 мл x 1
Раствор для отмывки 4	20 мл x 1
РН-буфер	1,2 мл x 8



Свидетельство на товарный знак № 212724 № 321480 Регистрационный номер:

Маркировка реагентов, входящих в состав комплекта «РИБО-преп» вариант 100

Наименование реагента	Маркировка
Раствор для лизиса	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Раствор для лизиса 30 мл AmpliSens Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. Срок годности Условия хранения 2°C → 8°C Warning symbol and barcode
Раствор для преципитации	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Раствор для преципитации 40 мл AmpliSens Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. Срок годности Условия хранения 2°C → 8°C Warning symbol and barcode
Раствор для отмывки 3	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Раствор для отмывки 3 50 мл AmpliSens Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. Срок годности Условия хранения 2°C → 25°C Warning symbol and barcode
Раствор для отмывки 4	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Раствор для отмывки 4 20 мл AmpliSens Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. Срок годности Условия хранения 2°C → 25°C Warning symbol and barcode

РНК-буфер	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора РНК-буфер 1,2 мл Серия LOT Кат. № REP Дата изгот. Срок годности Условия хранения -8°C AmpliSens	
-----------	---	--

**Маркировка комплекта «IT-комплект» вариант 200 (упаковка 2 из 2)
(комплект 3 из 3)**

AmpliSens ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 121211 Москва, ул. Новоторжеская, д. 1 Москва, ул. Новоторжеская, д. 1, стр. 1 тел.: (495) 974-5642, факс: (495) 207-5422 e-mail: info@amplisens.ru, www.amplisens.ru Набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT ТУ 21.20.23-412-01897593-2020 Форма 2: «РН50-преп» вариант 100 (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200 Упаковка 2 из 2 Комплект 3 из 3 «IT-комплект» вариант 200 Состав комплекта: <table border="0"> <tr> <td>IT-mix SARS-CoV-2</td> <td>1,0 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>IT-mix-E</td> <td>1,0 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>C+ IT-SARS-CoV-2</td> <td>0,1 мл x 1</td> </tr> <tr> <td>C-</td> <td>1,0 мл x 2</td> </tr> </table> Сертификат на товарный знак № 212724, № 127140 Регистрационный номер	IT-mix SARS-CoV-2	1,0 мл x 1	IT-mix-E	1,0 мл x 1	C+ IT-SARS-CoV-2	0,1 мл x 1	C-	1,0 мл x 2	AmpliSens ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора ИТ-комплект вариант 200 Упаковка 2 из 2 Комплект 3 из 3 Условия хранения -16°C
IT-mix SARS-CoV-2	1,0 мл x 1								
IT-mix-E	1,0 мл x 1								
C+ IT-SARS-CoV-2	0,1 мл x 1								
C-	1,0 мл x 2								

Маркировка реагентов, входящих в состав «IT-комплекта» вариант 200


Наименование реагента	Маркировка
IT-mix SARS-CoV-2	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора IT-mix SARS-CoV-2 1,0 мл Серия LOT Кат. № REP Дата изгот. Срок годности Условия хранения -16°C AmpliSens
IT-mix-E	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора IT-mix-E 1,0 мл Серия LOT Кат. № REP Дата изгот. Срок годности Условия хранения -16°C AmpliSens
C+ IT-SARS-CoV-2	АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT C+ IT-SARS-CoV-2 0,1 мл Серия LOT Кат. № REP Дата изгот. Срок годности Условия хранения -16°C AmpliSens

C-		Amplisens	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора	
			C- 1,0 мл Серия  Кат. №  Дата изготав.  Срок годности  Условия хранения  -24°C	

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

Руководитель группы
стандартизации

должность


подпись

Пыпкина М.А.

Ф.И.О.

15.03.21

Дата

КОПИЯ ВЕРНА

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 5
лист 06

Руководитель подразделения развития и качества продукции
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 60/20 от 17.04.2020г.)

Е.А. Козлова

« 01 » 03 2021 г.
М.П.

Макет маркировки медицинского изделия

Набор реагентов

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT


Форма 3: «МАГНО-сорб» вариант 100М (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200

На 5 листах

Маркировка набора реагентов (упаковка 1 из 2)



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pct.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT

ТУ 21.20.23-412-01897593-2020




Форма 3: «МАГНО-сорб» вариант 100М (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200



Упаковка 1 из 2 включает:

«МАГНО-сорб» вариант 100М - 2 шт.



Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480




Регистрационный номер:



Маркировка комплекта «МАГНО-сорб» вариант 100М (комплект 1 из 3)



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pct.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT

ТУ 21.20.23-412-01897593-2020



Форма 3: «МАГНО-сорб» вариант 100М (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200




Комплект 1 из 3

«МАГНО-сорб» вариант 100М

Состав комплекта:

Лизирующий раствор МАГНО-сорб	107 мл x 1
Раствор для отмывки 6	87 мл x 1
Раствор для отмывки 7	35 мл x 1
Буфер для элюции	14 мл x 1
Магнетизированная силика	1,0 мл x 2
Компонент А	1,0 мл x 1



Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480




Регистрационный номер:



Маркировка комплекта «МАГНО-сорб» вариант 100М (комплект 2 из 3)



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pccr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов
АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT
ТУ 21.20.23-412-01897593-2020



Форма 3: «МАГНО-сорб» вариант 100М (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200



Комплект 2 из 3

«МАГНО-сорб» вариант 100М

Состав комплекта:

Лизирующий раствор МАГНО-сорб	107 мл x 1
Раствор для отмывки 6	87 мл x 1
Раствор для отмывки 7	35 мл x 1
Буфер для элюции	14 мл x 1
Магнетизированная силика	1,0 мл x 2
Компонент А	1,0 мл x 1

2 °C → 25 °C



Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480



Регистрационный номер:



Маркировка реагентов, входящих в состав комплекта «МАГНО-сорб» вариант 100М

Наименование реагента	Маркировка
Лизирующий раствор МАГНО-сорб	AmpliSens ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Лизирующий раствор МАГНО-сорб 107 мл Серия Кат. № Дата изгот. Срок годности Условия хранения 2 °C → 25 °C
Раствор для отмывки 6	AmpliSens ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Раствор для отмывки 6 87 мл Серия Кат. № Дата изгот. Срок годности Условия хранения 2 °C → 25 °C
Раствор для отмывки 7	AmpliSens ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Раствор для отмывки 7 35 мл Серия Кат. № Дата изгот. Срок годности Условия хранения 2 °C → 25 °C

Буфер для элюции	AmpliSens	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Буфер для элюции 14 мл Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. Срок годности Условия хранения 2°C 25°C	
Магнетизированная силика	AmpliSens	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Магнетизированная силика 1,0 мл Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. Срок годности Условия хранения 2°C 25°C	
Компонент А	AmpliSens	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Компонент А 1,0 мл Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. Срок годности Условия хранения 2°C 25°C	

**Маркировка комплекта «IT-комплект» вариант 200 (упаковка 2 из 2)
(комплект 3 из 3)**

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 111173, Москва, ул. Новогиревская, 3А Ан. пав. ул. Новогиревская, 3А, 119, 6 тел.: (495) 874-96-42, факс: (495) 393-5423 e-mail: info@amplisens.ru, www.amplisens.ru	Набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT ТУ 21.20.23-412-01897593-2020 Форма 3: «МАГНО-сорб» вариант 100Н (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200 Упаковка 2 из 2 Комплект 3 из 3 «IT-комплект» вариант 200 Состав комплекта: IT-mix SARS-CoV-2 1,0 мл x 1 IT-mix-E 1,0 мл x 1 C+ IT-SARS-CoV-2 0,1 мл x 1 C- 1,0 мл x 2 REF LOT Серийный номер на упаковке: 10-232724, № 321420 Регистрационный номер:	V200 -24 °C -16 °C IT-mix-E
---	--	--------------------------------------

Маркировка реагентов, входящих в состав «IT-комплекта» вариант 200

Наименование реагента	Маркировка
IT-mix SARS-CoV-2	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора IT-mix SARS-CoV-2 1,0 мл Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. Срок годности Условия хранения -24°C -16°C

IT-mix-E		ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора IT-mix-E 1,0 мл Серия Кат. № Дата изготов. Срок годности Условия хранения -24°C -16°C AmpliSens	
C+ IT-SARS-CoV-2		AmpliSens® SARS-CoV-2-IT C+ IT-SARS-CoV-2 0,1 мл Серия Кат. № Дата изготов. Срок годности Условия хранения -24°C -16°C AmpliSens	
C-		ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора C- 1,0 мл Серия Кат. № Дата изготов. Срок годности Условия хранения -24°C -16°C AmpliSens	

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

Руководитель группы
стандартизации

должность

подпись

Пыпкина М.А.

Ф.И.О.

15.03.21

Дата

КОПИЯ ВЕРНА

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:

нес

лист

5
06

Руководитель подразделения развития и качества продукции
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 60/20 от 17.04.2020г.)



Е.А. Козлова



« 01 » 03 2021 г.
М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека



В.Г. Акимкин

«26» февраля 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT

2021 г.



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru




Набор реагентов

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT



ТУ 21.20.23-412-01897593-2020

Форма 1: «IT-комплект» вариант 200



Состав комплекта:

IT-mix SARS-CoV-2	1,0 мл x 1
IT-mix-E	1,0 мл x 1
C+ IT-SARS-CoV-2	0,1 мл x 1
C-	1,0 мл x 2

-24 °C

-16 °C



IT-mix-E

41221-30

18.02.21



2021-02-16




2022-02-16

Срок годности при температуре хранения от -24 °C до -16 °C: 12 месяцев

3


**Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 1,
до вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock)**

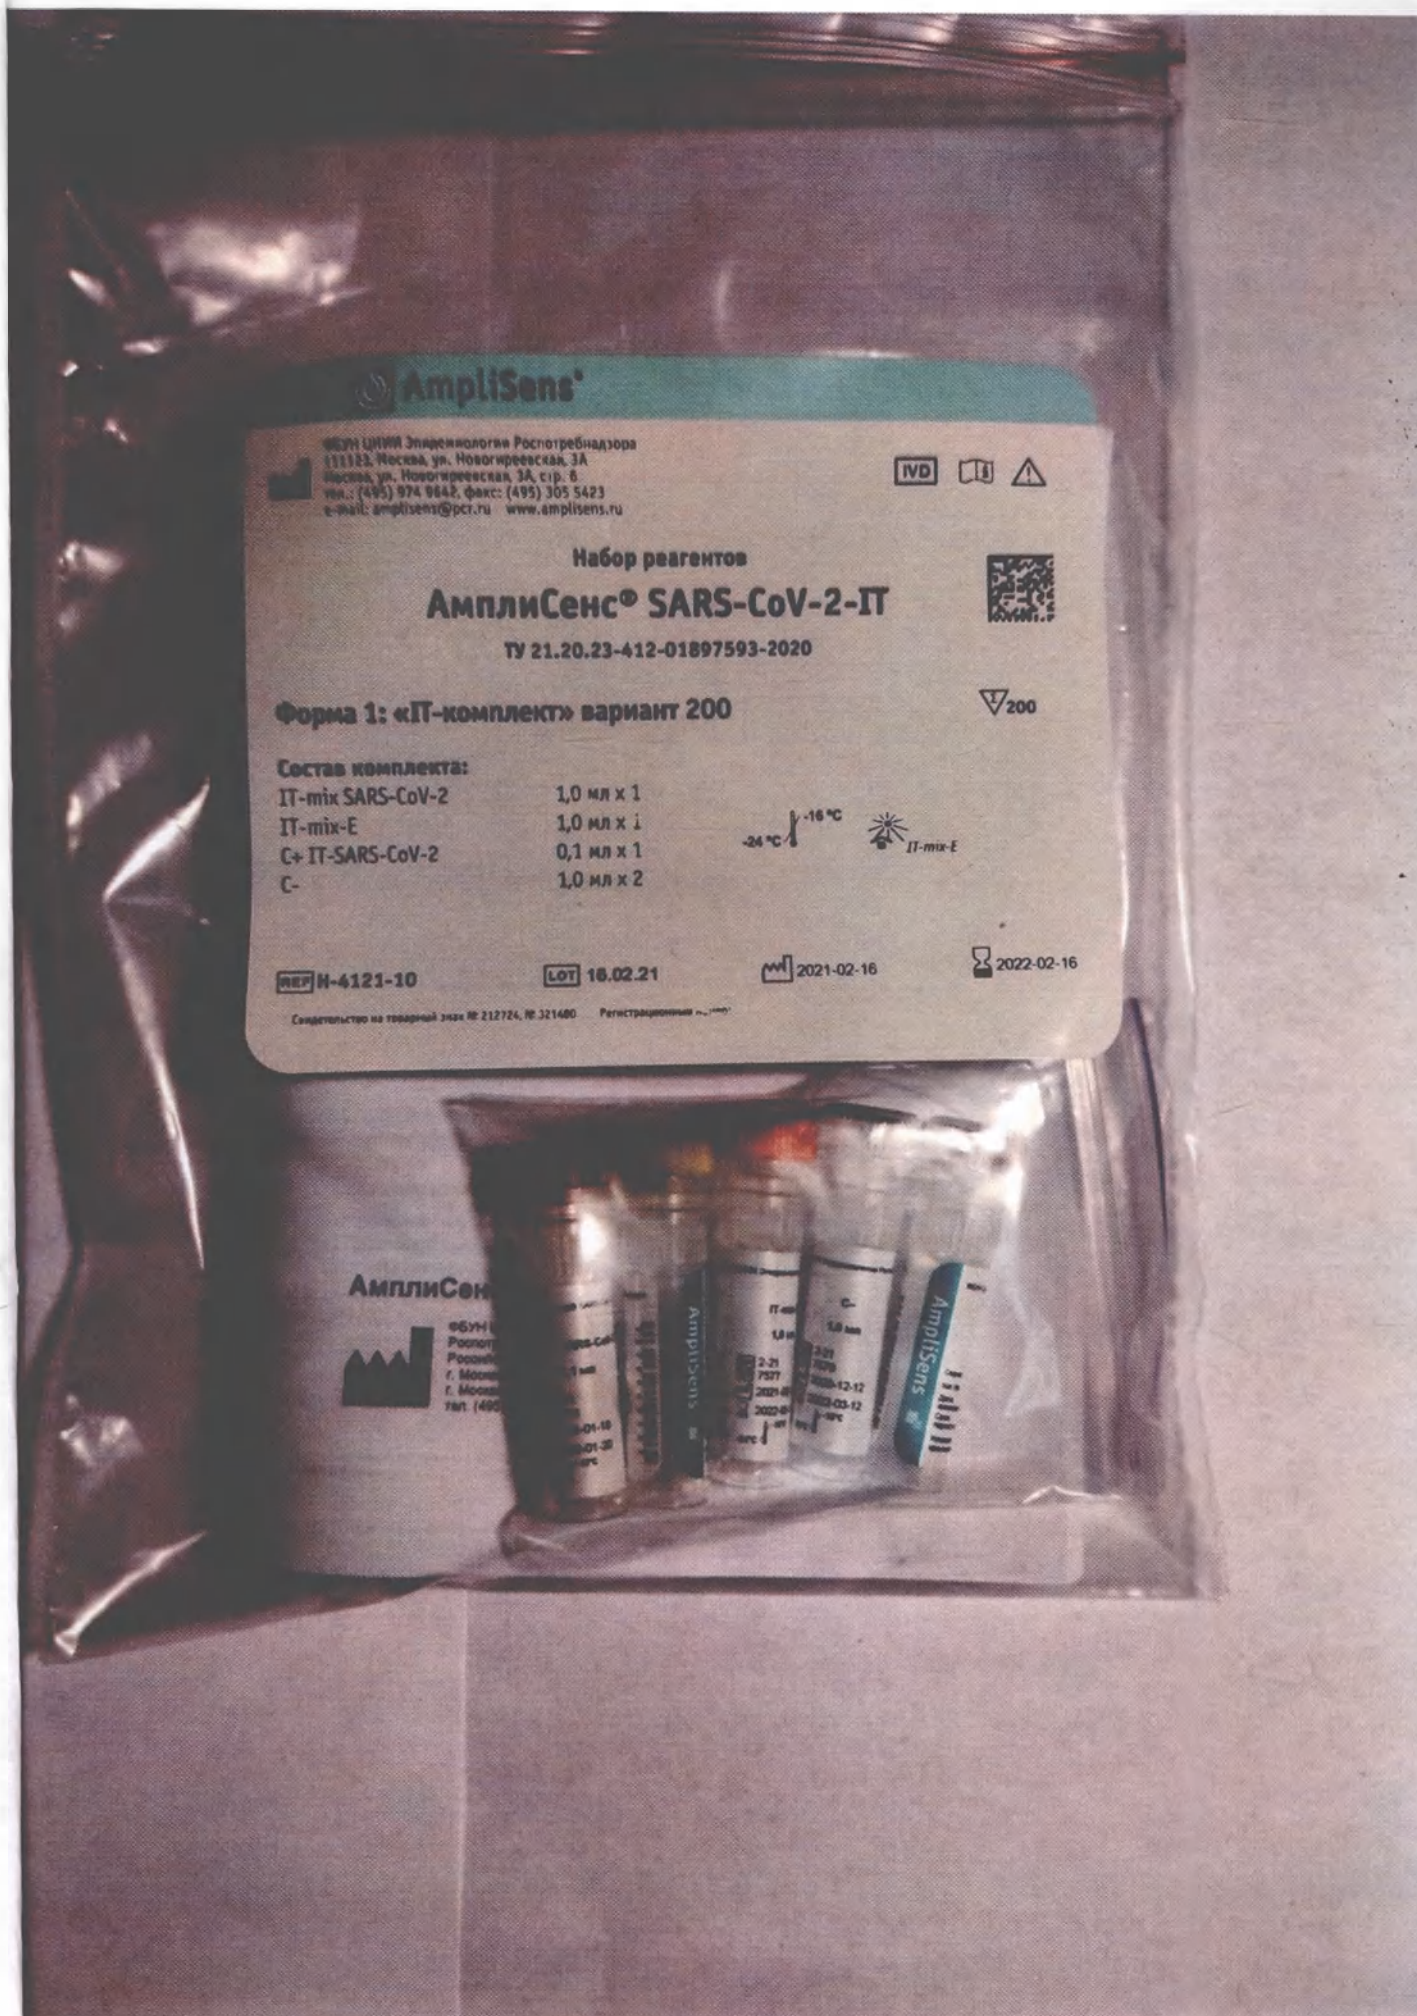


**Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 1,
после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock)**



Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 1,
до вскрытия внешней упаковки (цефленовый пакет).

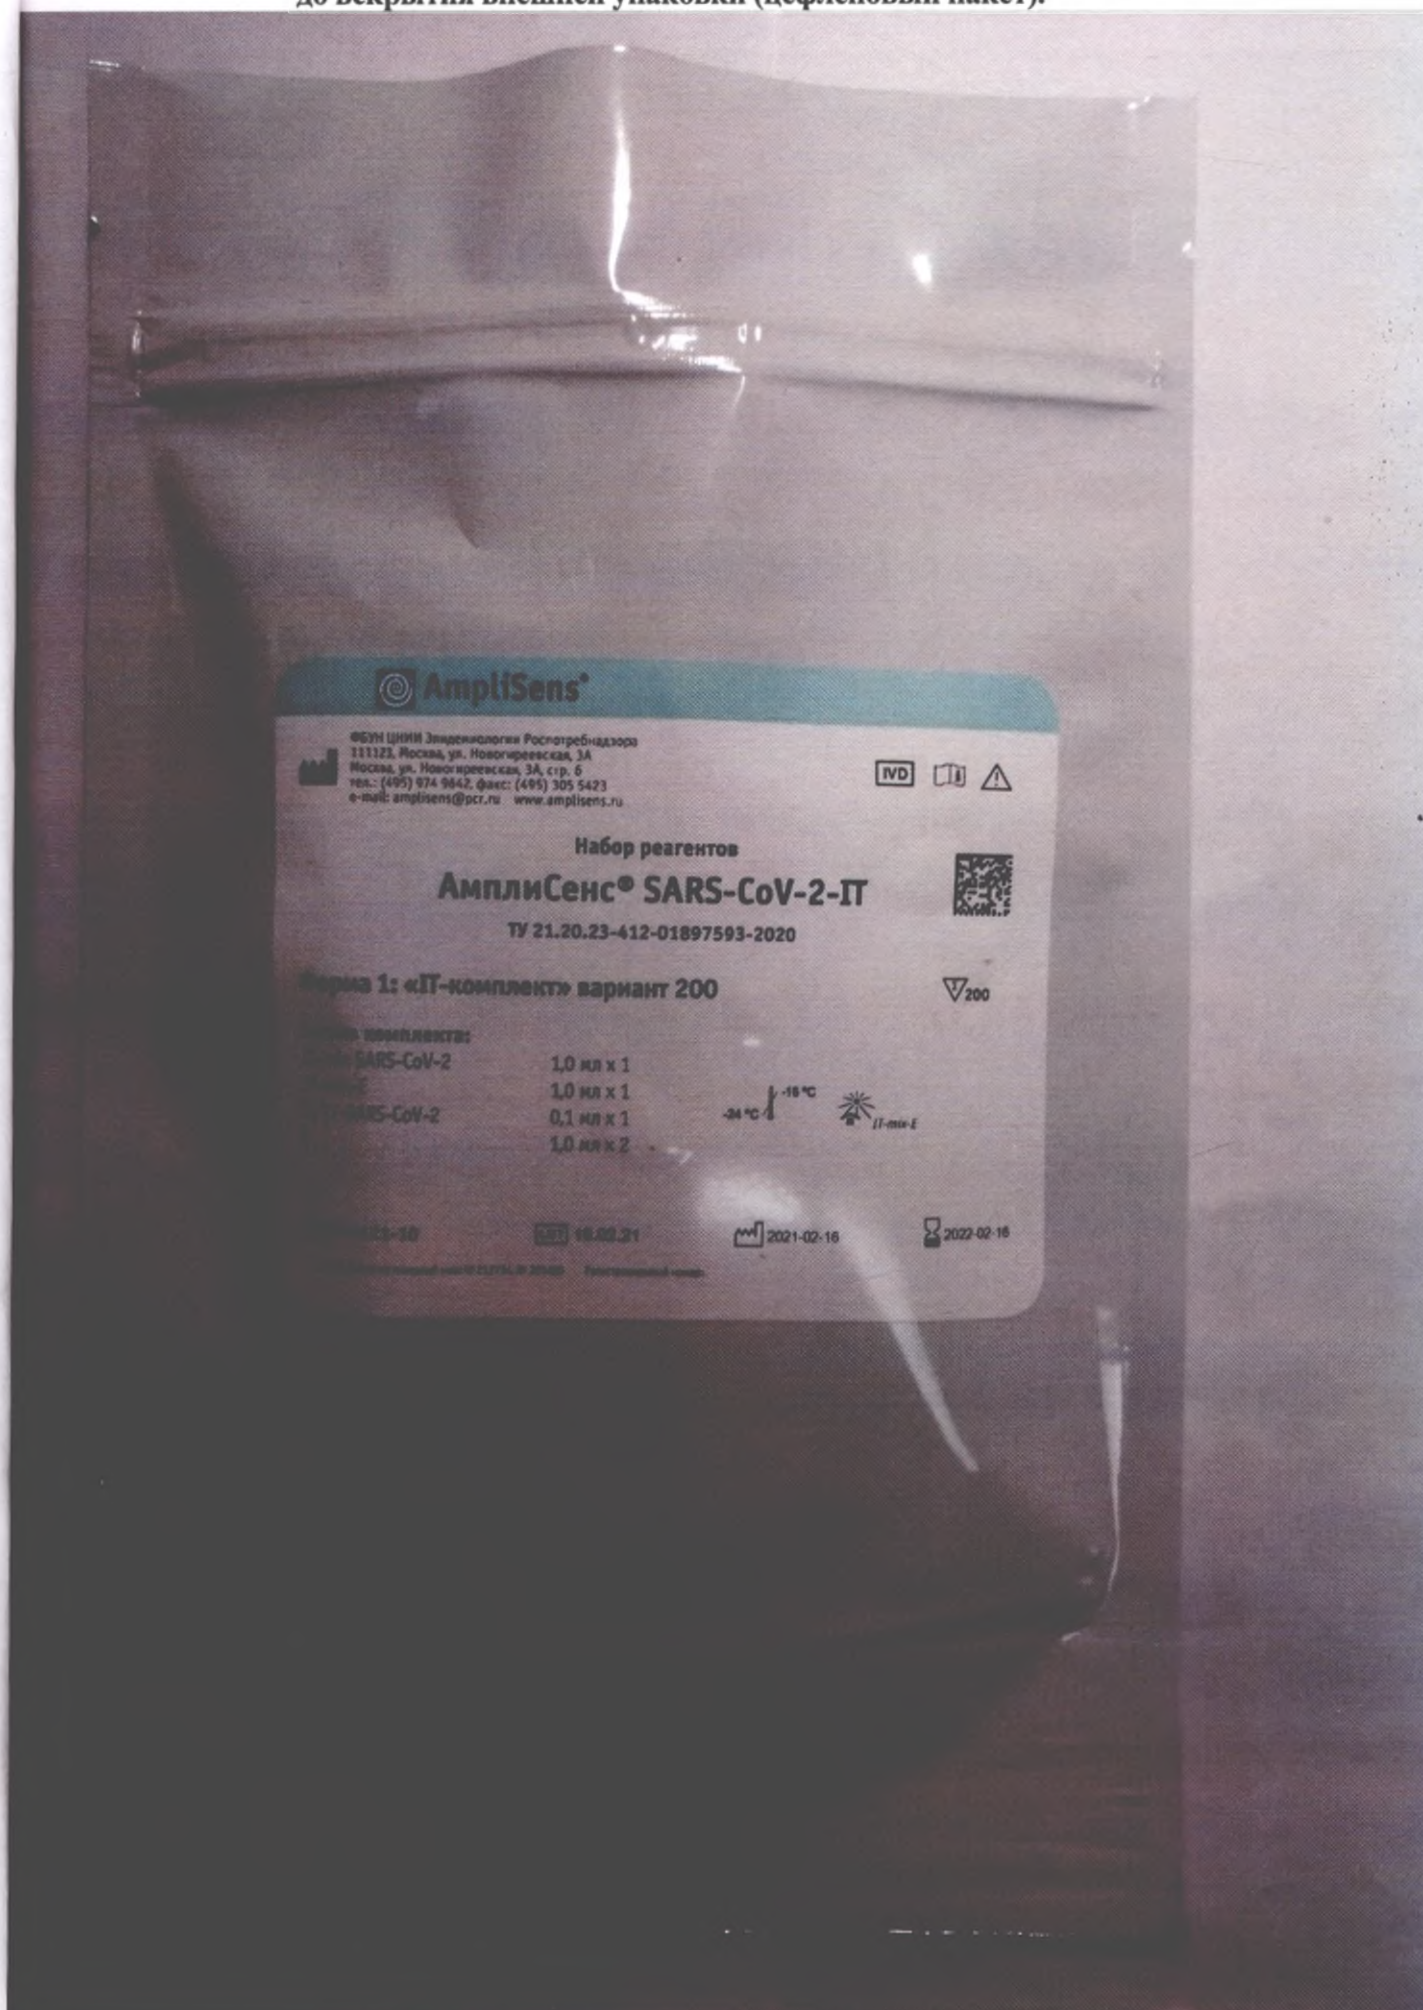



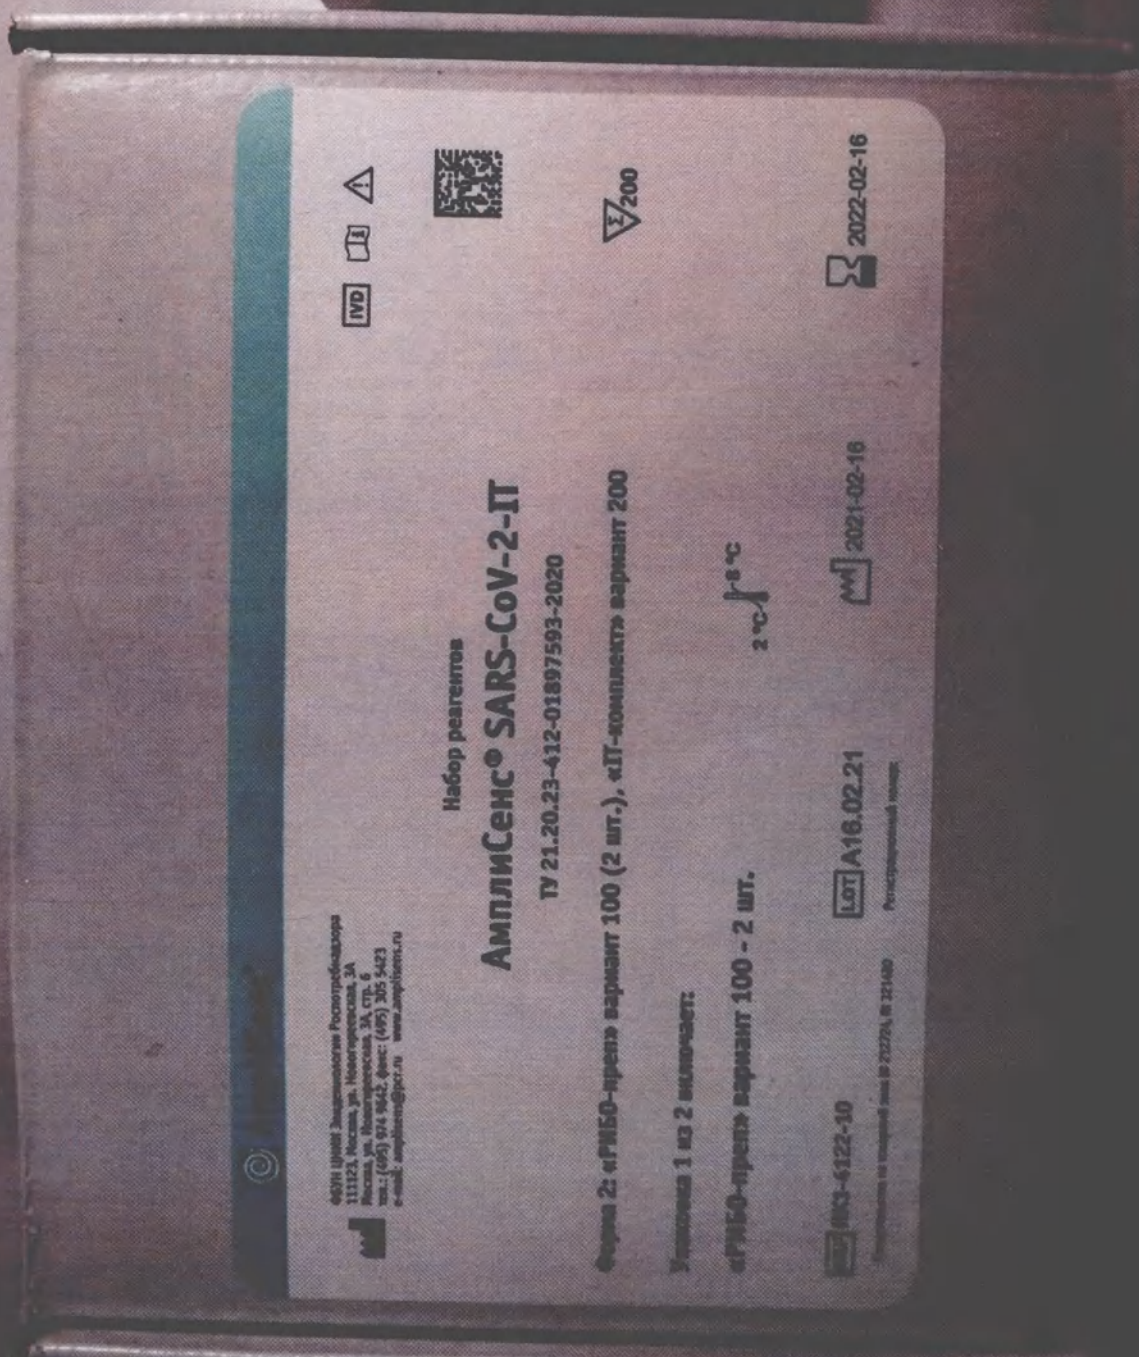

Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2, после вскрытия внешней упаковки (коробка)



ФКУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогорская, 3А
Москва, ул. Новогорская, 3А, стр. 6
тш.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amphisens@yandex.ru www.amphisens.ru

Набор реагентов

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT




ТУ 21.20.23-412-01897593-2020

Форма 2: «ГН50-преп» вариант 100 (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200

Упаковка 1 из 2 включает:

«ГН50-преп» вариант 100 – 2 шт.


2 °C





АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2, упаковка 1 из 2

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT


Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2, упаковки 1 из 2, после вскрытия внешней упаковки (коробка)

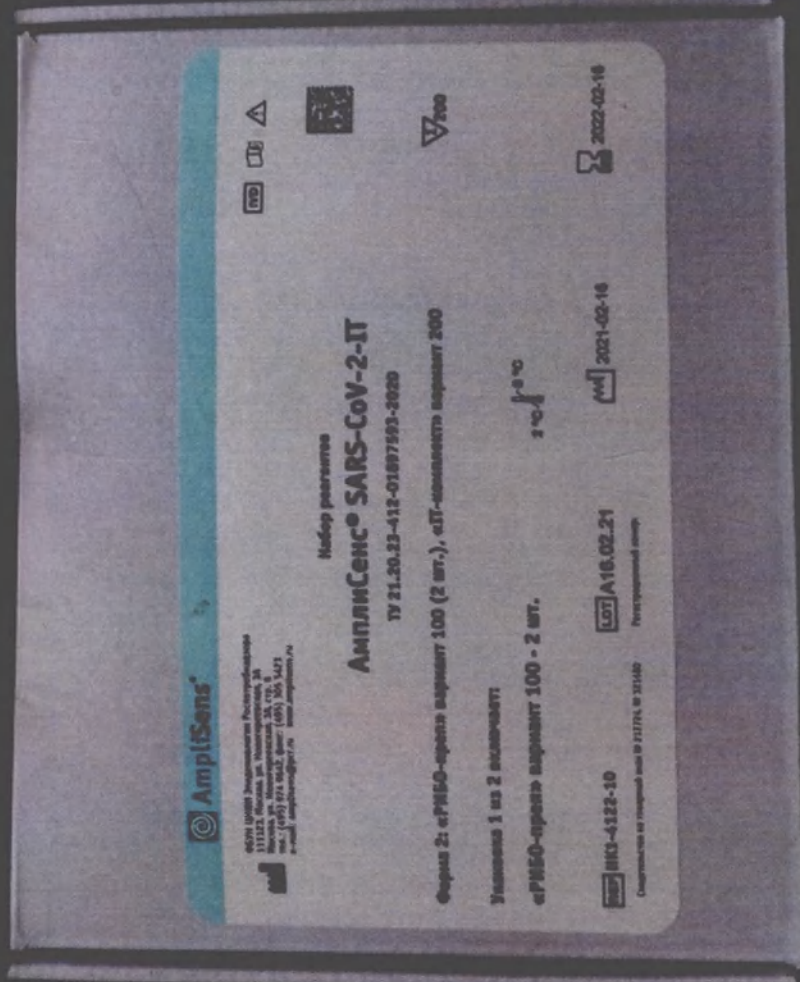


**Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2,
упаковки 2 из 2, до вскрытия внешней упаковки (коробка)**

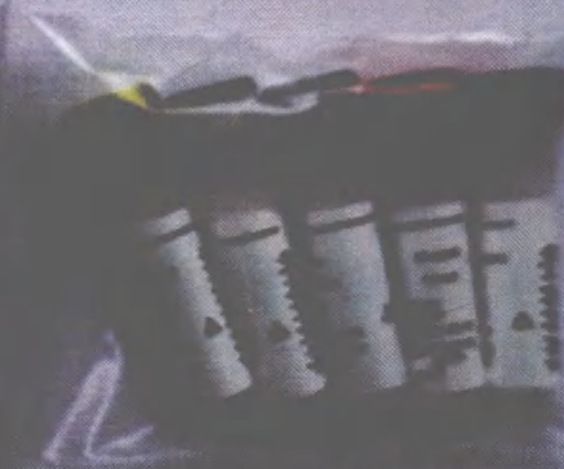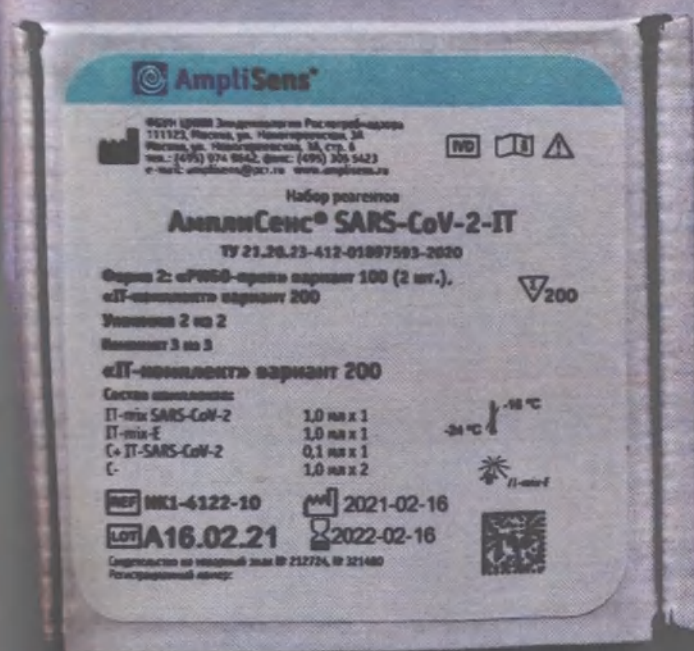



Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2,
до вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock)

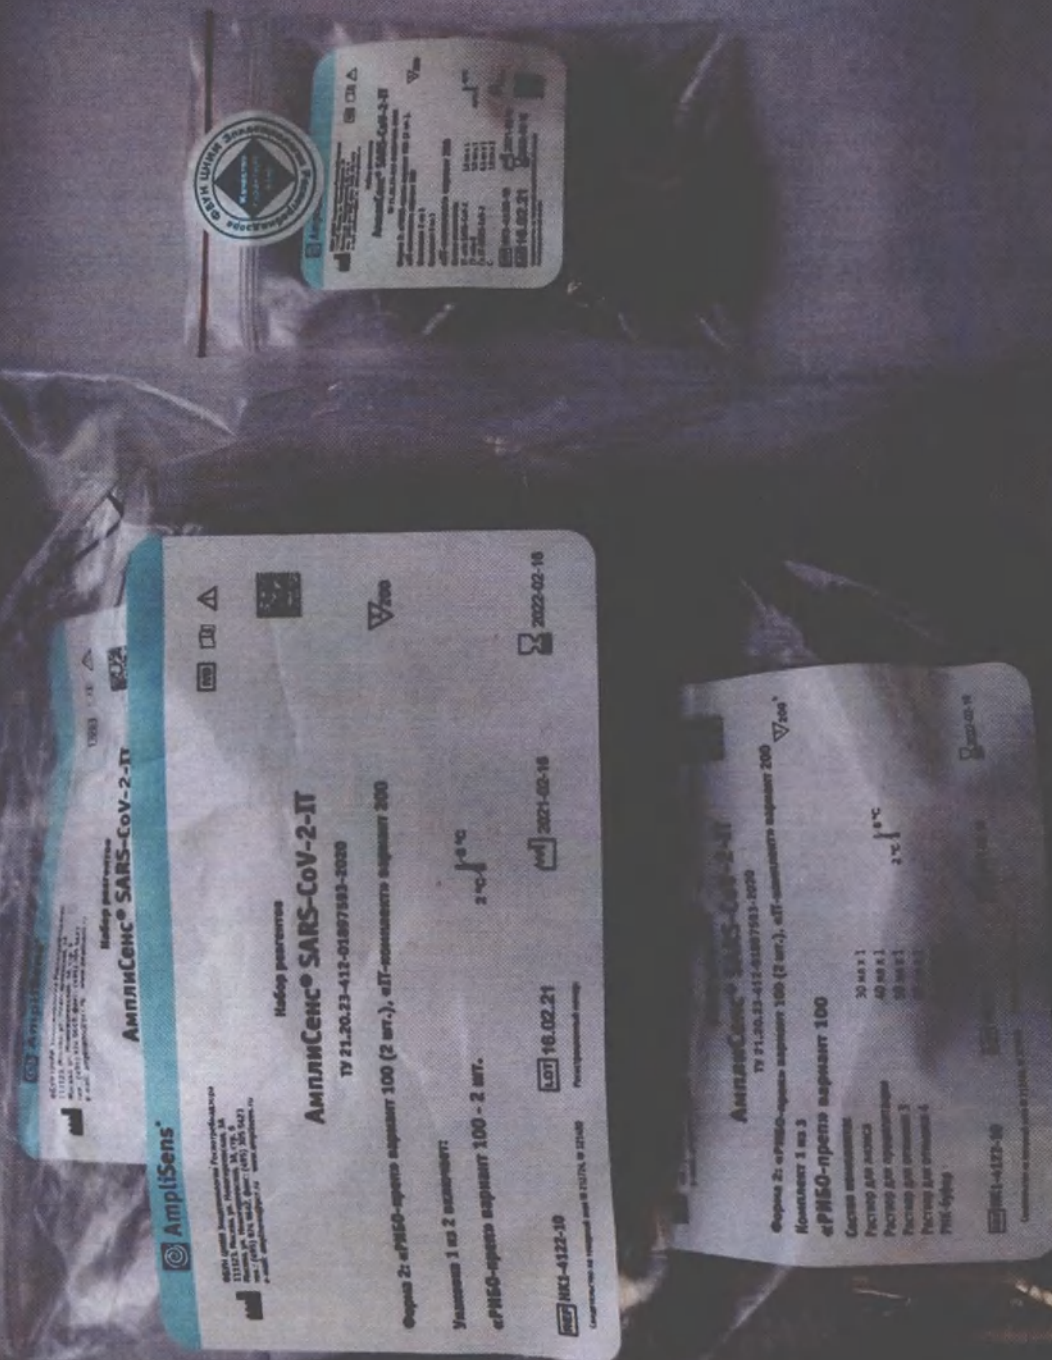

**Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2,
после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock)**

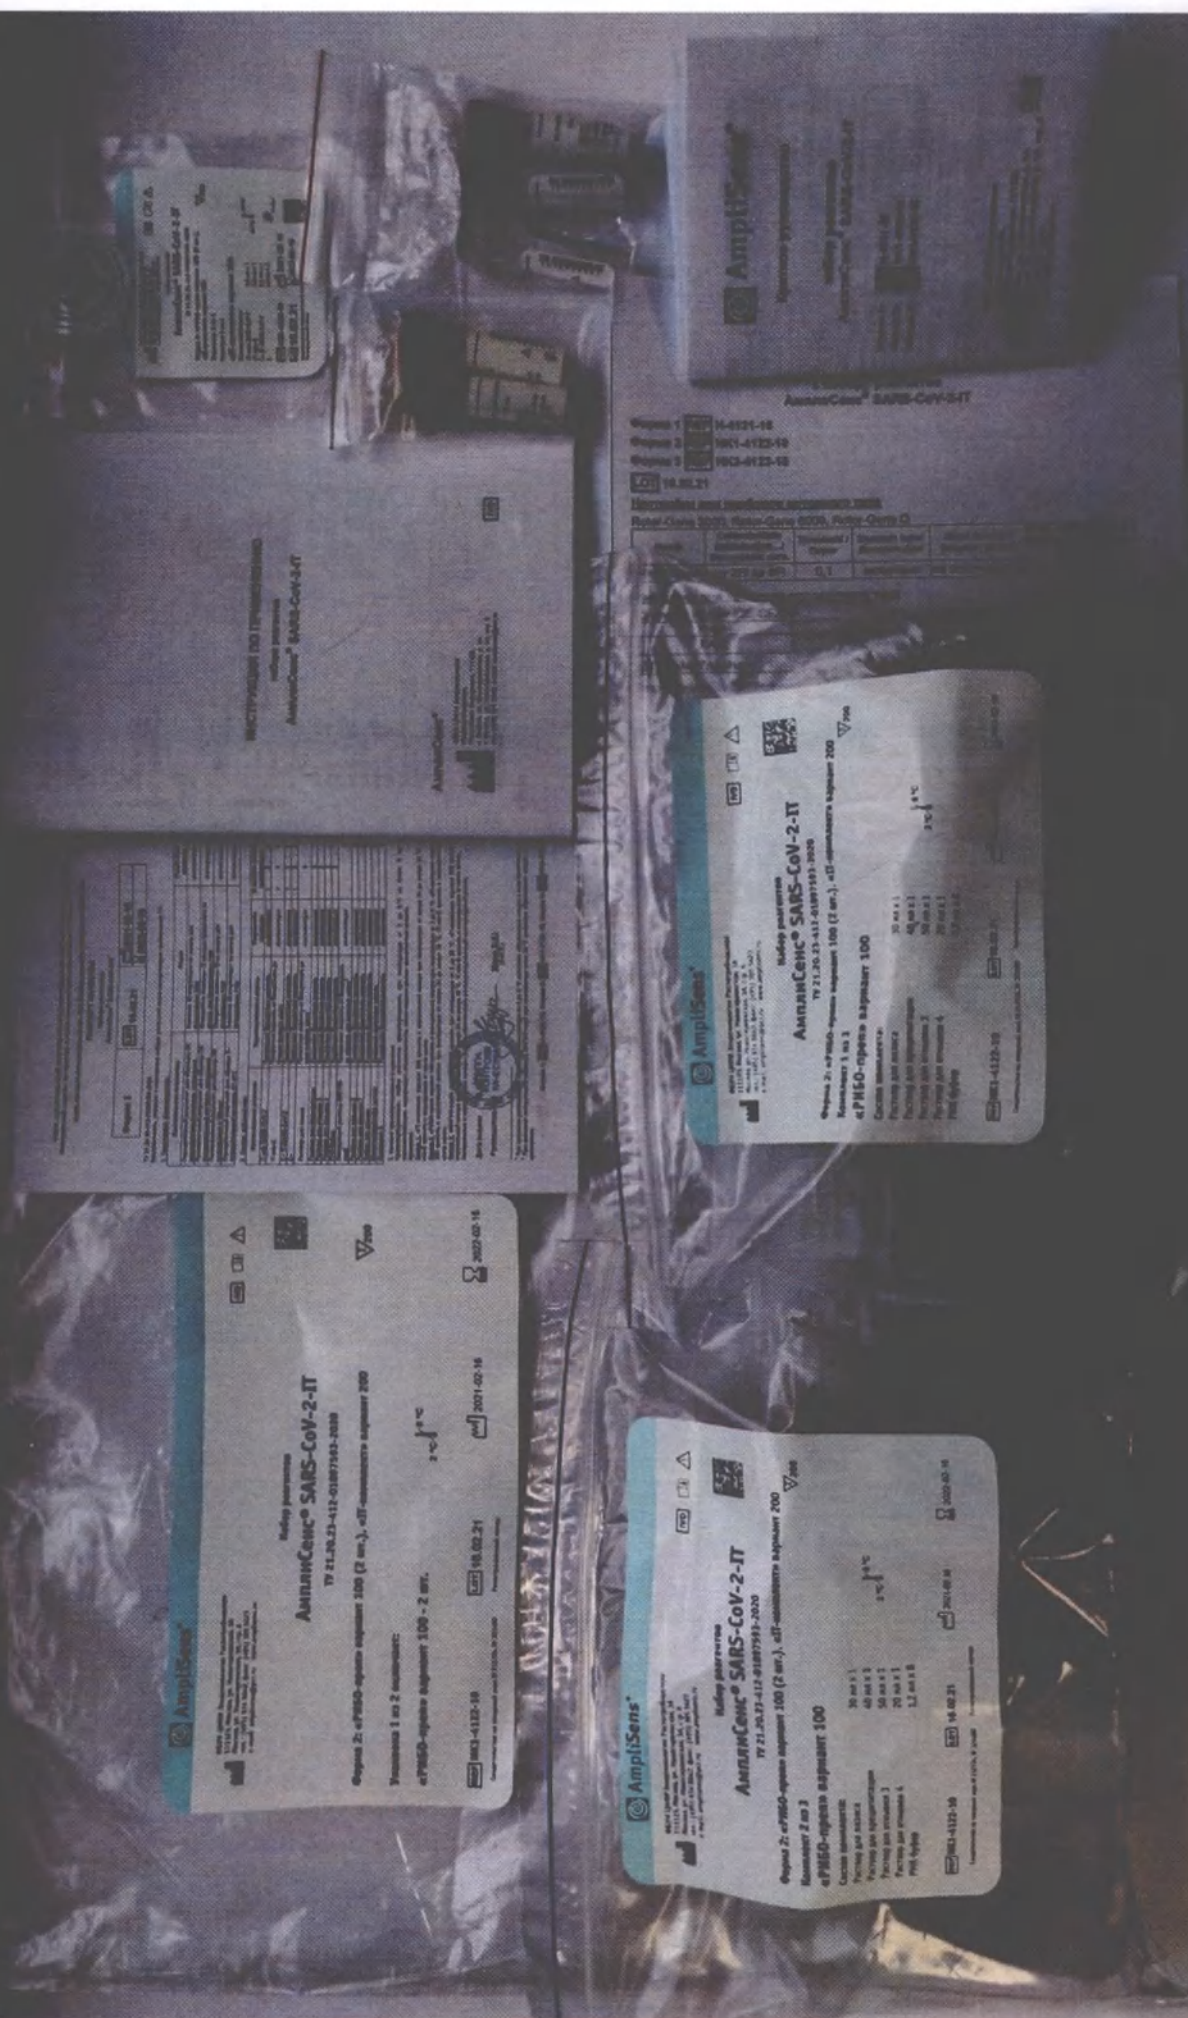

Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2, упаковки 1 из 2, до вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock)

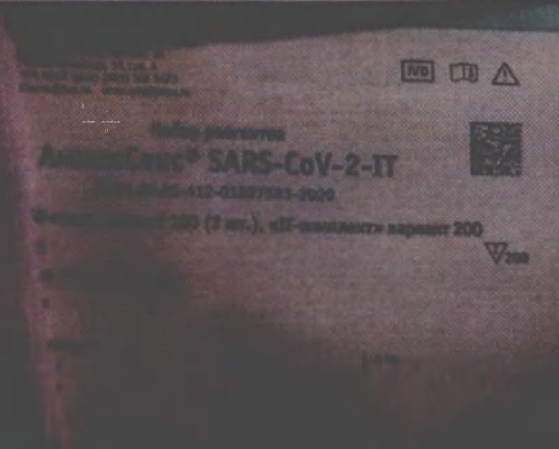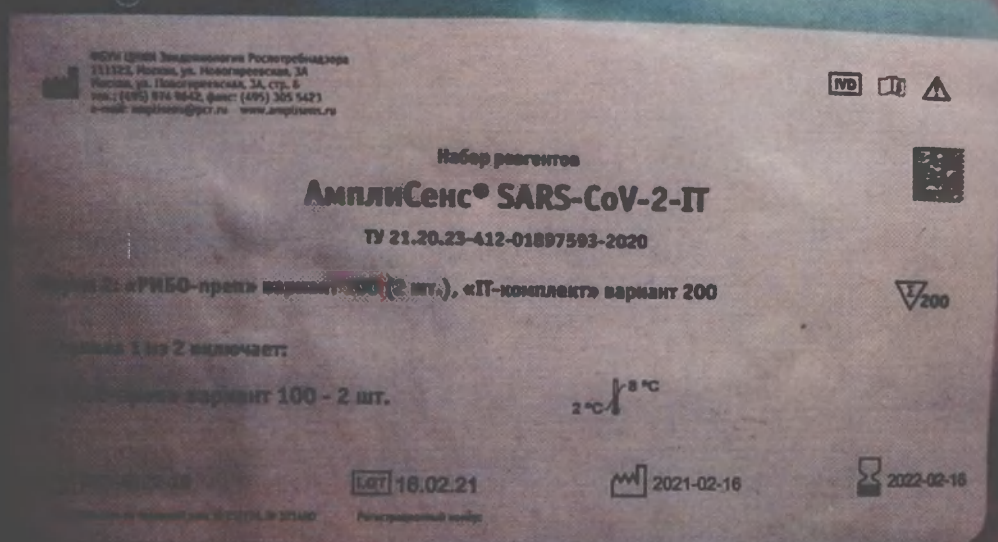


Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2, упаковки 1 из 2, после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock)








Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2,
до вскрытия внешней упаковки (цефленовый пакет)

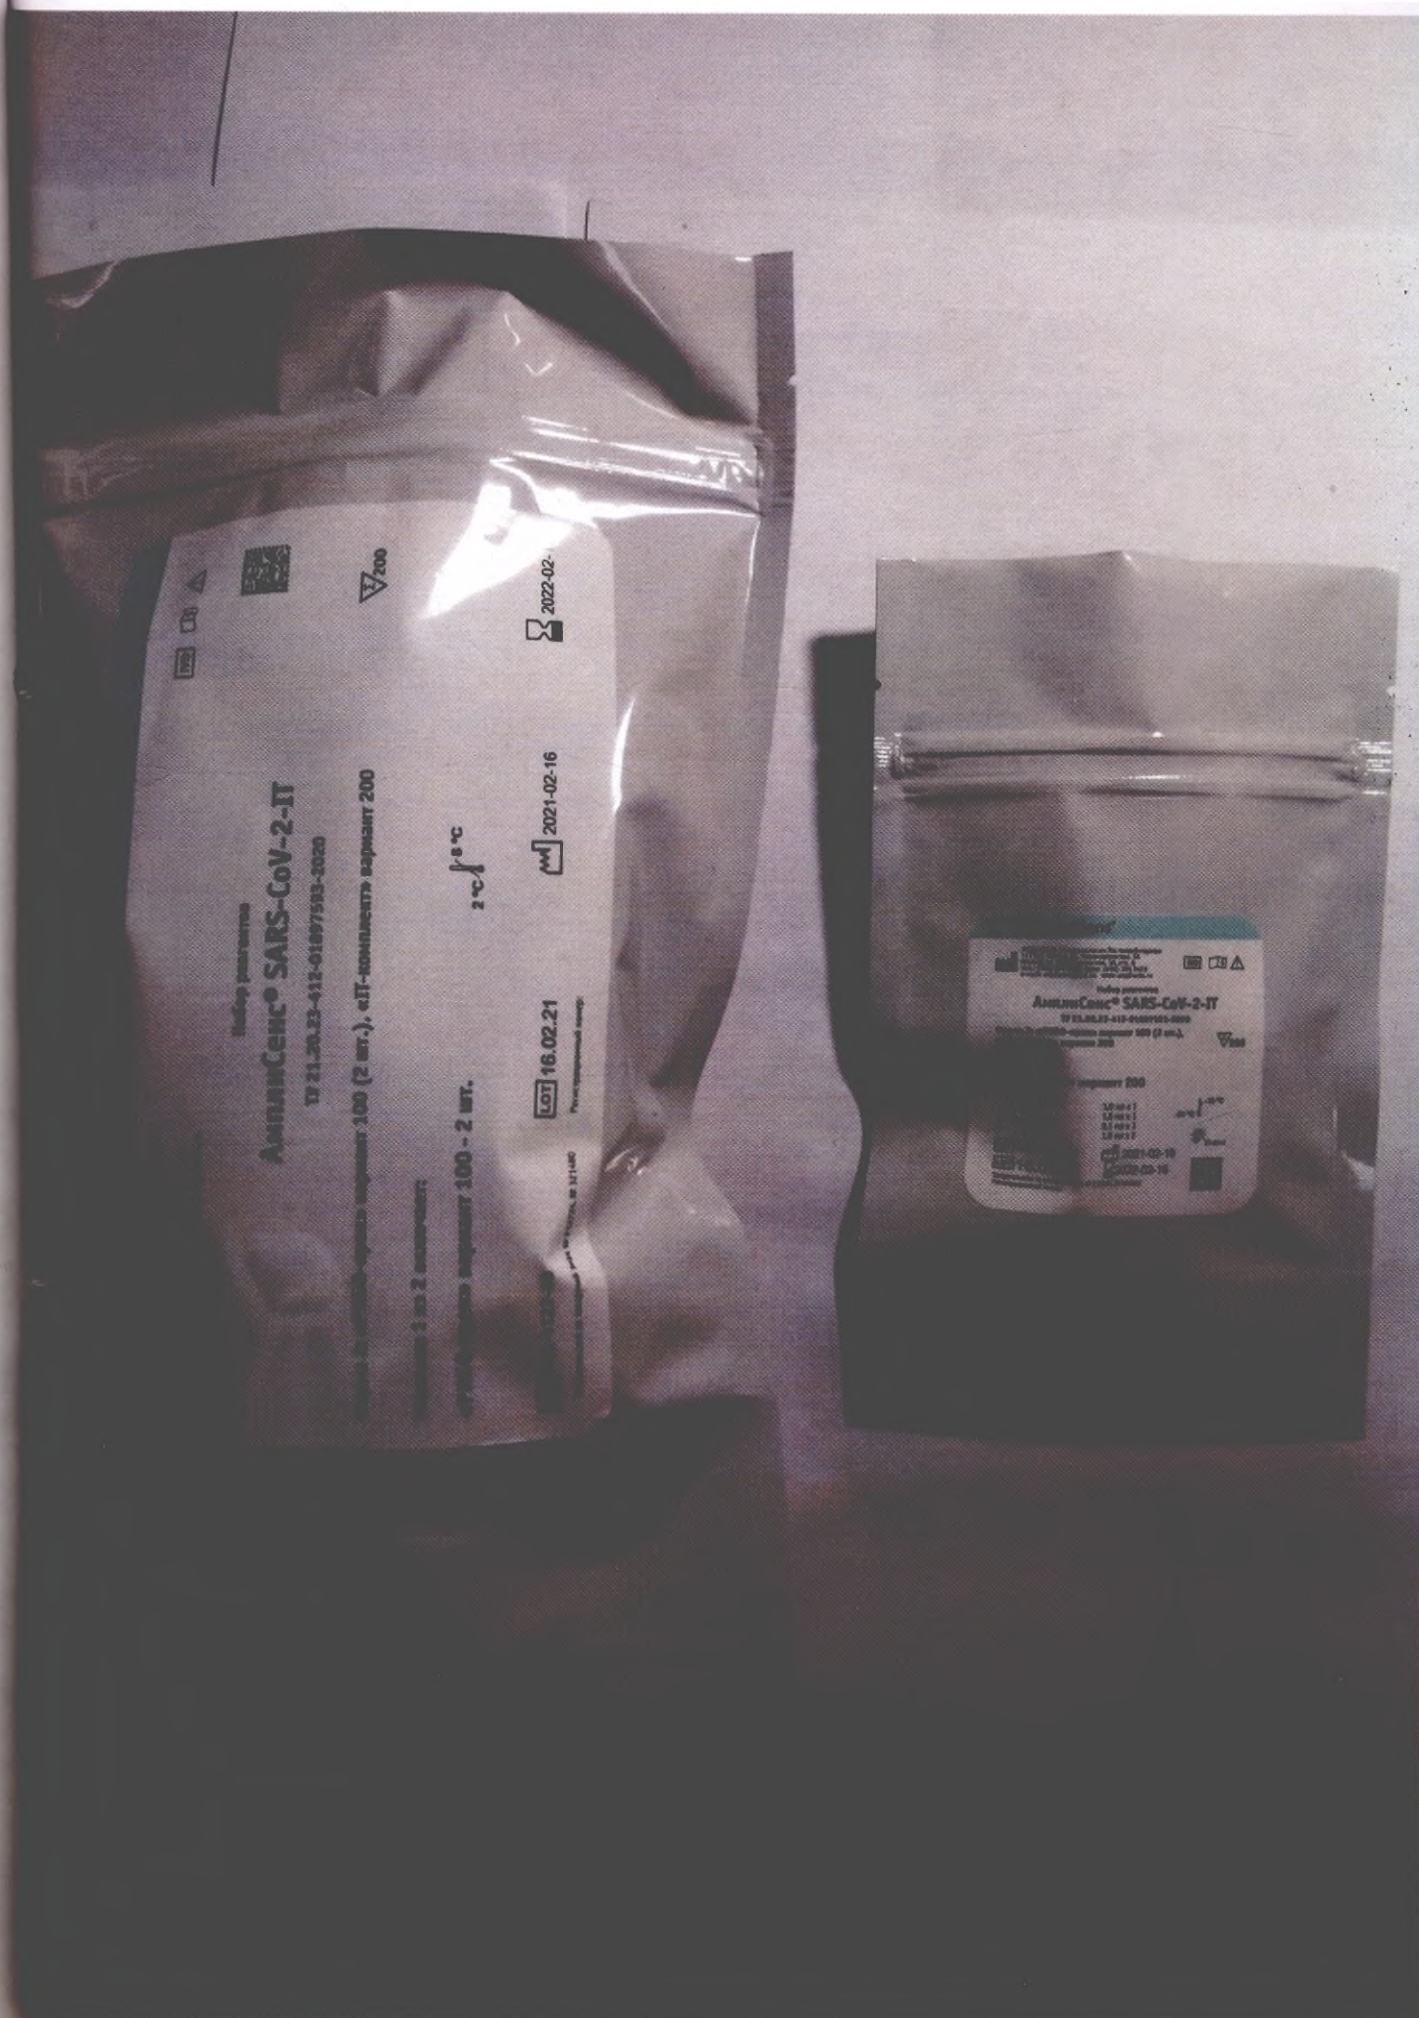

**Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2,
после вскрытия внешней упаковки (цефленовый пакет)**




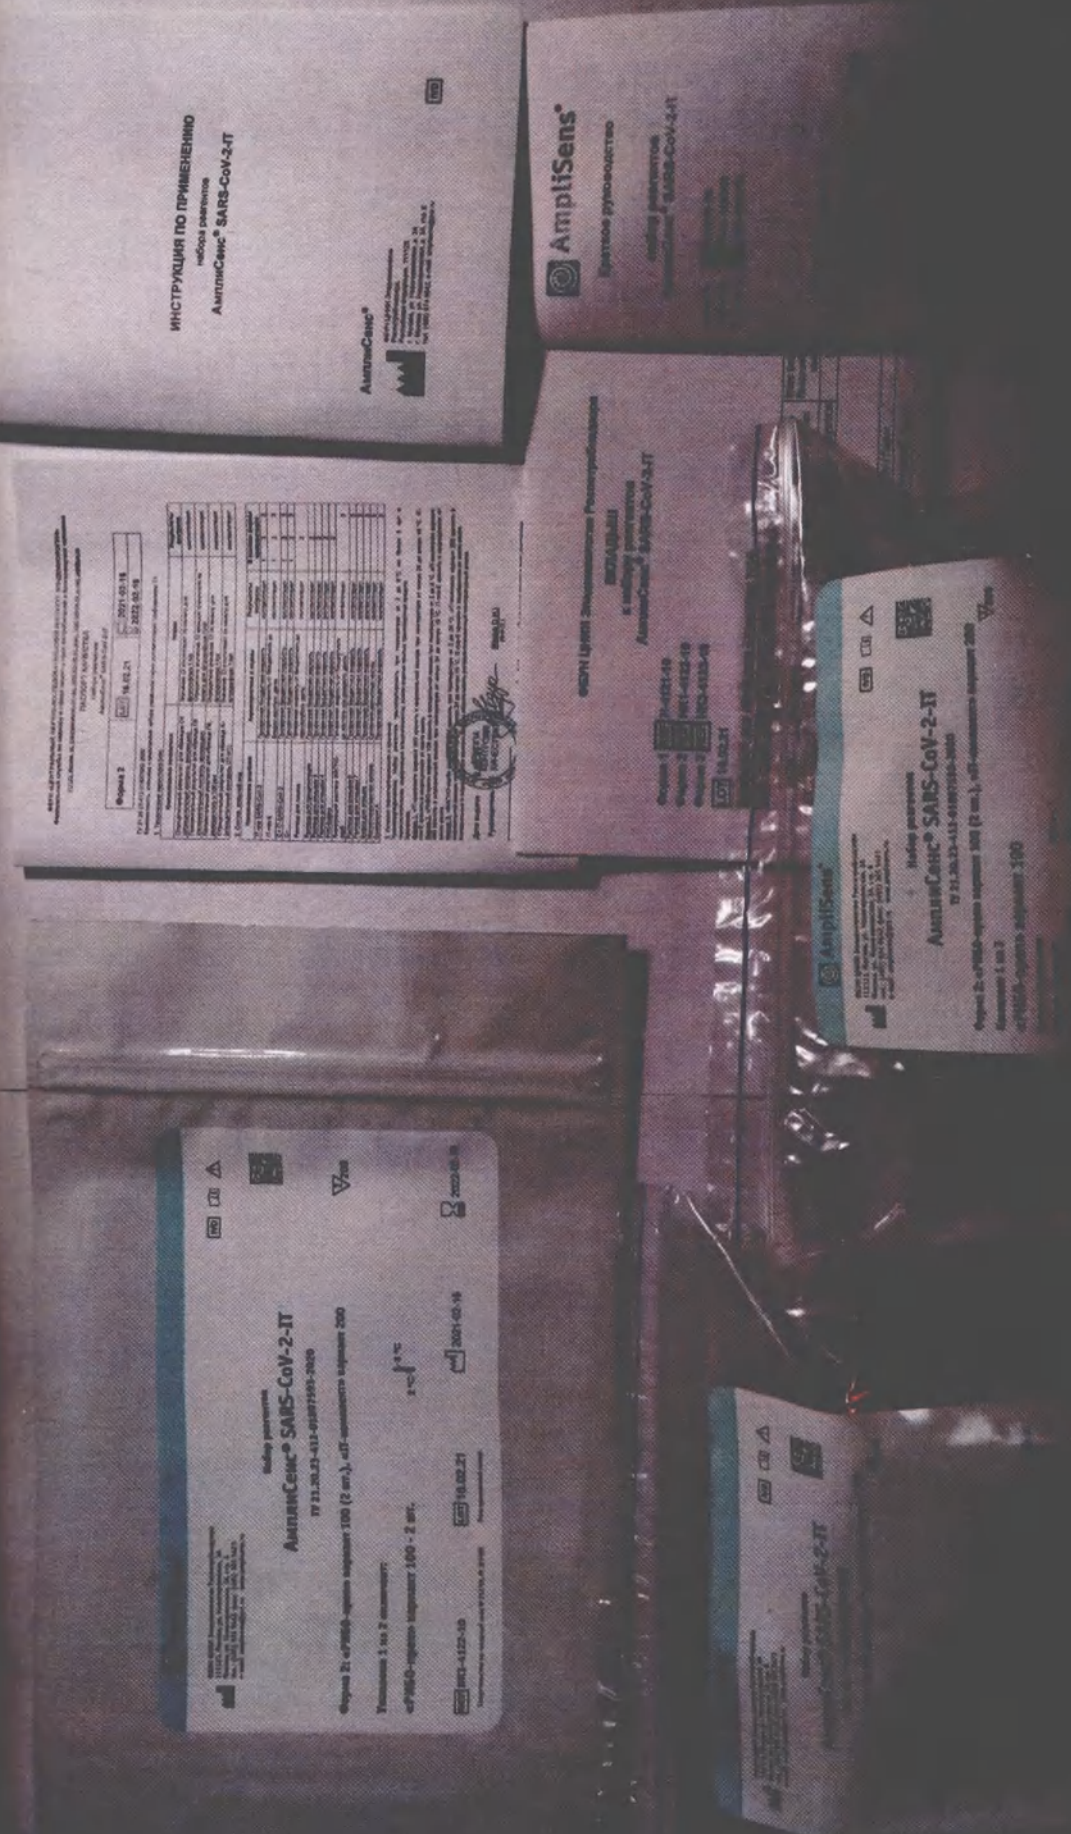


Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2, упаковки 2 из 2, до вскрытия внешней упаковки (цефленовый пакет)



Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2, упаковки 2 из 2, после вскрытия внешней упаковки (цефленовый пакет)

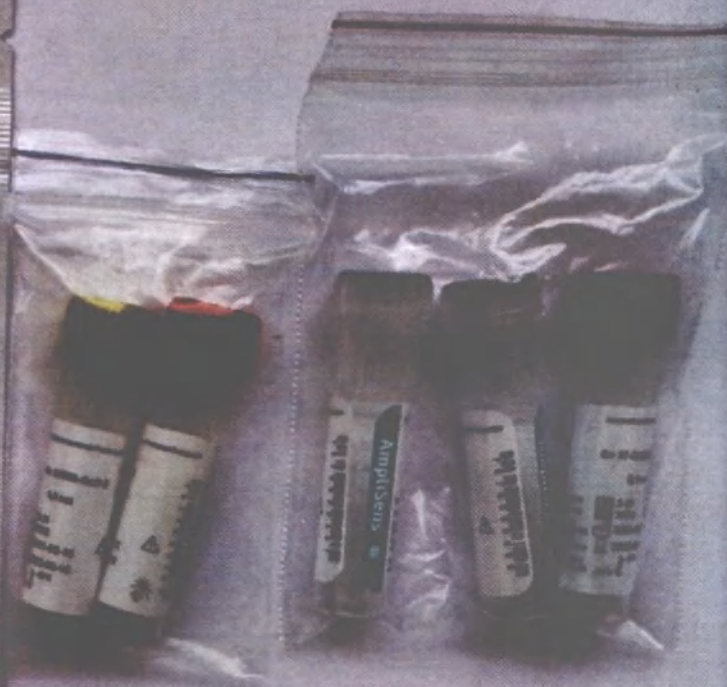

Фотография реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2, упаковки 1 из 2, «РИБО-преп» вариант 100 (2 шт.)

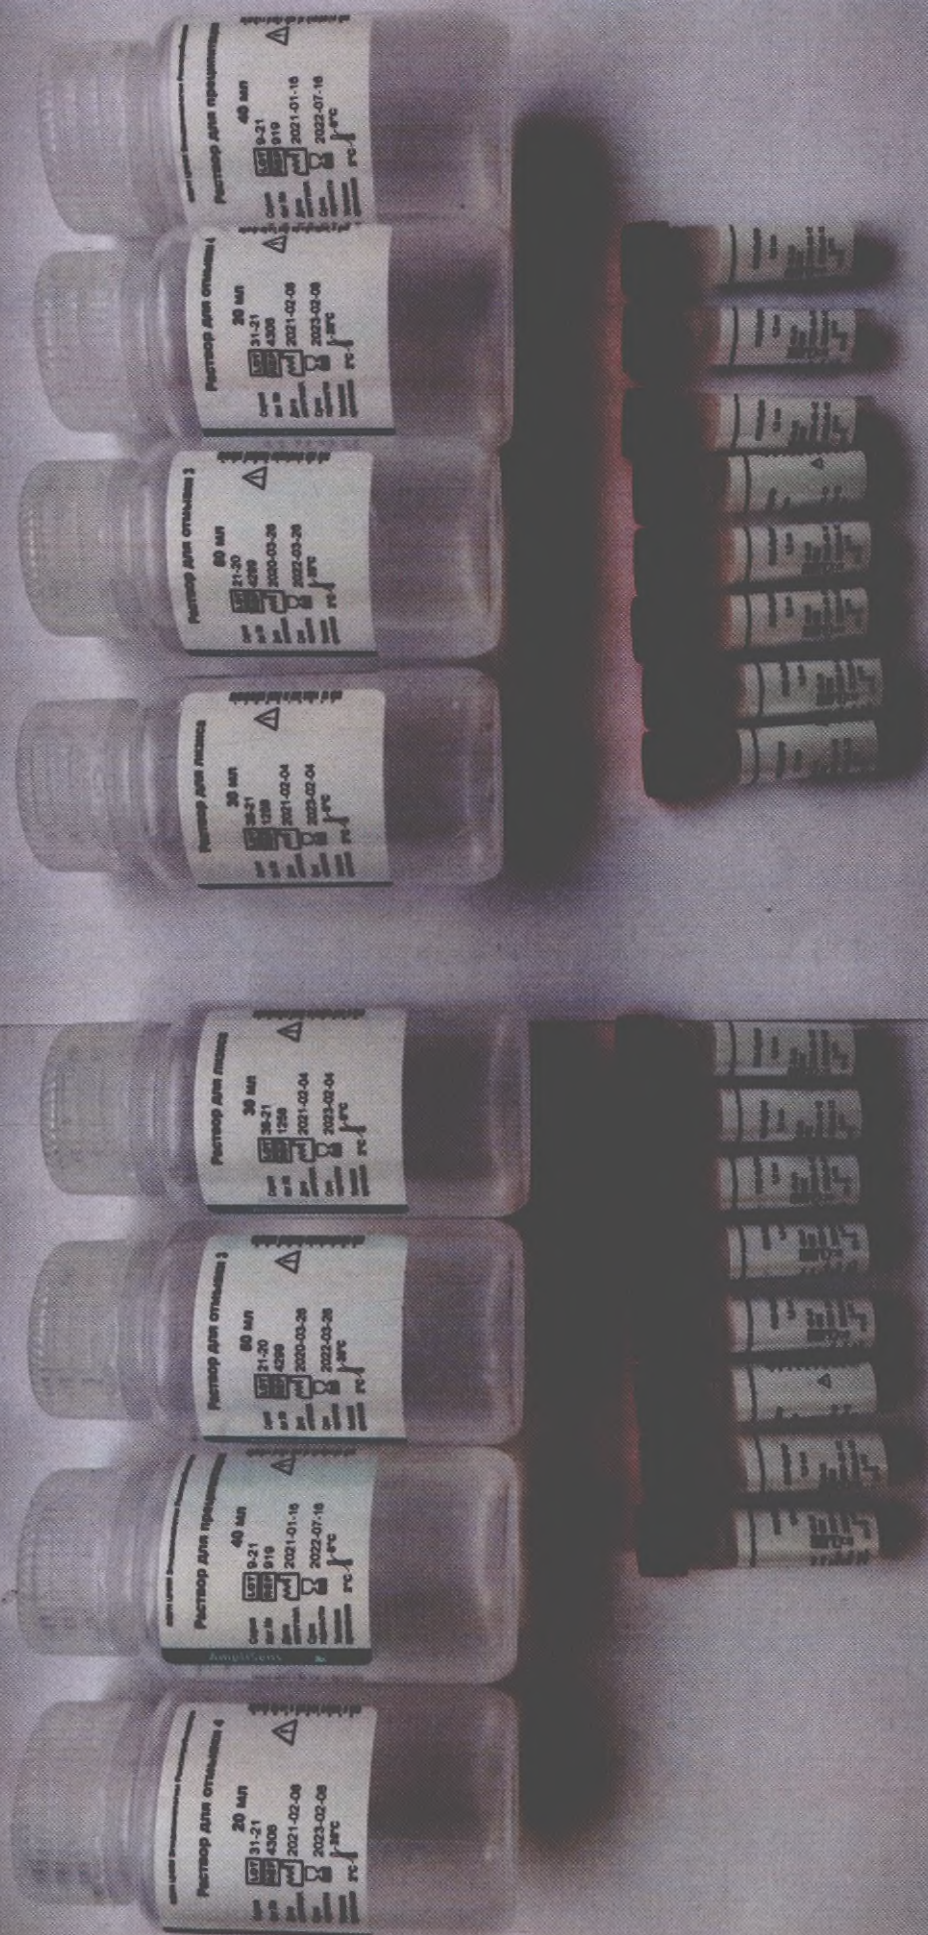



[illegible]

Набор реагентов

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT

TY 21.20.23-412-01897593-2020

вариант 3: «МГТБ-сервис» вариант 100М (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200

ВЫПУСК 100М - 2 шт.

25°C

Lot A16.02.21



2021-02-16

2022-02-16

Copyright Clearance Center

100

Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 3,
после вскрытия внешней упаковки (коробка)

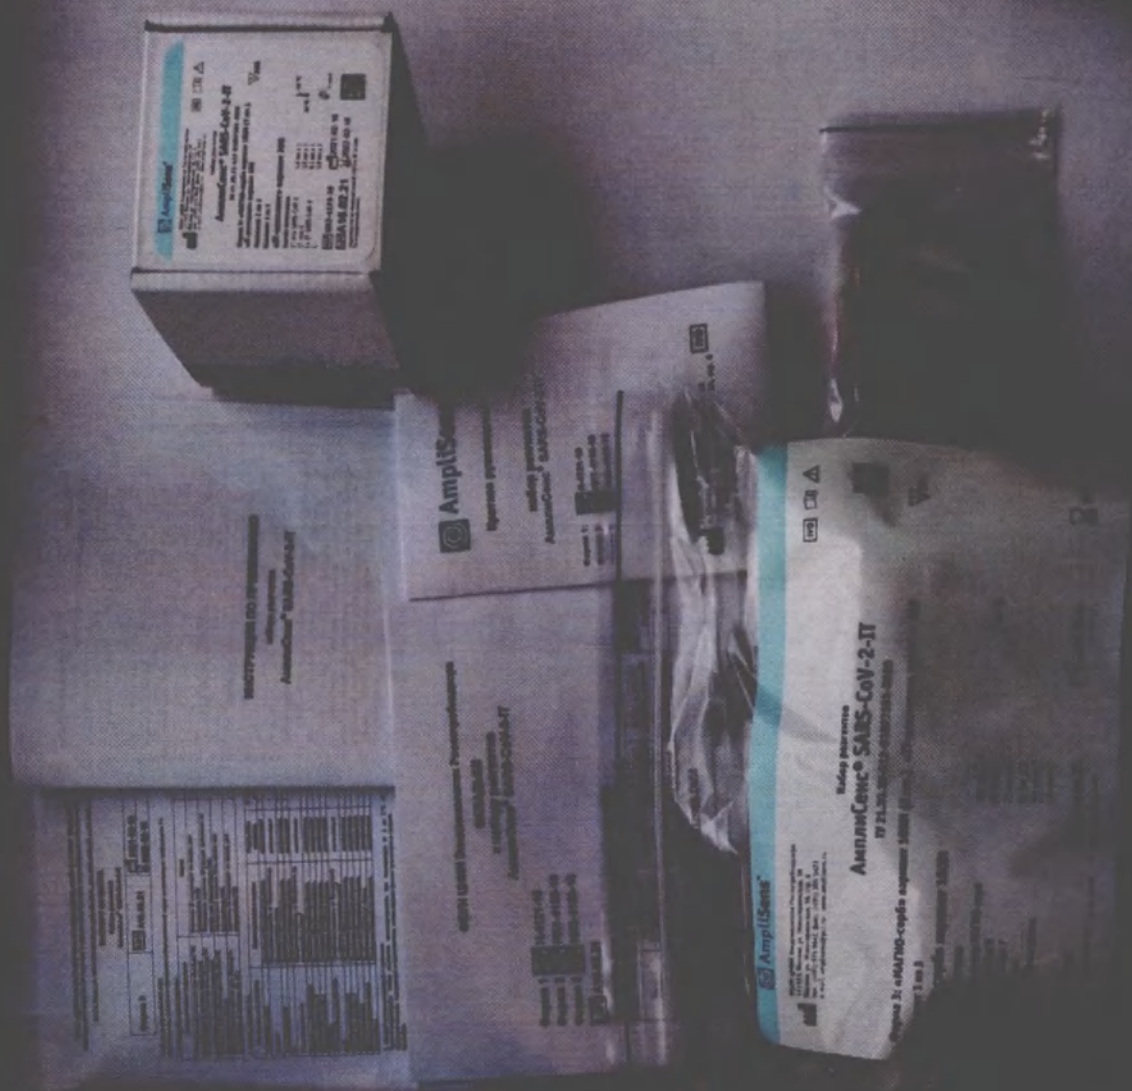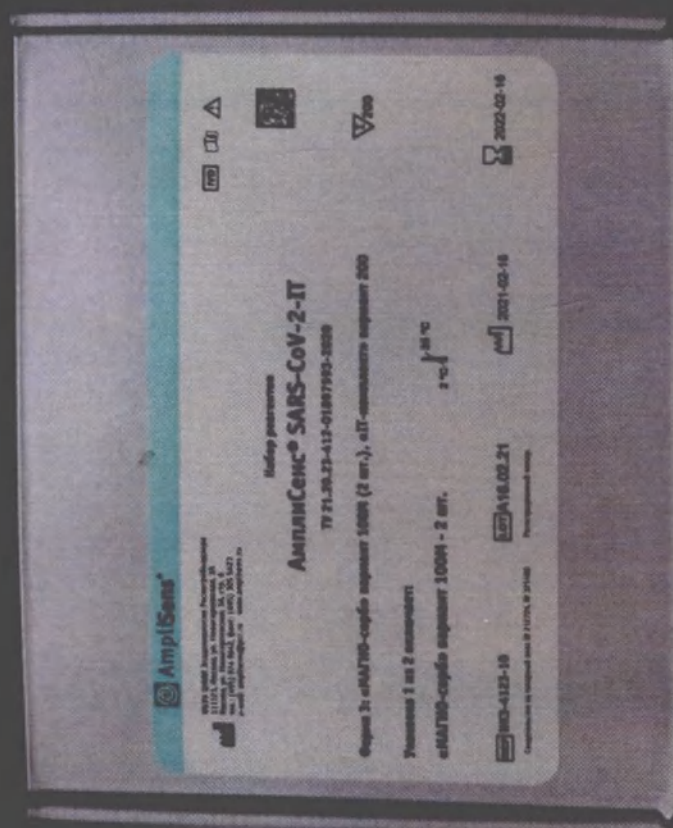

ООО ЦРПМИ
125167, Москва, ул. Новоурожайская, 3А
Многоквартирный дом «Новоурожайская», 3А, стр. 6
Тел.: (495) 913 9122, факс: (495) 305 5423
e-mail: info@cirpmi.ru, www.amplisen.ru

Набор реагентов

АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT

ТУ 21.20.23-412-01897593-2020

Содержит: «АмплиСенс» вариант 100М (2 шт.), «IT-комплект» вариант 200

Содержит: 1 из 2 вариантов:

«АмплиСенс» вариант 100М - 2 шт.

2°C / 25°C

Срок годности: 12 мес.


LSA16.02.21

Срок годности: 12 мес.


Регистрационный номер

2021-02-16

2022-02-16




Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 3, упаковки 1 из 2, после вскрытия внешней упаковки (коробка)

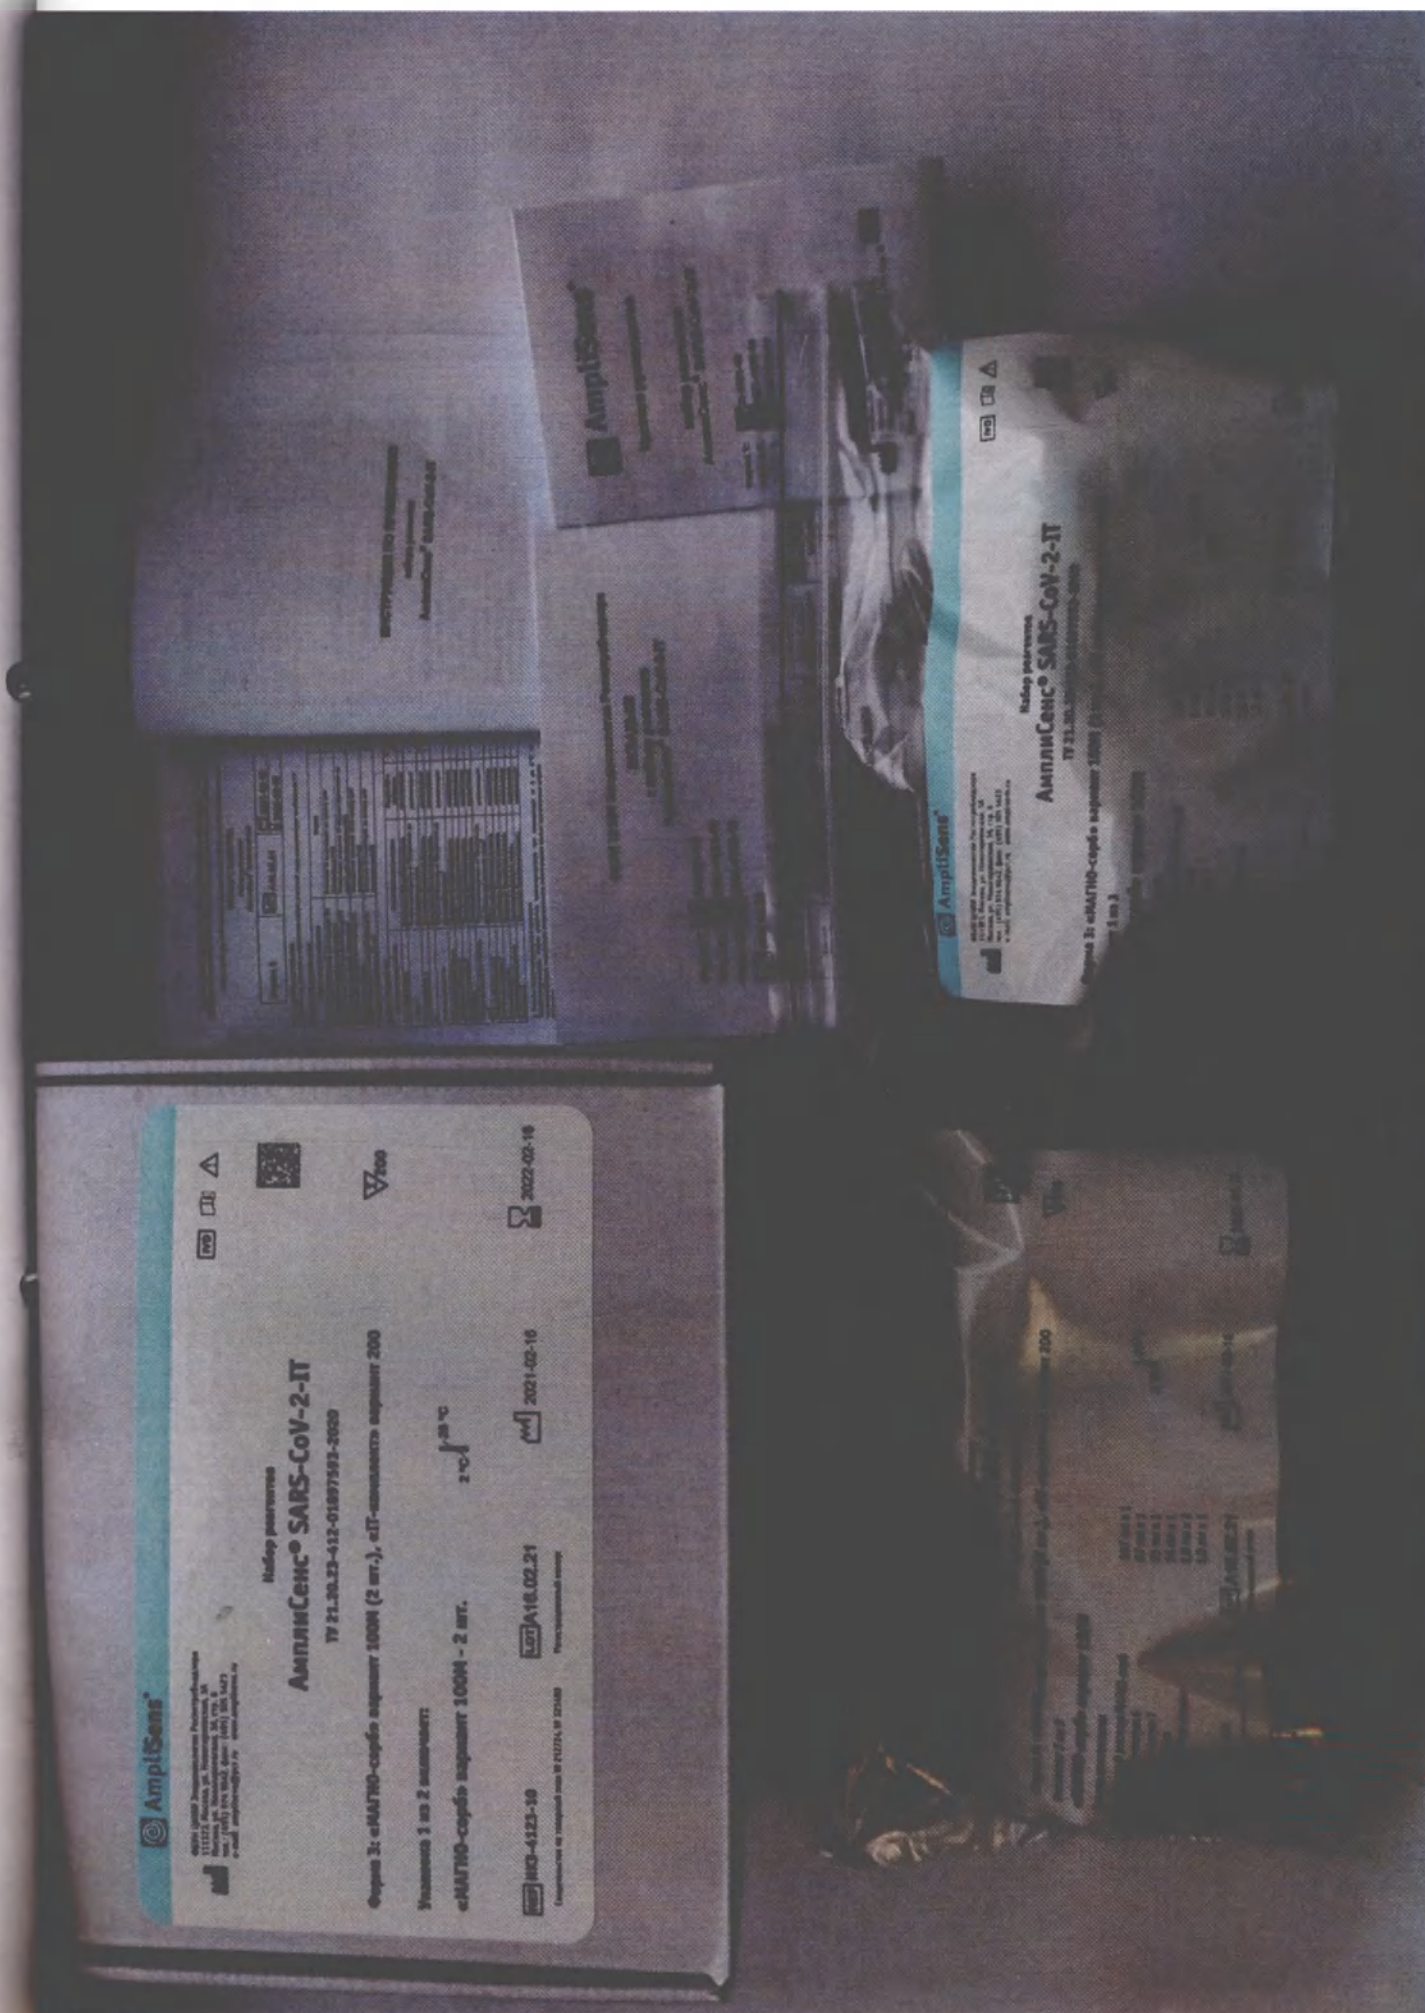

Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 3, упаковки 2 из 2, до вскрытия внешней упаковки (коробка)




Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 3, упаковки 2 из 2, после вскрытия внешней упаковки (коробка)

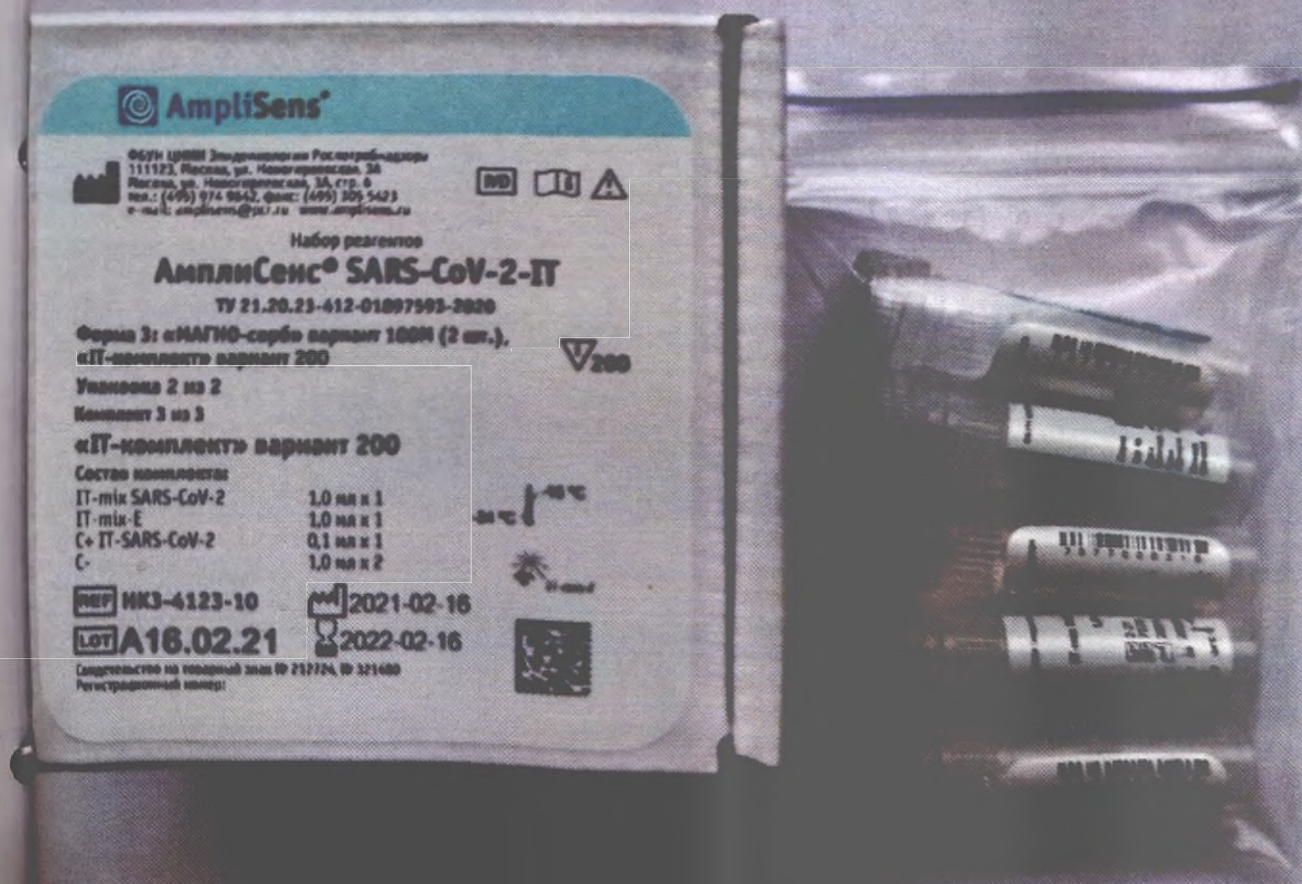


**Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 3,
до вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock)**




Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 3,
после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock)

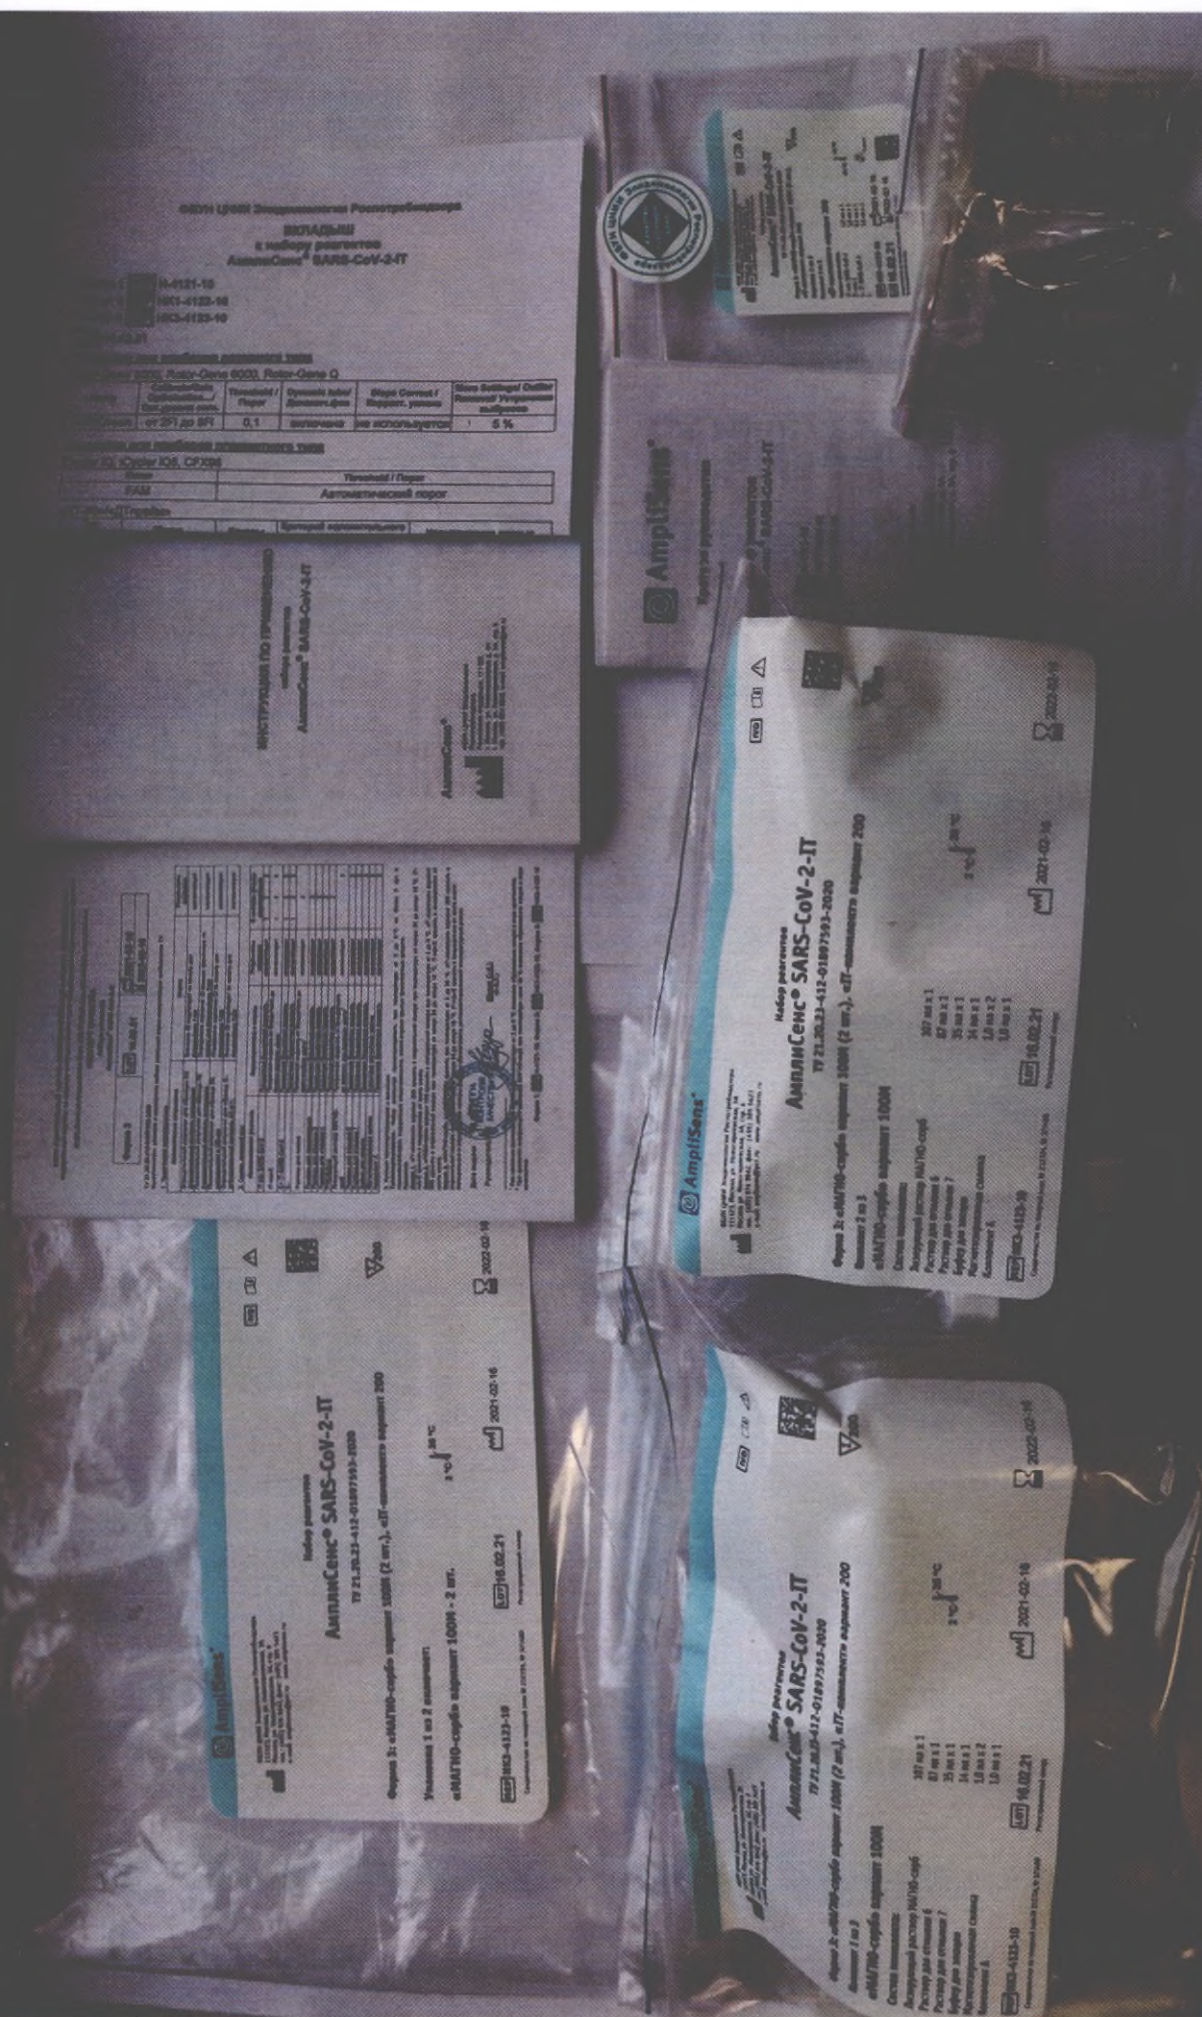

Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 3, упаковки 1 из 2, до вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock)

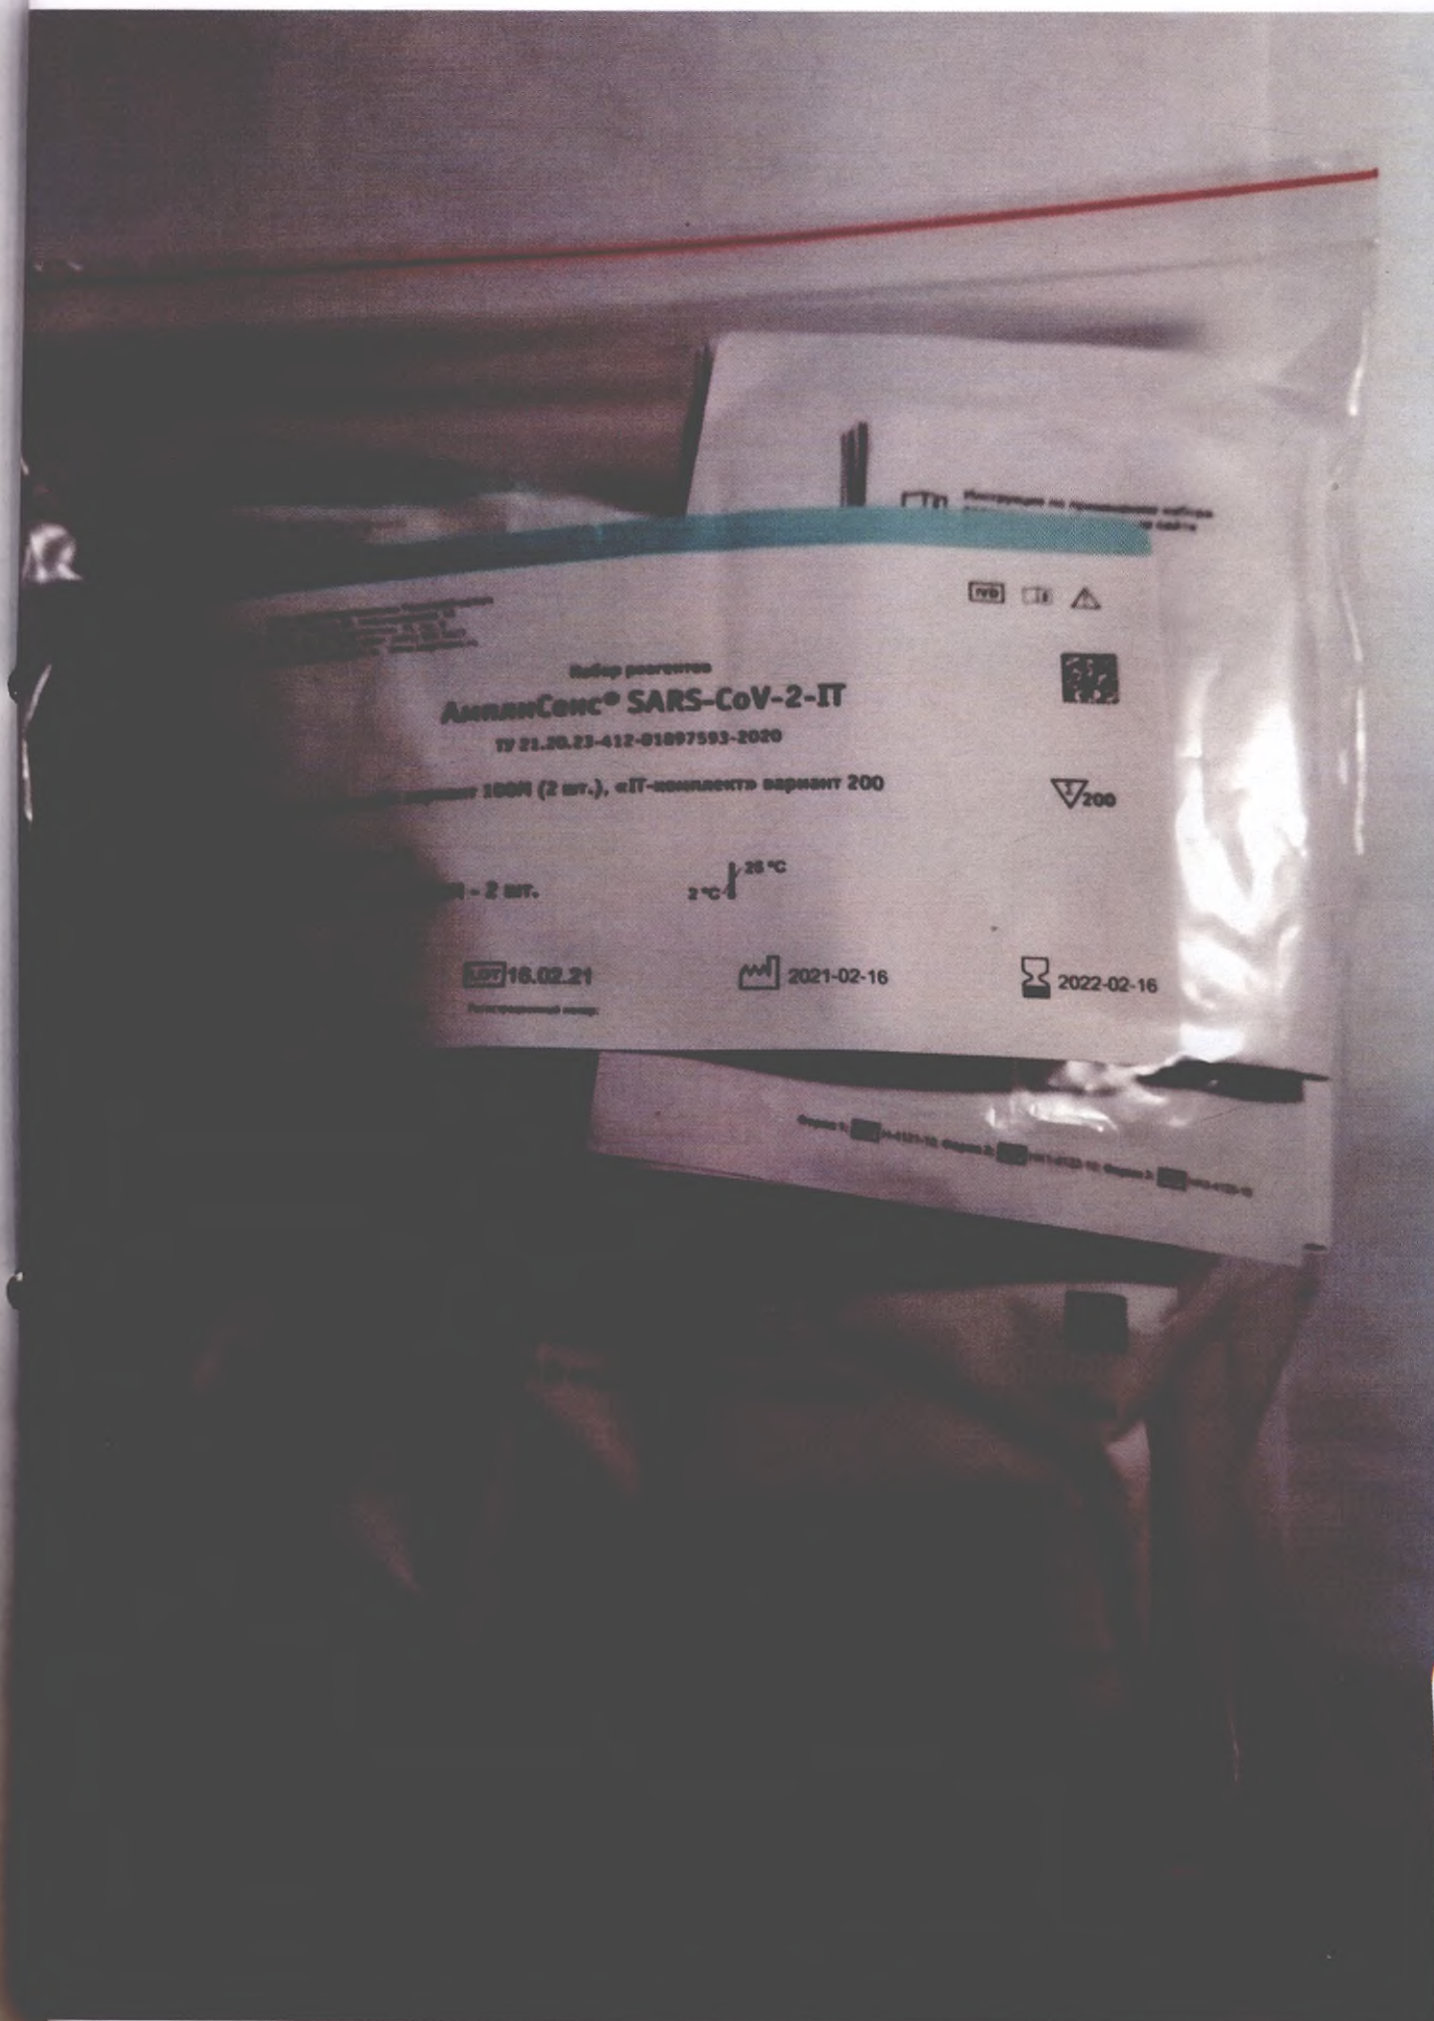

Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 3, упаковки 1 из 2, после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock)

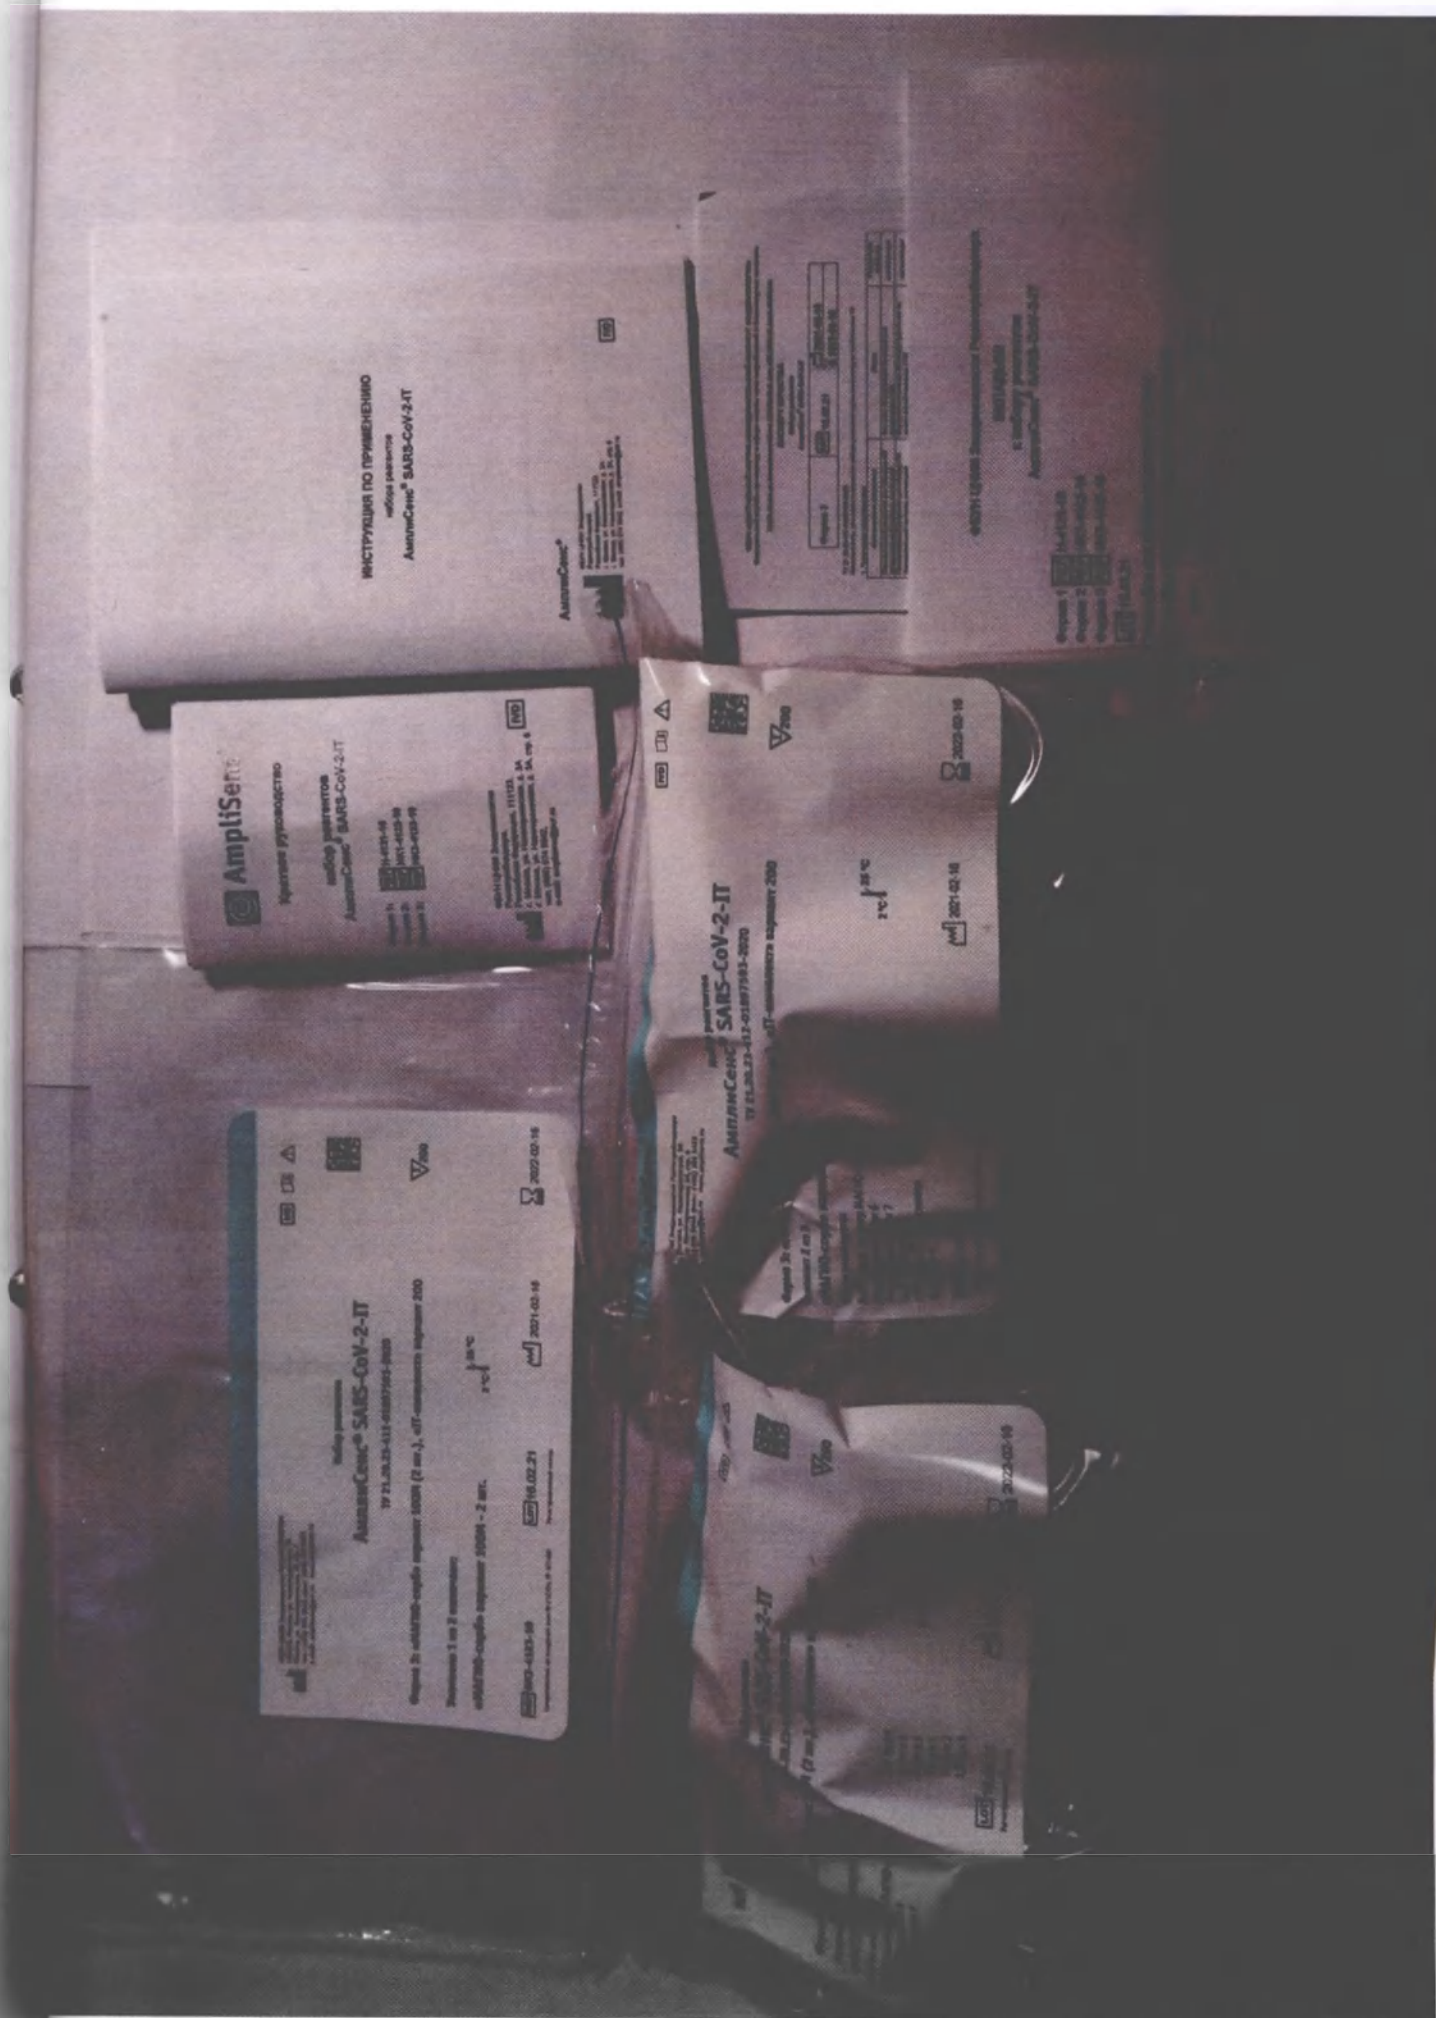





Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 3,
до вскрытия внешней упаковки (цефленовый пакет)



Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 2,
после вскрытия внешней упаковки (цефленовый пакет)



ИЗДАНИЕ 1.0

АмплиСенс® SARS-CoV-2-П

Набор реагентов

ТУ 21.20.23-412-01897593-2020

Формат 3: «МАГНО-сорб» вариант 100М (2 шт.), «П-комплект» вариант 200

Упаковка 1 из 2 включает:

«МАГНО-сорб» вариант 100М - 2 шт.

2 °C / 25 °C

ИЗДАНИЕ 1.0

АмплиСенс® SARS-CoV-2-П

Набор реагентов

ТУ 21.20.23-412-01897593-2020


Формат 3: «МАГНО-сорб» вариант 100М (2 шт.), «П-комплект» вариант 200

Упаковка 1 из 2 включает:


«МАГНО-сорб» вариант 100М - 2 шт.

2 °C / 25 °C

Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-ИТ, форма 3, упаковки 1 из 2, после вскрытия внешней упаковки (цефленовый пакет)

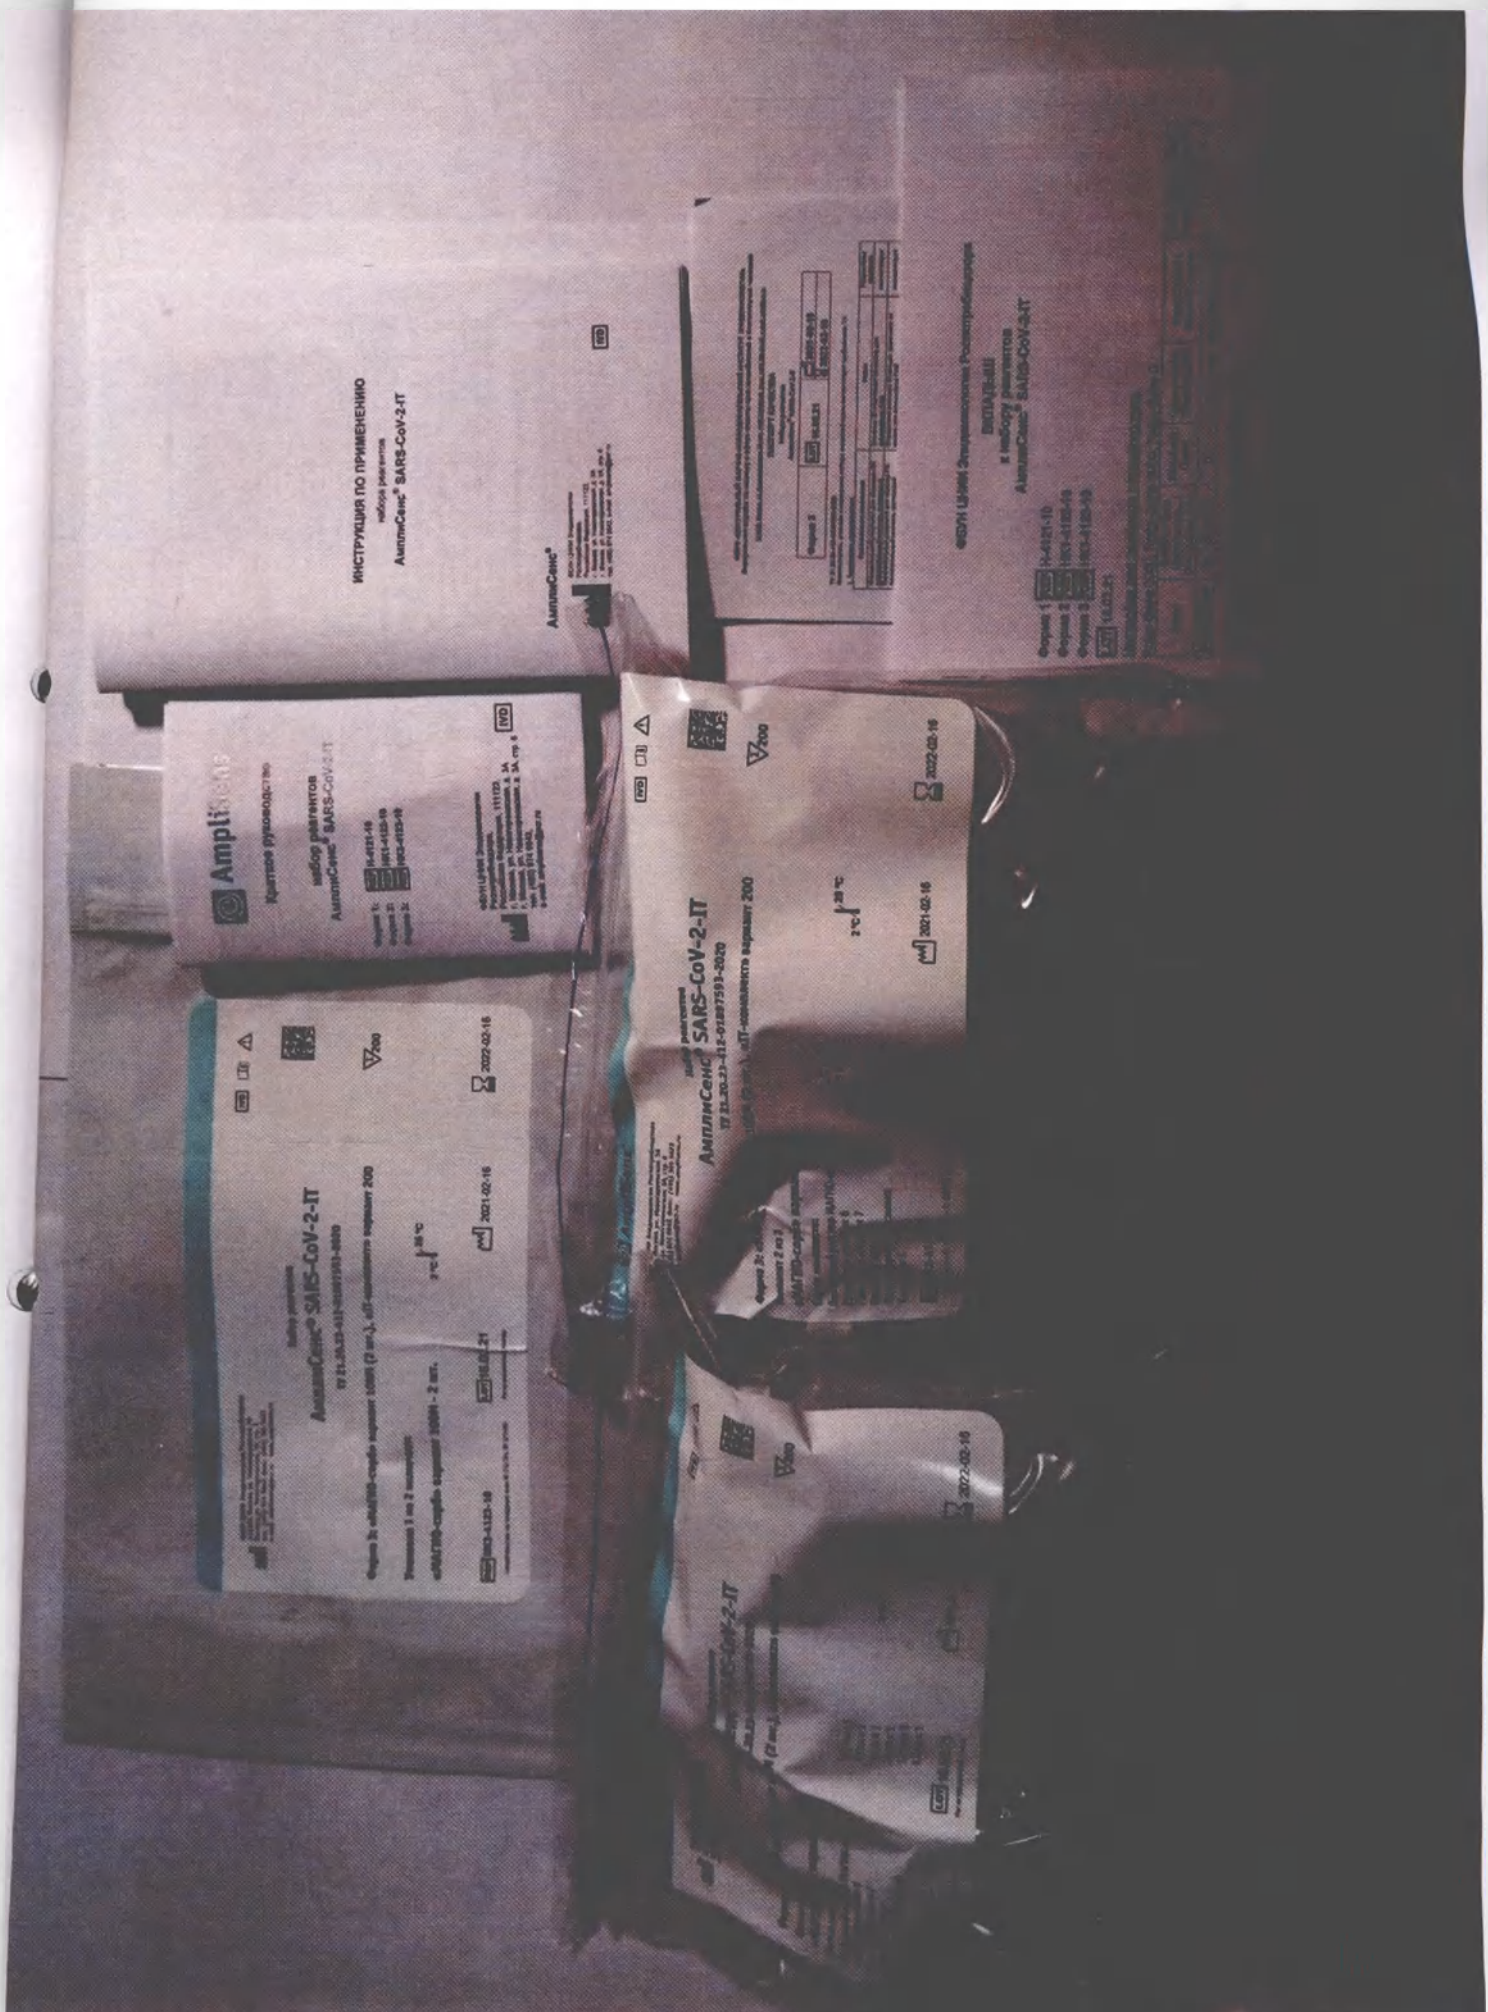

Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 3, упаковки 2 из 2, до вскрытия внешней упаковки (цефленовый пакет)

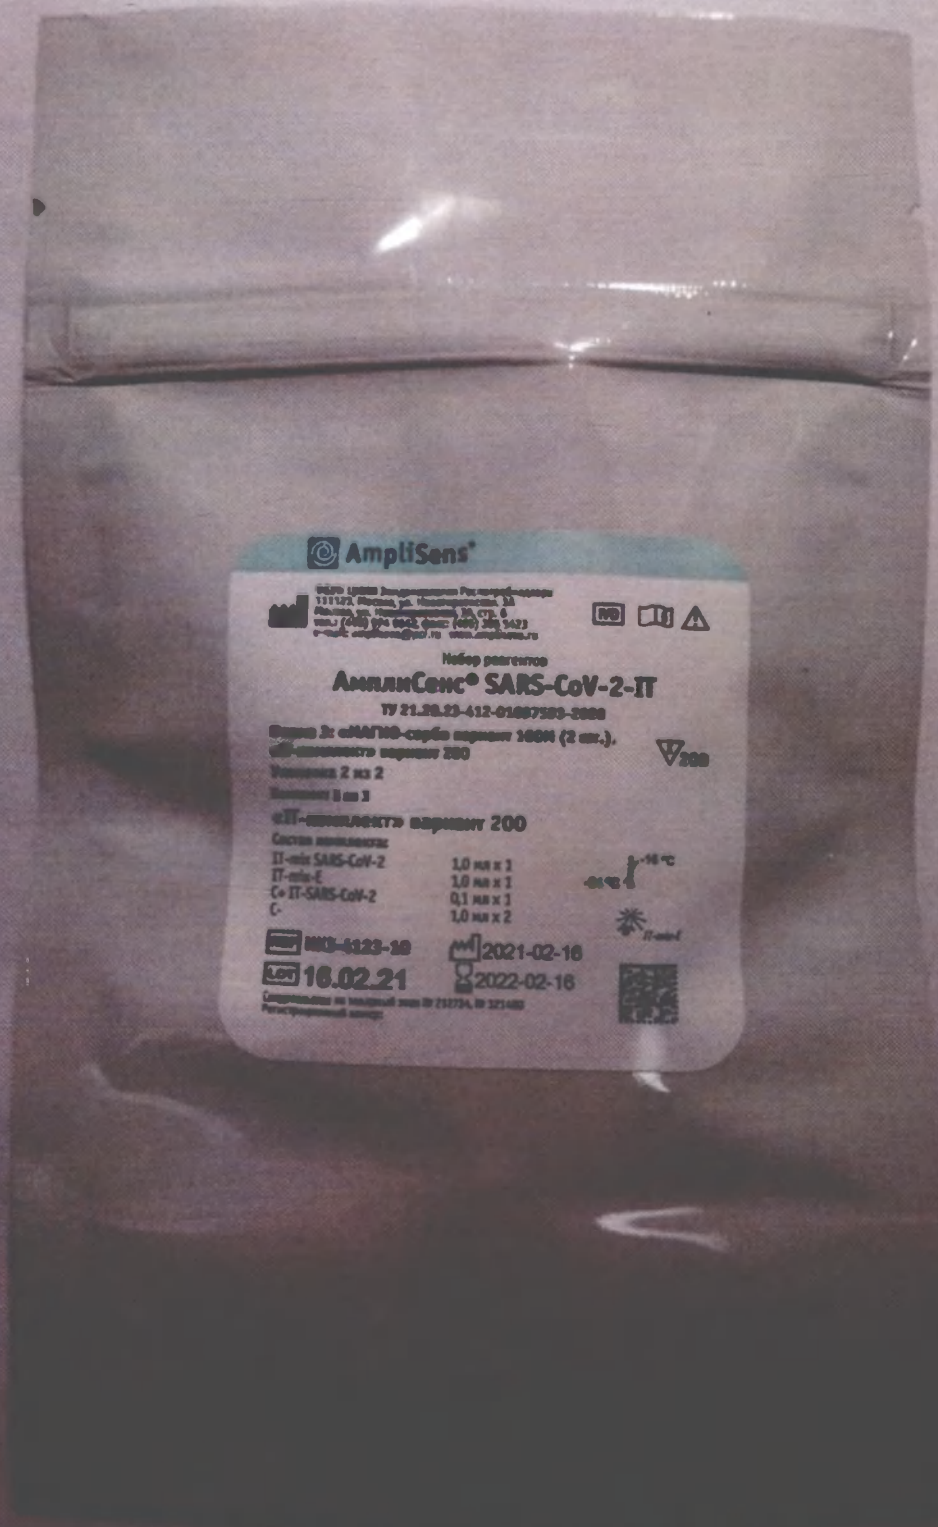


Фотография набора реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 3, упаковки 2 из 2, после вскрытия внешней упаковки (цефленовый пакет)



Фотография реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-IT, форма 3, упаковки 1 из 2, «МАГНО-сорб» вариант 100М (2 шт.)



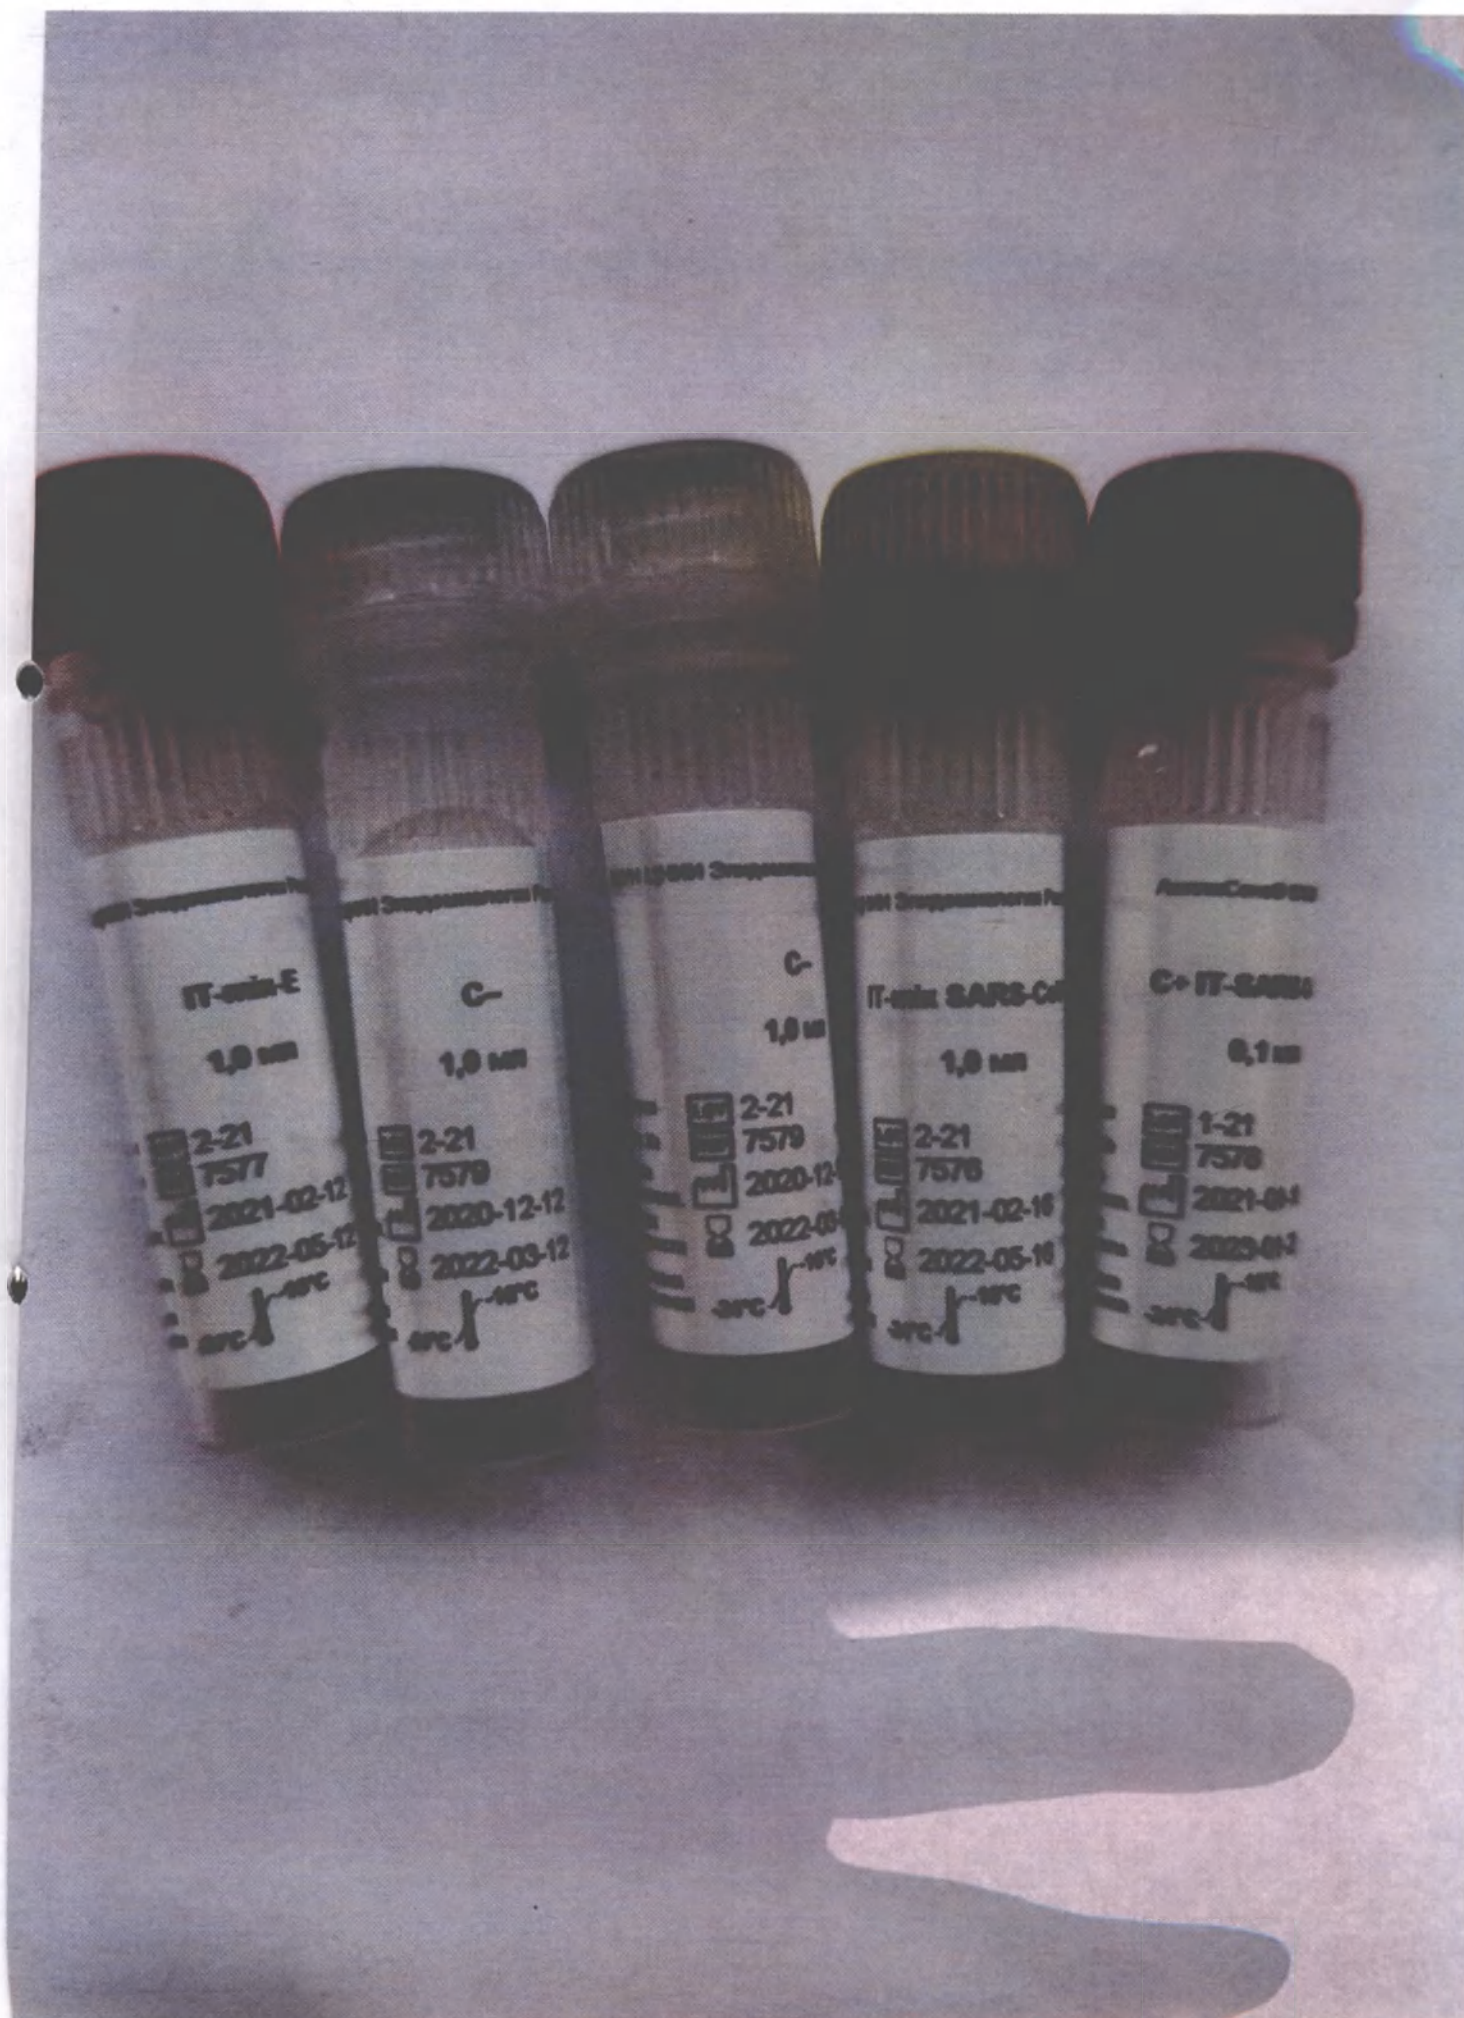

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 48
сорок восемь лист 26

Руководитель подразделения развития и качества продукции
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 60/20 от 17.04.2020 г.)



« 26 » 04 20 21 г. 

Е.А. Козлова

М.П.

