


ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

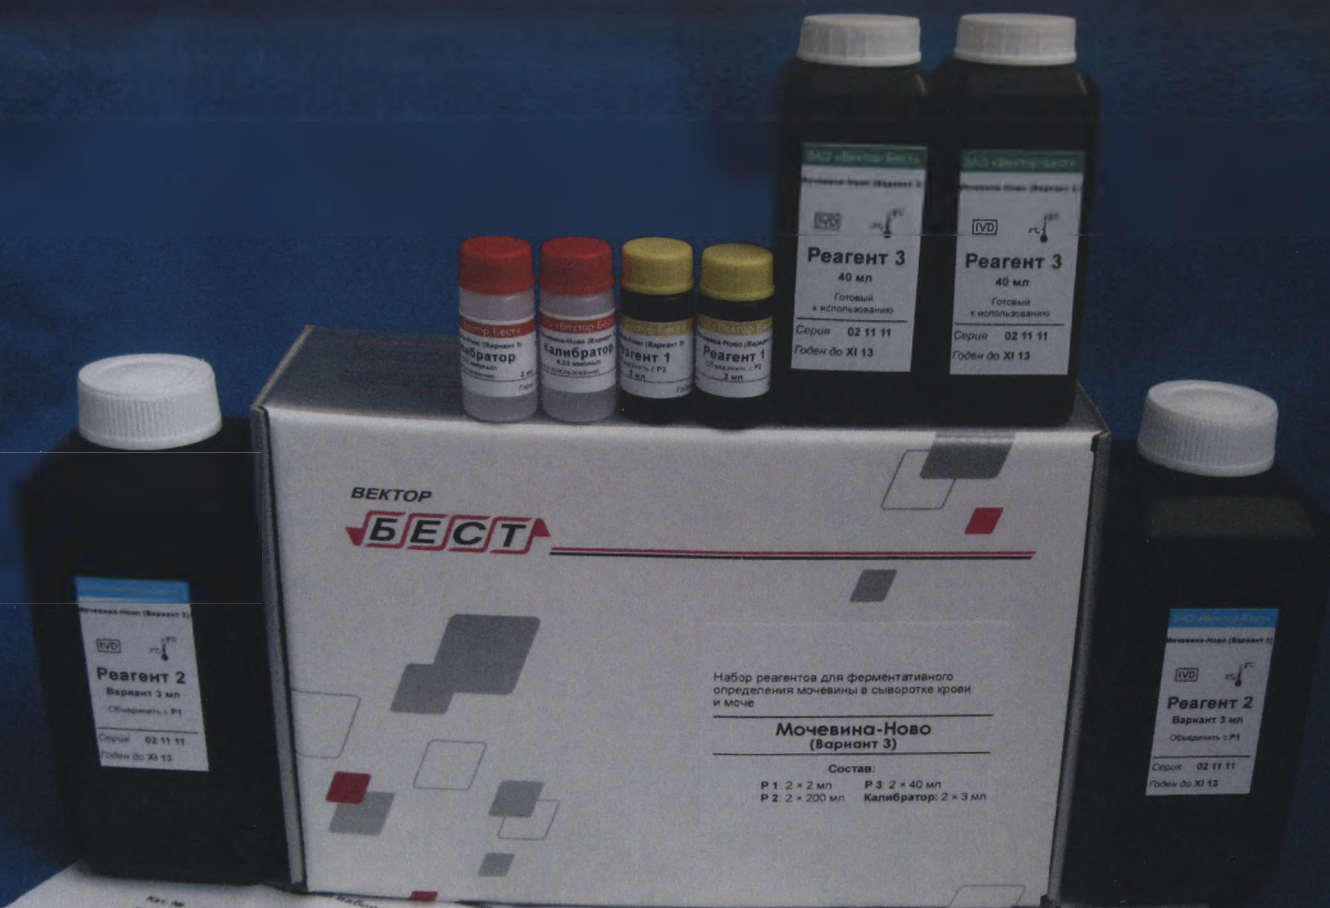

ИНСТРУКЦИЯ
к набору реагентов для ферментативного определения мочевины в сыворотке крови и моче
МОЧЕВИНА-НОВО (Вариант 3)

Набор реагентов для ферментативного определения мочевины в сыворотке крови и моче

ТУ 9398-063-23548-172-2007
Извещение №1 об изменении
РУ № ФСР 2007/01468 от 24.12.2007
Хранить при температуре 2-8°C
Наименование показателя

Внешний вид	Процедура	Результат
Реагент 1	Процедура бесцветная или слегка мутная	Процедура бесцветная или слегка мутная
Реагент 2	Процедура бесцветная или слегка мутная	Процедура бесцветная или слегка мутная
Реагент 3	Процедура бесцветная или слегка мутная	Процедура бесцветная или слегка мутная
Калибратор	Процедура бесцветная или слегка мутная	Процедура бесцветная или слегка мутная

После добавления реагентов и инкубации при температуре 37°C в течение 10 минут.

108

