

## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

### МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:


**заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Варианты исполнения:

pearl disks 98,3ммØ x 10мм, 98,3ммØ x 12мм, 98,3ммØ x 14мм, 98,3ммØ x 16мм, 98,3ммØ x 18мм, 98,3ммØ x 20мм, 98,3ммØ x 25мм; 95ммØ x 10мм, 95ммØ x 12мм, 95ммØ x 14мм, 95ммØ x 16мм, 95ммØ x 18мм, 95ммØ x 20мм, 95ммØ x 25мм; Pearl blocks 75,5мм x 40мм x16мм, 75,5мм x 40мм x22мм; Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 14мм, 90мм x 72,5мм x 16мм, 90мм x 72,5мм x 18мм, 90мм x 72,5мм x 20мм, 90мм x 72,5мм x 25мм; Shell disks 98,3ммØ x 10мм, 98,3ммØ x 12мм, 98,3ммØ x 14мм, 98,3ммØ x 16мм, 98,3ммØ x 18мм, 98,3ммØ x 20мм, 98,3ммØ x 25мм; Shell D-shape 90мм x 72,5мм x 14мм, 90мм x 72,5мм x 16мм, 90мм x 72,5мм x 18мм, 90мм x 72,5мм x 20мм, 90мм x 72,5мм x 25мм; Shell blocks 75,5мм x 40мм x16мм, 75,5мм x 40мм x22мм

Производства DOCERAM Medical Ceramics GmbH, Германия

1.1 Pearl disk 98,3ммØ x 10мм. Изделие.

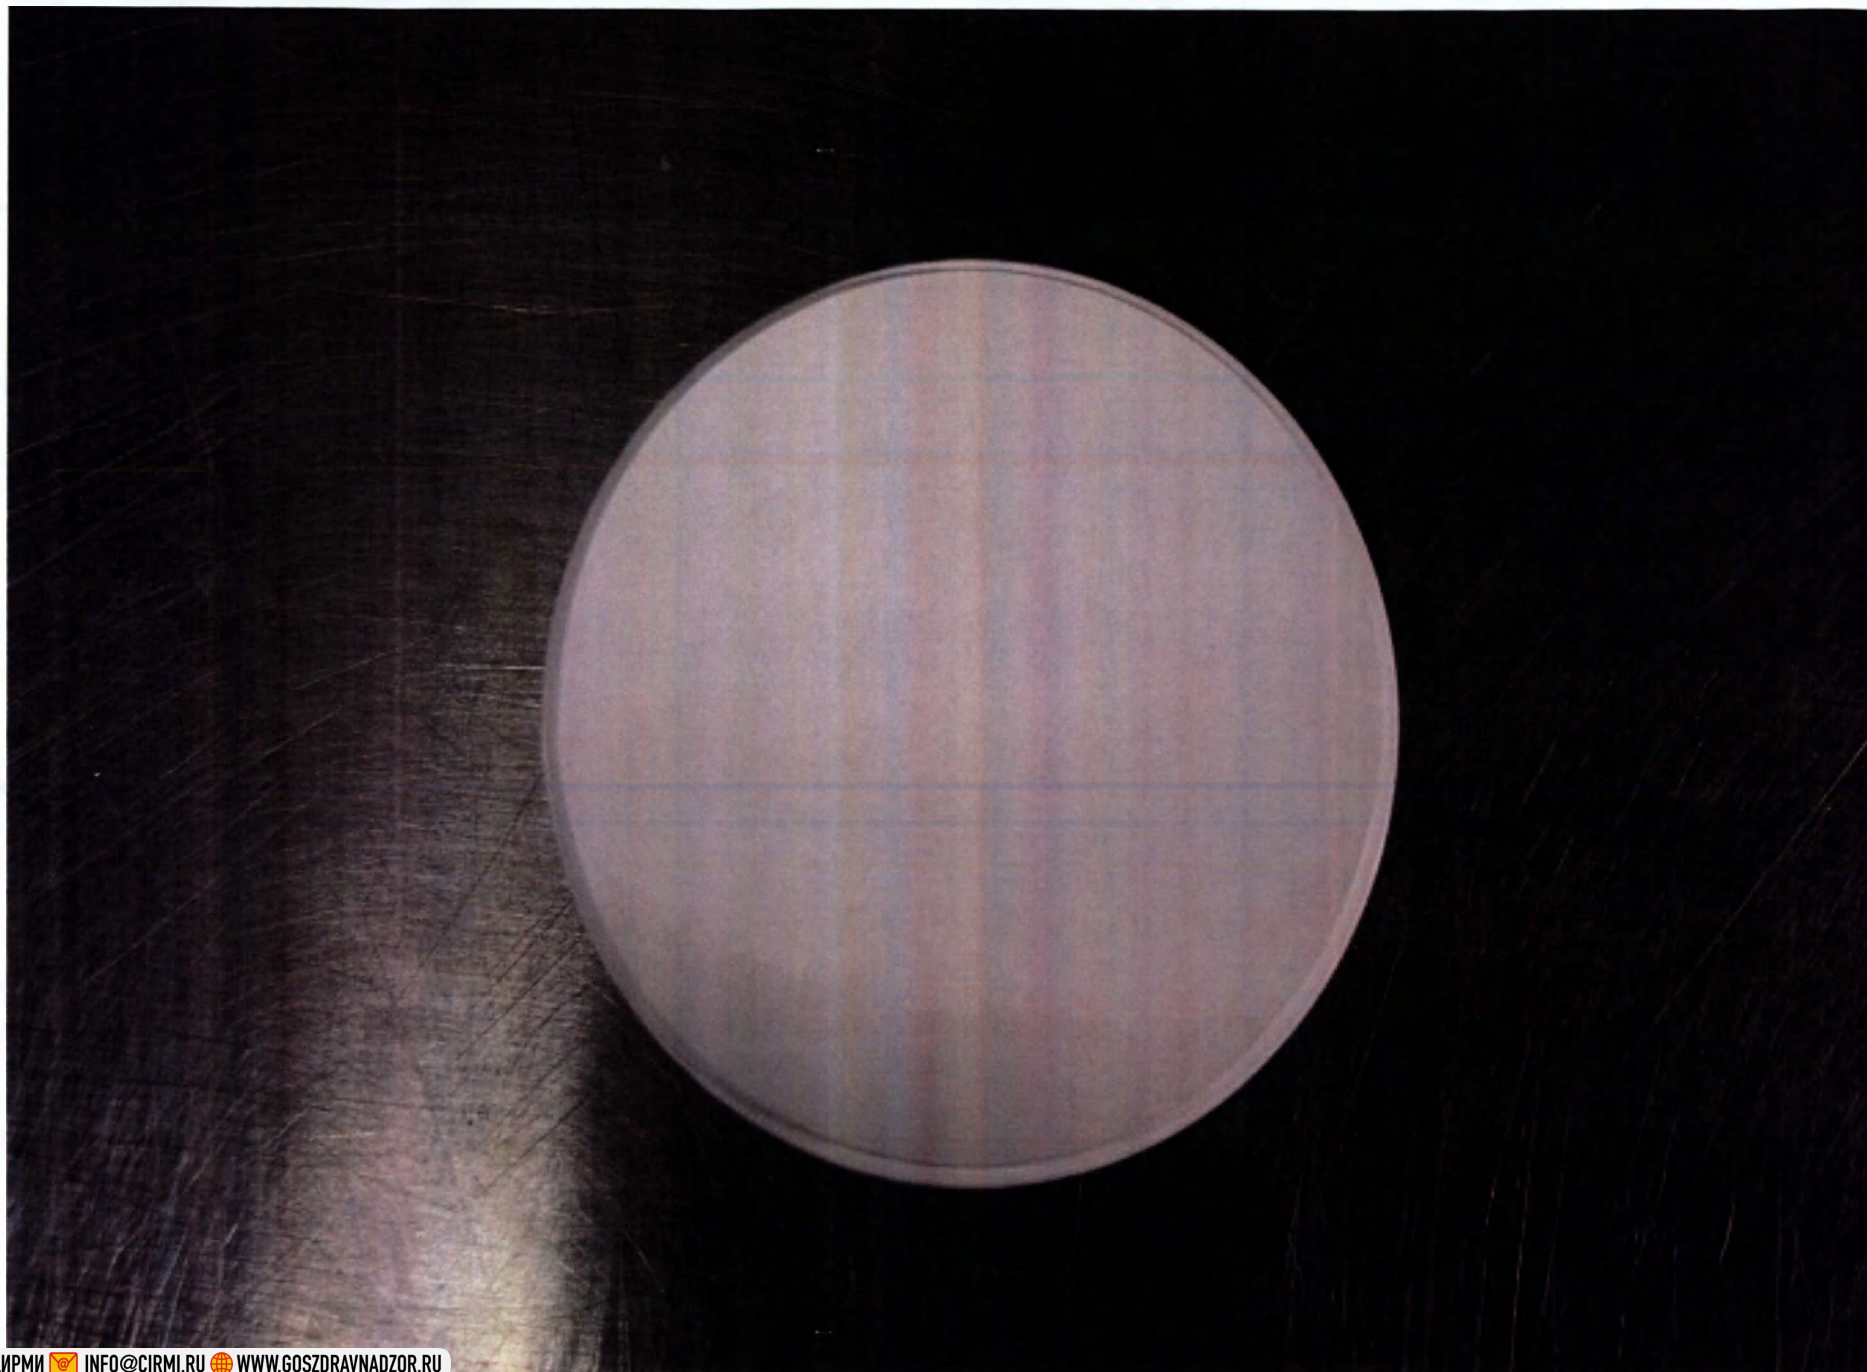

1.2 Pearl disk 98,3ммØ x 10мм.Упаковка.



1.3 Pearl disk 98,3ммØ x 10мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ  
ООО «ТС Дентал»  
123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2  
+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 98,3ммØ x 10мм

Серийный номер: 3210-WN-3092

LOT: 3181339

Дата производства: 13.04.2015

Срок годности: 13.04.2022

Фактор усадки: S > 6 %




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

2.1 Pearl disk 98,3ммØ x 12мм. Изделие.

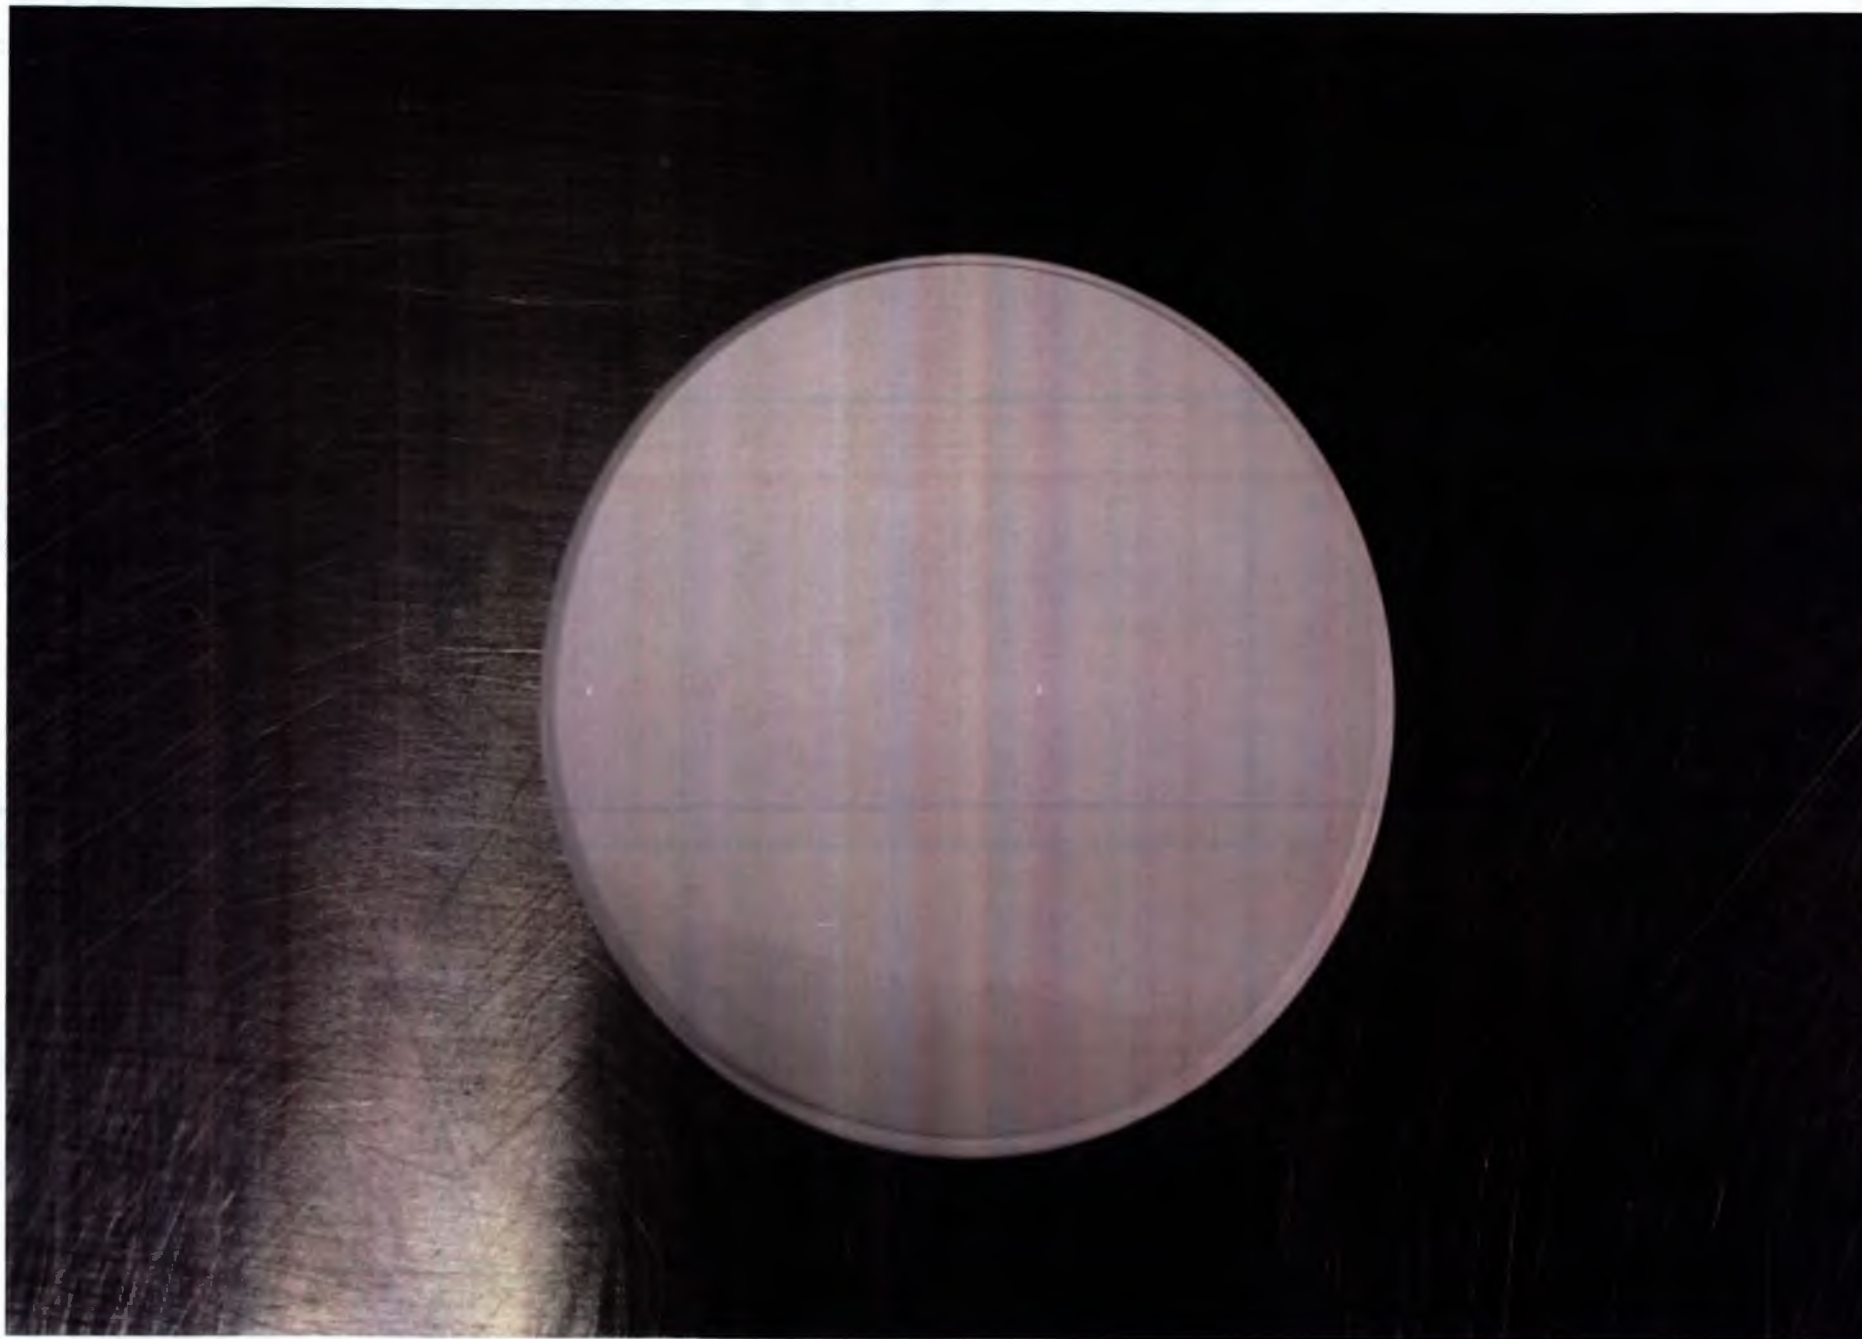

2.2 Pearl disk 98,3ммØ x 12мм. Упаковка.



### 2.3 Pearl disk 98,3ммØ x 12мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ  
ООО «ТС Дентал»  
123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2  
+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 98,3ммØ x 12мм

Серийный номер: 3210-WN-3093

LOT: 3194768

Дата производства: 13.04.2015

Срок годности: 13.04.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany


Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....


3.1 Pearl disk 98,3ммØ x 14мм. Изделие.

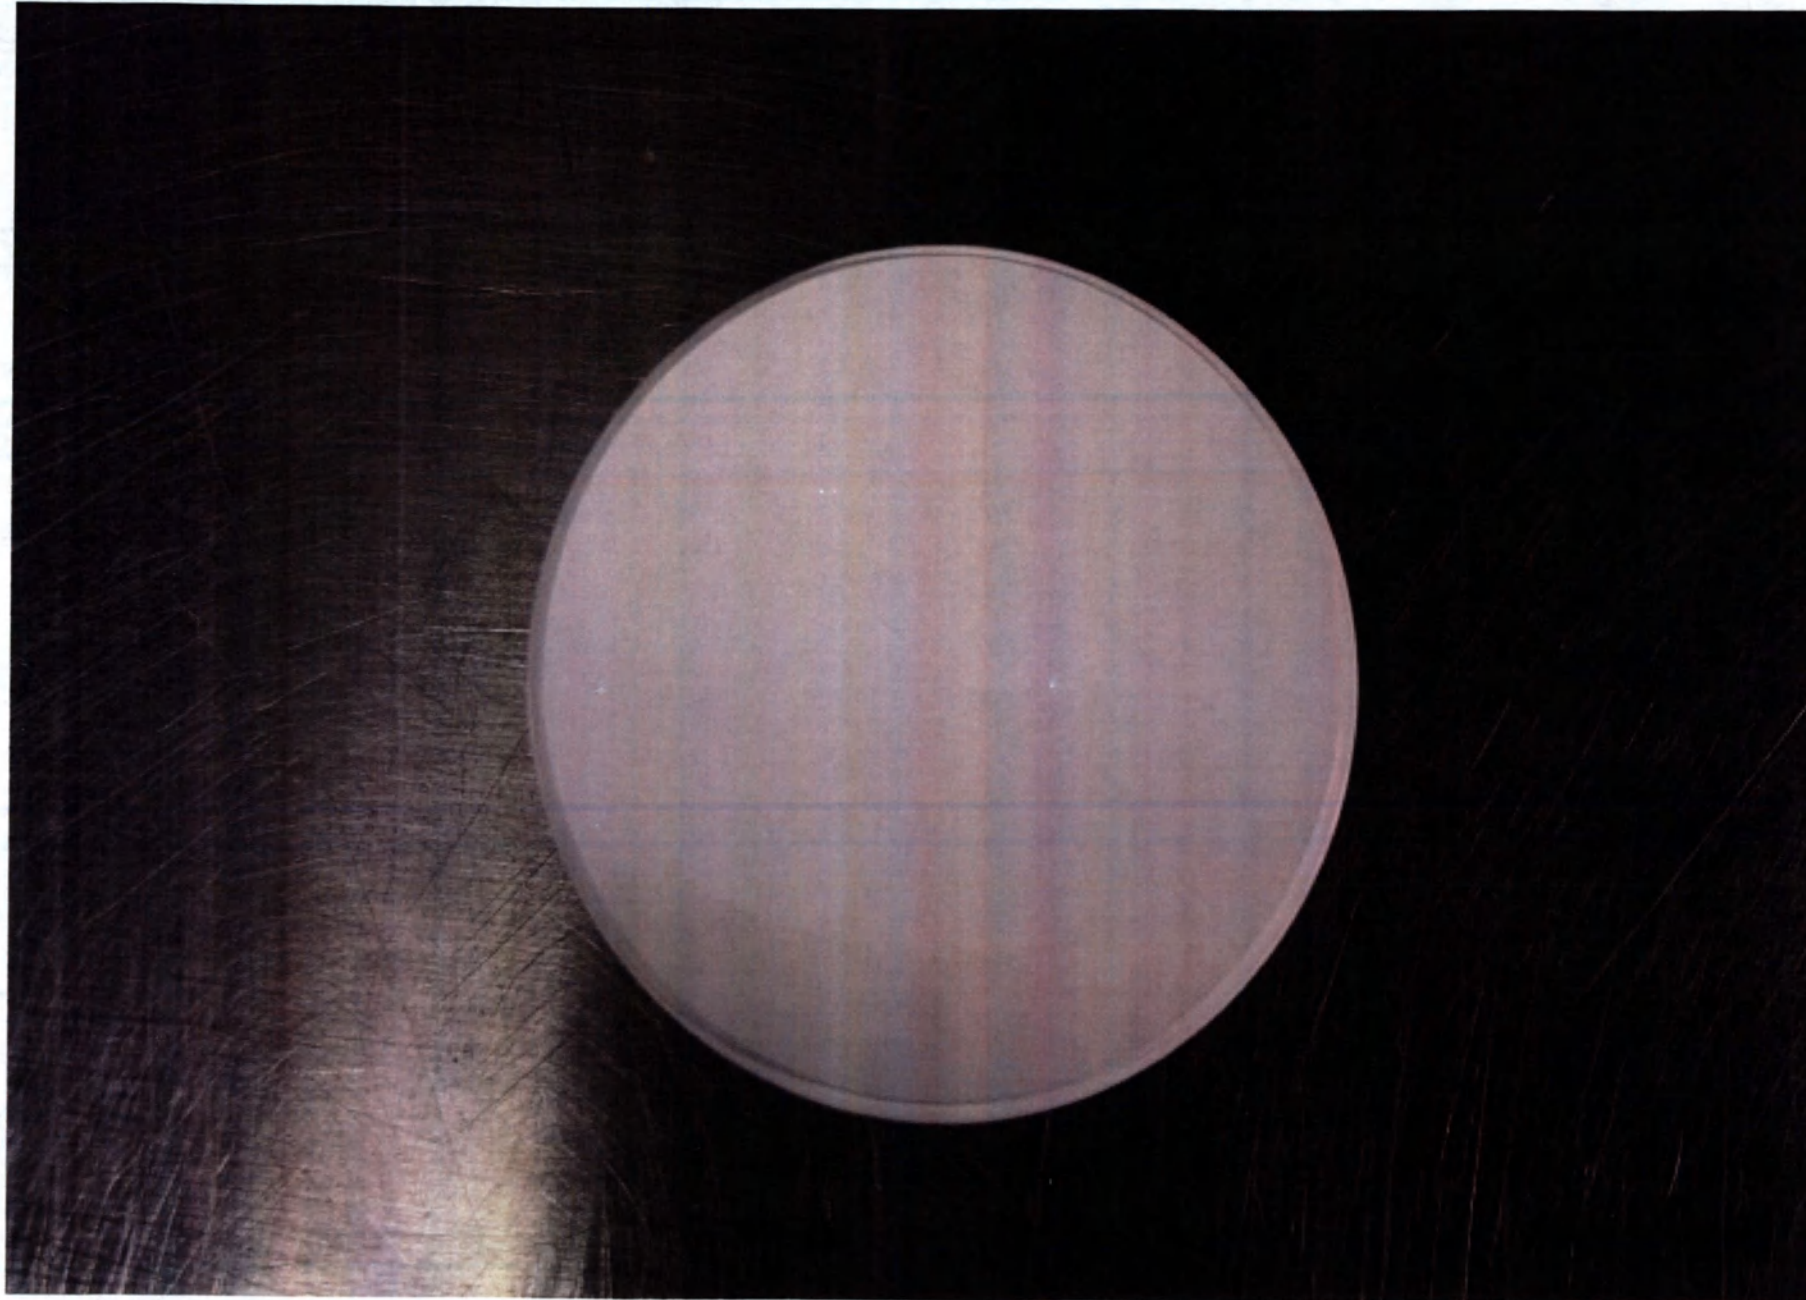

3.2 Pearl disk 98,3ммØ x 14мм.Упаковка.

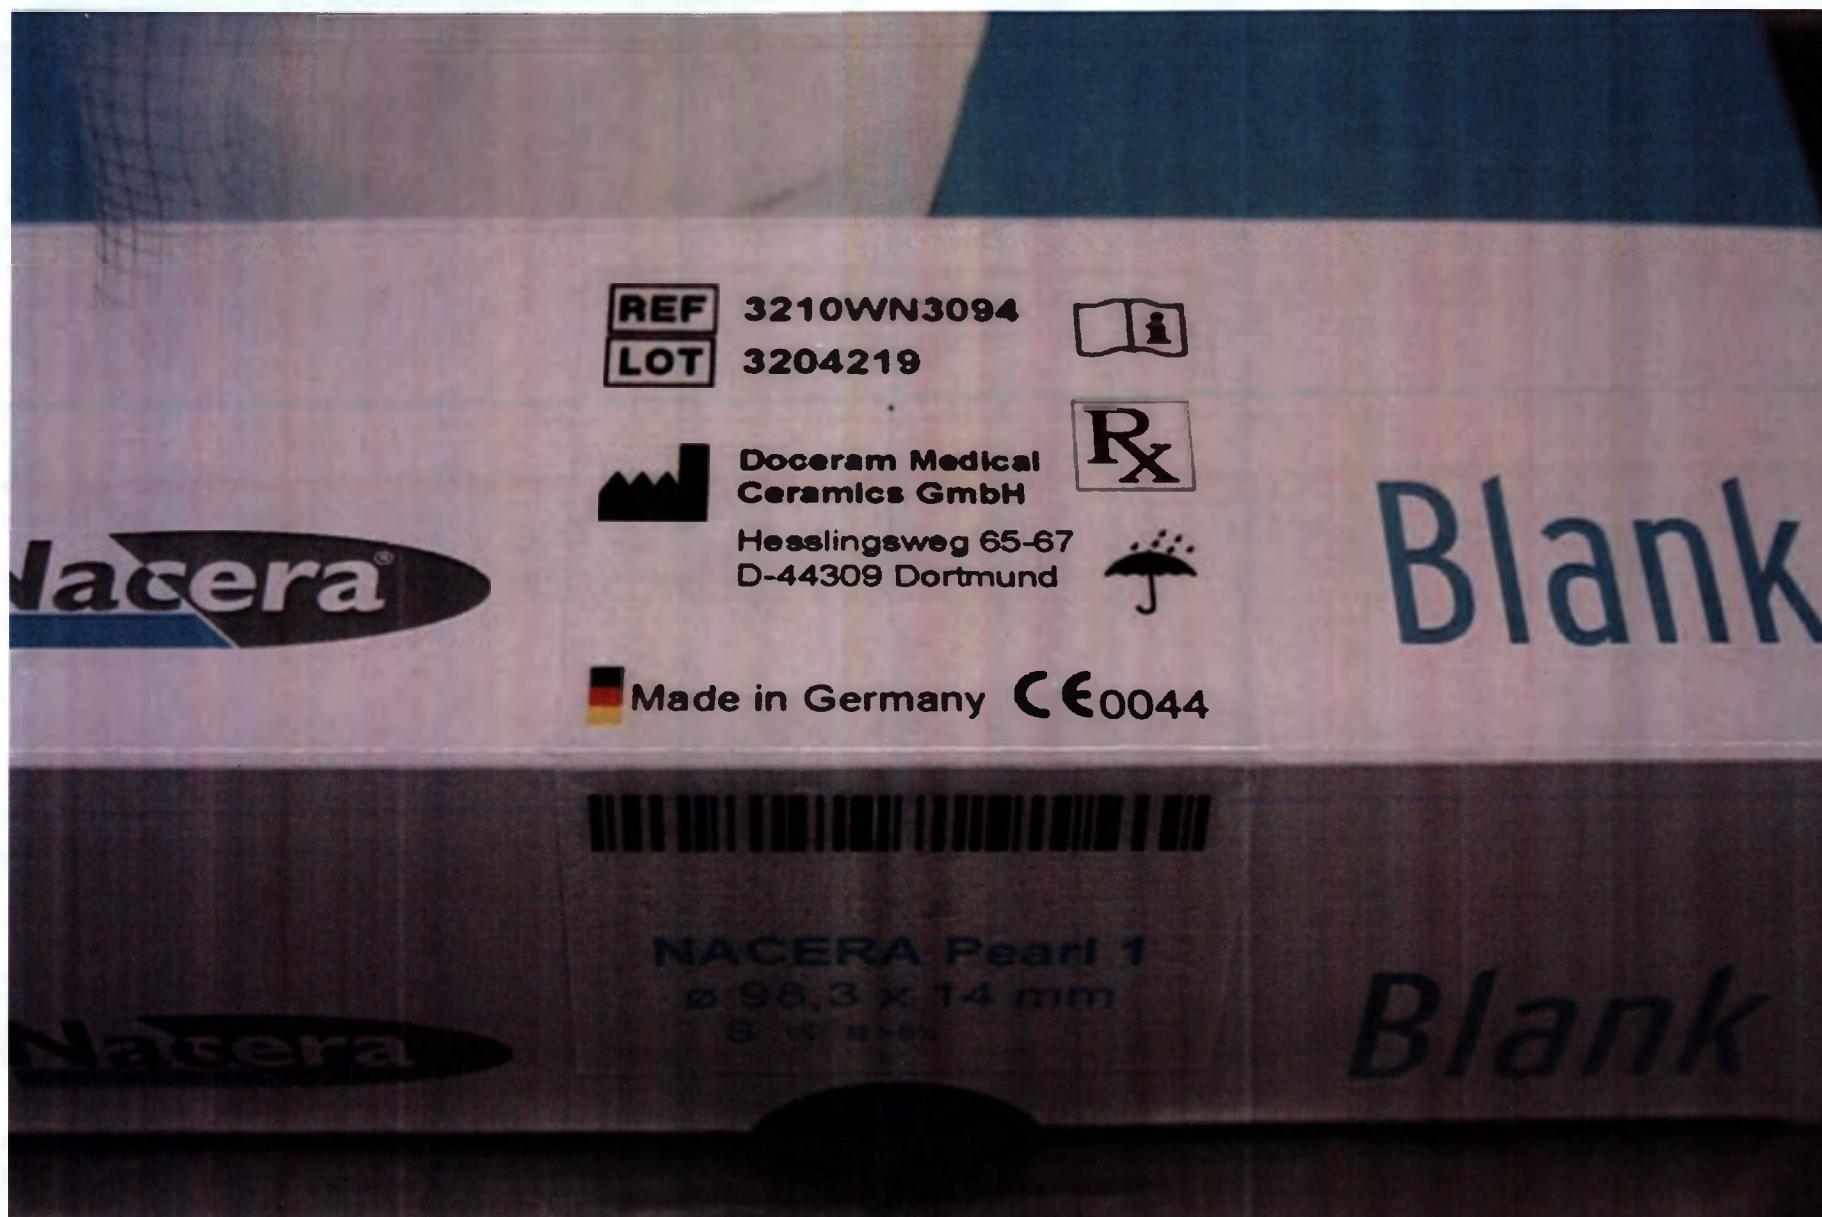

### 3.3 Pearl disk 98,3ммØ x 14мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ  
ООО «ТС Дентал»  
123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2  
+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 98,3ммØ x 14мм

Серийный номер: 3210-WN-3094

LOT: 3204219

Дата производства: 12.06.2015

Срок годности: 12.06.2022

Фактор усадки: S > 6 %




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

4.1 Pearl disk 98,3ммØ x 16мм. Изделие.

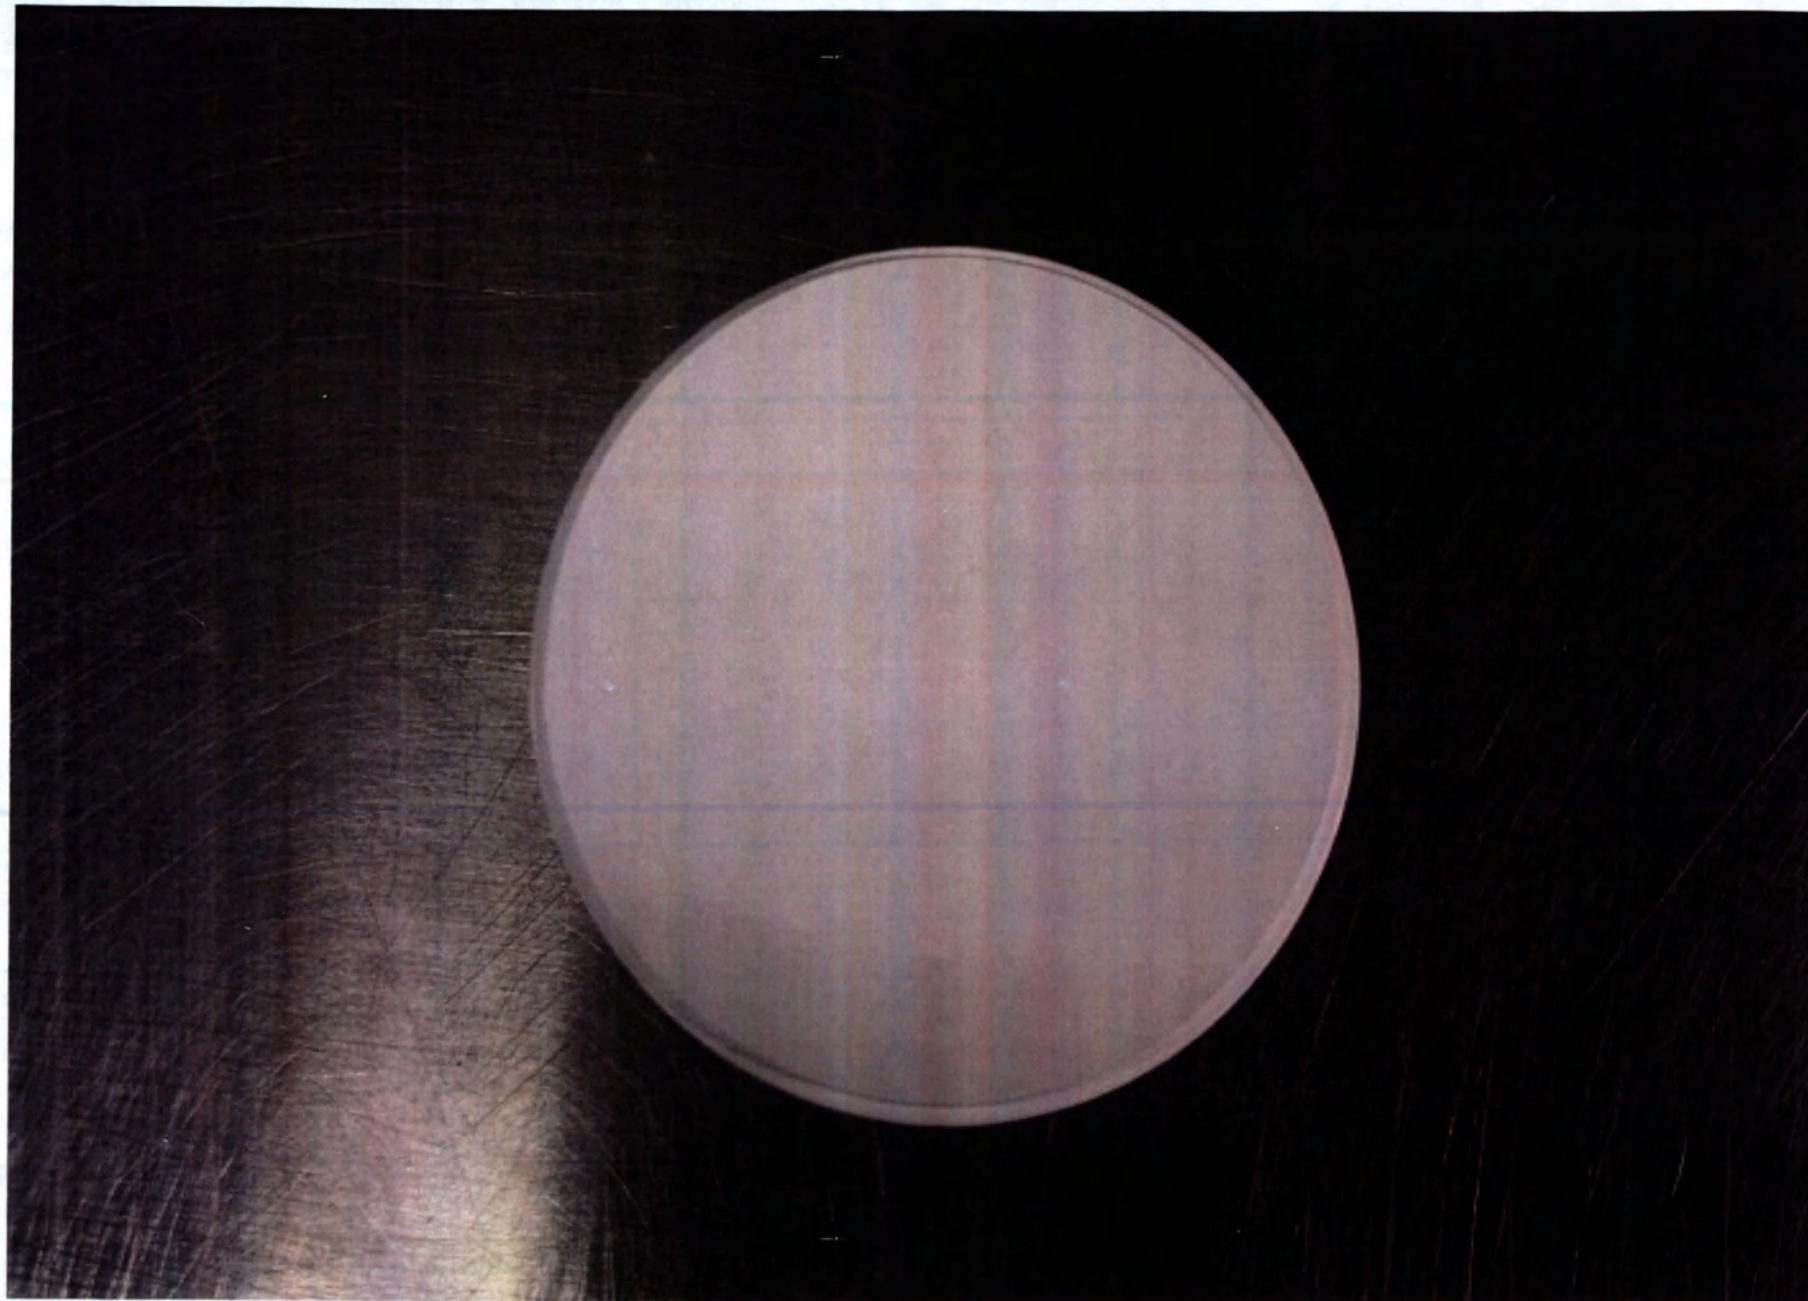

4.2 Pearl disk 98,3ммØ x 16мм. Упаковка.



#### 4.3 Pearl disk 98,3ммØ x 16мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ  
ООО «ТС Дентал»  
123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2  
+7 495 921 35 06

#### Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 98,3ммØ x 16мм

Серийный номер: 3210-WN-3913

LOT: 3193377

Дата производства: 20.03.2015

Срок годности: 20.03.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

5.1 Pearl disk 98,3ммØ x 18мм. Изделие.

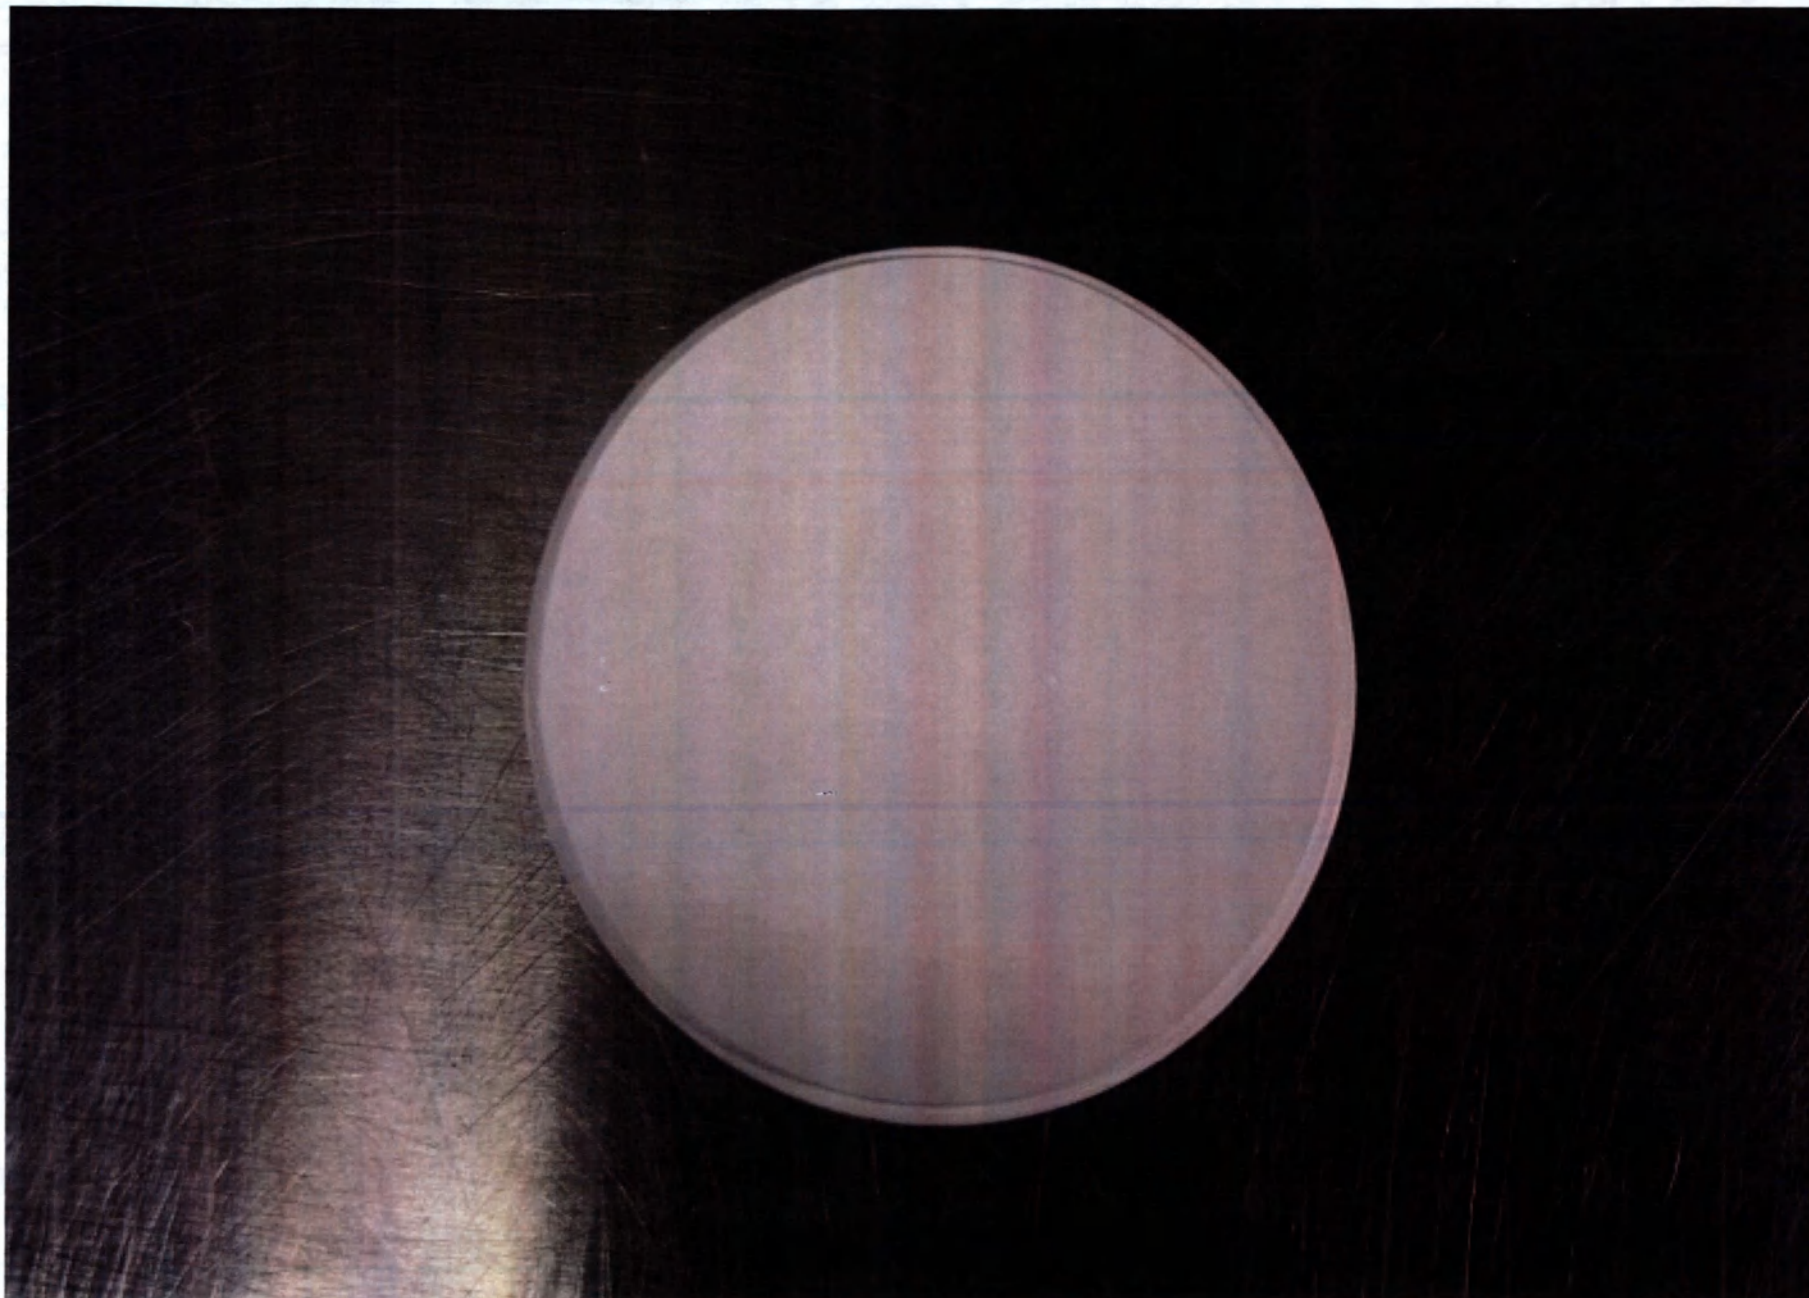

5.2 Pearl disk 98,3ммØ x 18мм. Упаковка.



5.3 Pearl disk 98,3ммØ x 18мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 98,3ммØ x 18мм

Серийный номер: 3210-WN-3095

LOT: 3198927

Дата производства: 11.06.2015

Срок годности: 11.06.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

6.1 Pearl disk 98,3ммØ x 20мм. Изделие.

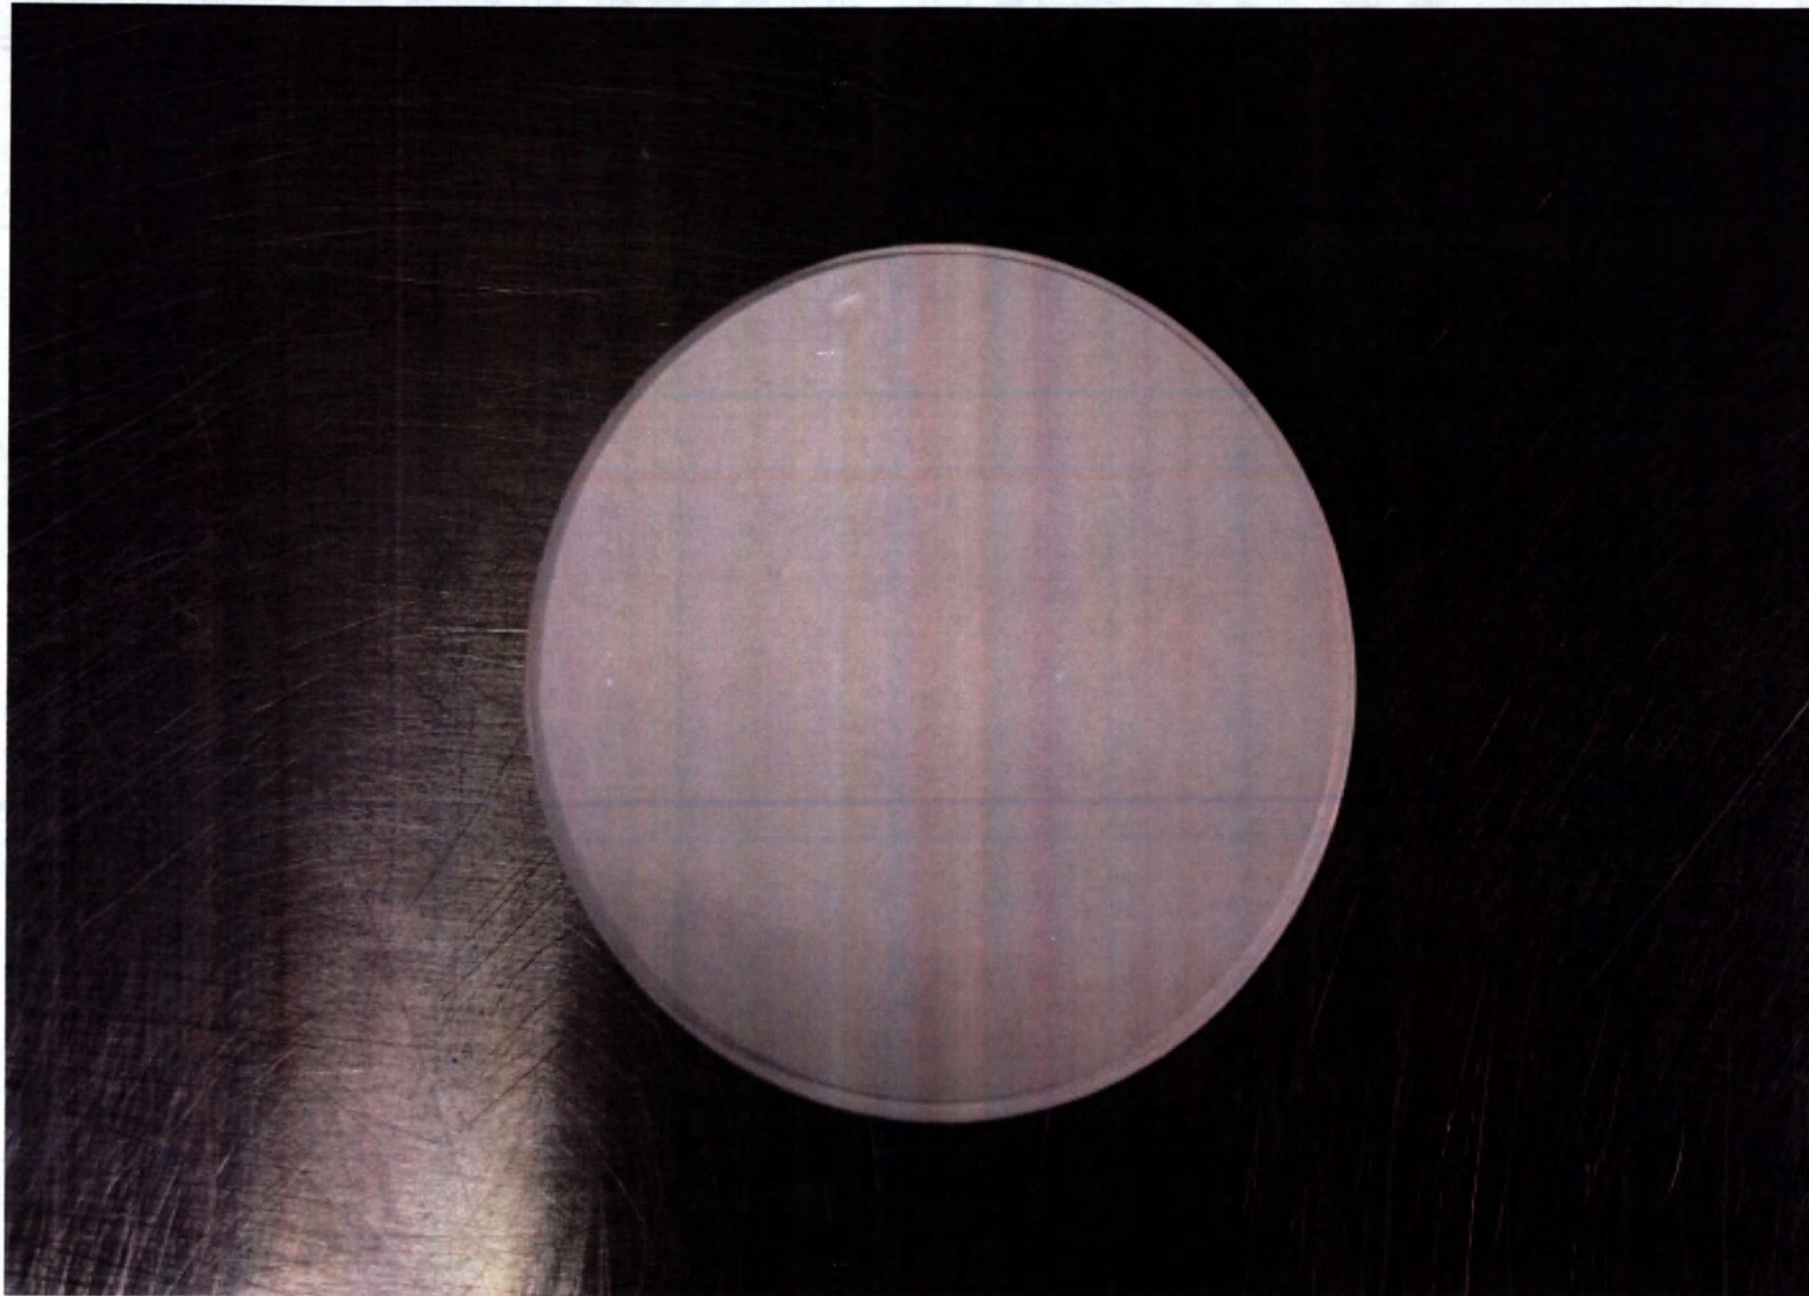

6.2 Pearl disk 98,3ммØ x 20мм. Упаковка.



### 6.3 Pearl disk 98,3ммØ x 20мм. Маркировка для РФ



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 98,3ммØ x 20мм

Серийный номер: 3210-WN-3096

LOT: 3203956

Дата производства: 24.02.2015

Срок годности: 24.02.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany


Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

7.1 Pearl disk 98,3ммØ x 25мм. Изделие.

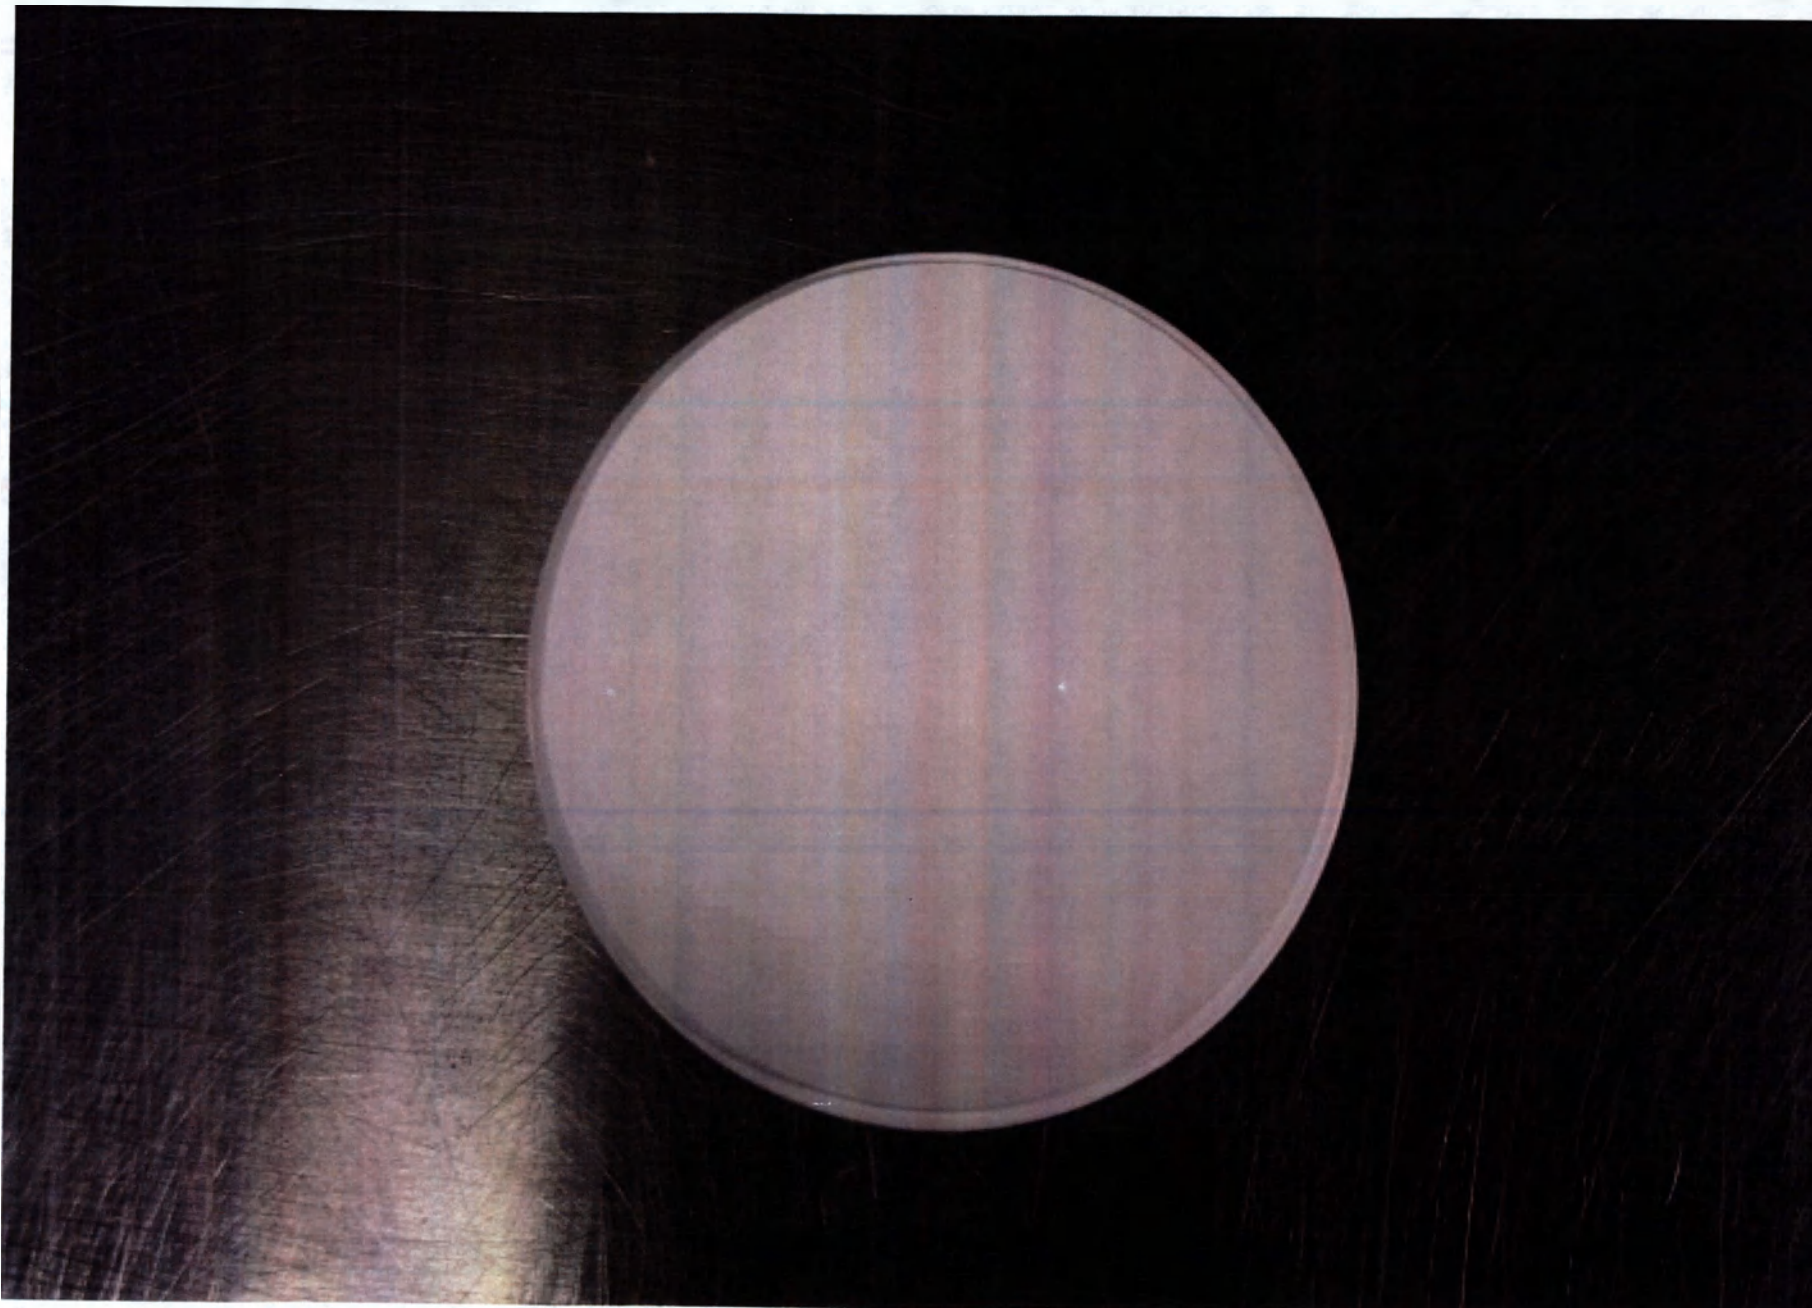

7.2 Pearl disk 98,3ммØ x 25мм. Упаковка.

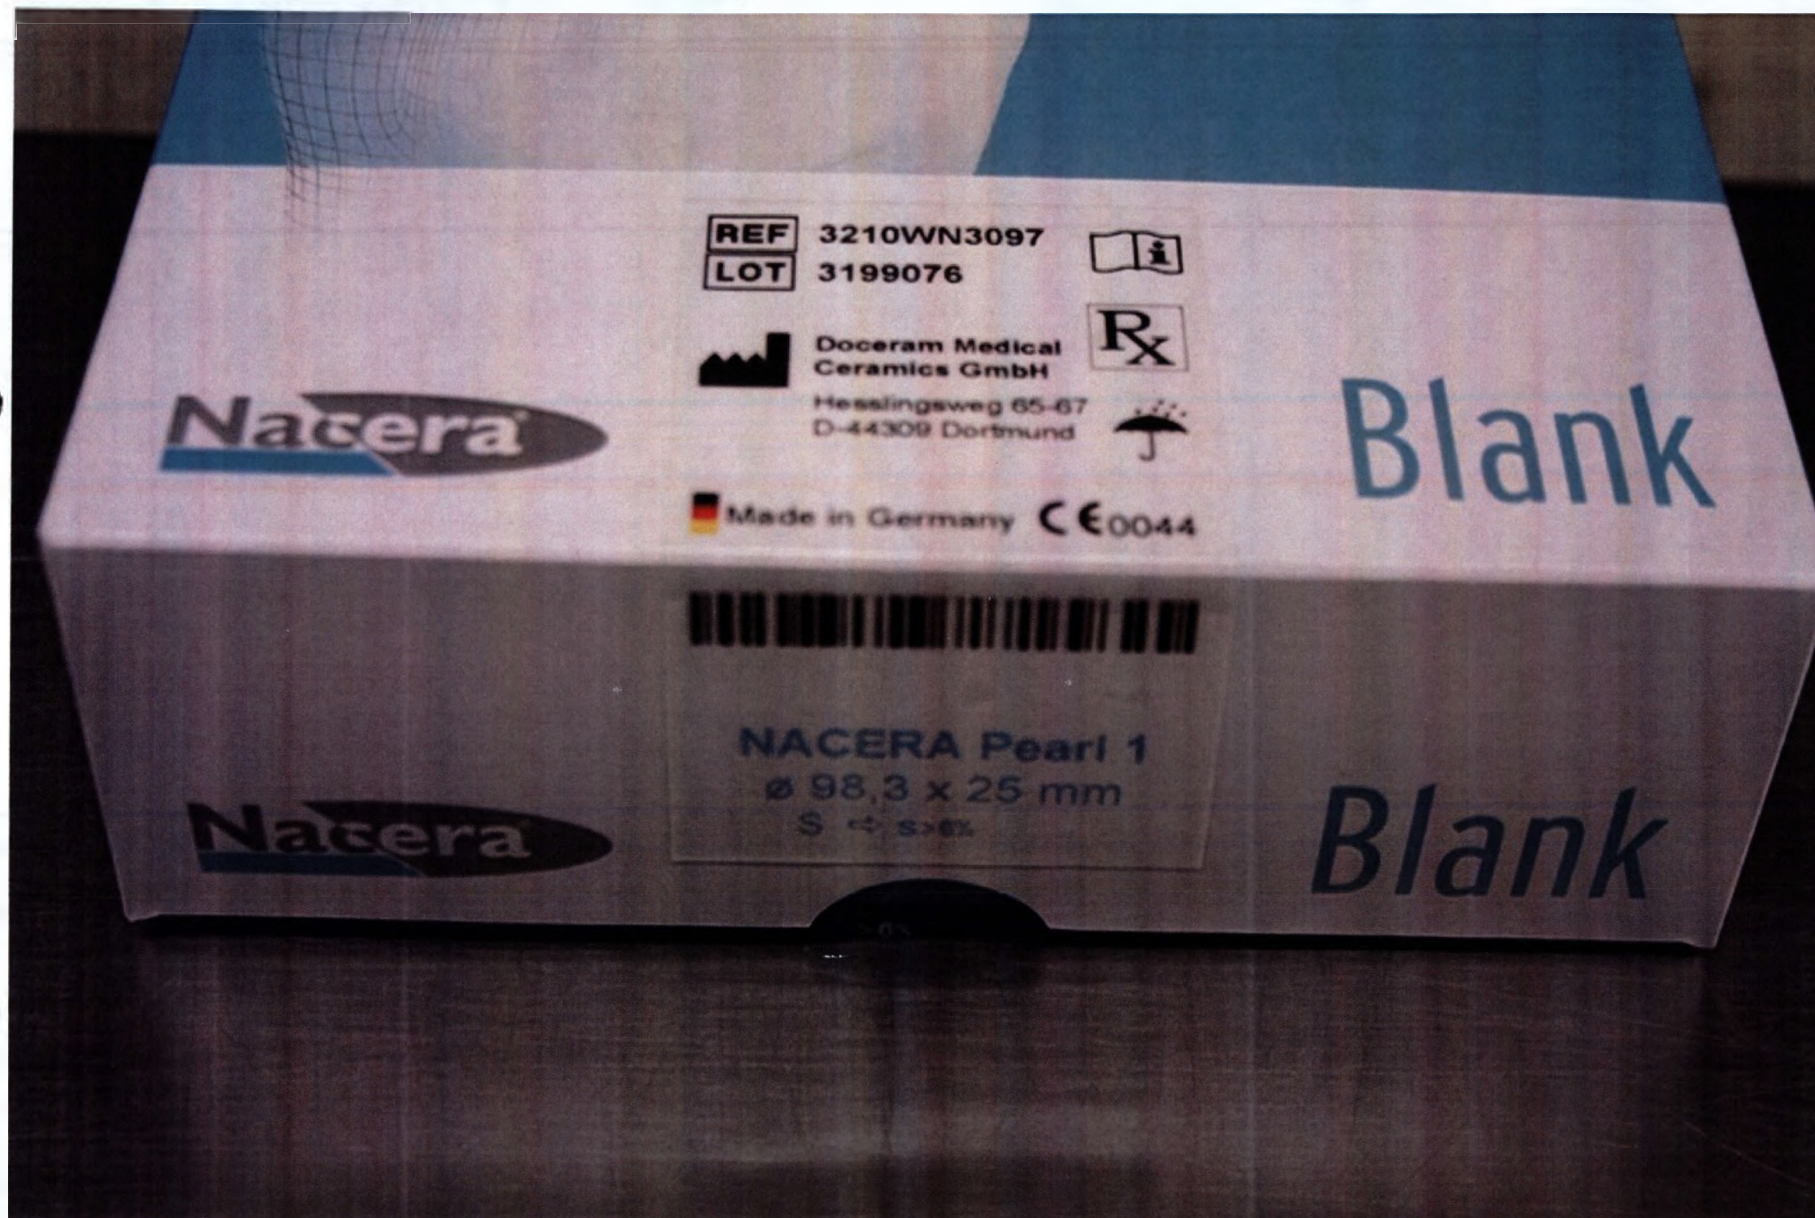

7.3 Pearl disk 98,3ммØ x 25мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 98,3ммØ x 25мм

Серийный номер: 3210-WN-3097

LOT: 3199076

Дата производства: 06.03.2015

Срок годности: 06.03.2022

Фактор усадки: S > 6 %




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany


Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

8.1 Pearl disk 95ммØ x 10мм. Изделие.

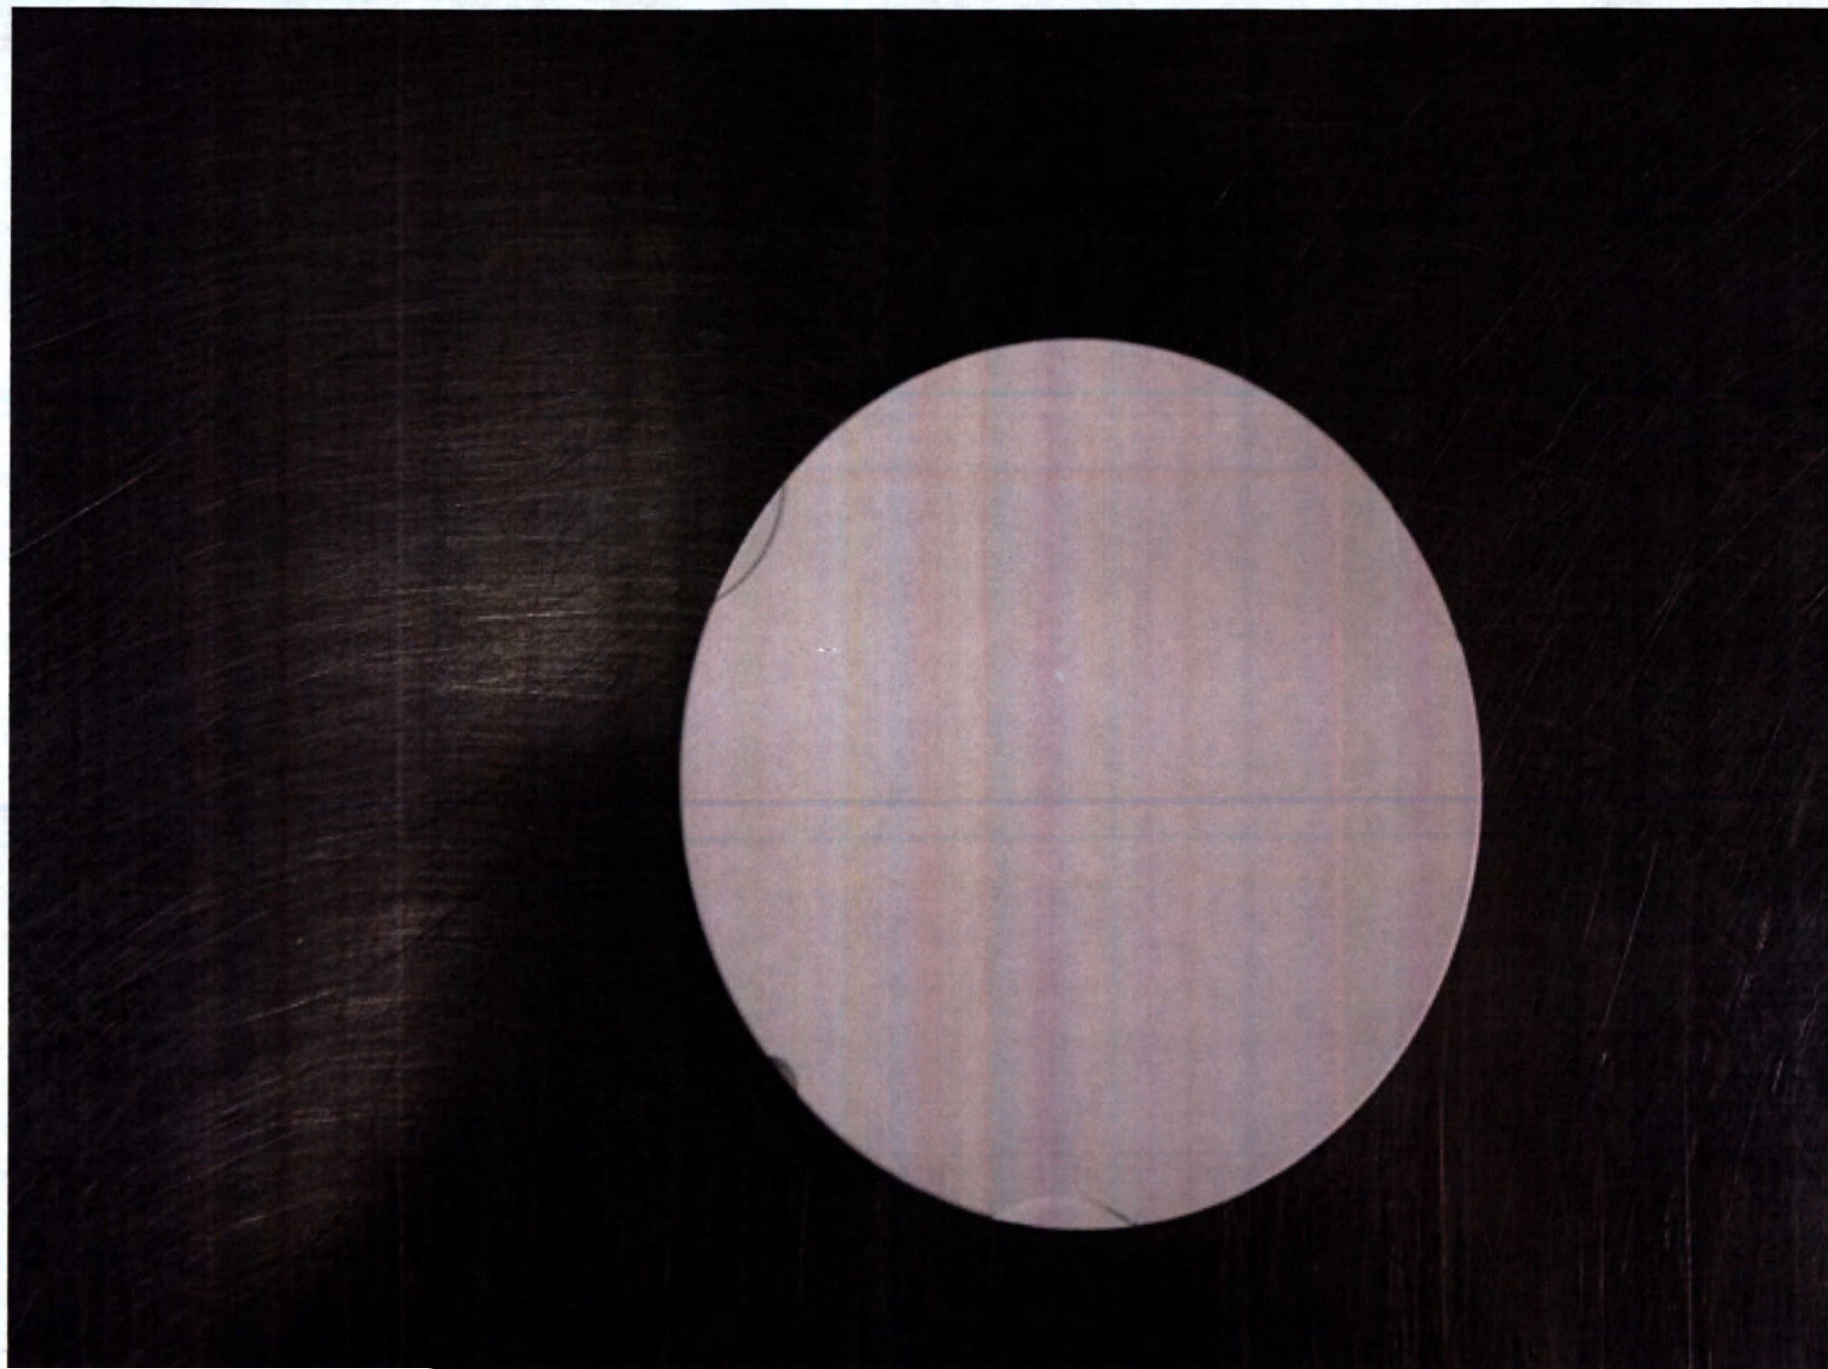

8.2 Pearl disk 95mmØ x 10mm. Упаковка.

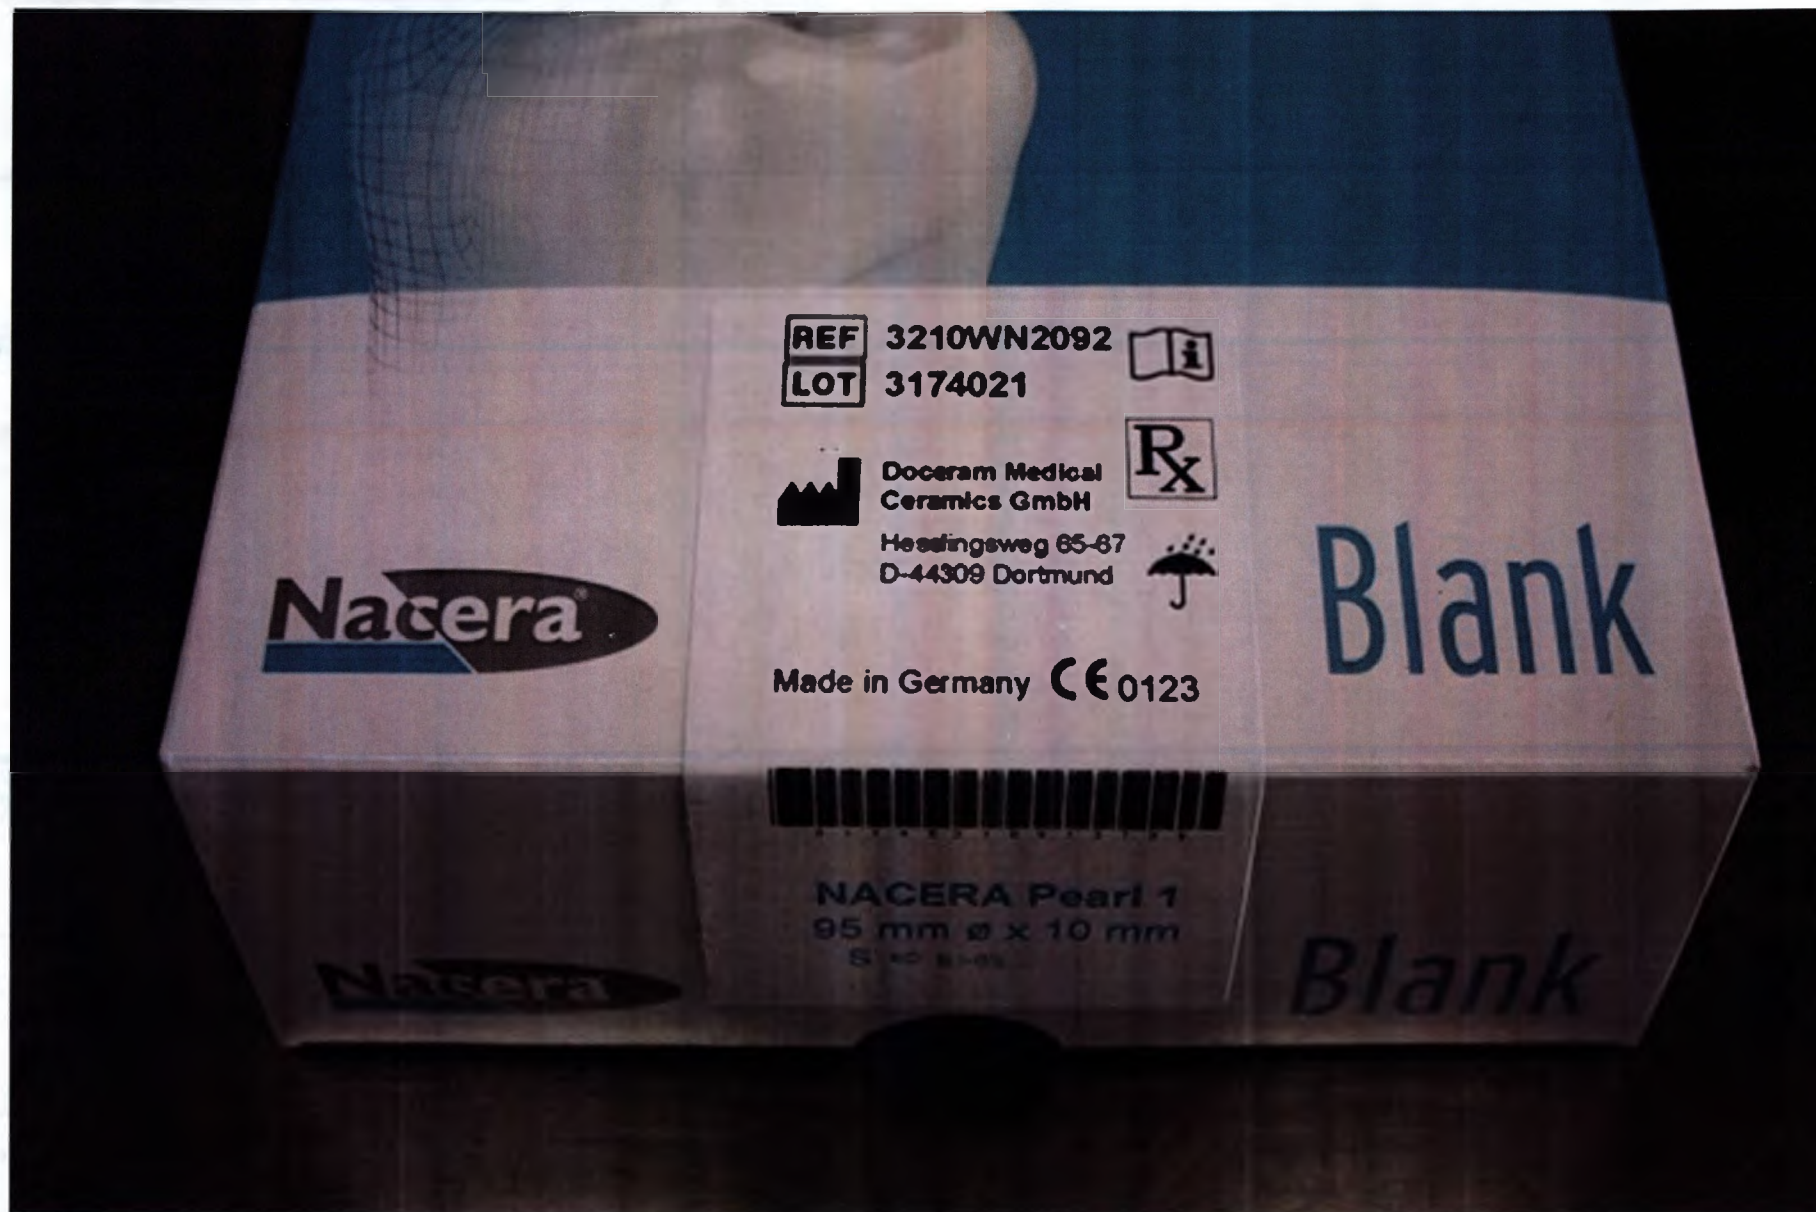

### 8.3 Pearl disk 95ммØ x 10мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ  
ООО «ТС Дентал»  
123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2  
+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 95 ммØ x 10мм

Серийный номер: 3210-WN-2092

LOT: 3174021

Дата производства: 18.02.2015

Срок годности: 18.02.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

9.1 Pearl disk 95ммØ x 12мм. Изделие.

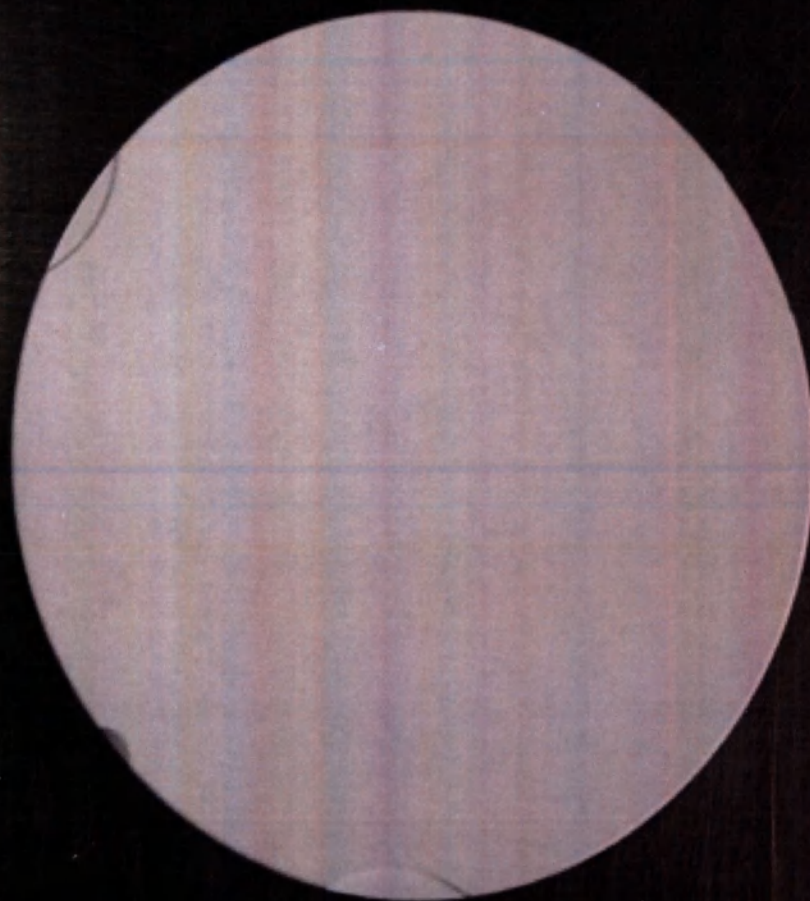

9.2 Pearl disk 95mmØ x 12mm. Упаковка.



### 9.3 Pearl disk 95ммØ x 12мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 95ммØ x 12мм

Серийный номер: 3210-WN-2093

LOT: 3174039

Дата производства: 19.02.2015

Срок годности: 12.02.2022

Фактор усадки: S > 6 %




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

10.1 Pearl disk 95ммØ x 14мм. Изделие.

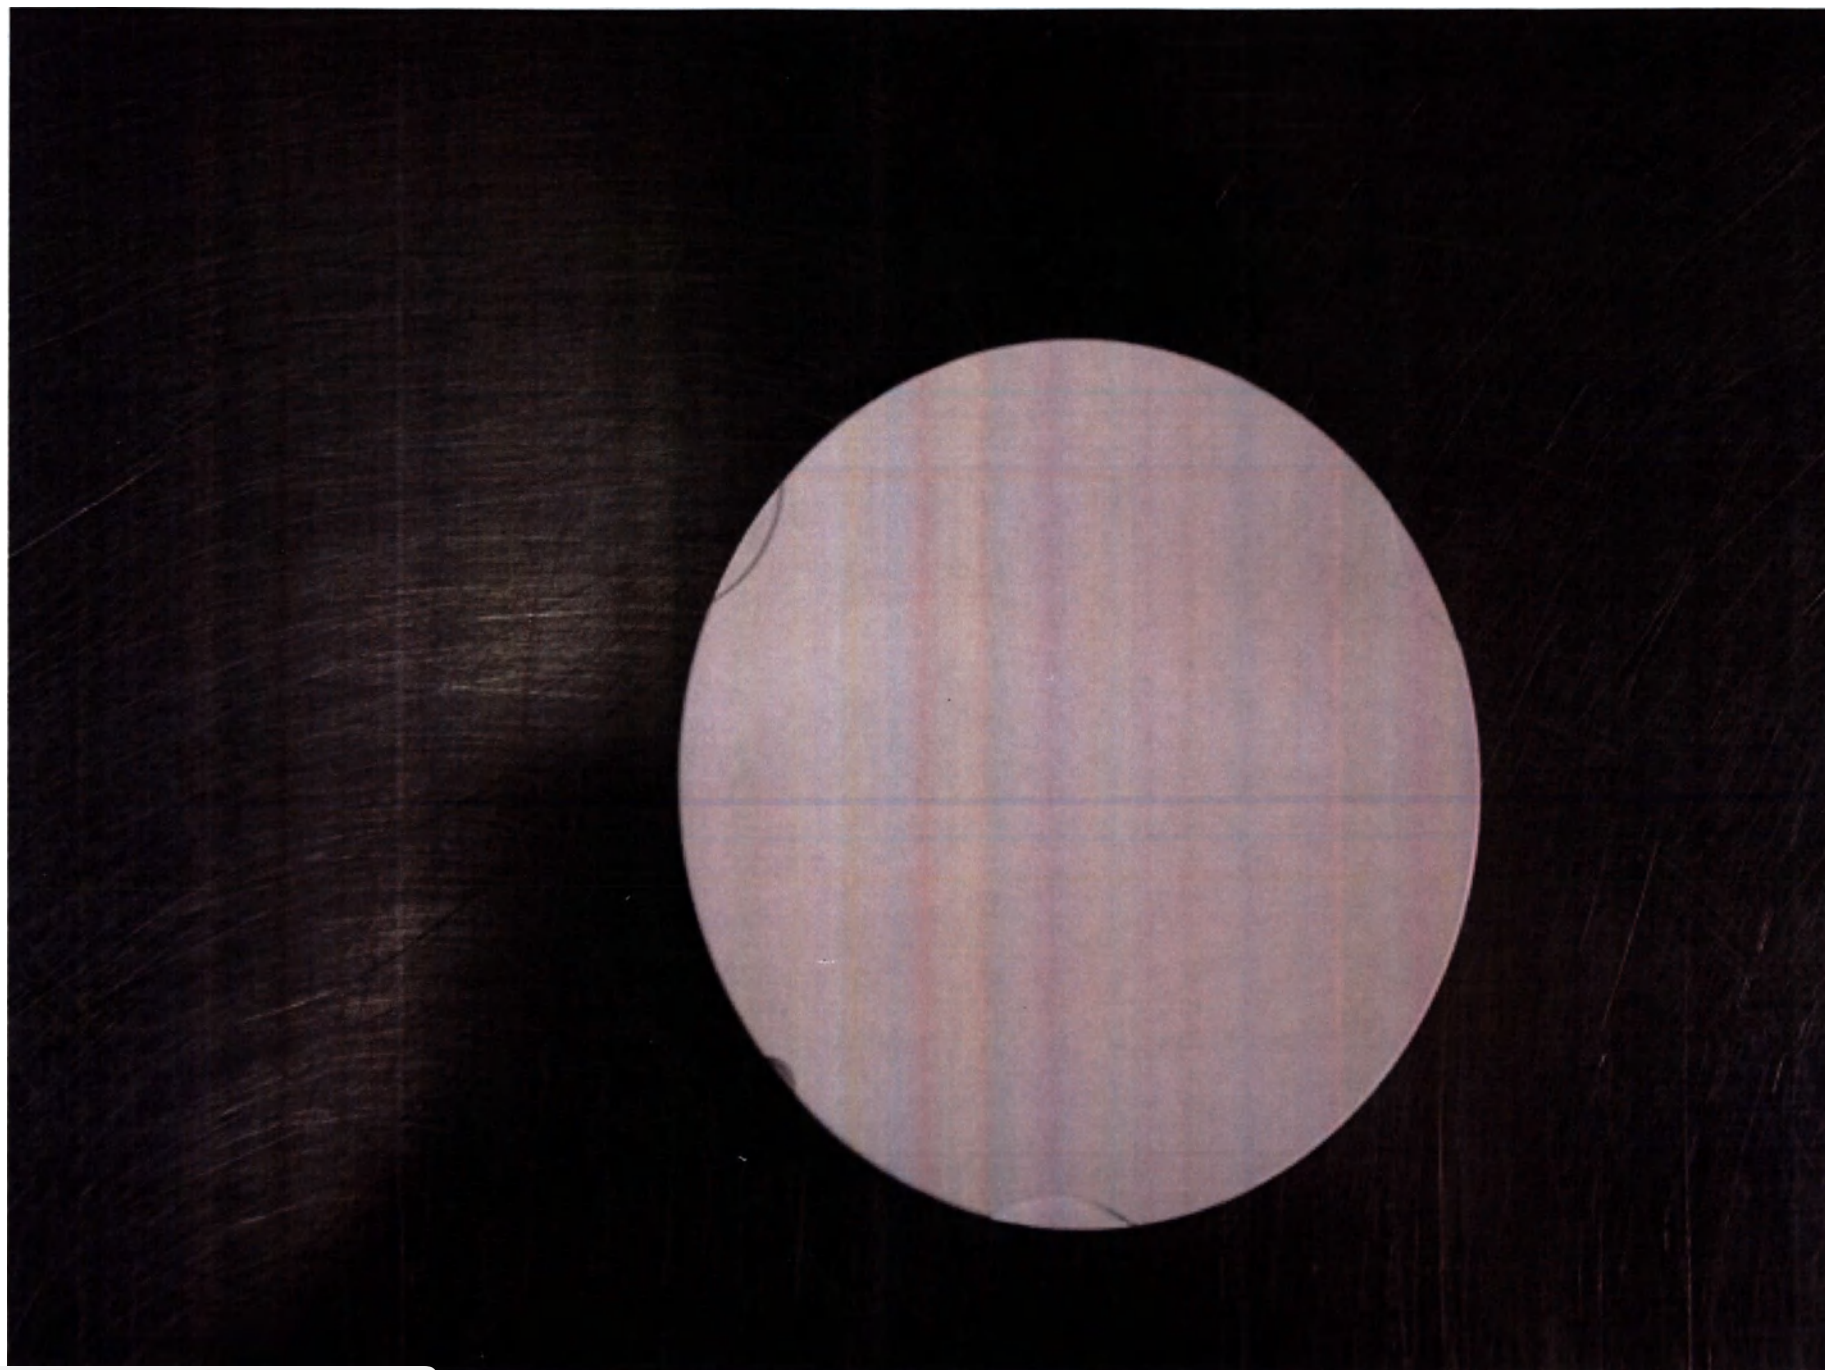

10.2 Pearl disk 95mmØ x 14mm. Упаковка.



### 10.3 Pearl disk 95ммØ x 14мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 95ммØ x 14мм

Серийный номер: 3210-WN-2094

LOT: 3171549

Дата производства: 24.02.2015

Срок годности: 24.02.2022

Фактор усадки: S > 6 %




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

11.1 Pearl disk 95ммØ x 16мм. Изделие.

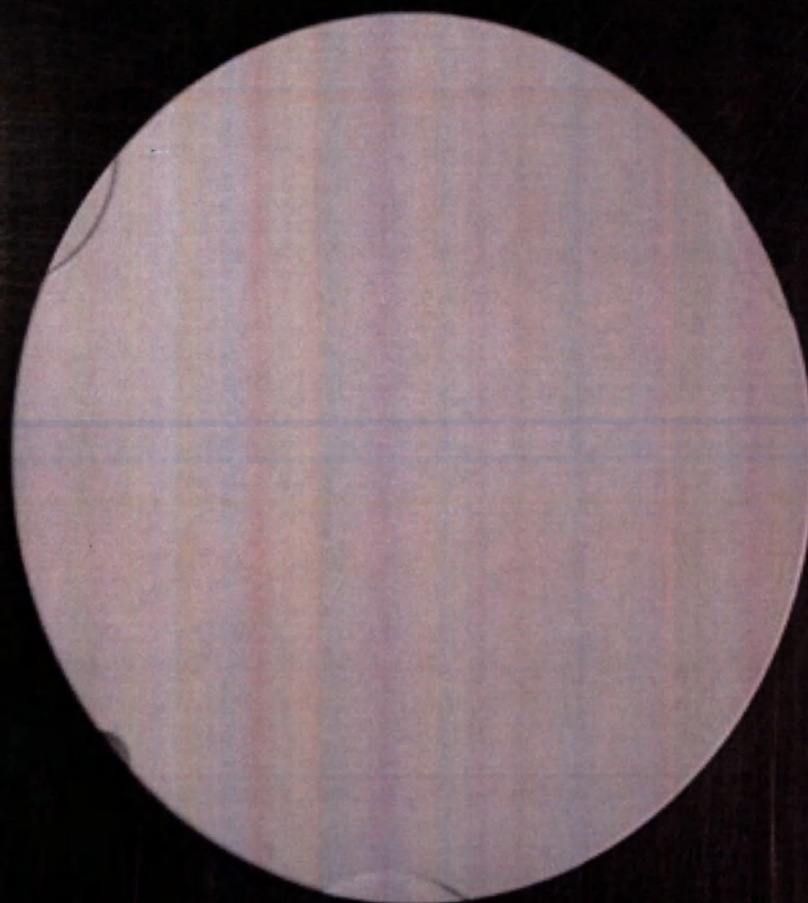

11.2 Pearl disk 95mmØ x 16mm. Упаковка.



### 11.3 Pearl disk 95ммØ x 16мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 95ммØ x 16мм

Серийный номер: 3210-WN-2913

LOT: 3174059

Дата производства: 09.12.2014

Срок годности: 09.12.2021

Фактор усадки: S > 6 %




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany


Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

12.1 Pearl disk 95ммØ x 18мм. Изделие.

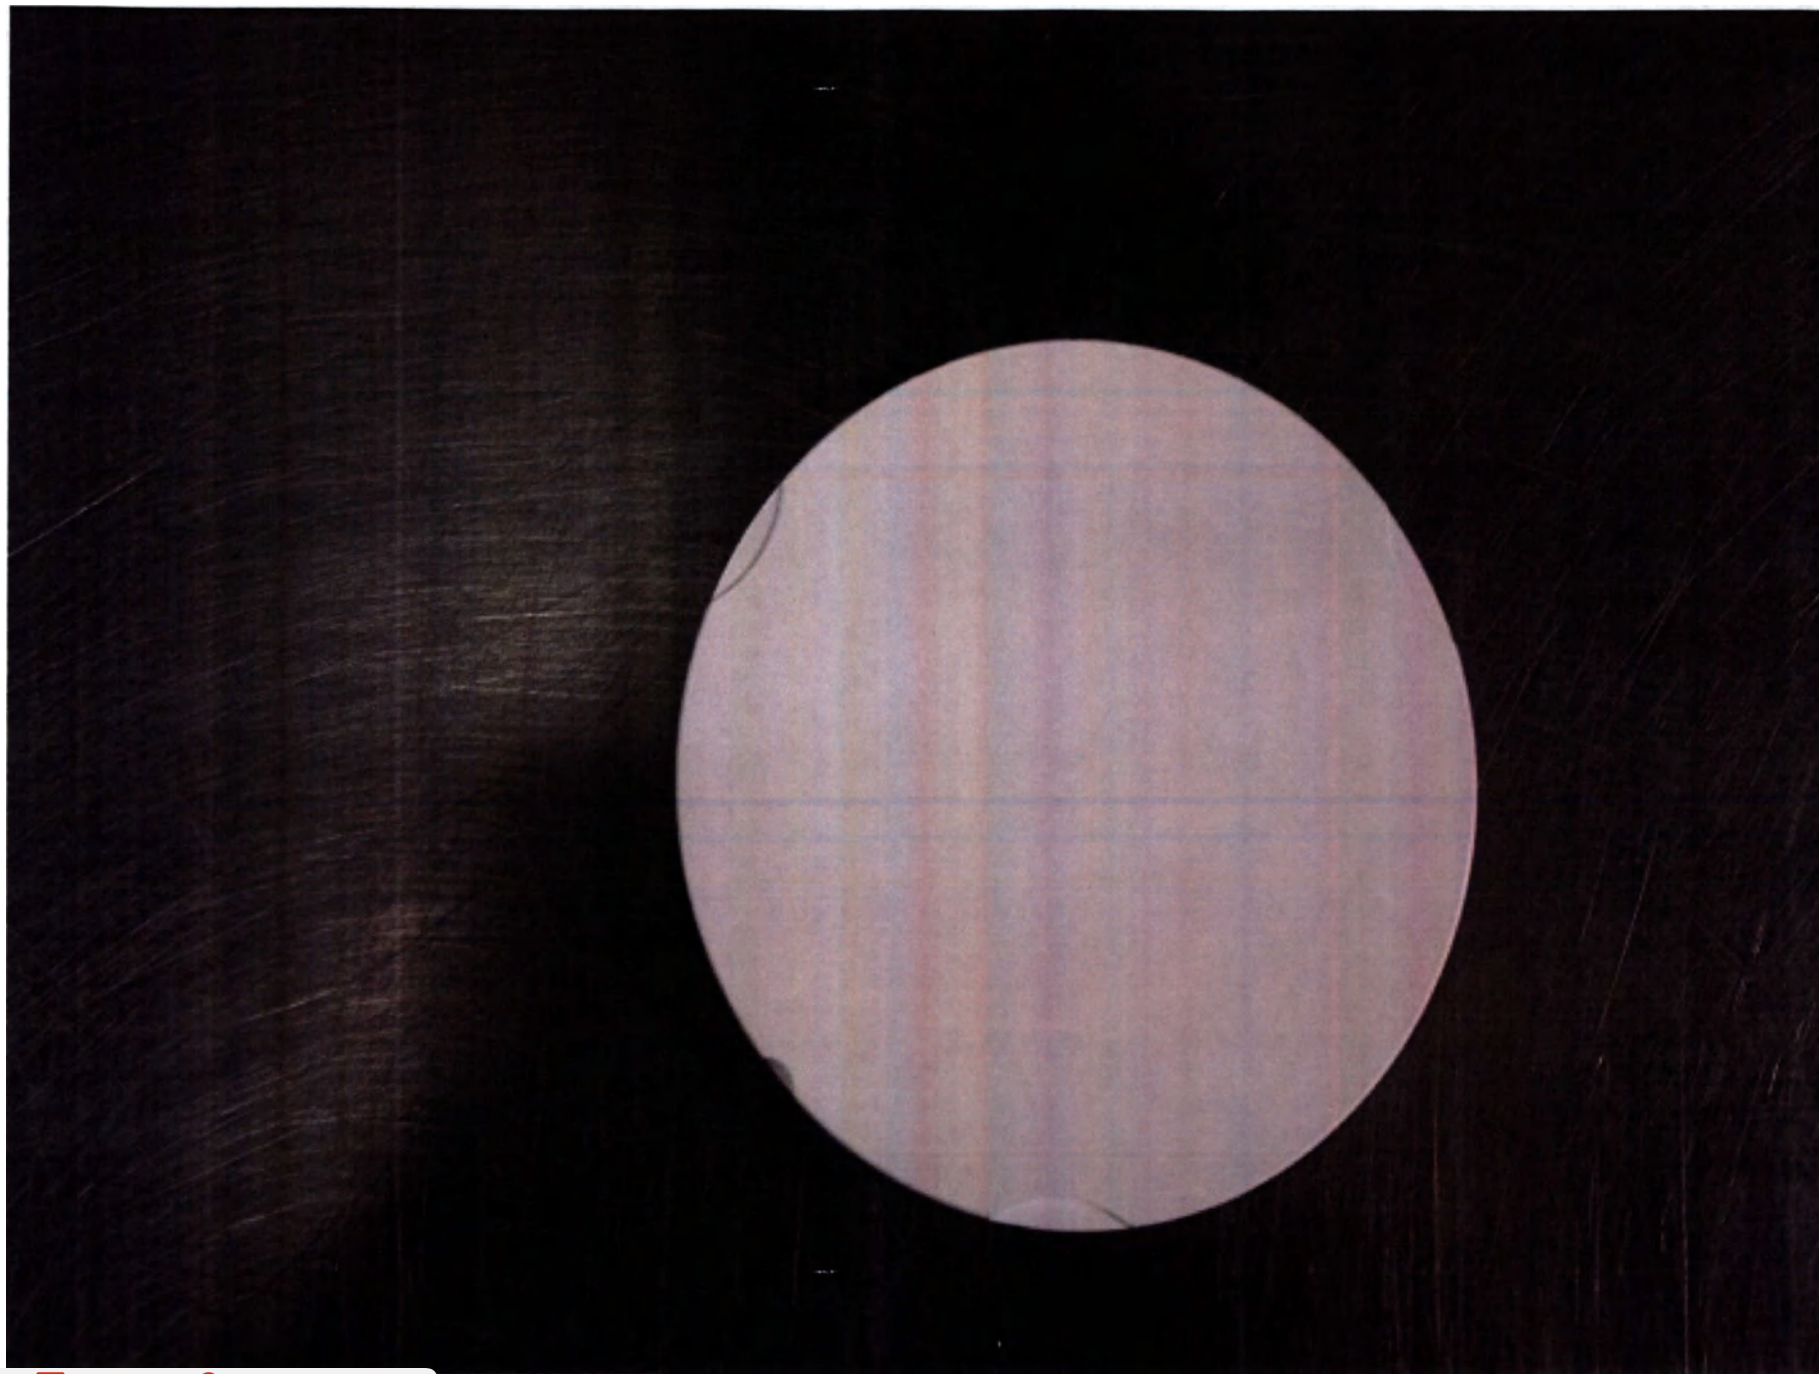

12.2 Pearl disk 95mmØ x 18mm. Упаковка.

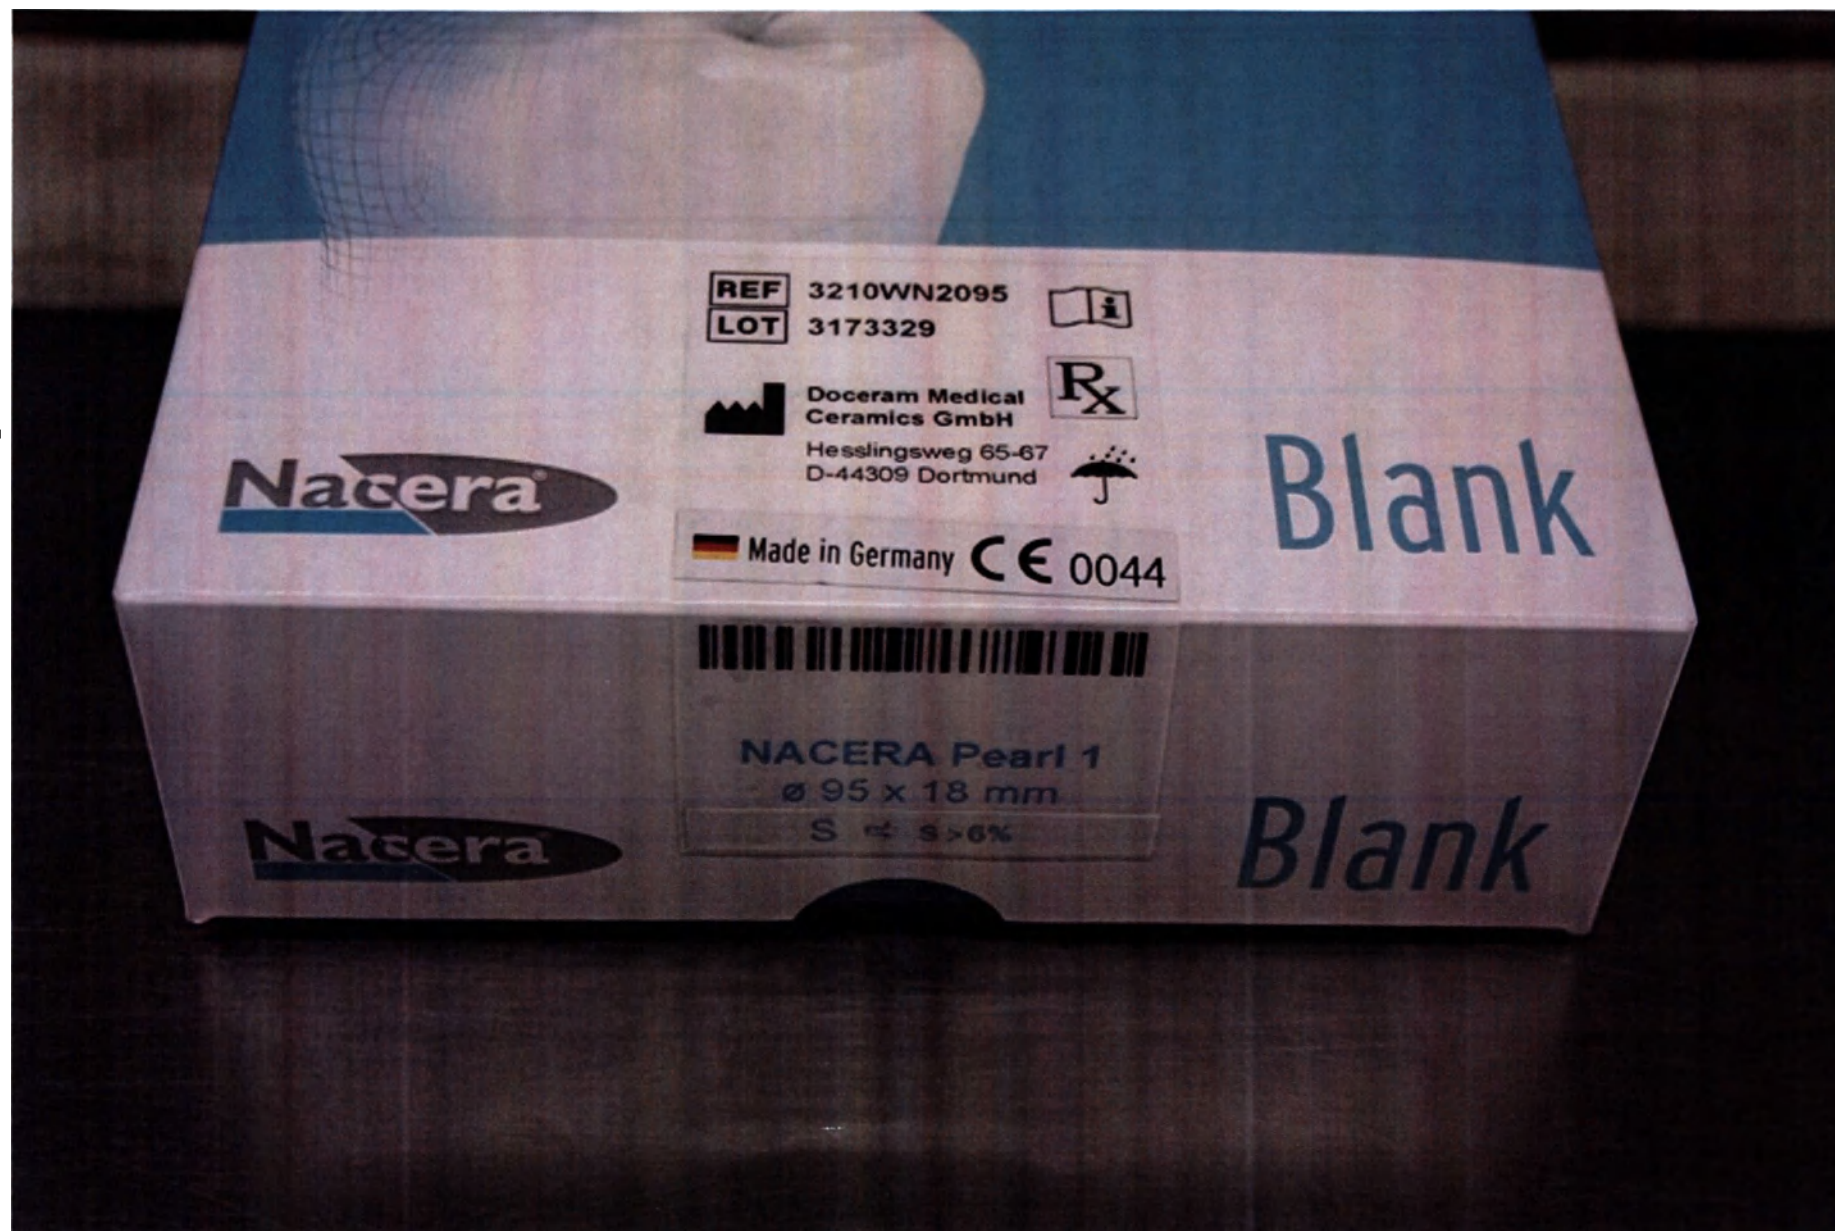

### 12.3 Pearl disk 95ммØ x 18мм. Маркировка изделия для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 95ммØ x 18мм

Серийный номер: 3210-WN-2095

LOT: 3173329

Дата производства: 24.02.2015

Срок годности: 24.02.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

13.1 Pearl disk 95ммØ x 20мм. Изделие.

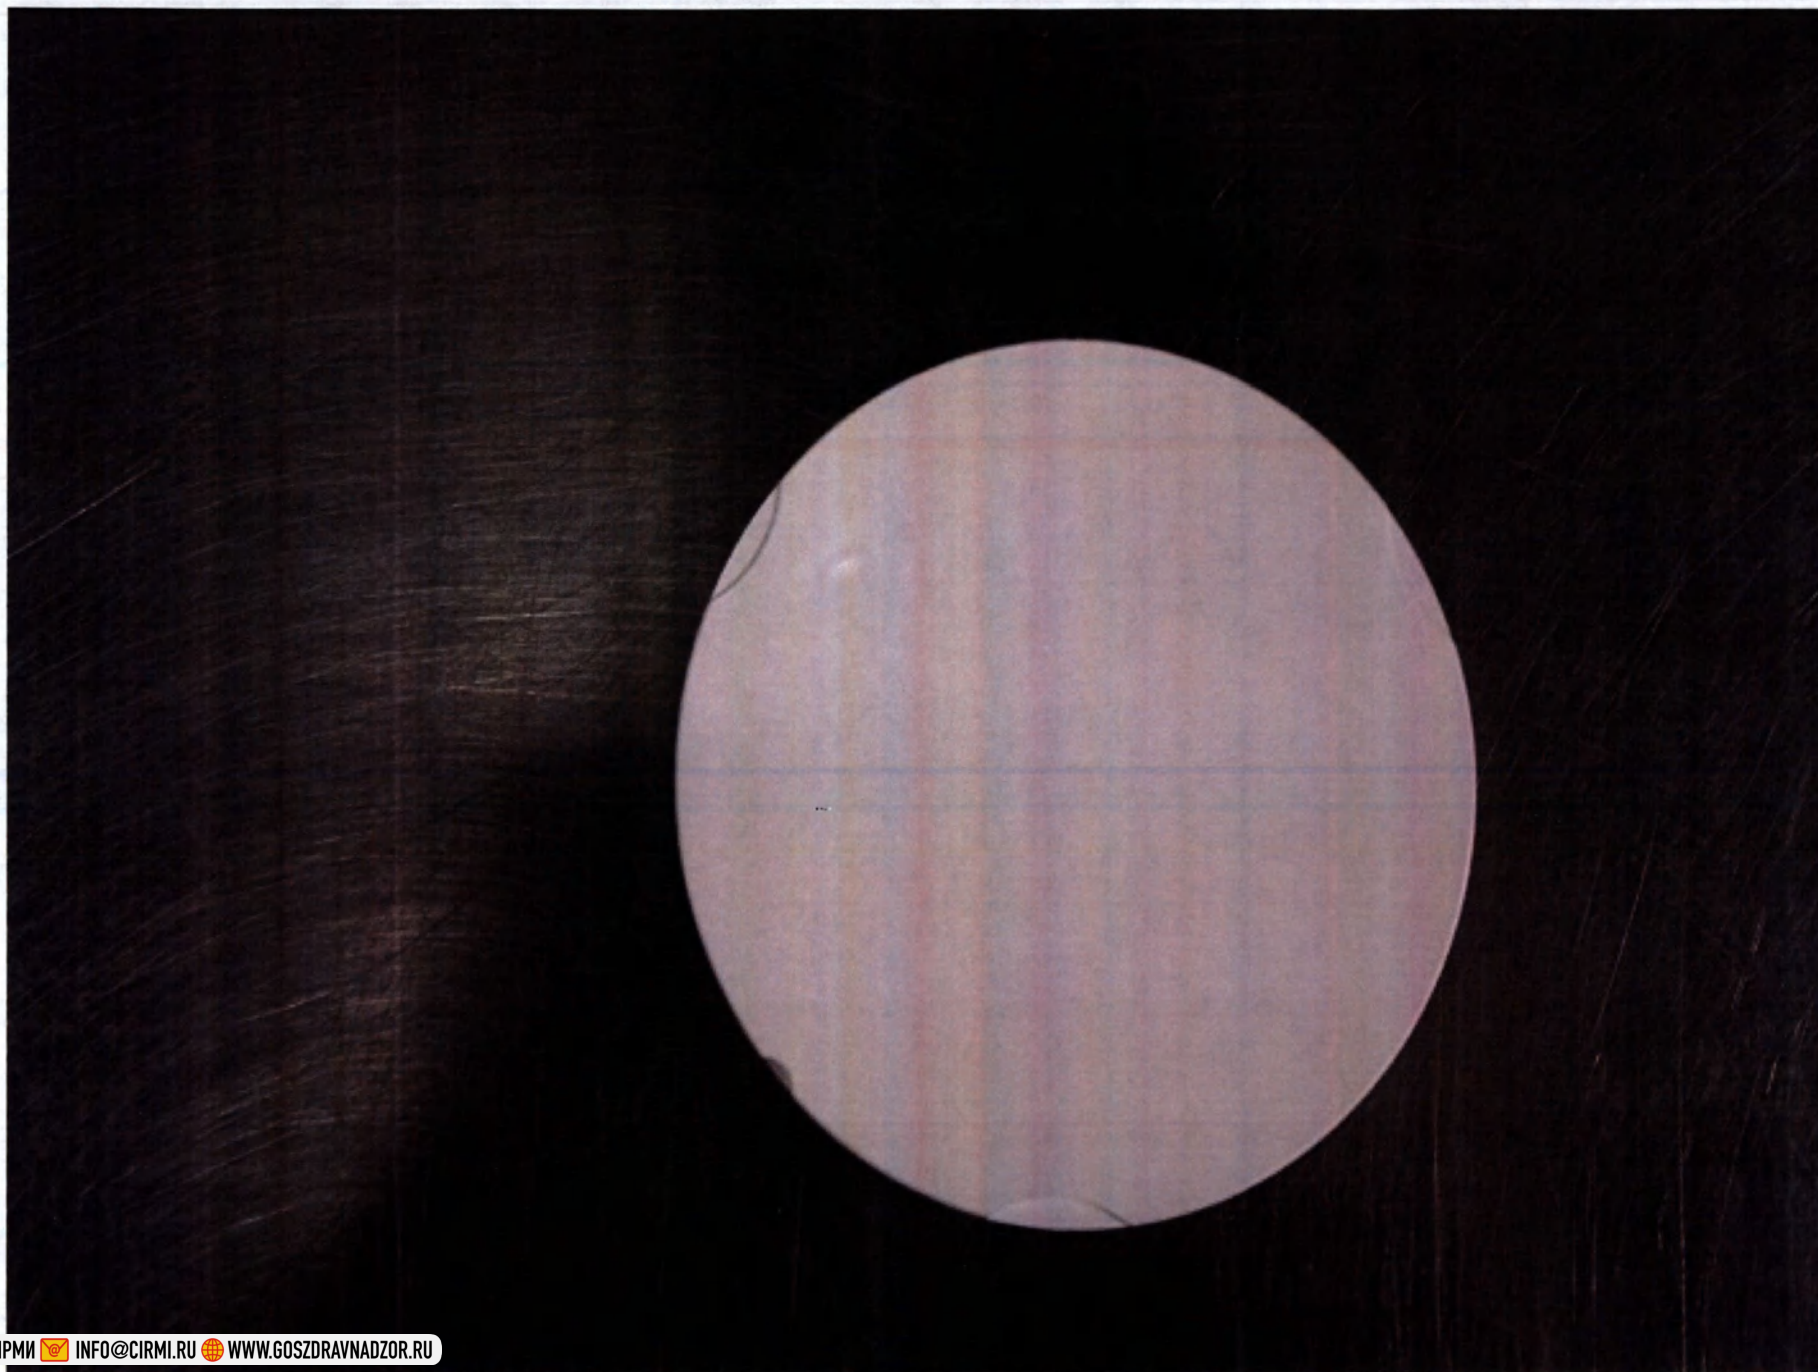

13.2 Pearl disk 95mmØ x 20mm. Упаковка.



13.3 Pearl disk 95ммØ x 20мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 95 ммØ x 20мм

Серийный номер: 3210-WN-2096

LOT: 3197699

Дата производства: 20.01.2015

Срок годности: 20.01.2022

Фактор усадки: S > 6 %




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

14.1 Pearl disk 95ммØ x 25мм. Изделие.

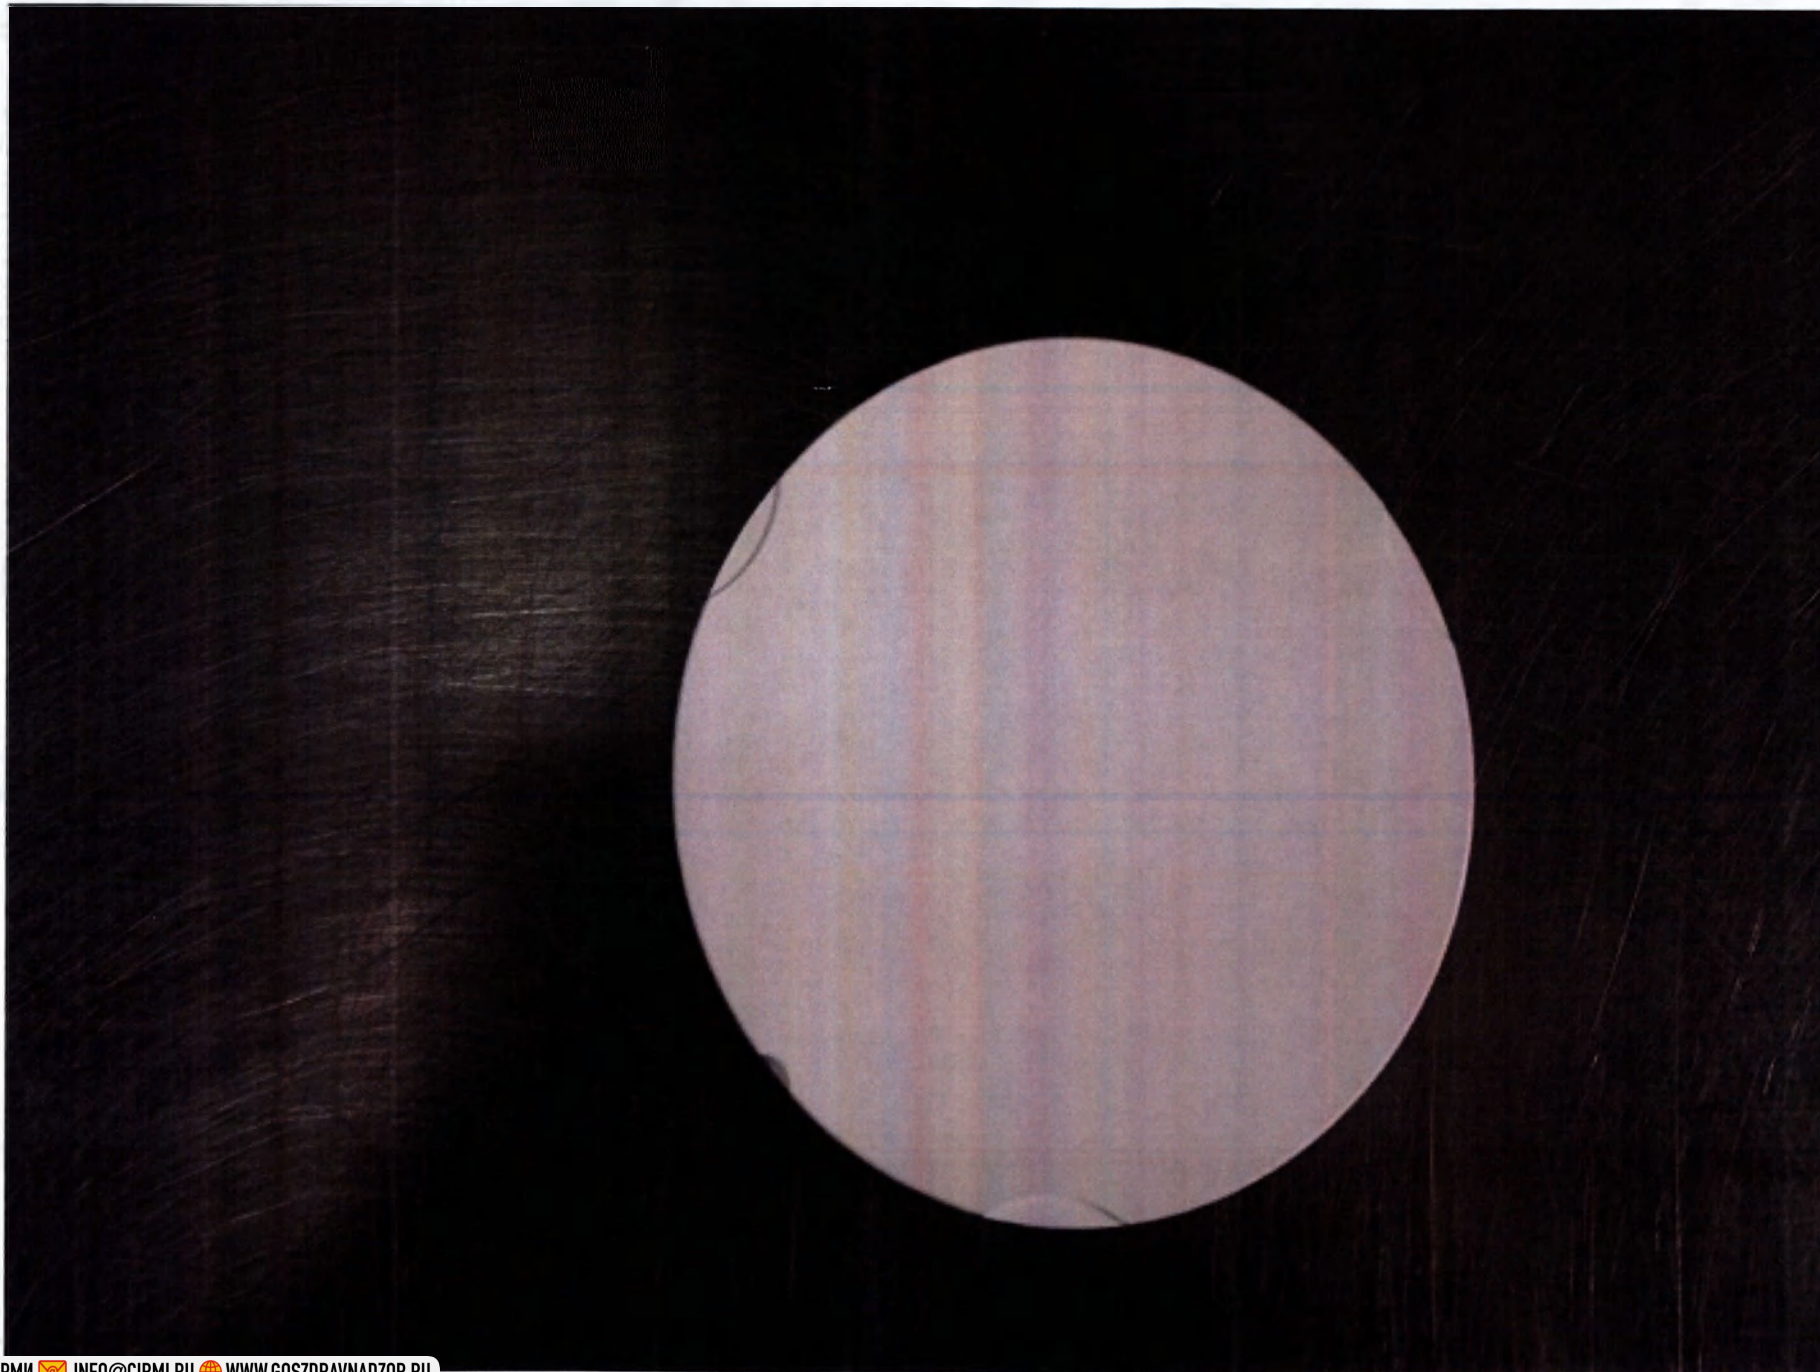

14.2 Pearl disk 95mmØ x 25mm. Упаковка.



14.3 Pearl disk 95ммØ x 25мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl disks 95ммØ x 25мм

Серийный номер: 3210-WN-2097

LOT: 3177631

Дата производства: 20.03.2015

Срок годности: 20.03.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

15.1 Pearl block 75,5мм x 40мм x 16мм. Изделие.

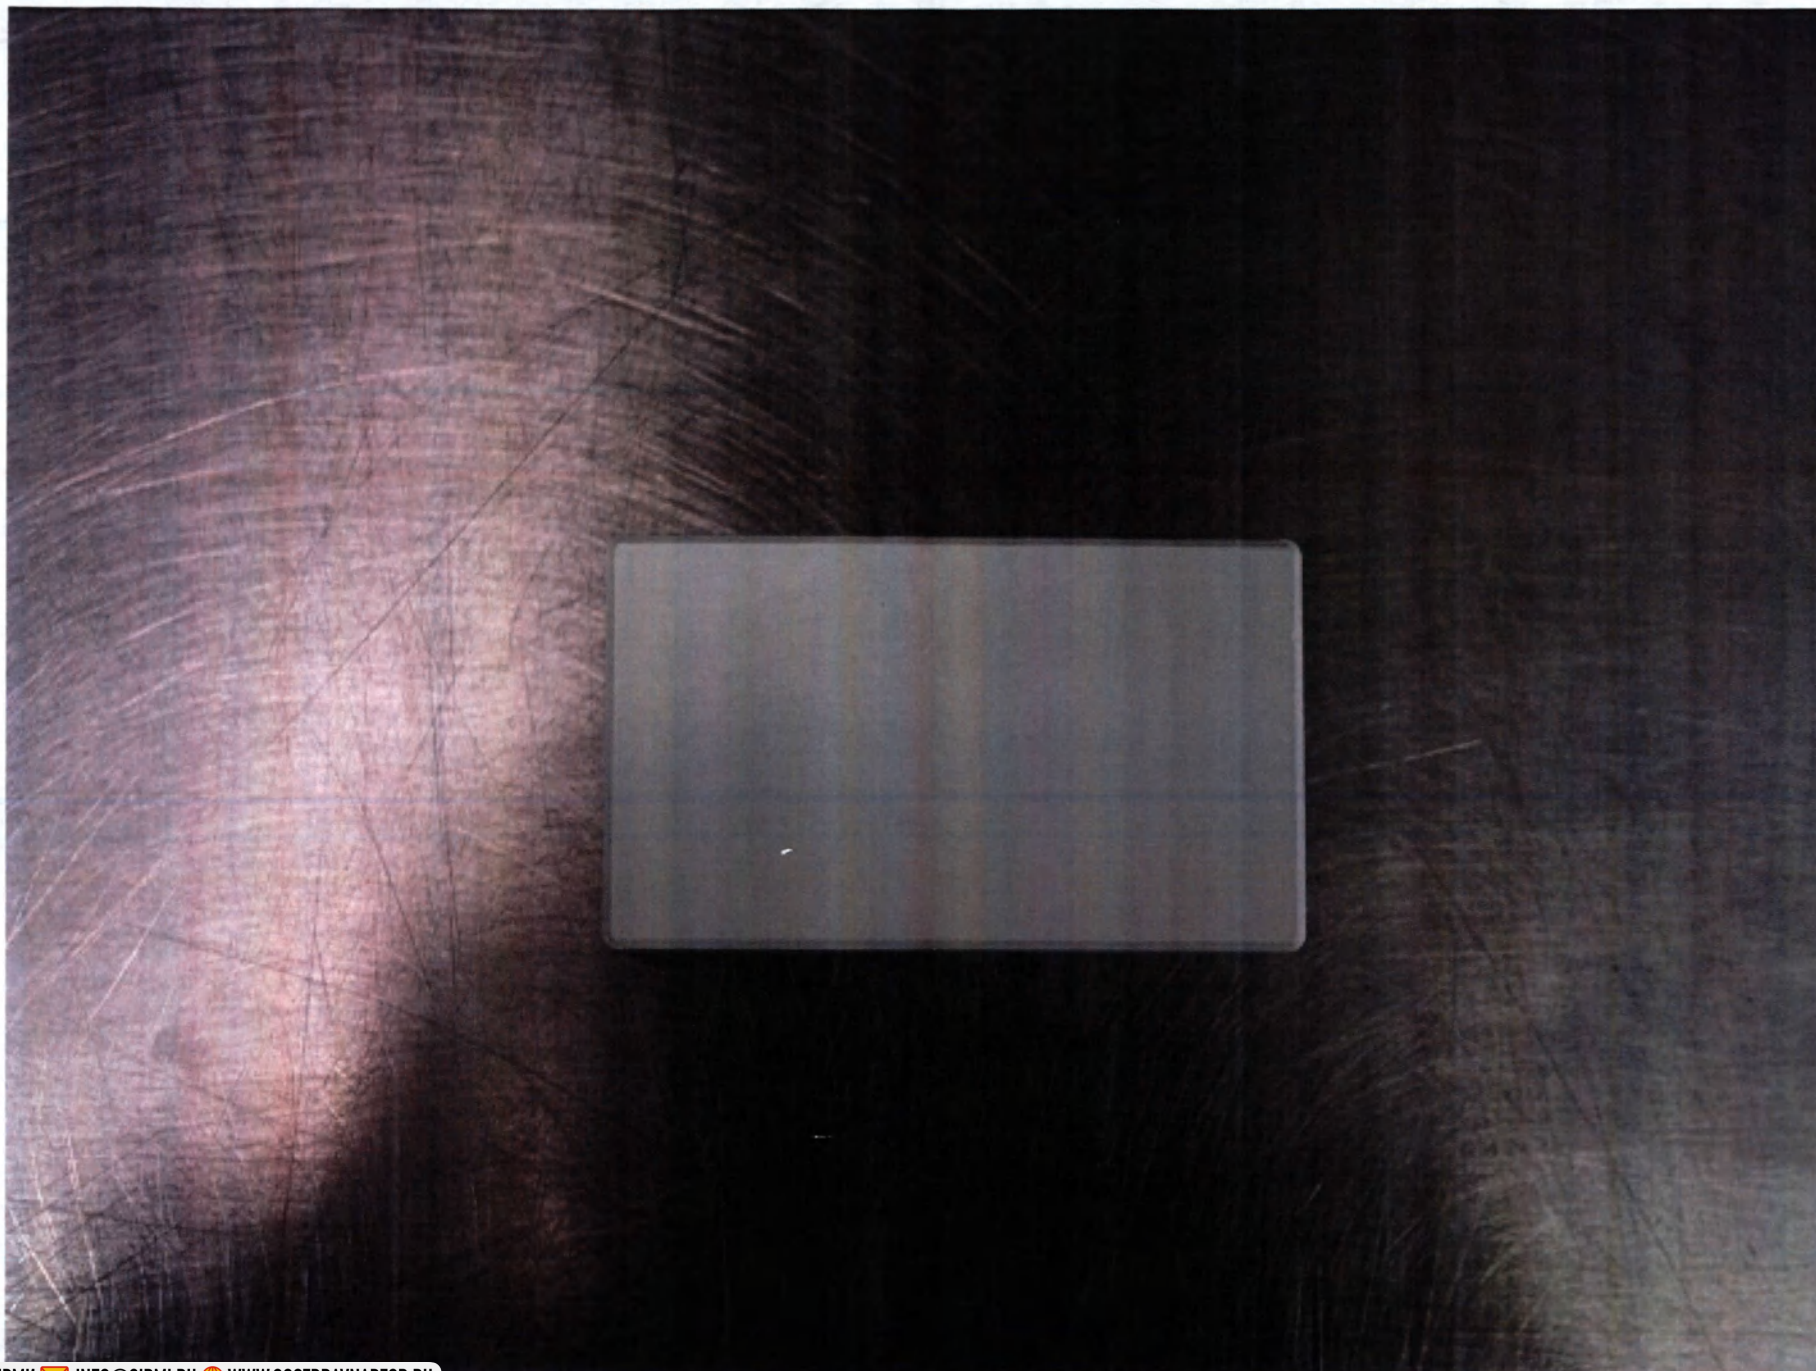

15.2 Pearl block 75,5мм x 40мм x 16мм. Упаковка.



15.3 Pearl block 75,5мм x 40мм x 16мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl block 75,5мм x 40мм x 16мм

Серийный номер: 3210-WN-8788

LOT: 3145029

Дата производства: 24.02.2015

Срок годности: 24.02.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

16.1 Pearl block 75,5мм x 40мм x 22мм. Изделие.

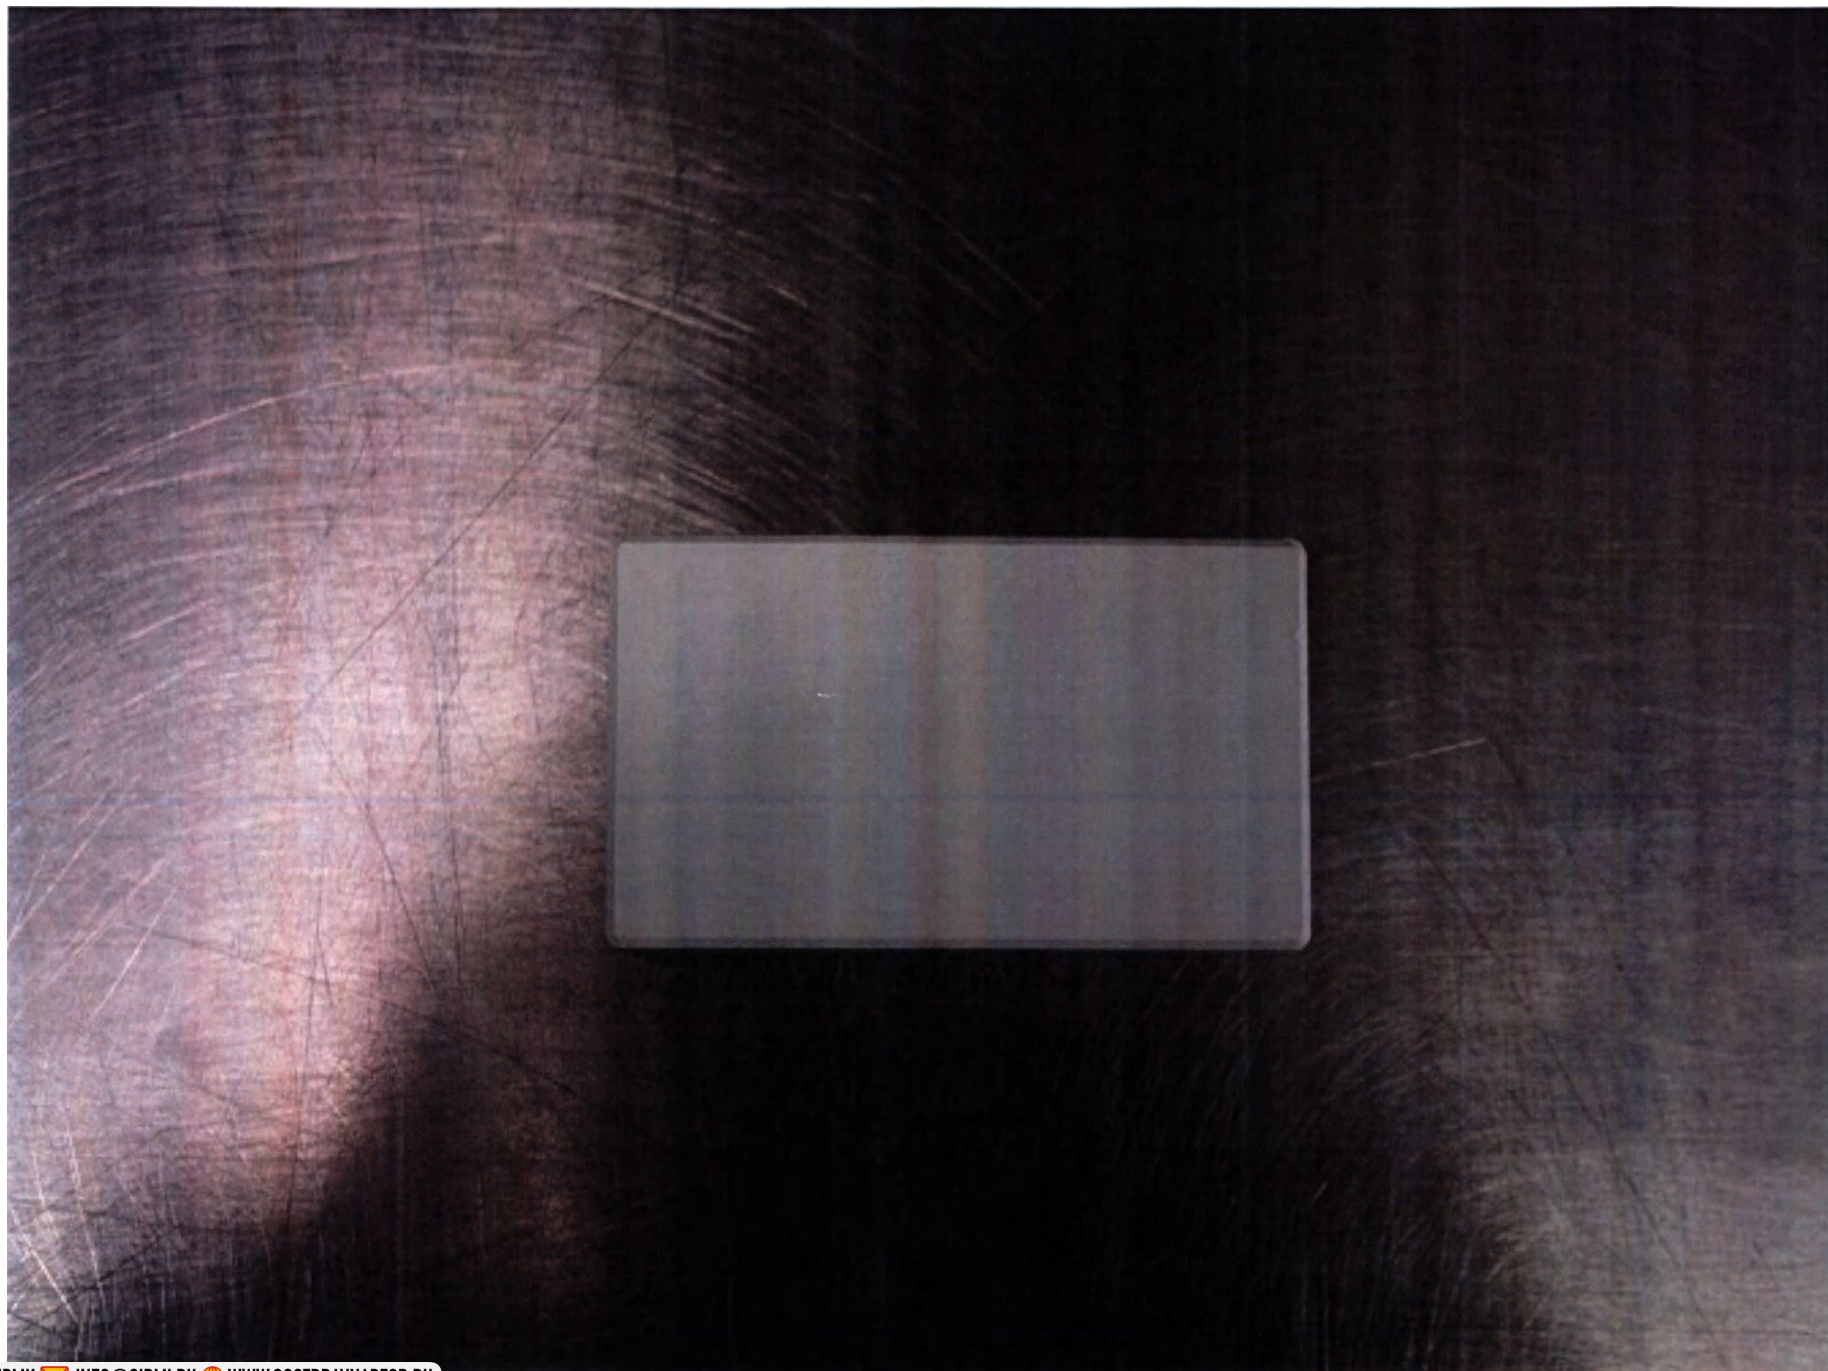

16.2 Pearl block 75,5мм x 40мм x 22мм. Упаковка.



### 16.3 Pearl block 75,5мм x 40мм x 22мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl block 75,5мм x 40мм x 22мм

Серийный номер: 3210-WN-38787

LOT: 3145379

Дата производства: 04.11.2013

Срок годности: 04.11.2020

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

17.1 Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 14мм. Изделие.

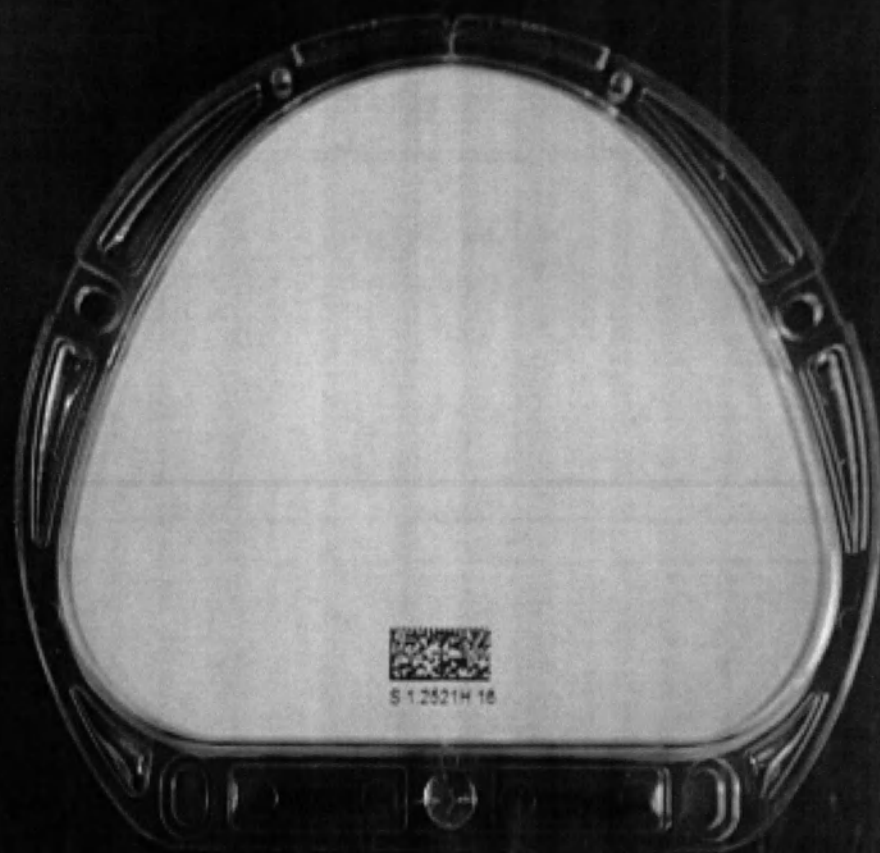

17.2 Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 14мм. Упаковка.



17.3 Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 14мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 14мм

Серийный номер: 3210-WNB-9094

LOT: 3174139

Дата производства: 06.11.2013

Срок годности: 06.11.2020

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

18.1 Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 16мм. Изделие.

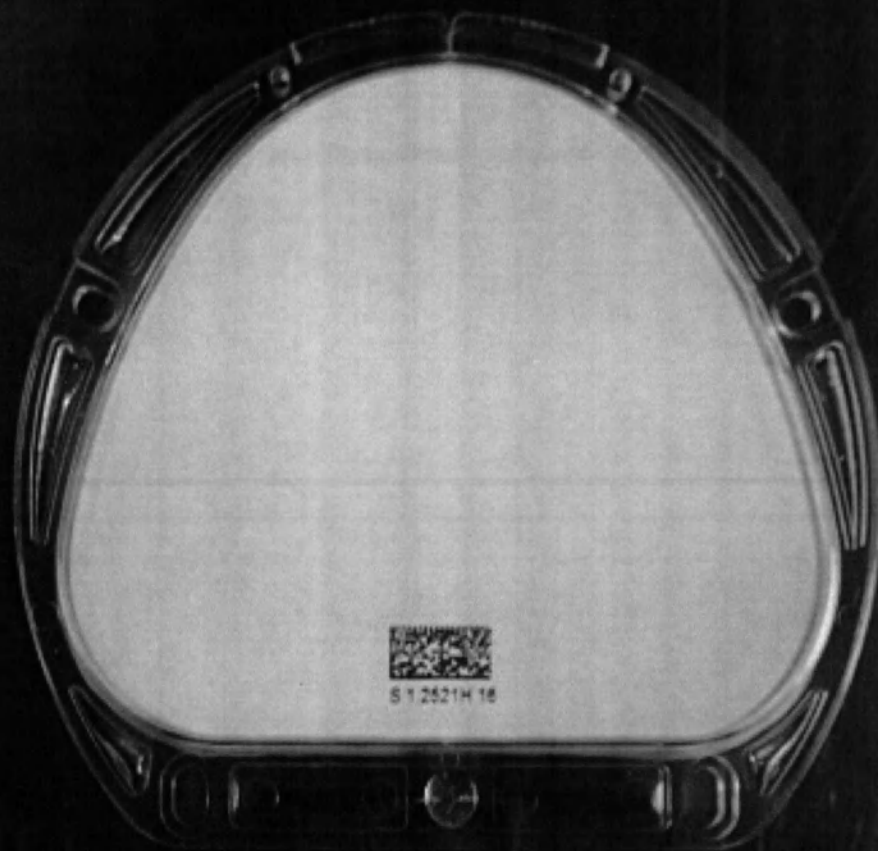

18.2 Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 16мм. Упаковка.



### 18.3 Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 16мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 16мм

Серийный номер: 3210-WNB-9913

LOT: 3174101

Дата производства: 23.02.2015

Срок годности: 23.02.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

19.1 Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 18мм. Изделие.

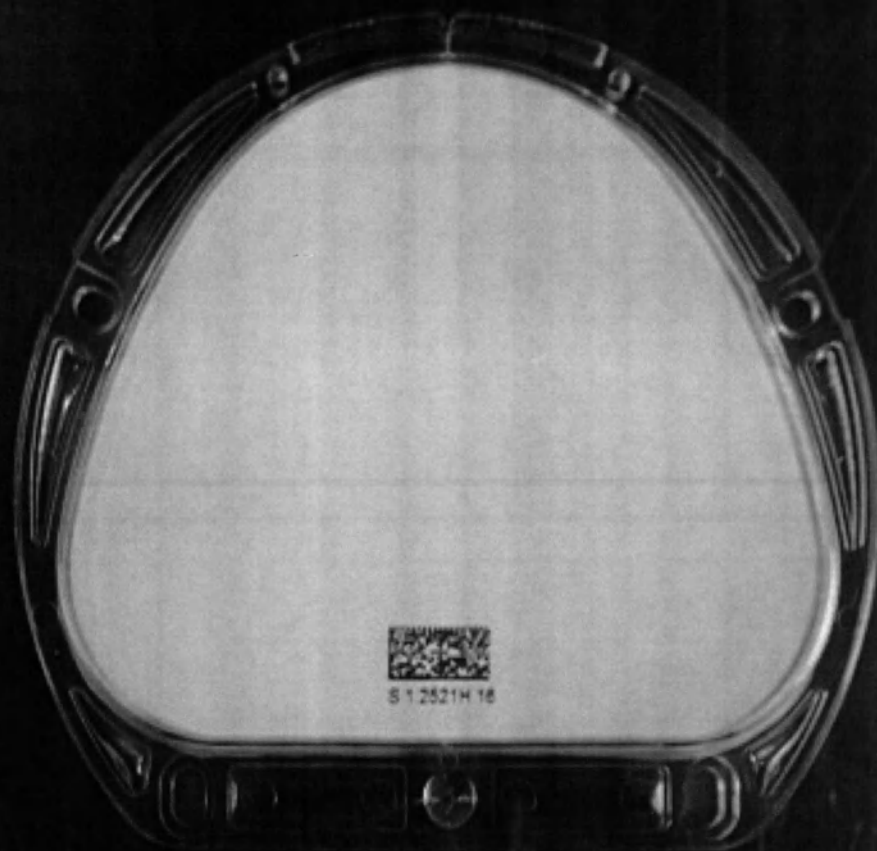

19.2 Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 18мм. Упаковка.



### 19.3 Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 18мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 18мм

Серийный номер: 3210-WNB-9095

LOT: 3176859

Дата производства: 23.02.2015

Срок годности: 23.02.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № P3H .....

20.1 Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 20мм. Изделие.

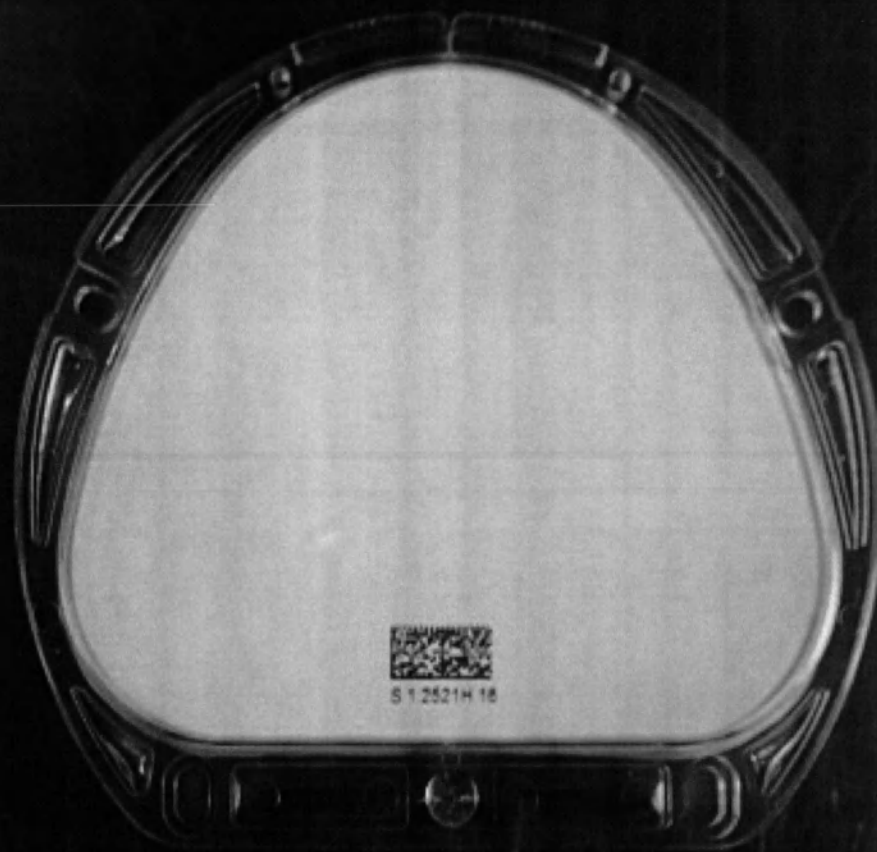

20.2 Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 20мм. Упаковка.



20.3 Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 20мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl D-shape 90мм x 72,5мм x 20мм

Серийный номер: 3210-WN-9096

LOT: 3166988

Дата производства: 24.03.2015

Срок годности: 24.03.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....


21.1 Pearl D-shape 90mm x 72,5мм x 25мм. Изделие.

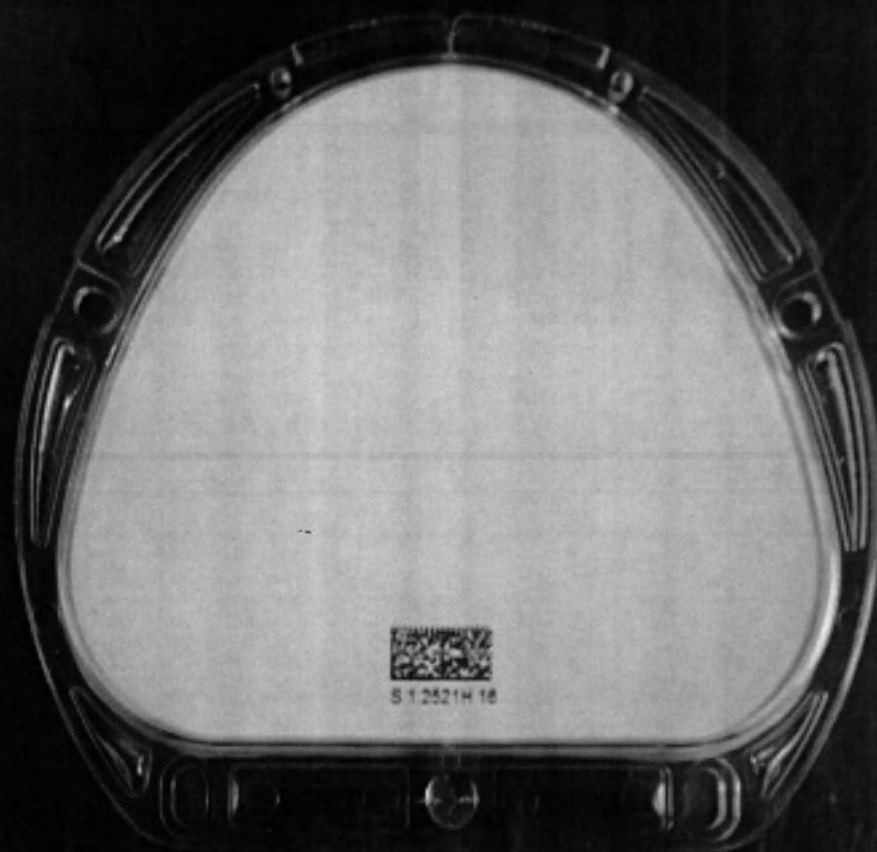

21.2 Pearl D-shape 90mm x 72,5mm x 25mm. Упаковка.



21.3 Pearl D-shape 90mm x 72,5мм x 25мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Pearl D-shape 90mm x 72,5мм x 25мм

Серийный номер: 3210-WNB-9097

LOT: 3176839

Дата производства: 23.10.2014

Срок годности: 23.10.2021

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

22.1 Shell disk 98,3ммØ x 10мм. Изделие.

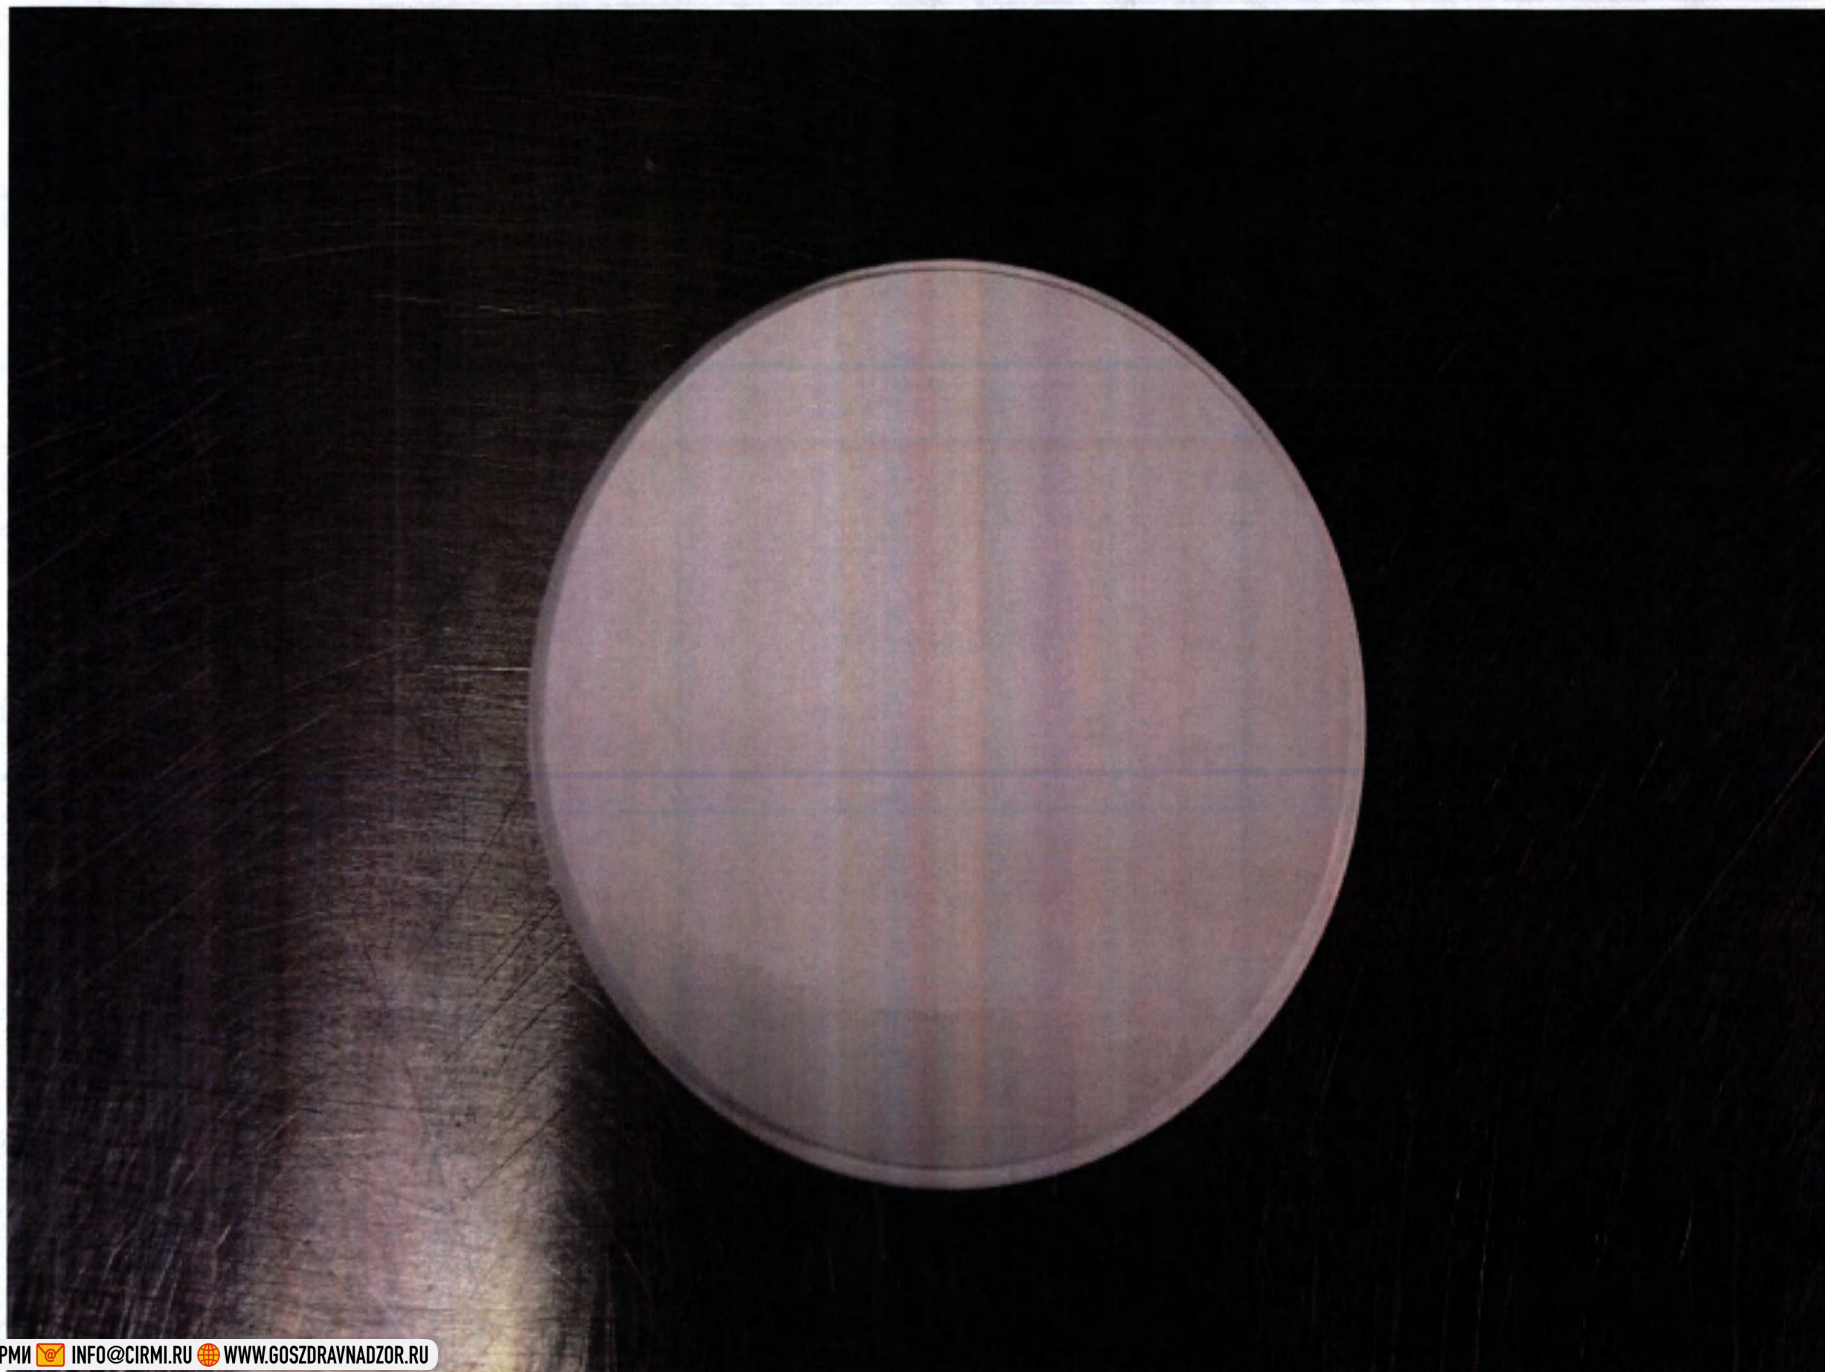

22.2 Shell disk 98,3ммØ x 10мм. Упаковка.



## 22.3 Shell disk 98,3ммØ x 10мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell disk 98,3ммØ x 10мм

Серийный номер: 3110-WN-3092

LOT: 3181483

Дата производства: 31.03.2015

Срок годности: 31.03.2022

Фактор усадки: S > 6 %




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

23.1 Shell disk 98,3ммØ x 12мм. Изделие.

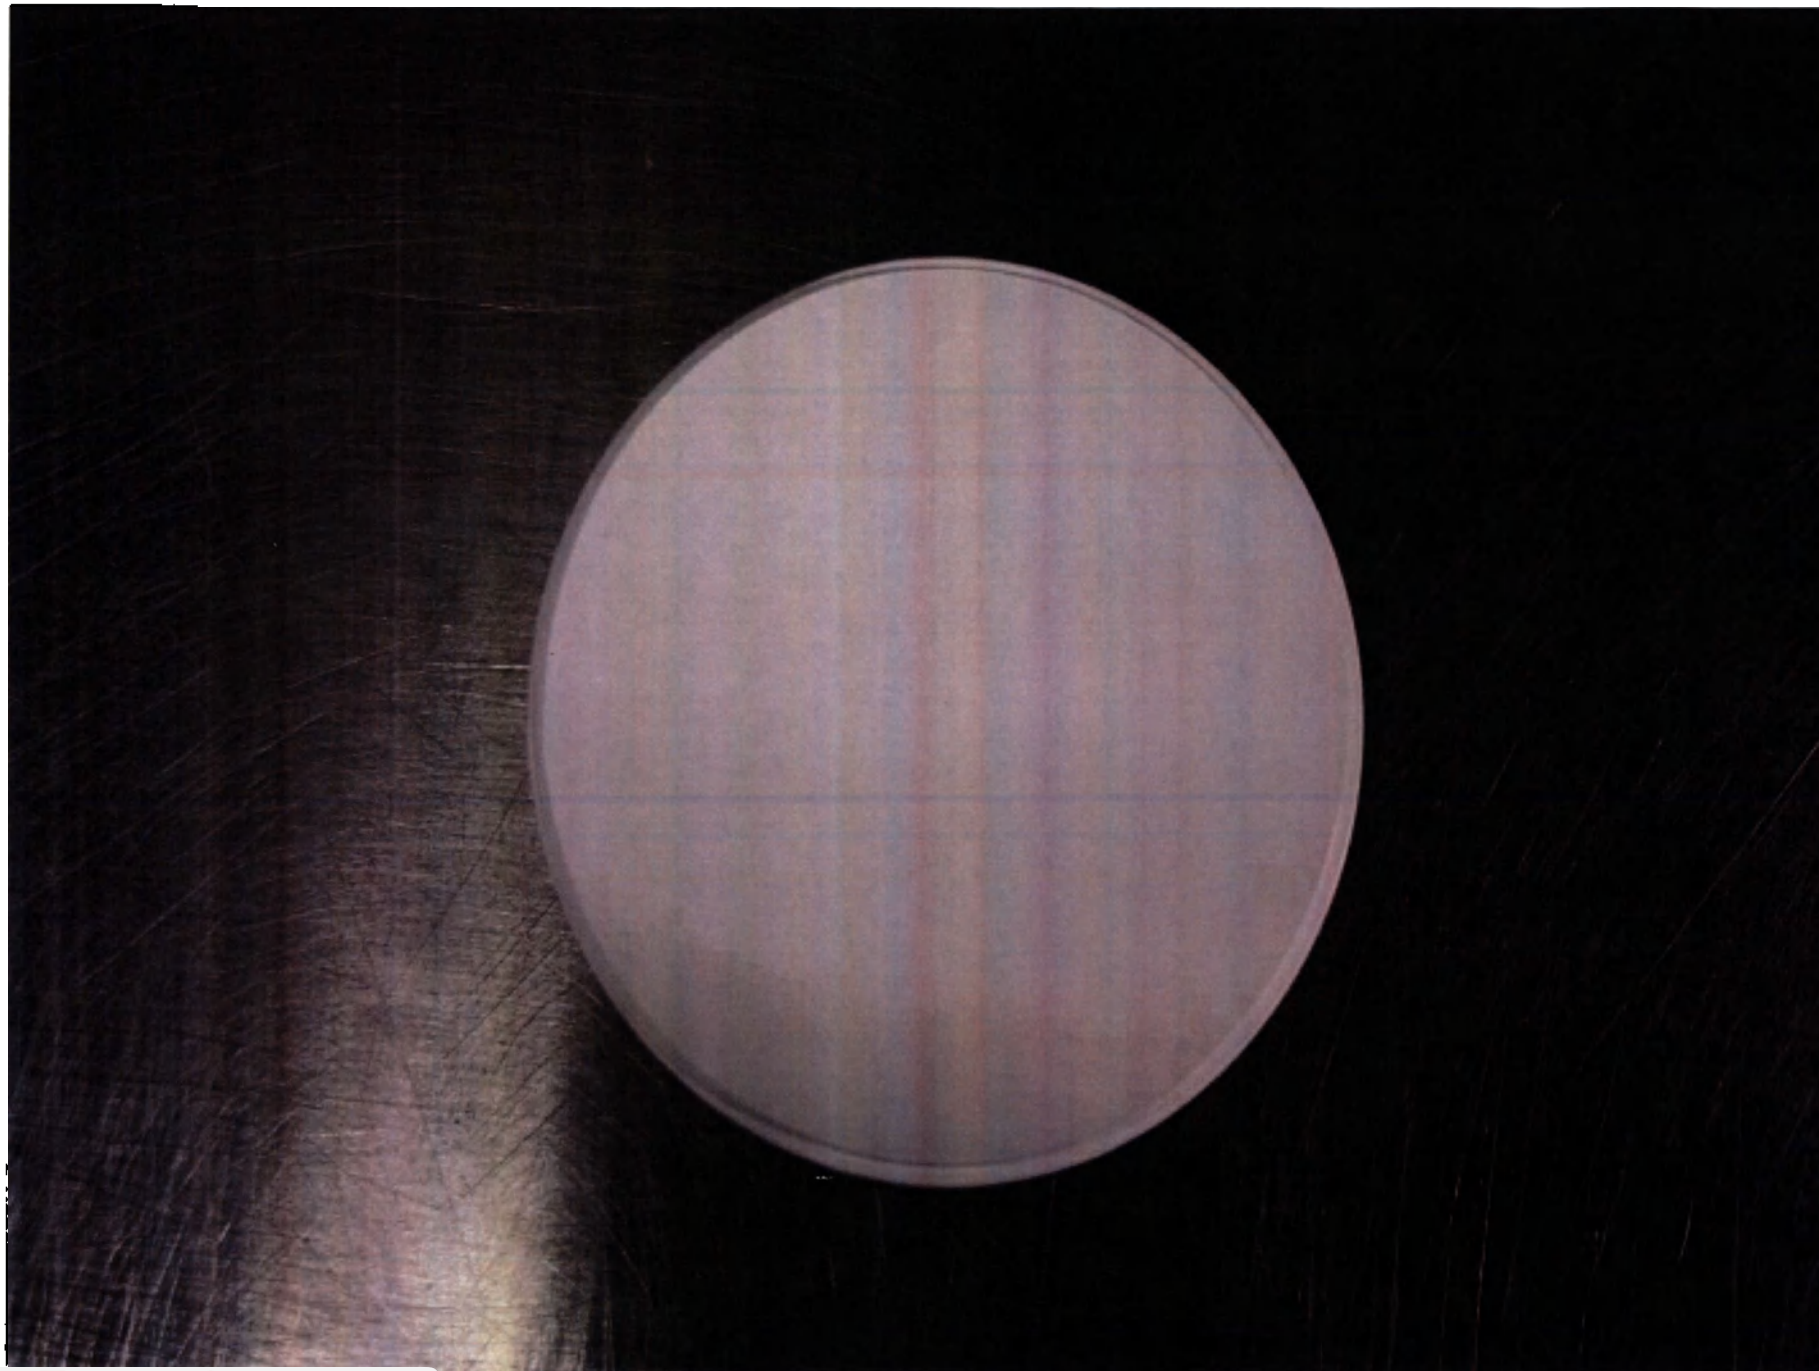

23.2 Shell disk 98,3ммØ x 12мм. Упаковка.



23.3 Shell disk 98,3ммØ x 12мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell disk 98,3ммØ x 12мм

Серийный номер: 3110-WN-3093

LOT: 3195344

Дата производства: 25.03.2015

Срок годности: 25.03.2022

Фактор усадки: S > 6 %




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

24.1 Shell disk 98,3ммØ x 14мм. Изделие.

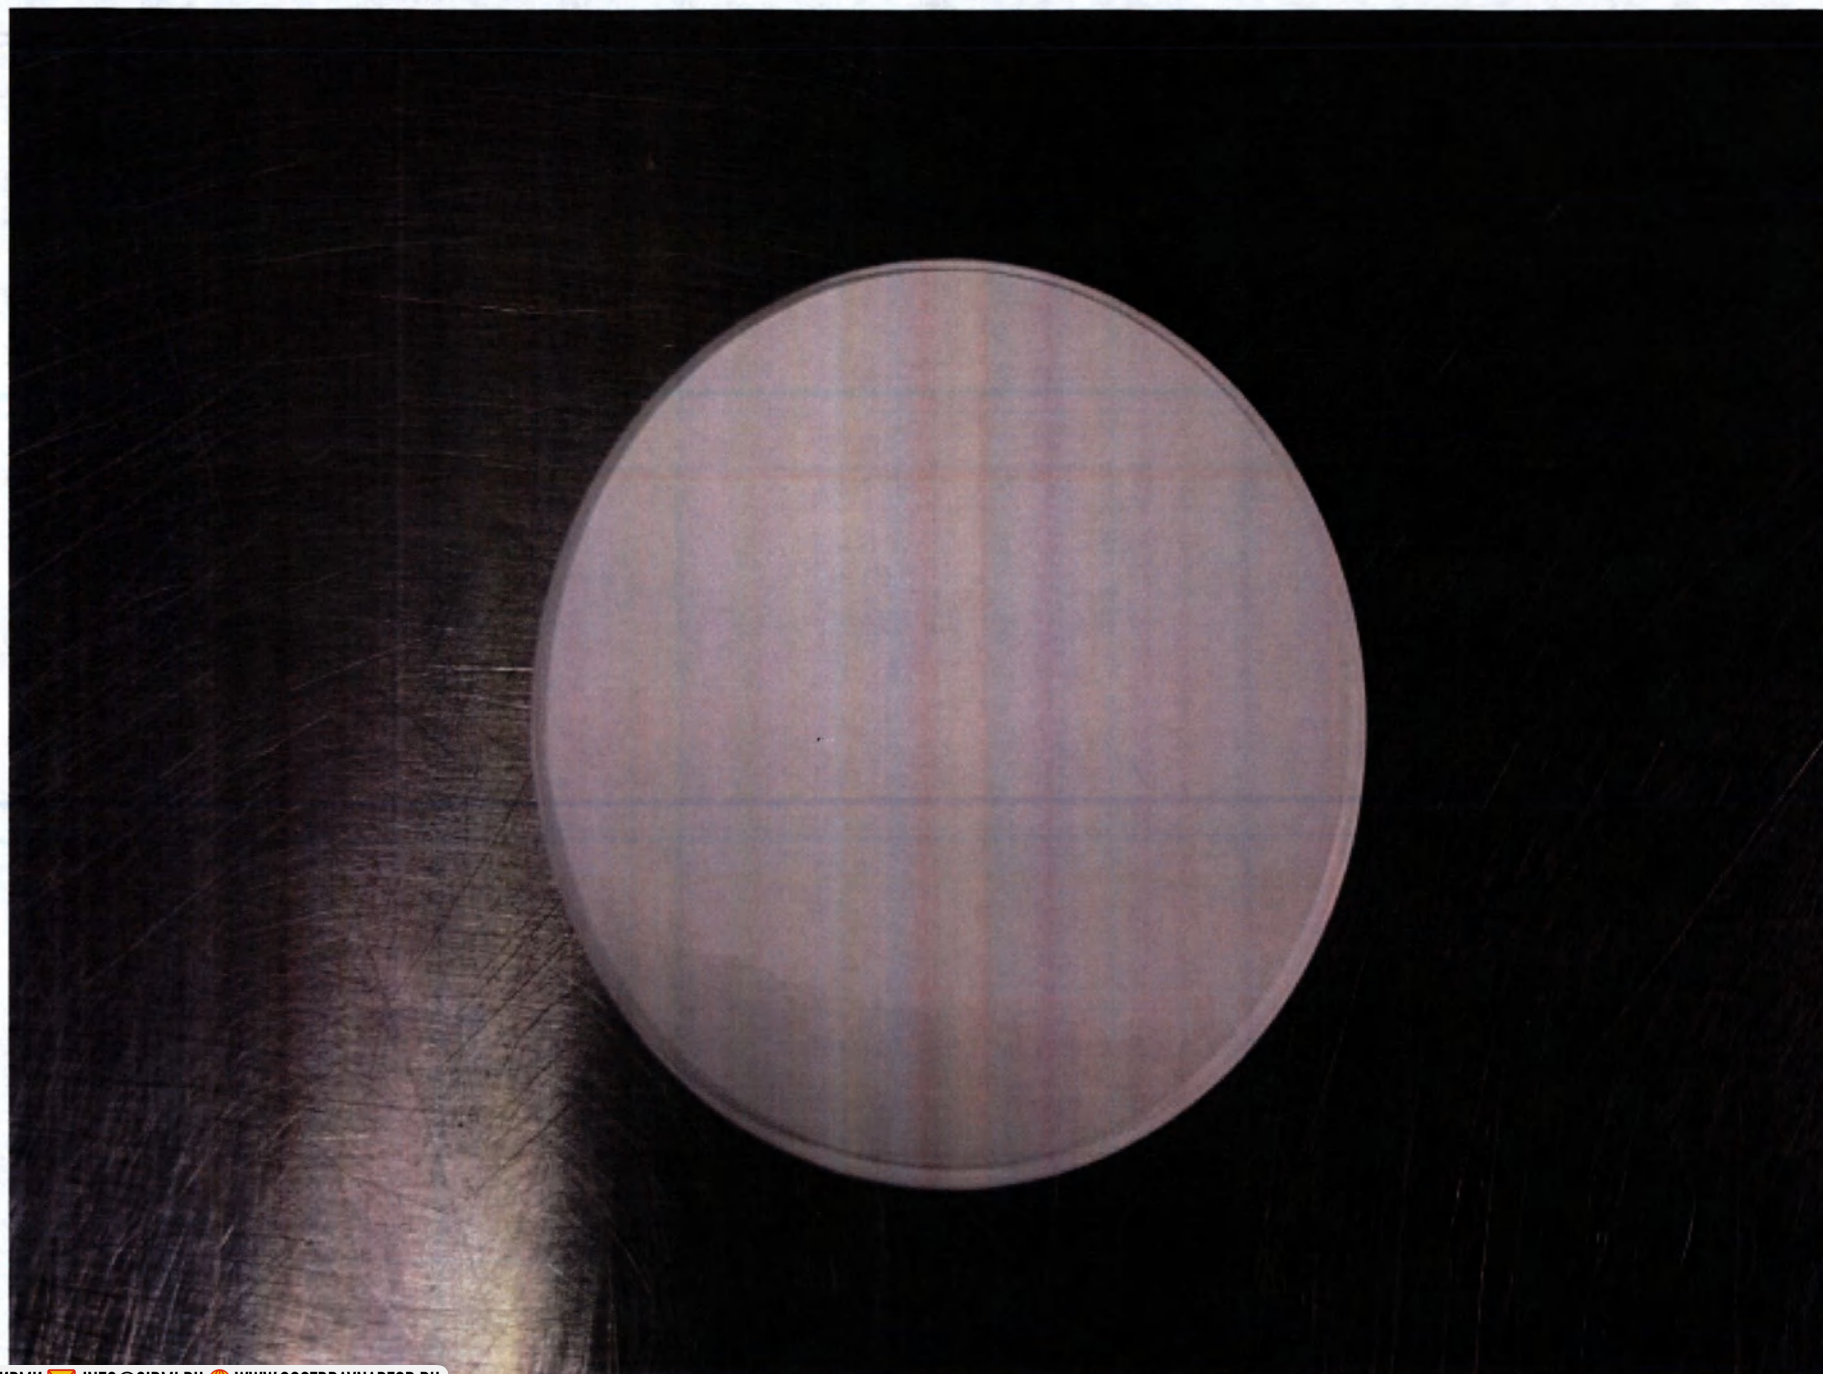

24.2 Shell disk 98,3ммØ x 14мм. Упаковка.



## 24.3 Shell disk 98,3ммØ x 14мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell disk 98,3ммØ x 14мм

Серийный номер: 3110-WN-3094

LOT: 3203974

Дата производства: 18.05.2015

Срок годности: 18.05.2022

Фактор усадки: S > 6 %




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....


25.1 Shell disk 98,3ммØ x 16мм. Изделие.

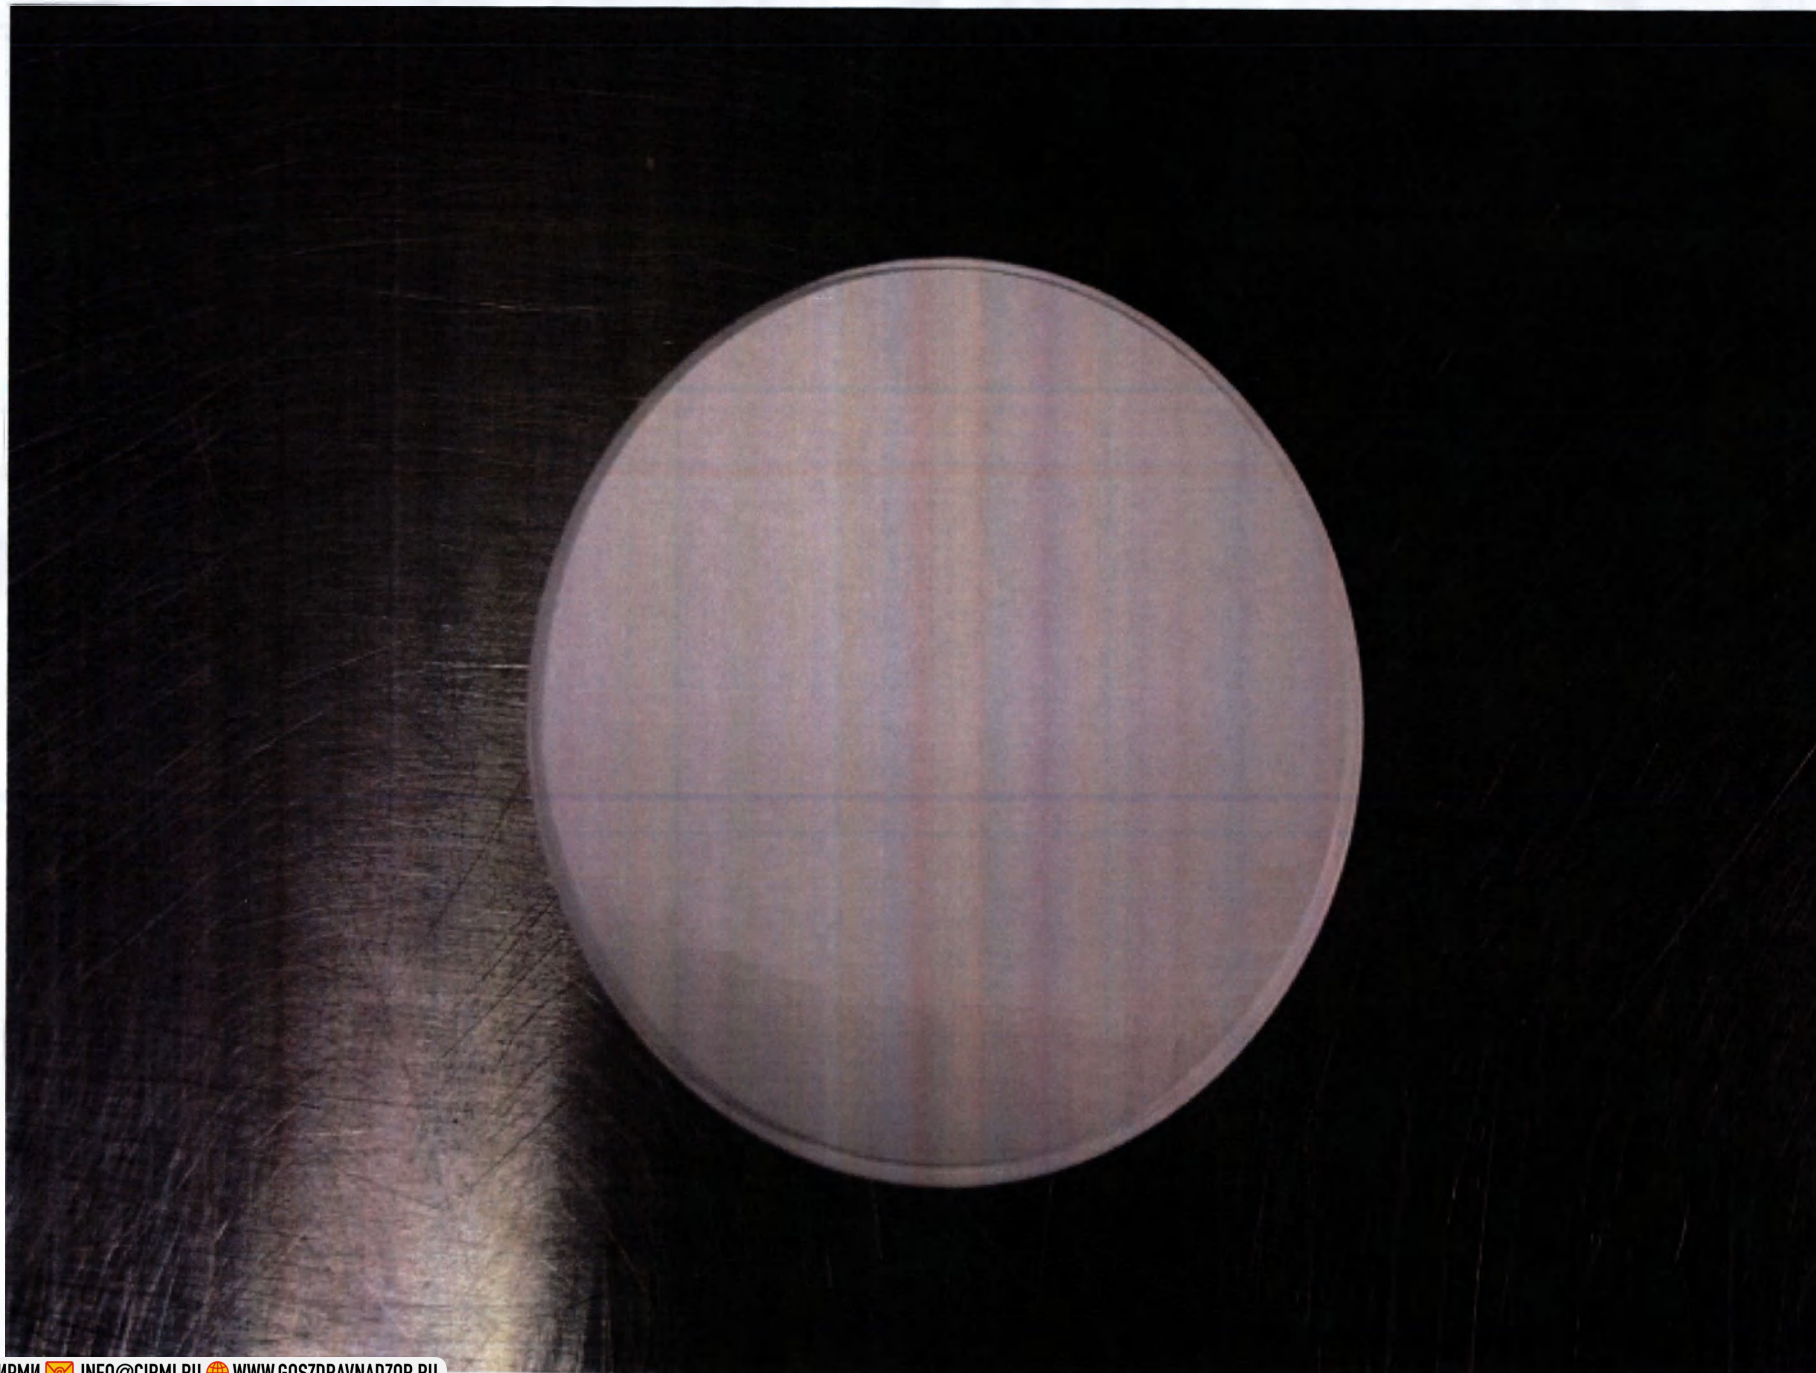

25.2 Shell disk 98,3ммØ x 16мм. Упаковка.



25.3 Shell disk 98,3ммØ x 16мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2  
+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell disk 98,3ммØ x 16мм

Серийный номер: 3110-WN-3913

LOT: 3182219

Дата производства: 03.06.2015

Срок годности: 03.06.2022

Фактор усадки: S > 6 %




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

26.1 Shell disk 98,3ммØ x 18мм. Изделие.

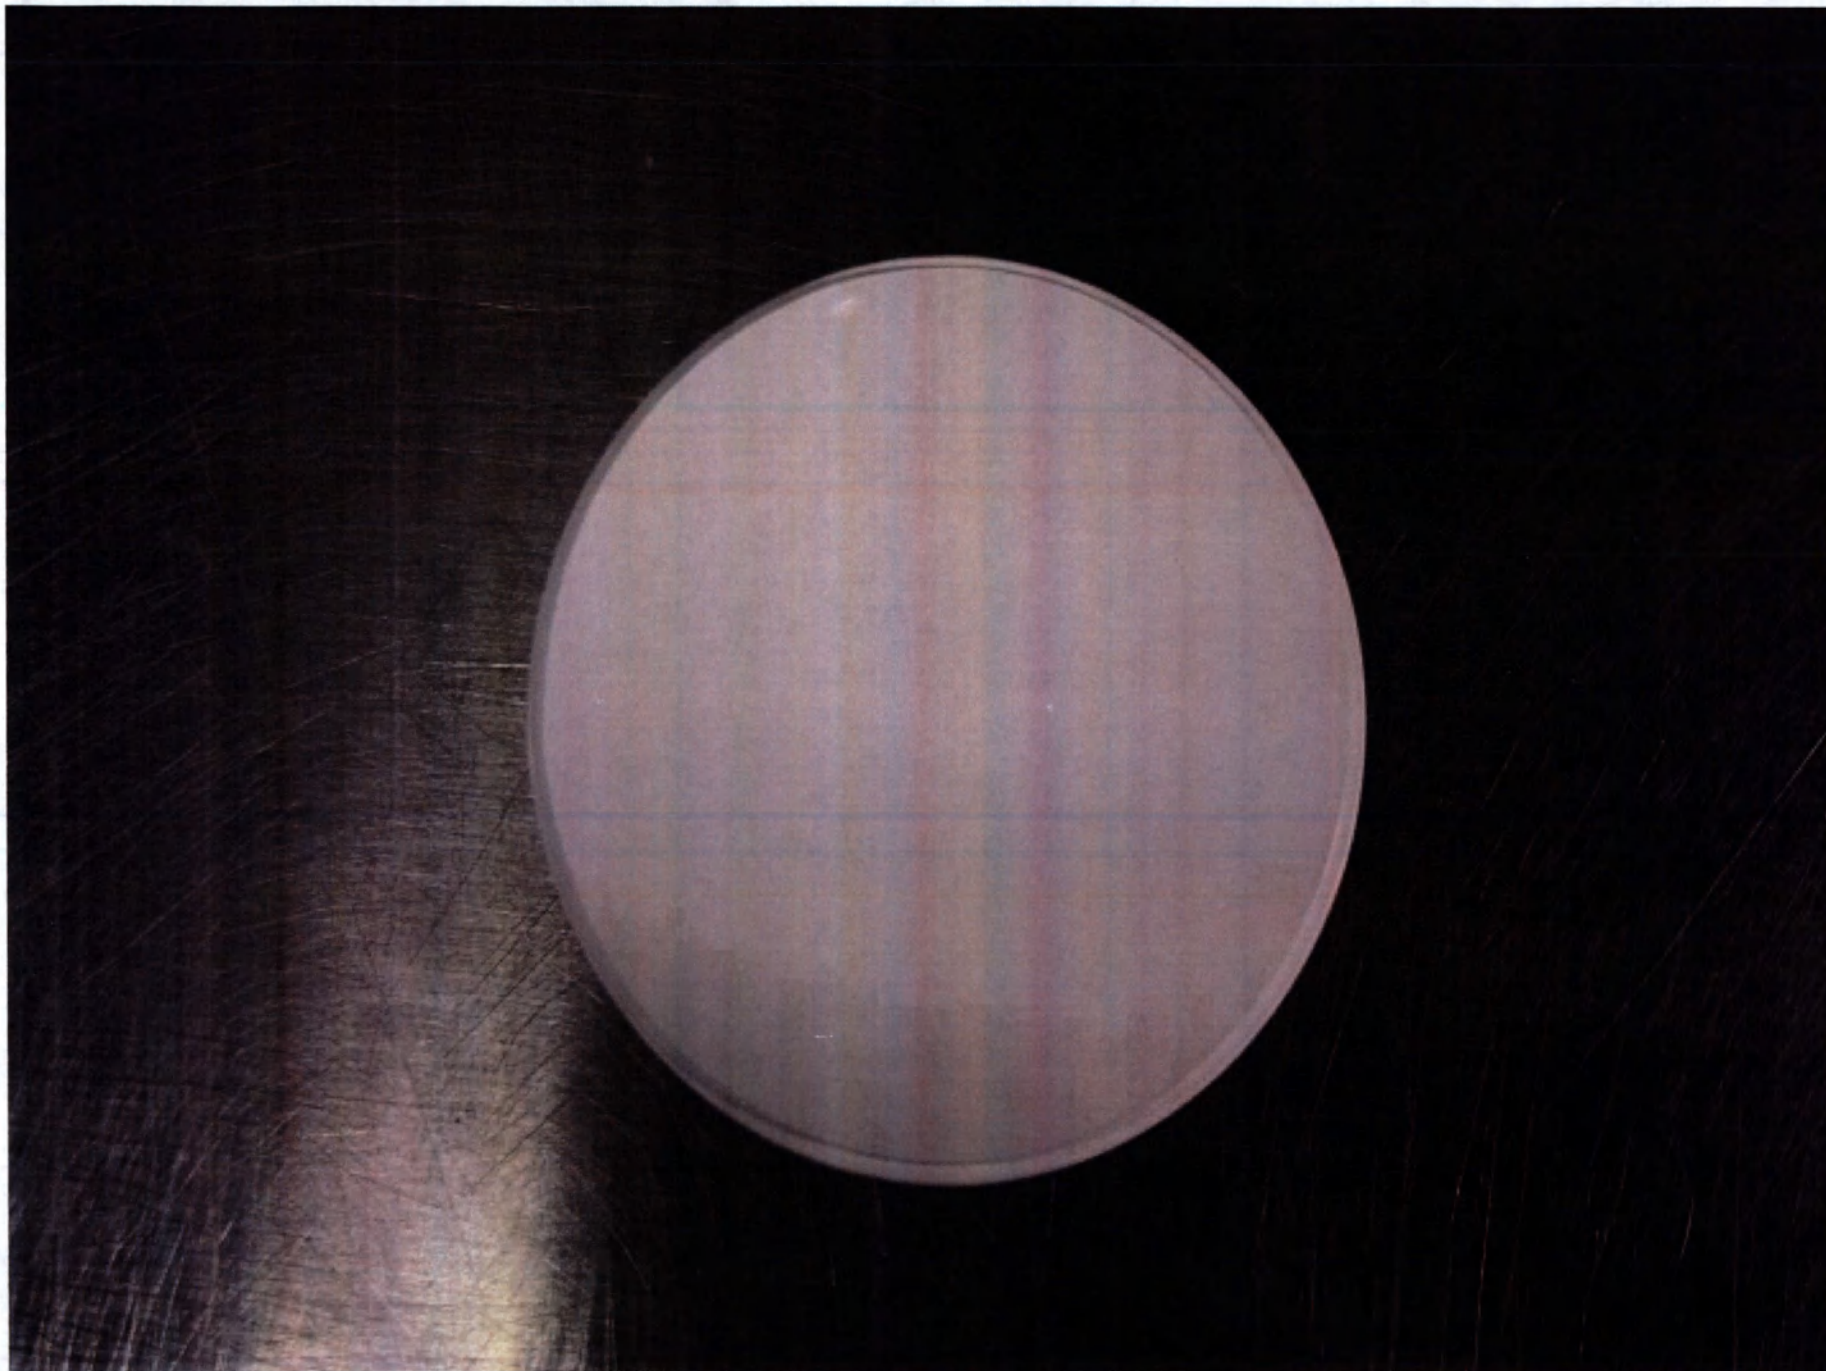

26.2 Shell disk 98,3ммØ x 18мм. Упаковка.



### 26.3 Shell disk 98,3ммØ x 18мм. Маркировка для РФ.



**Ответственный уполномоченный в РФ**

**ООО «ТС Дентал»**

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2  
+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell disk 98,3ммØ x 18мм

Серийный номер: 3110-WN-3095

LOT: 3204031

Дата производства: 27.03.2015

Срок годности: 27.03.2022

Фактор усадки: S > 6 %




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany


Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

27.1 Shell disk 98,3ммØ x 20мм. Изделие.

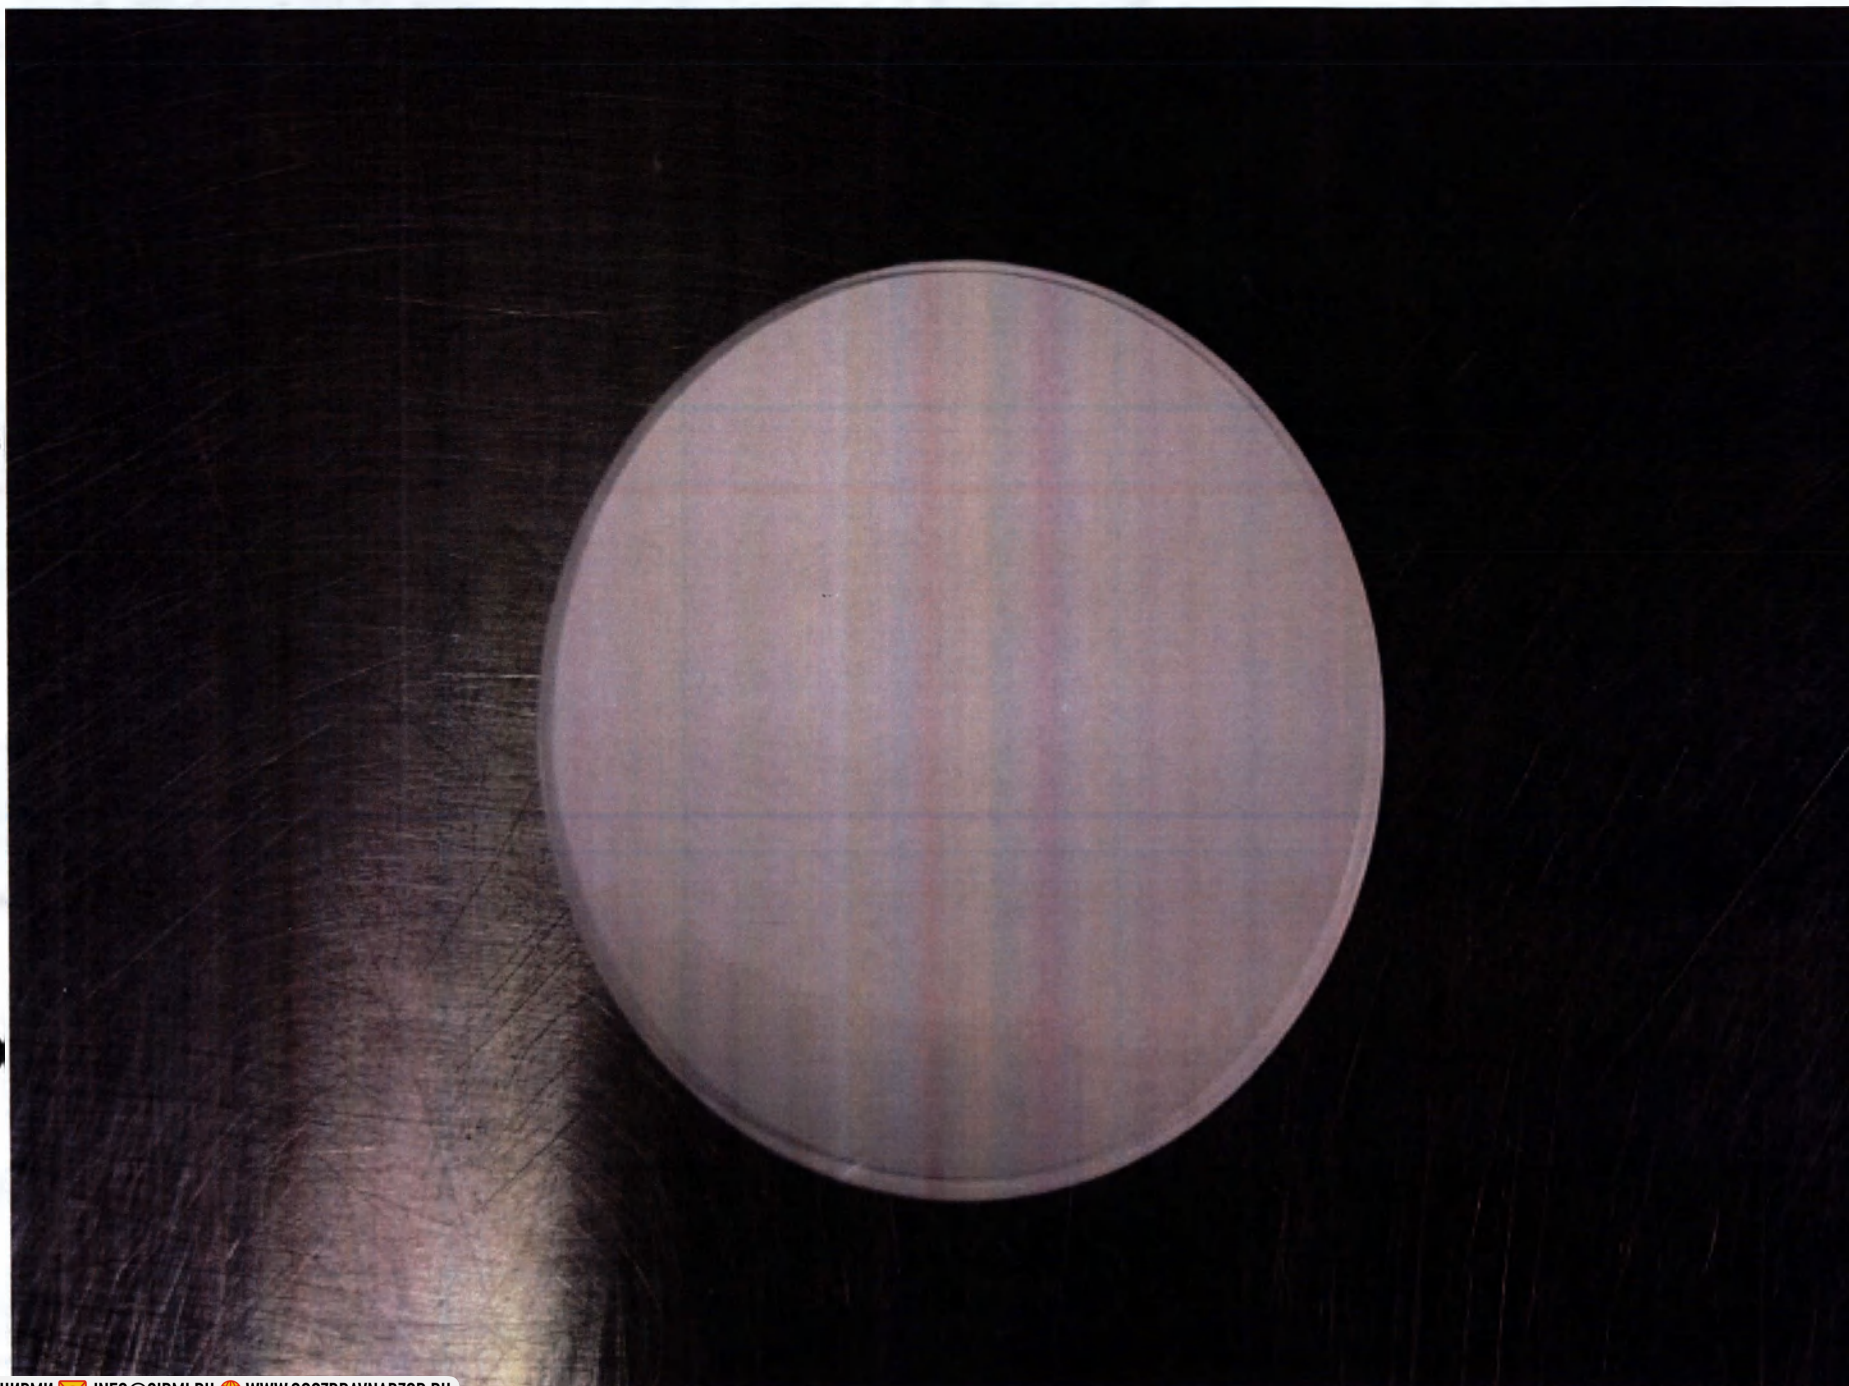

27.2 Shell disk 98,3ммØ x 20мм. Упаковка.

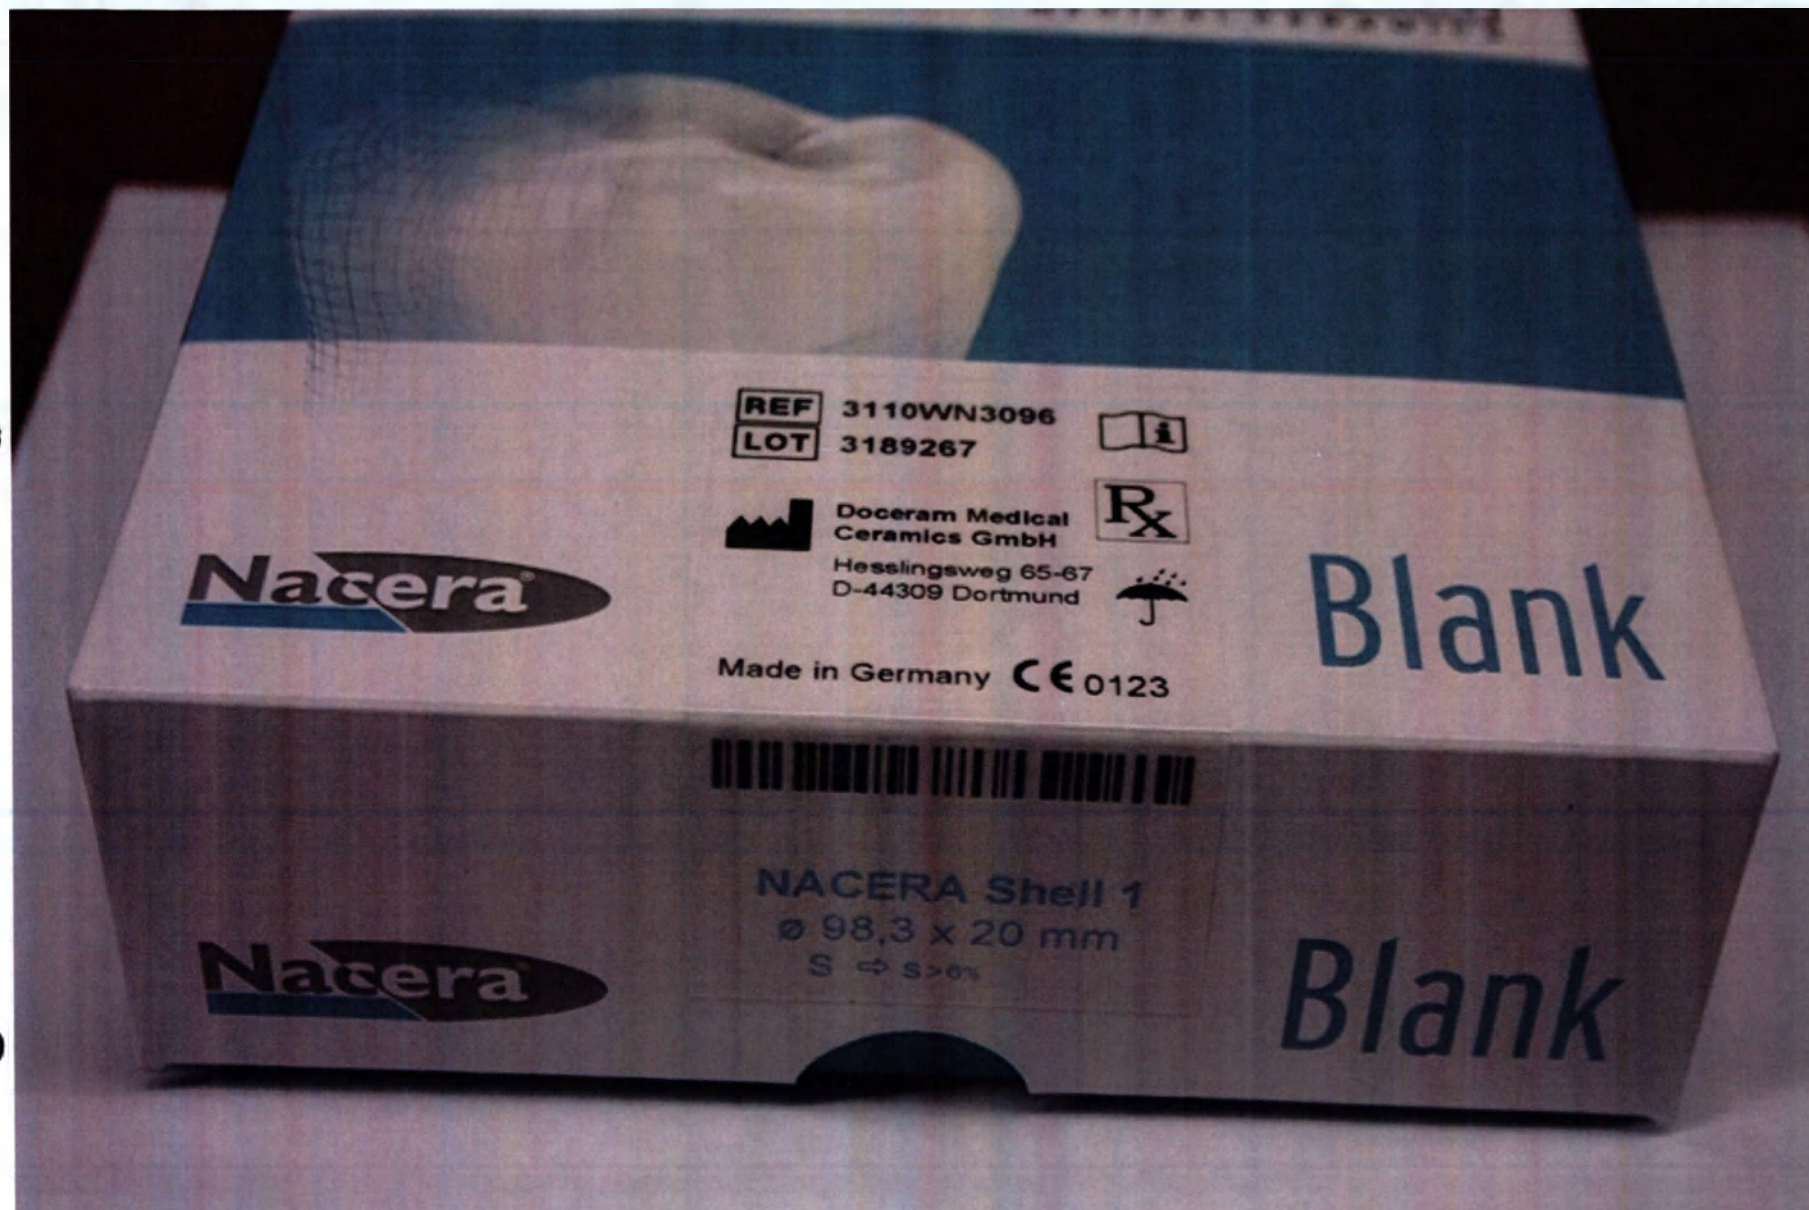

### 27.3 Shell disk 98,3ммØ x 20мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell disk 98,3ммØ x 20мм

Серийный номер: 3110-WN-3096

LOT: 3189267

Дата производства: 15.04.2015

Срок годности: 15.04.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

28.1 Shell disk 98,3ммØ x 25мм. Изделие.

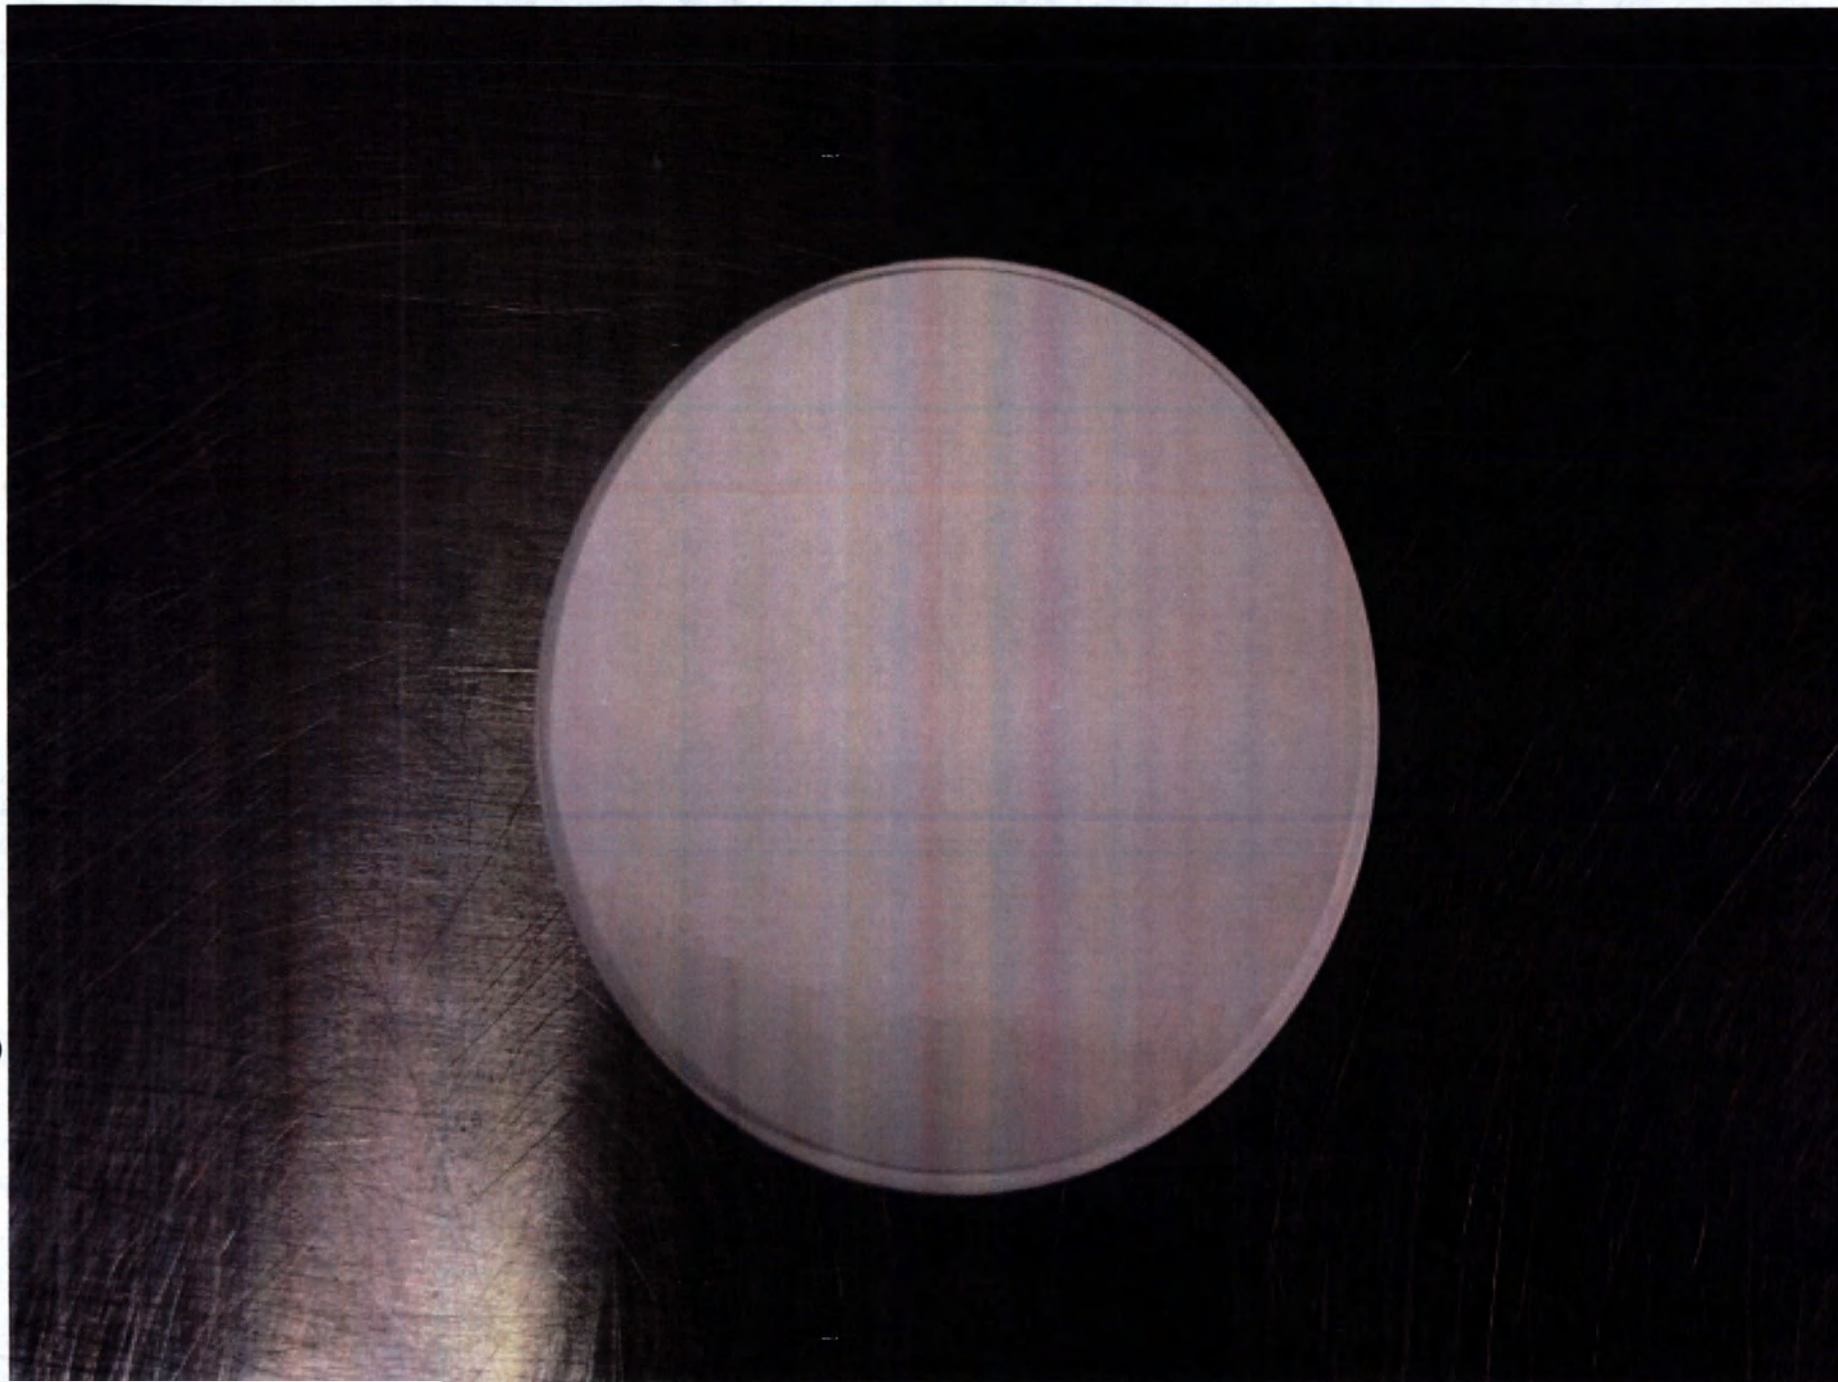

28.2 Shell disk 98,3ммØ x 25мм. Упаковка.



### 28.3 Shell disk 98,3ммØ x 25мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell disk 98,3ммØ x 25мм

Серийный номер: 3110-WN-3097

LOT: 3182177

Дата производства: 18.05.2015

Срок годности: 18.05.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany


Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

29.1 Shell block 75,5мм x 40мм x 16мм. Изделие.

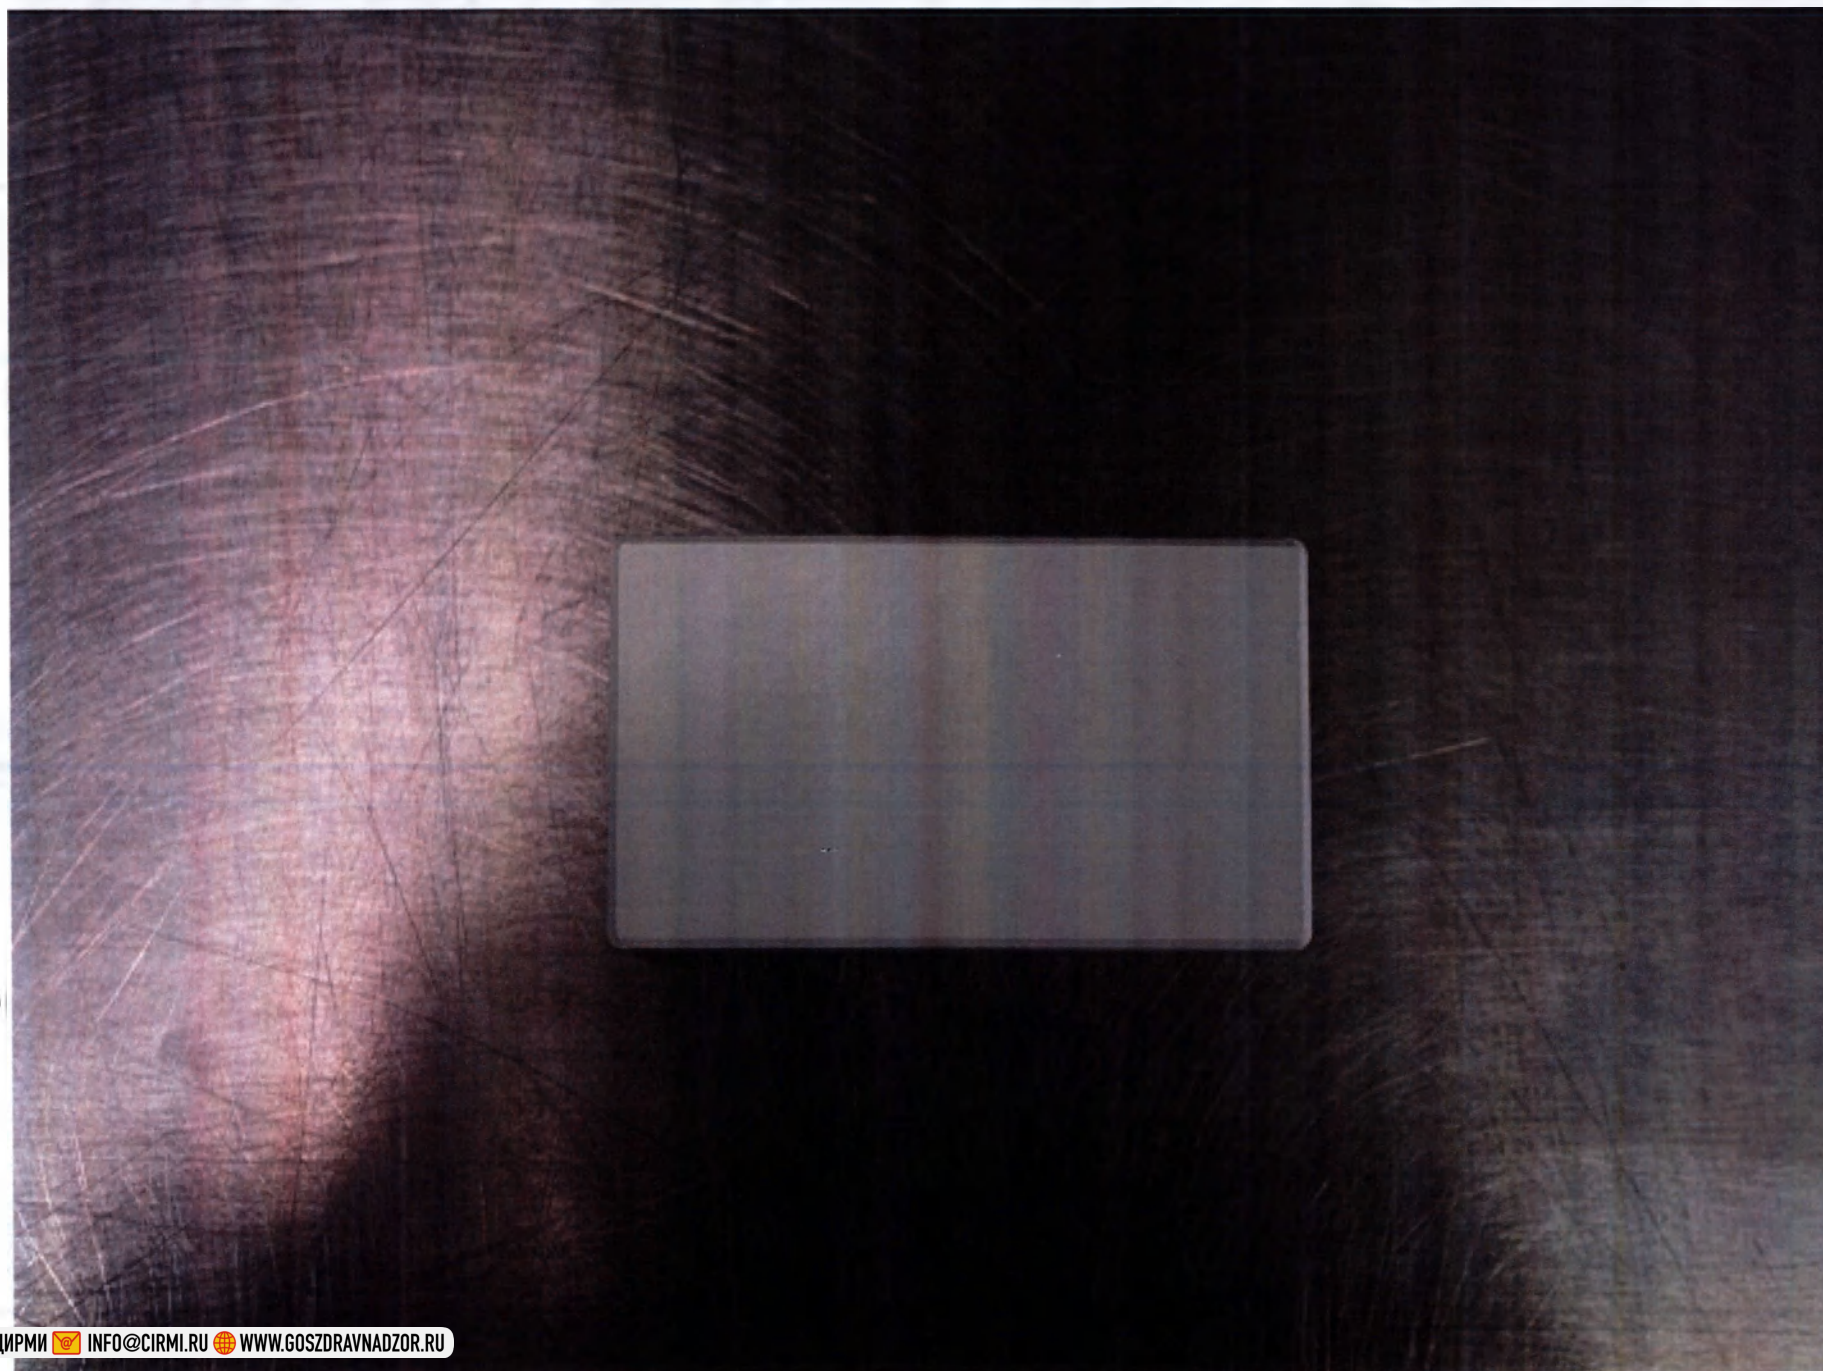

29.2 Shell block 75,5мм x 40мм x 16мм. Упаковка

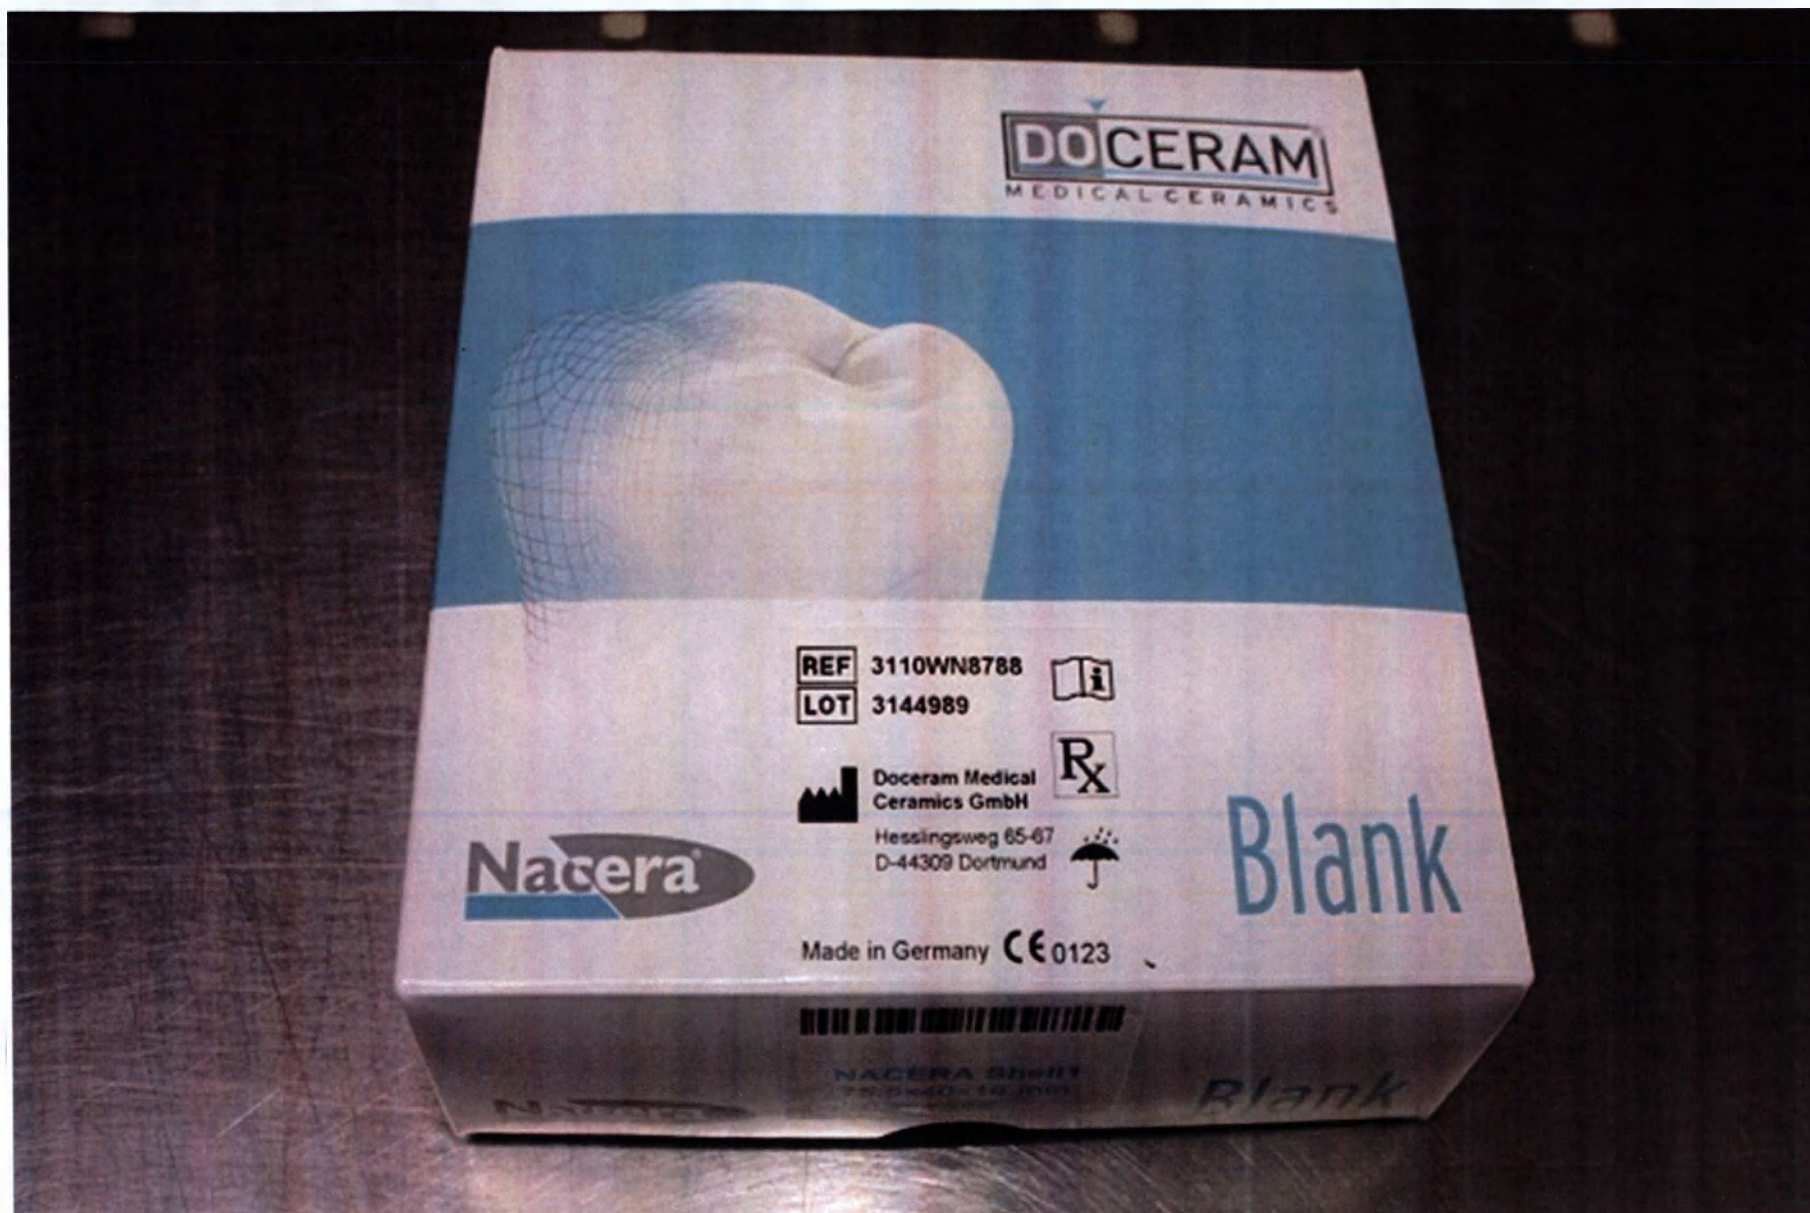

### 29.3 Shell block 75,5мм x 40мм x 16мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell block 75,5мм x 40мм x 16мм

Серийный номер: 3110-WN-8788

LOT: 3144989

Дата производства: 09.04.2015

Срок годности: 09.04.2022

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany


Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

30.1 Shell block 75,5мм x 40мм x 22мм. Изделие.

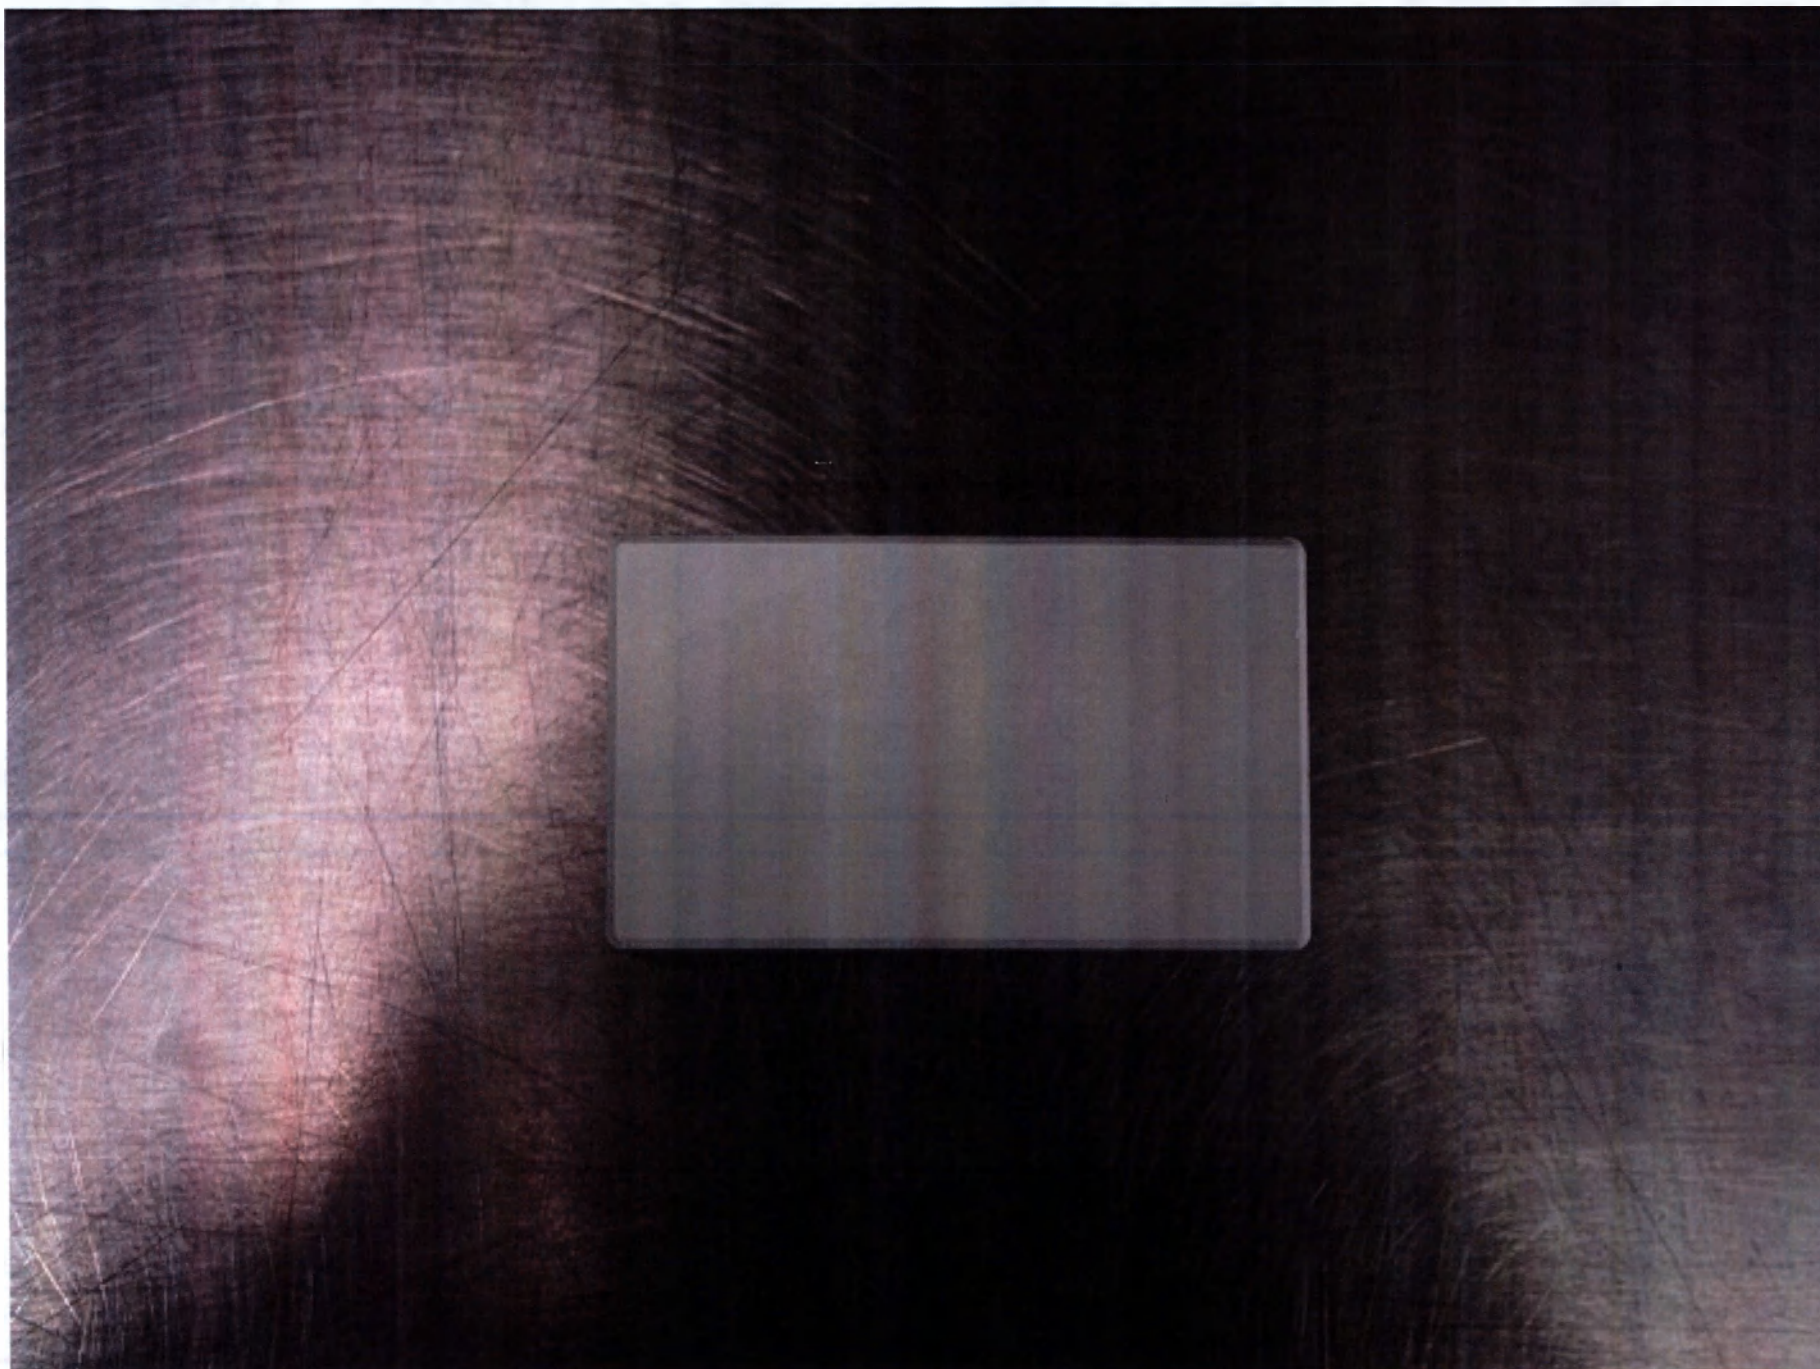

30.2 Shell block 75,5mm x 40mm x 22mm.

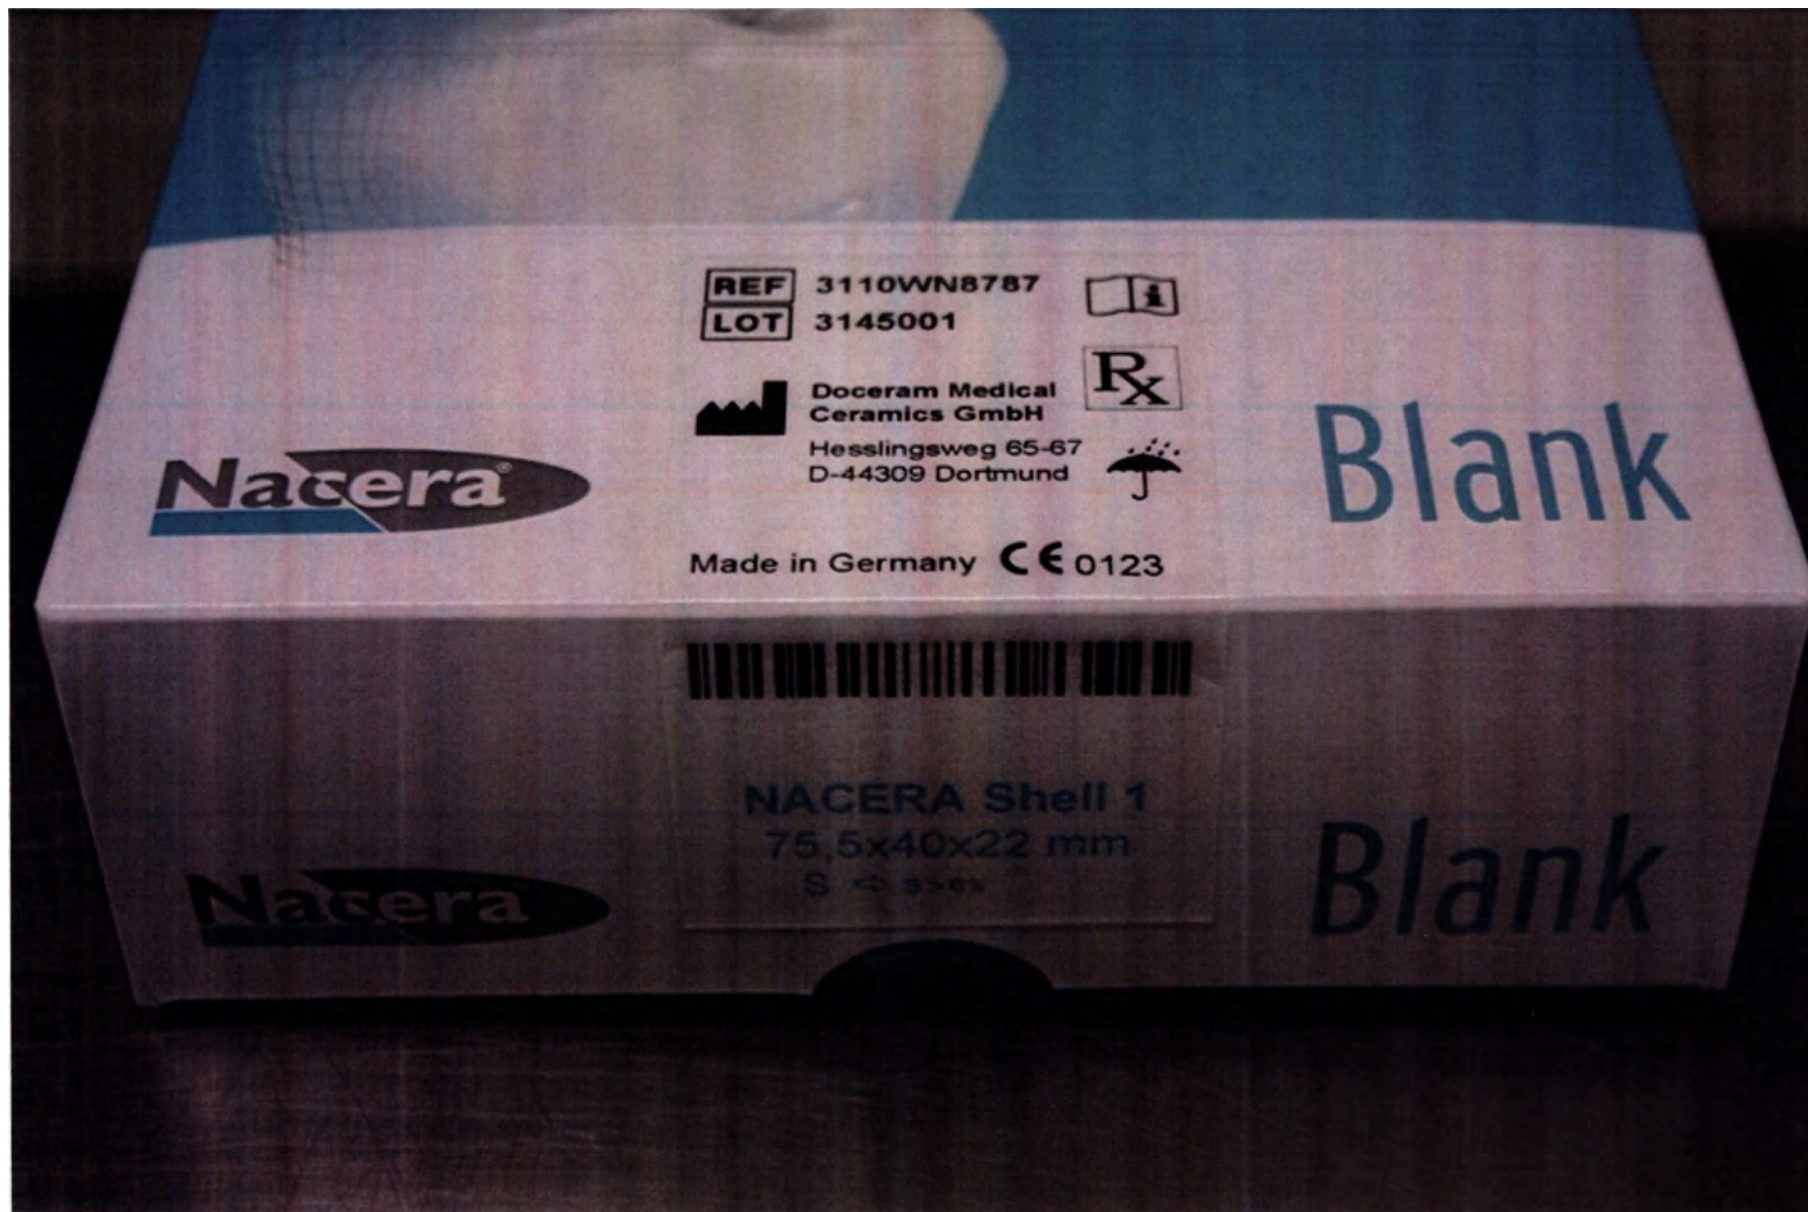

### 30.3 Shell block 75,5мм x 40мм x 22мм. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell block 75,5мм x 40мм x 22мм

Серийный номер: 3110-WN-8787

LOT: 3145001

Дата производства: 04.11.2013

Срок годности: 04.11.2020

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

31.1 Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 14mm. Изделие.

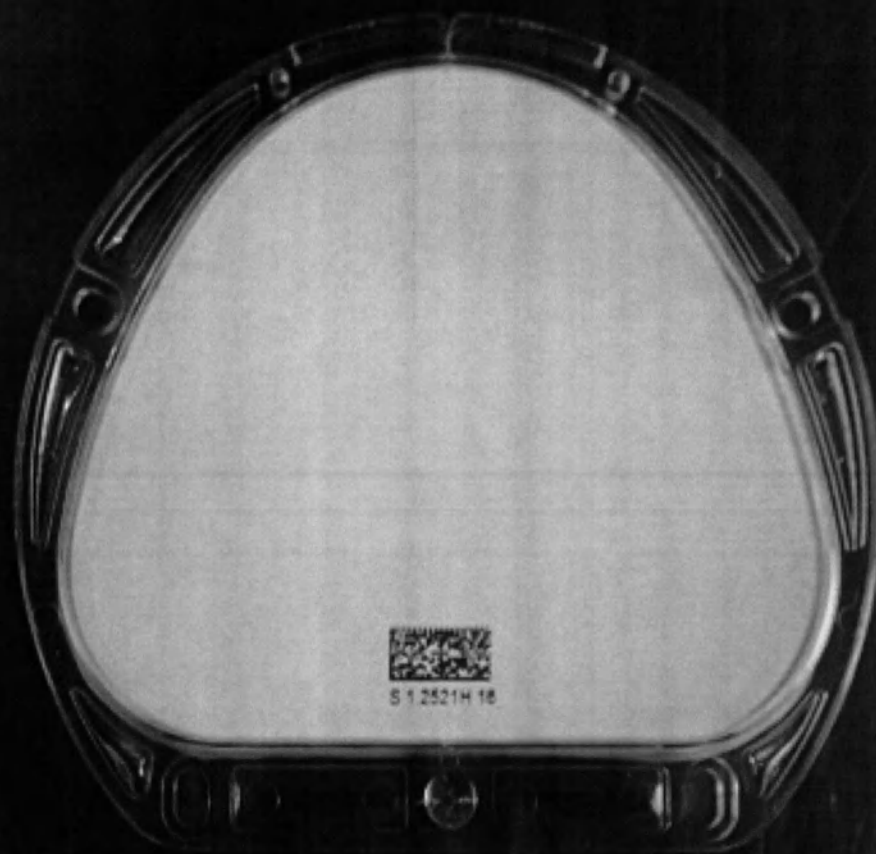

31.2 Shell D-shape 90mm x 72,5мм x 14мм. Упаковка.



### 31.3 Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 14mm. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 14mm

Серийный номер: 3110-WNB-9094

LOT: 3164759

Дата производства: 25.09.2014

Срок годности: 25.09.2021

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

32.1 Shell D-shape 90mm x 72,5мм x 16мм. Изделие.

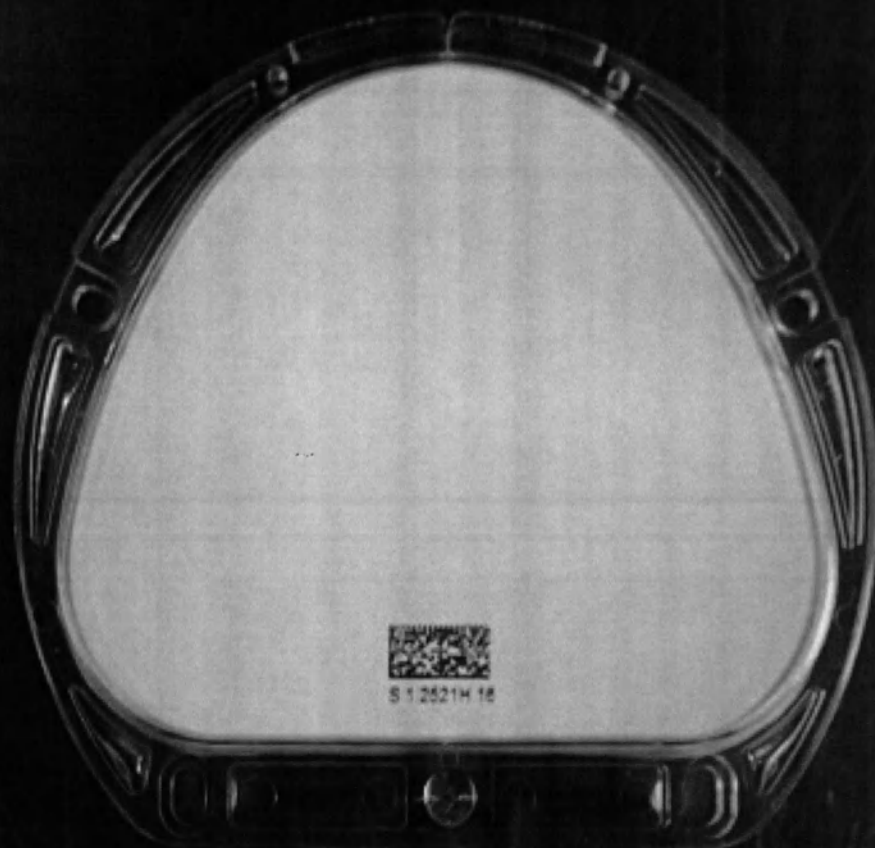

32.2 Shell D-shape 90mm x 72,5мм x 16мм. Упаковка.



### 32.3 Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 16mm. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ  
ООО «ТС Дентал»  
123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2  
+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 16mm

Серийный номер: 3110-WNB-9913

LOT: 3167027

Дата производства: 05.11.2014

Срок годности: 05.11.2021

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

### 33.1 Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 18mm. Изделие

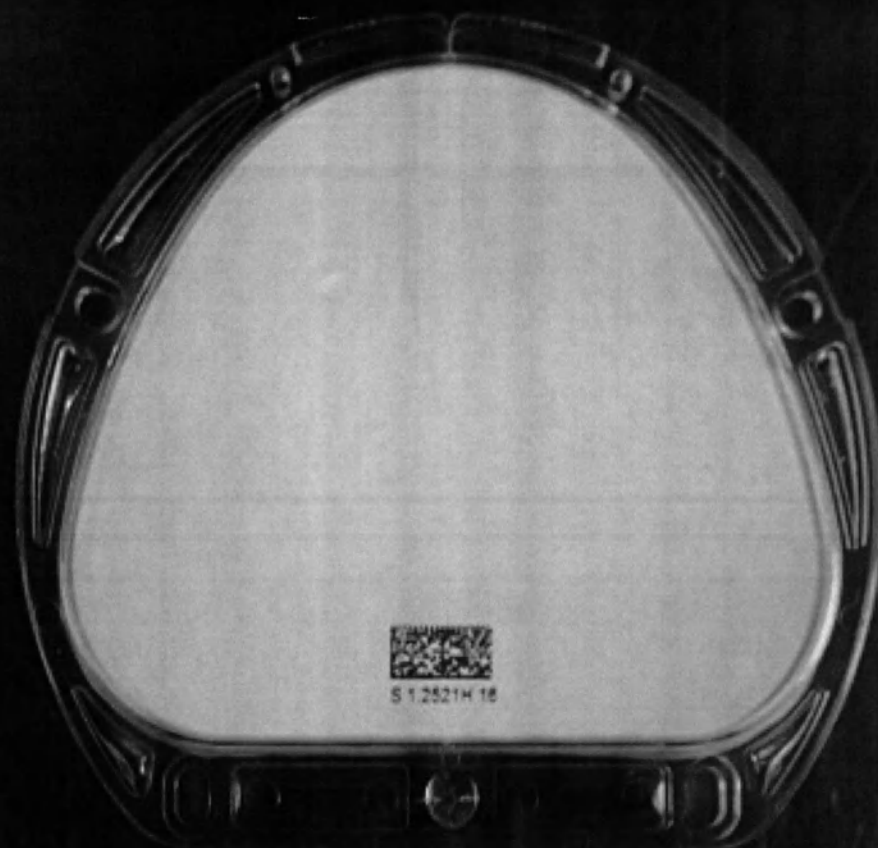

33.2 Shell D-shape 90mm x 72,5мм x 18мм. Упаковка.



### 33.3 Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 18mm. Маркировка для РФ.



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: D-shape 90mm x 72,5mm x 18mm

Серийный номер: 3110-WNB-9095

LOT: 3168546

Дата производства: 05.11.2014

Срок годности: 05.11.2021

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

34.1 Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 20mm. Изделие.

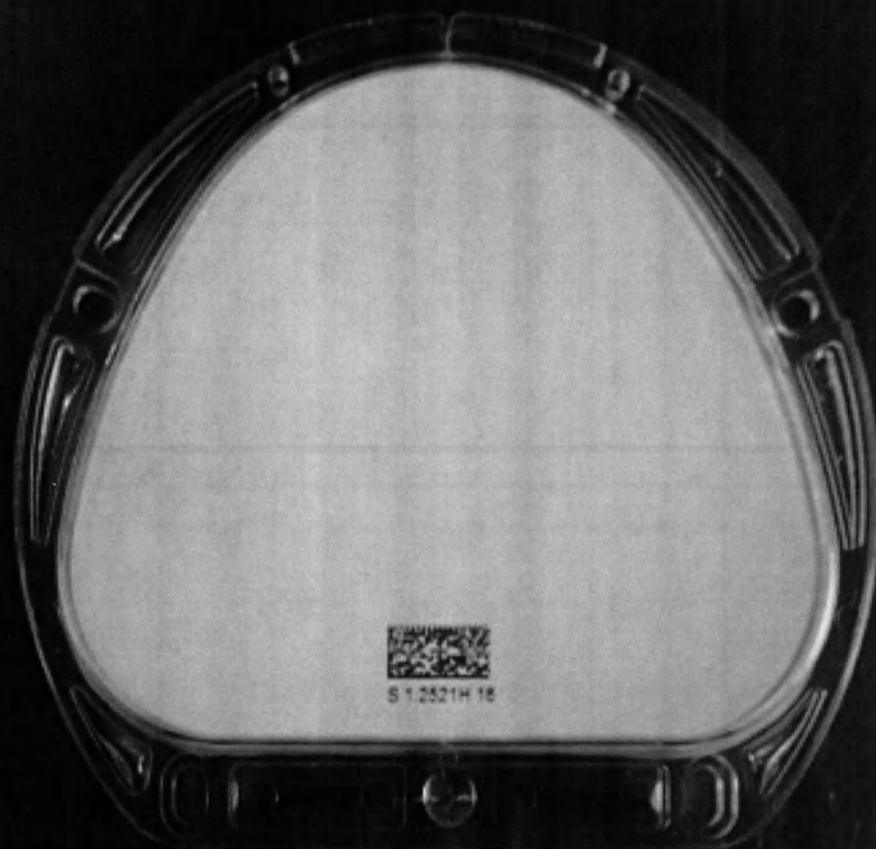

34.2 Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 20mm. Упаковка.



### 34.3 Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 20mm. Маркировка для РФ



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 20mm

Серийный номер: 3110-WN-9096

LOT: 3167036

Дата производства: 05.11.2014

Срок годности: 05.11.2021

Фактор усадки:  $S > 6 \%$




DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

### 35.1 Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 25mm. Изделие

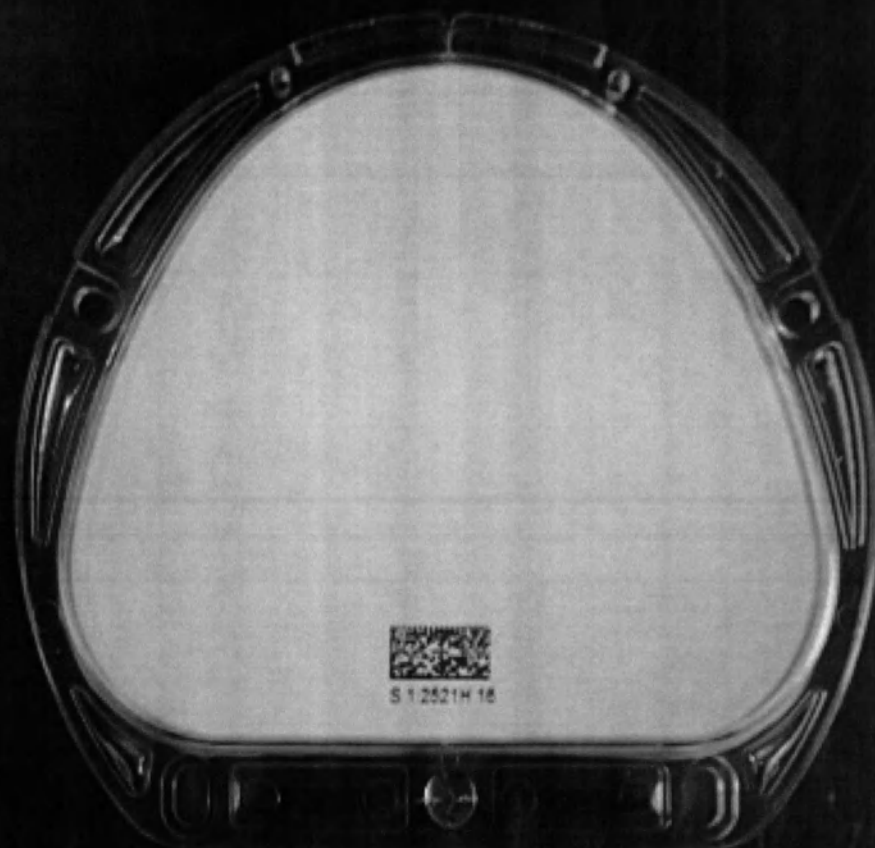

35.2 Shell D-shape 90mm x 72,5мм x 25мм. Упаковка.



### 35.3 Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 25mm. Маркировка для РФ



Ответственный уполномоченный в РФ

ООО «ТС Дентал»

123242, Россия, Москва, Столярный пер., 2

+7 495 921 35 06

**Заготовки из оксида циркония для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии NACERA.**

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха: от 15°C до 30°C (максимальная амплитуда от -29°C до + 60°C)
- Относительная влажность окружающего воздуха: от 30% до 85% (без конденсации)
- Атмосферное давление: от 50 гПа до 106 гПа

Вариант исполнения: Shell D-shape 90mm x 72,5mm x 25mm

Серийный номер: 3110-WNB-9097

LOT: 3169834

Дата производства: 05.11.2014

Срок годности: 05.11.2021

Фактор усадки:  $S > 6 \%$



DOCERAM Medical Ceramics GmbH  
Hesslingsweg 65-67, 44309 Dortmund, Germany

Сделано в Германии

Регистрационное удостоверение № РЗН .....

