

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МТО «Сормовь»


Стрекалов И.А.
«19» апреля 2017 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Аппарат электрохирургический высокочастотный Dixon Altafor Plus, с принадлежностями

1.1.Основной блок

Аппарат электрохирургический высокочастотный Altafor 1310 Plus








Аппарат электрохирургический высокочастотный Altafor 1340 Plus



Аппарат электрохирургический высокочастотный Altafor 1345 Plus

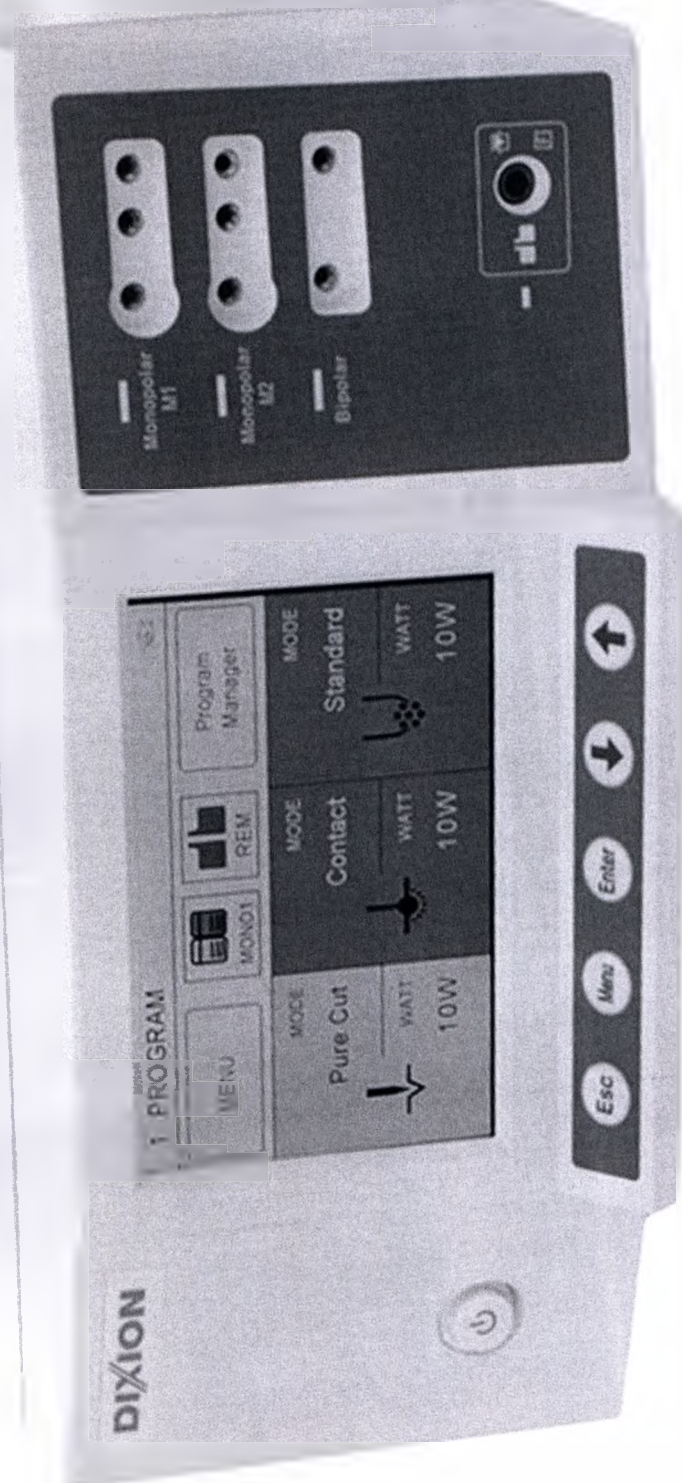

1.2. Держатель электродов с ручным управлением одноразовый



1.3. Педаль управления Коагуляция




1.4. Кабель питания



2.1. Педаль управления Резание/Коагуляция




2.2. Держатель электродов с управлением от педали

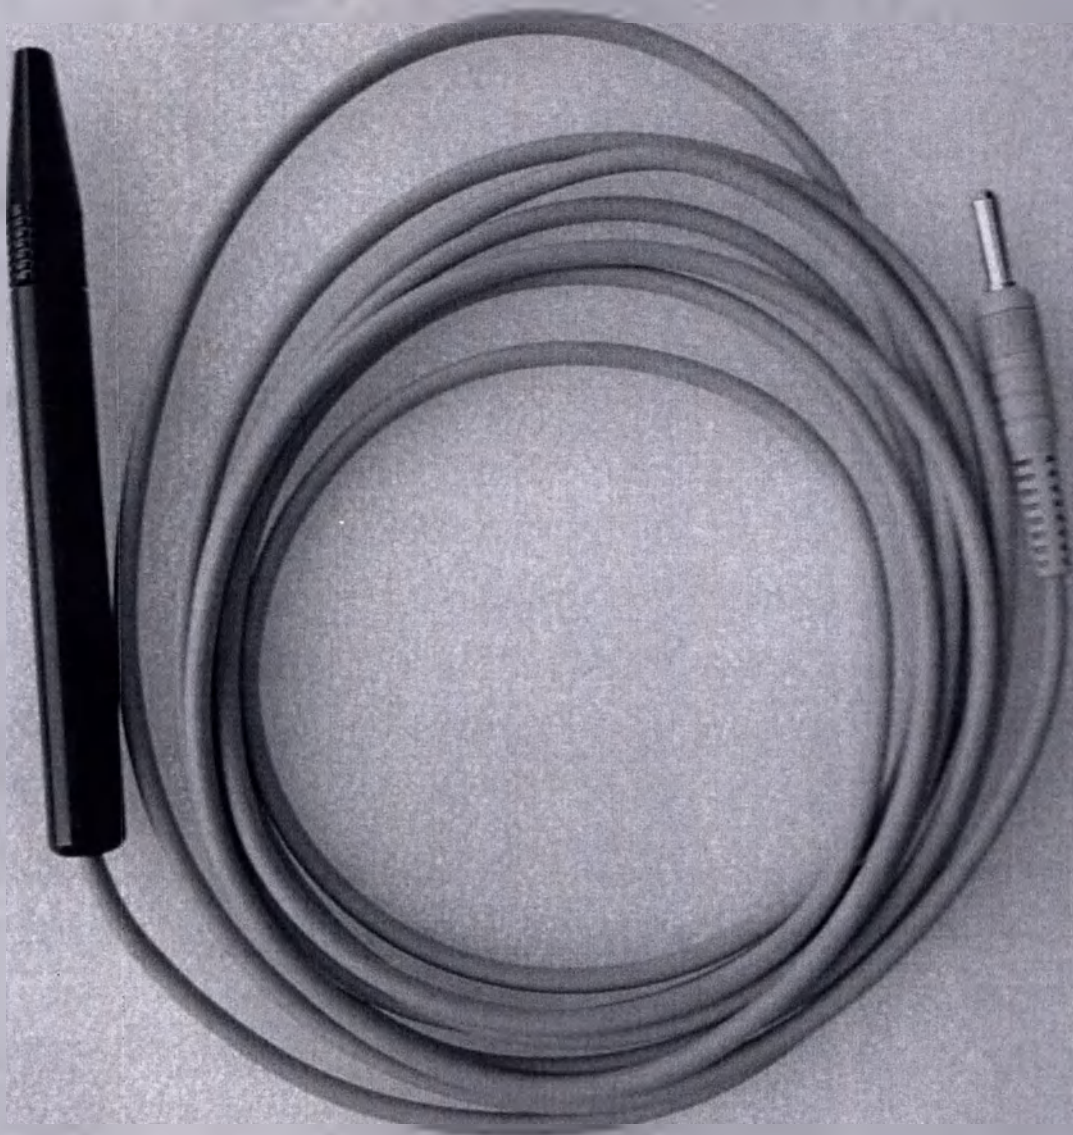

2.3. Кабель для подключения биполярных пинцетов




2.4. Электрод двойной нейтральный одноразовый

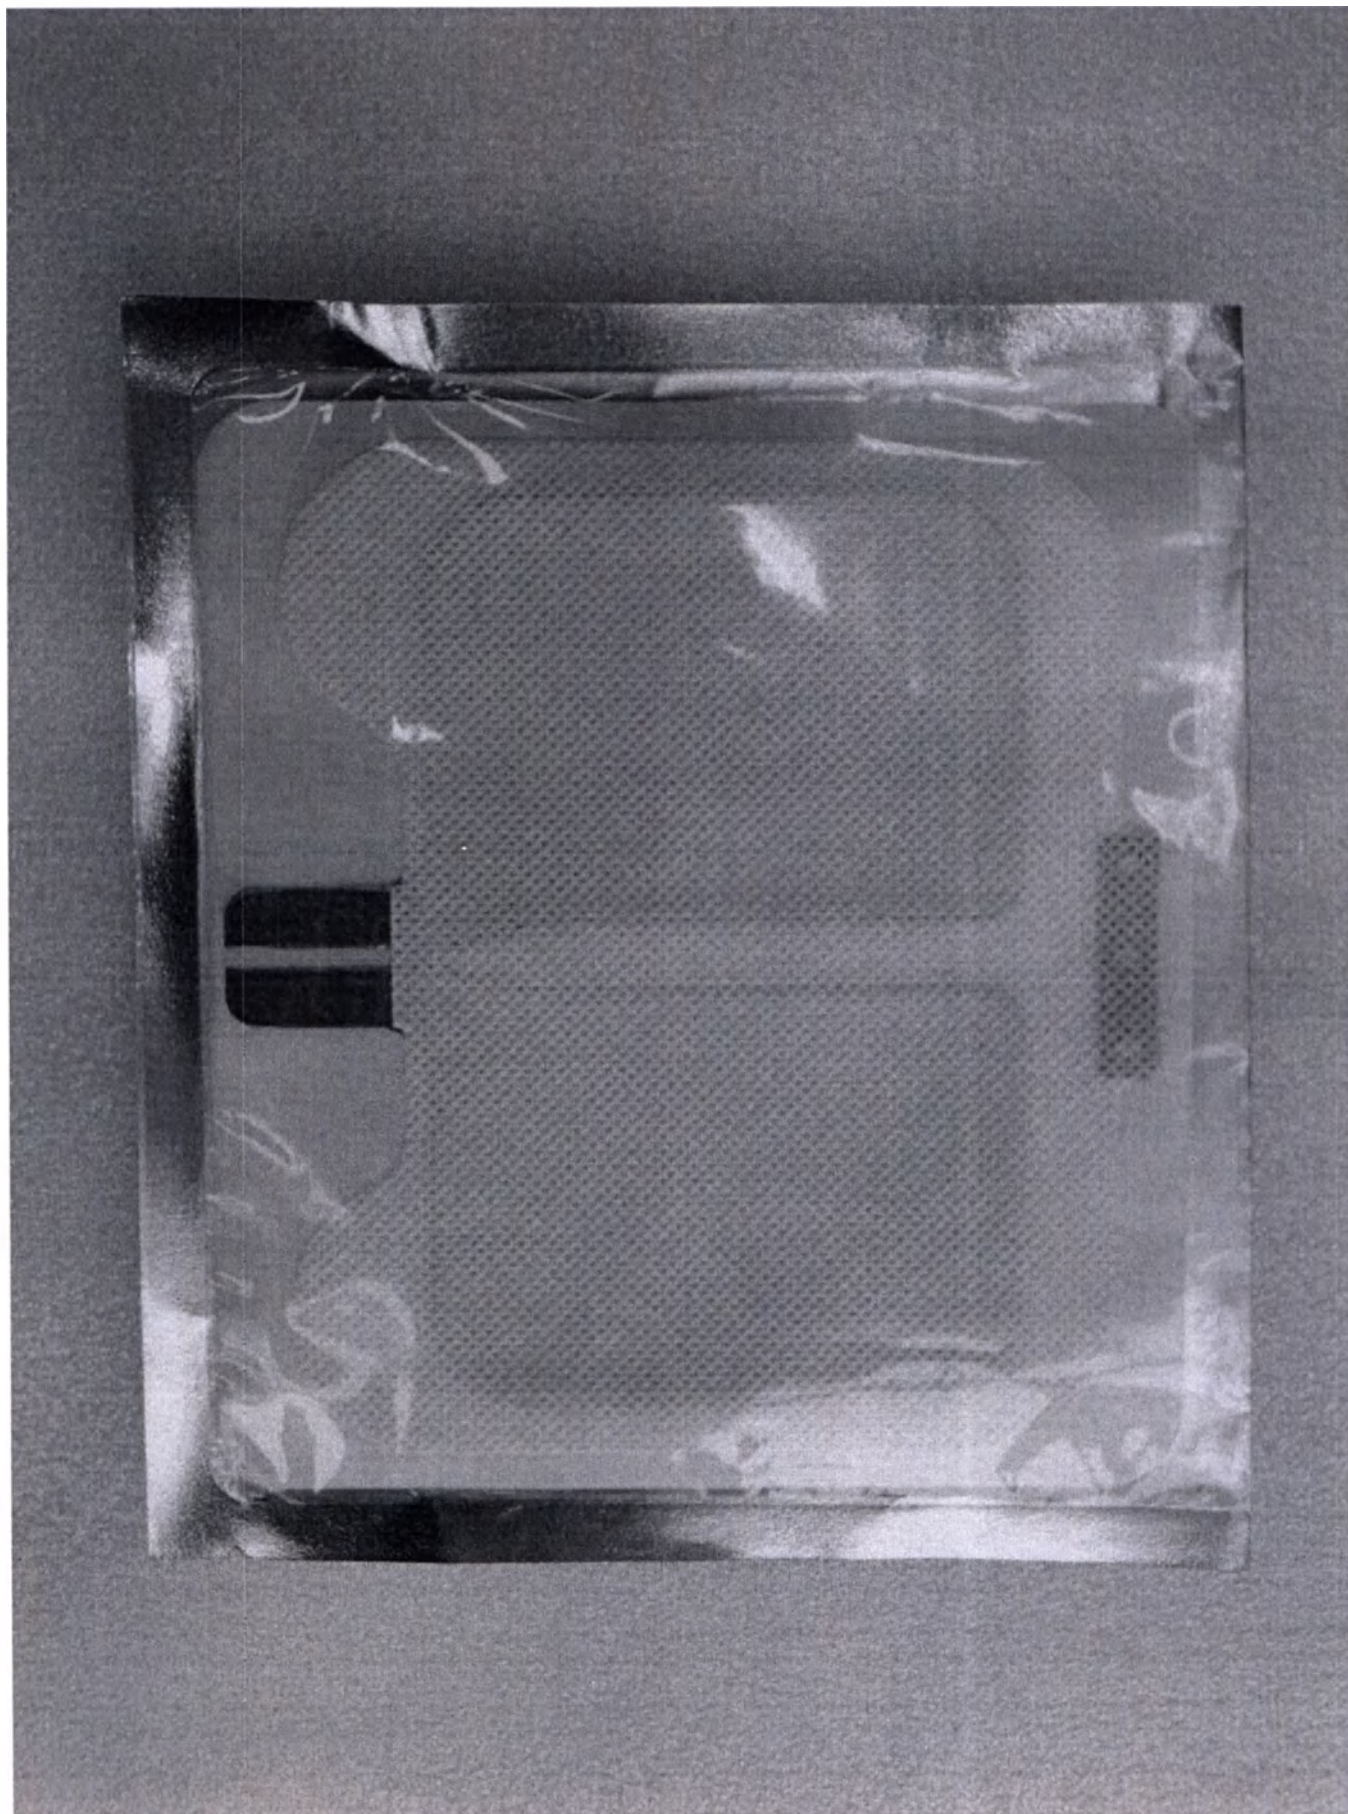


2.5. Кабель для подключения двойного одноразового нейтрального электрода



2.6. Электрод силиконовый нейтральный с кабелем многожильный

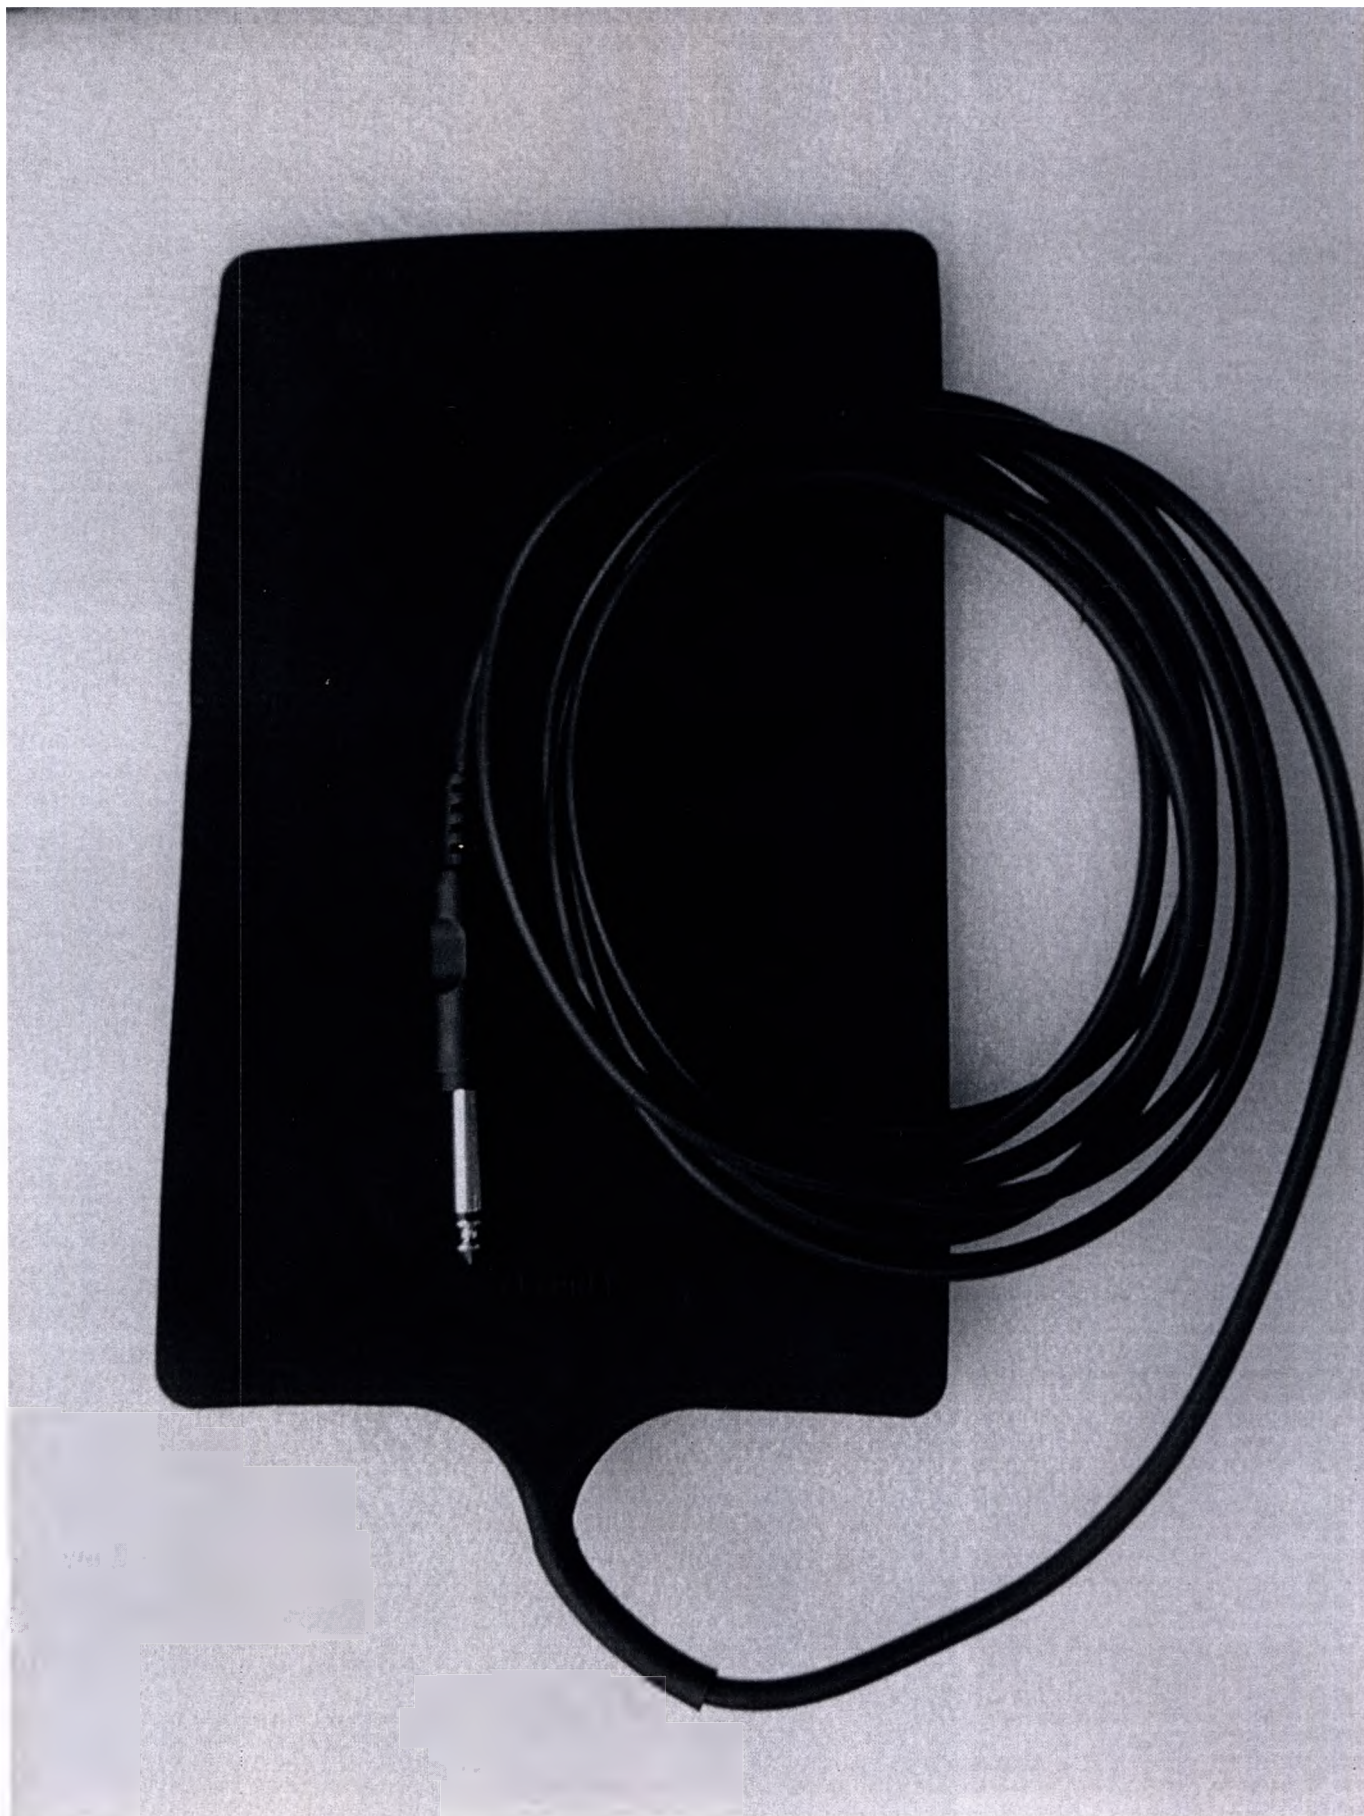

2.7. Электрод-нож монополярный

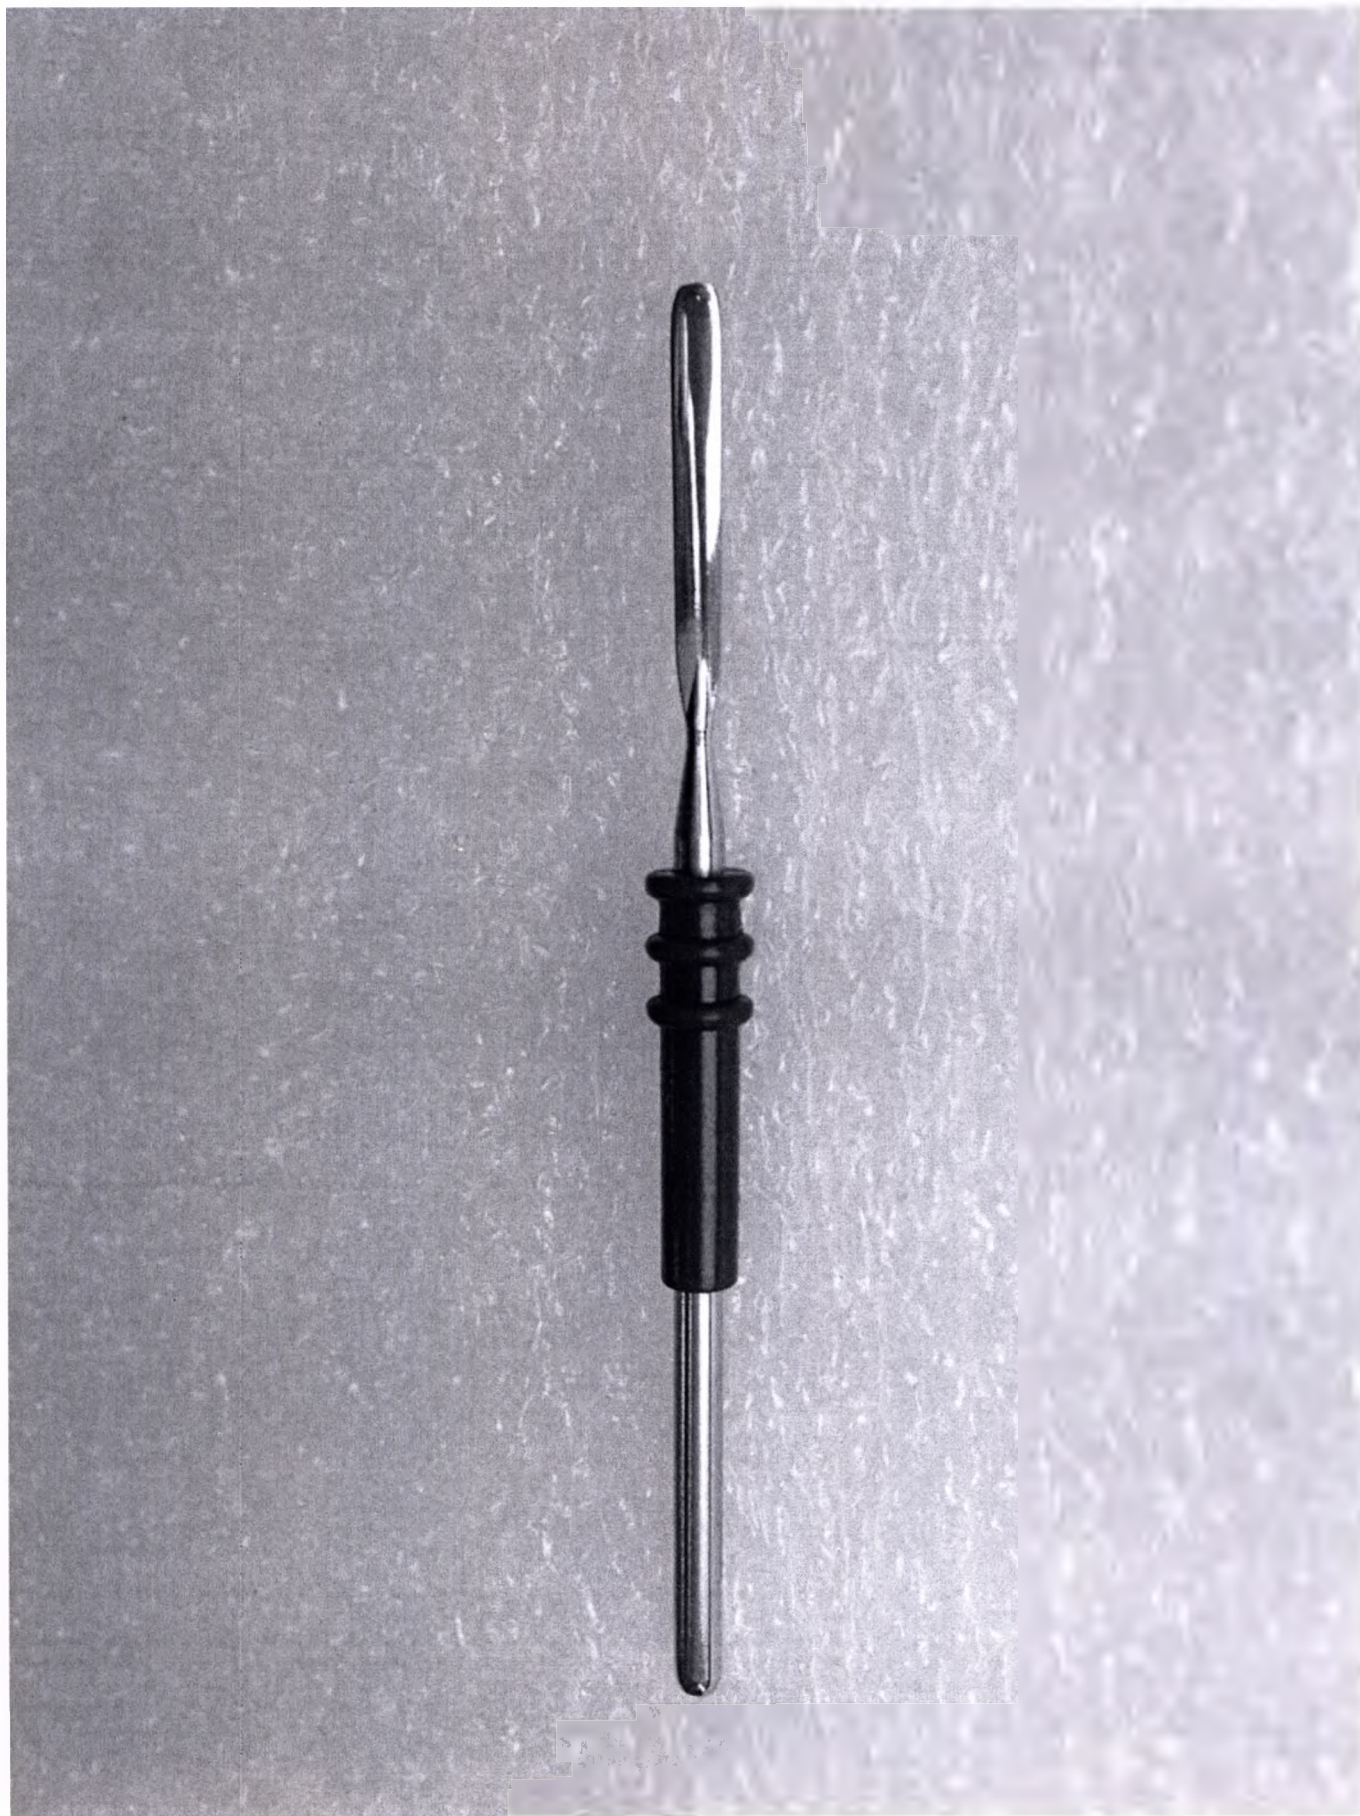

2.8.Электрод-игла монополярный



2.9. Электрод-игла изогнутый монополярный




2.10. Электрод-шар монополярный



2.11. Электрод-петля монополярный



2.12. Кабель заземления «Ground Cable»

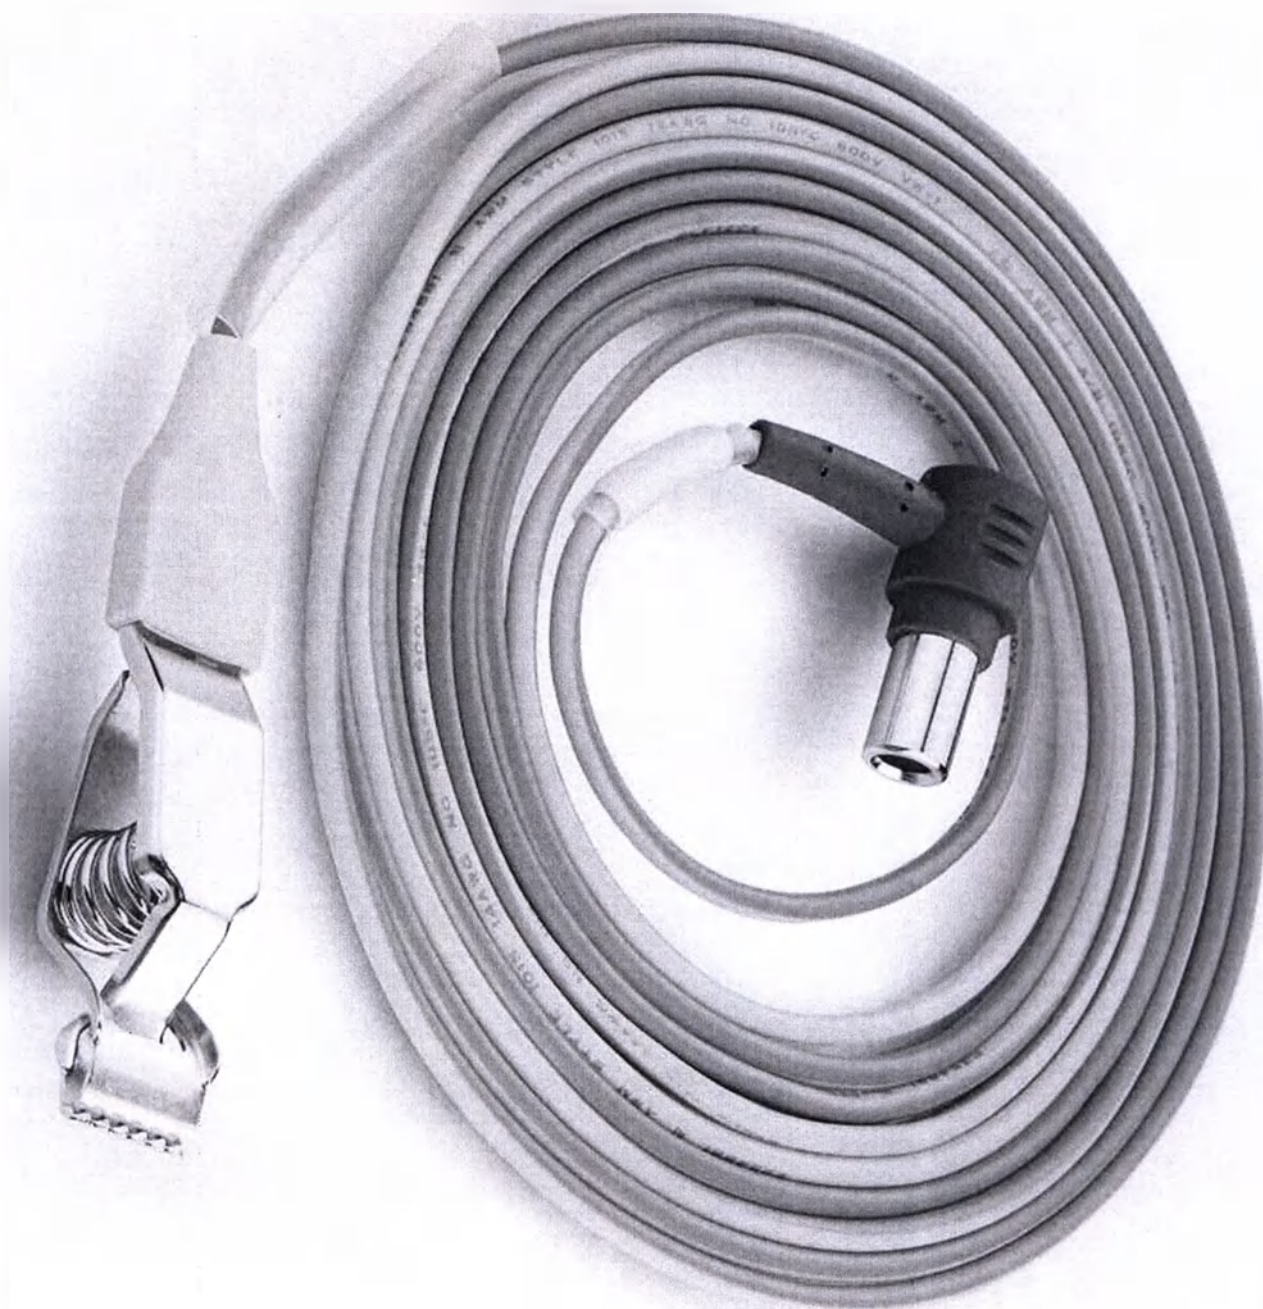


2.13. Биполярный пинцет изогнутый байонетный 15,2 см



2.14. Биполярный пинцет изогнутый байонетный 17,8 см.




2.15. Микрохирургический биполярный пинцет 9 см

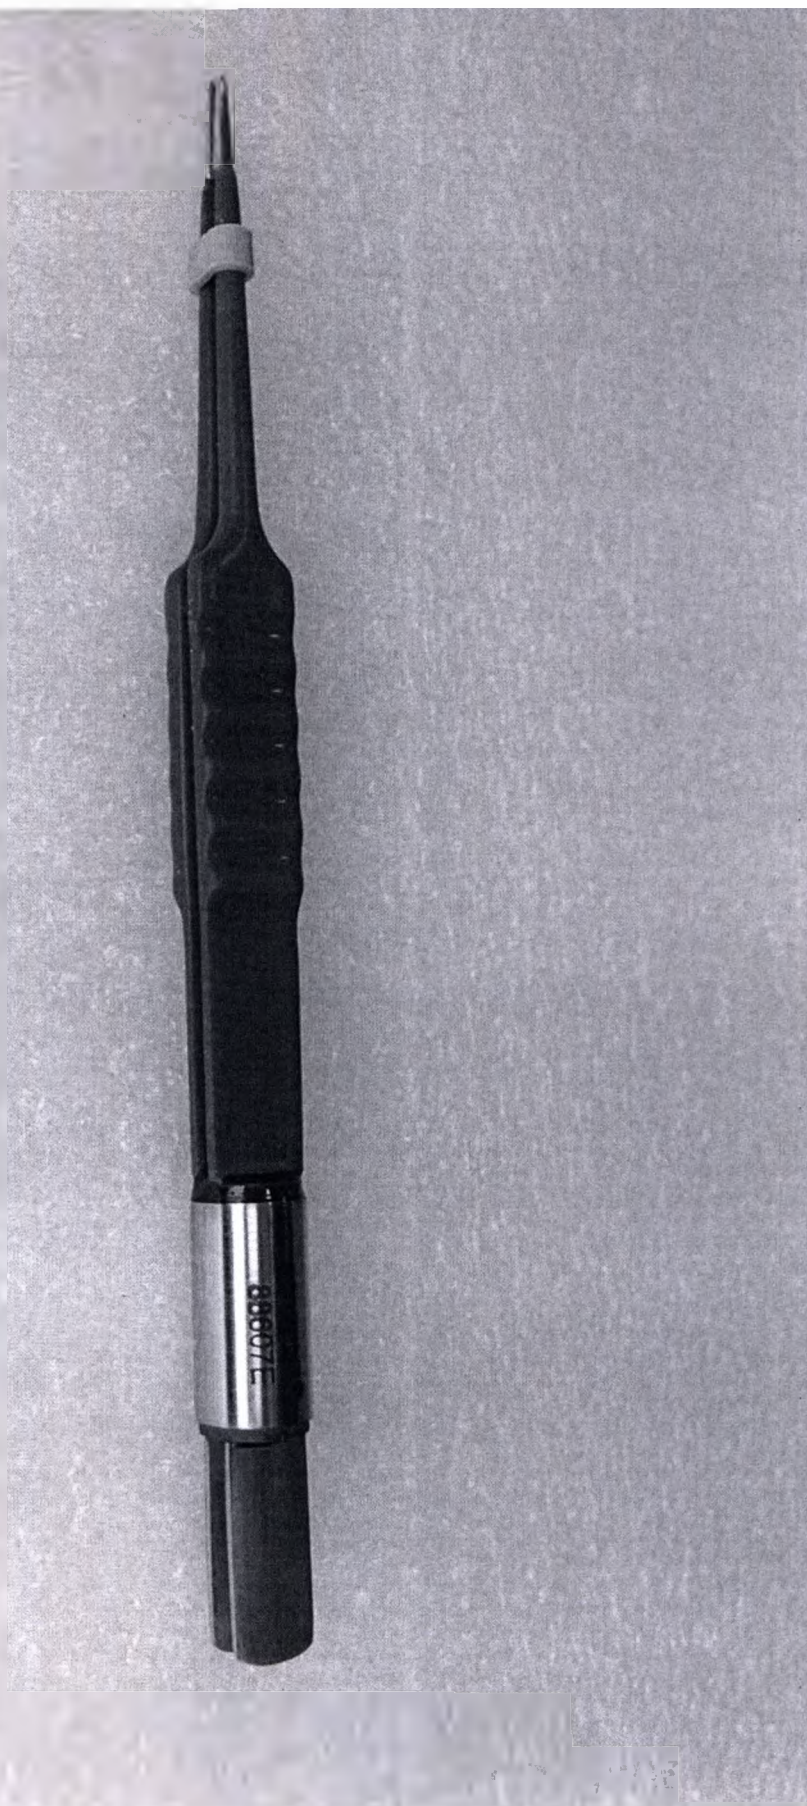

2.16. Микрохирургический биполярный пинцет с изогнутыми браншами 9 см



2.17. Биполярный пинцет прямой 12,1 см

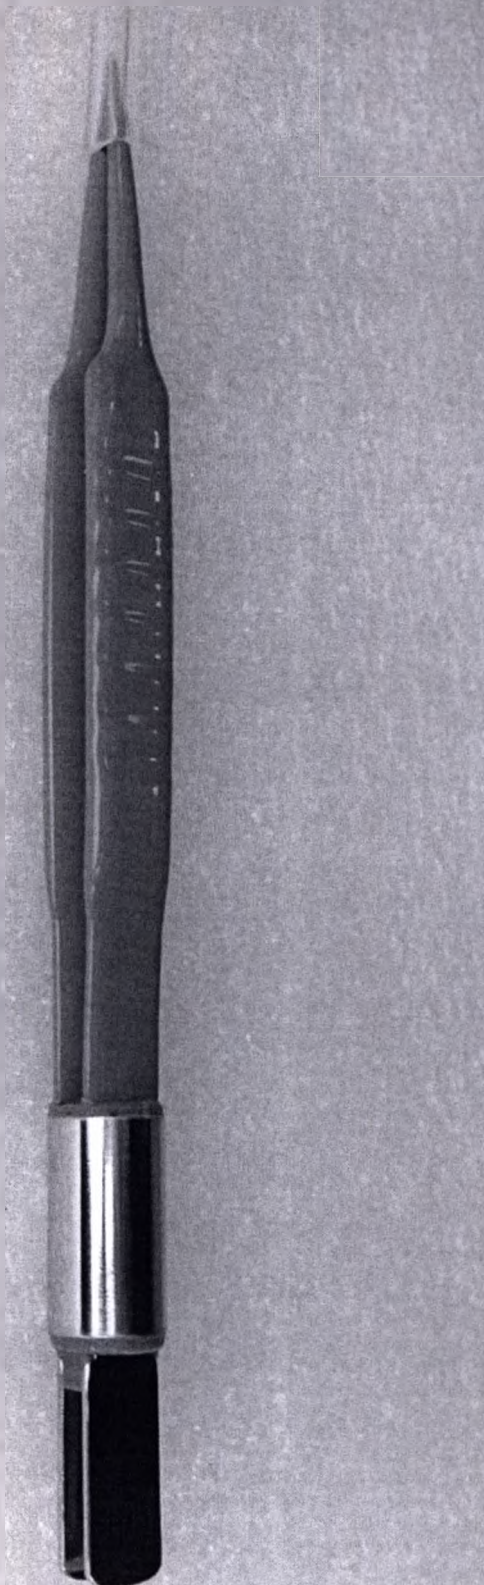


2.18. Биполярный пинцет прямой 17,8 см



2.19. Биполярный пинцет прямой с изогнутыми браншами 17,8 см



2.20. Тележка специальная

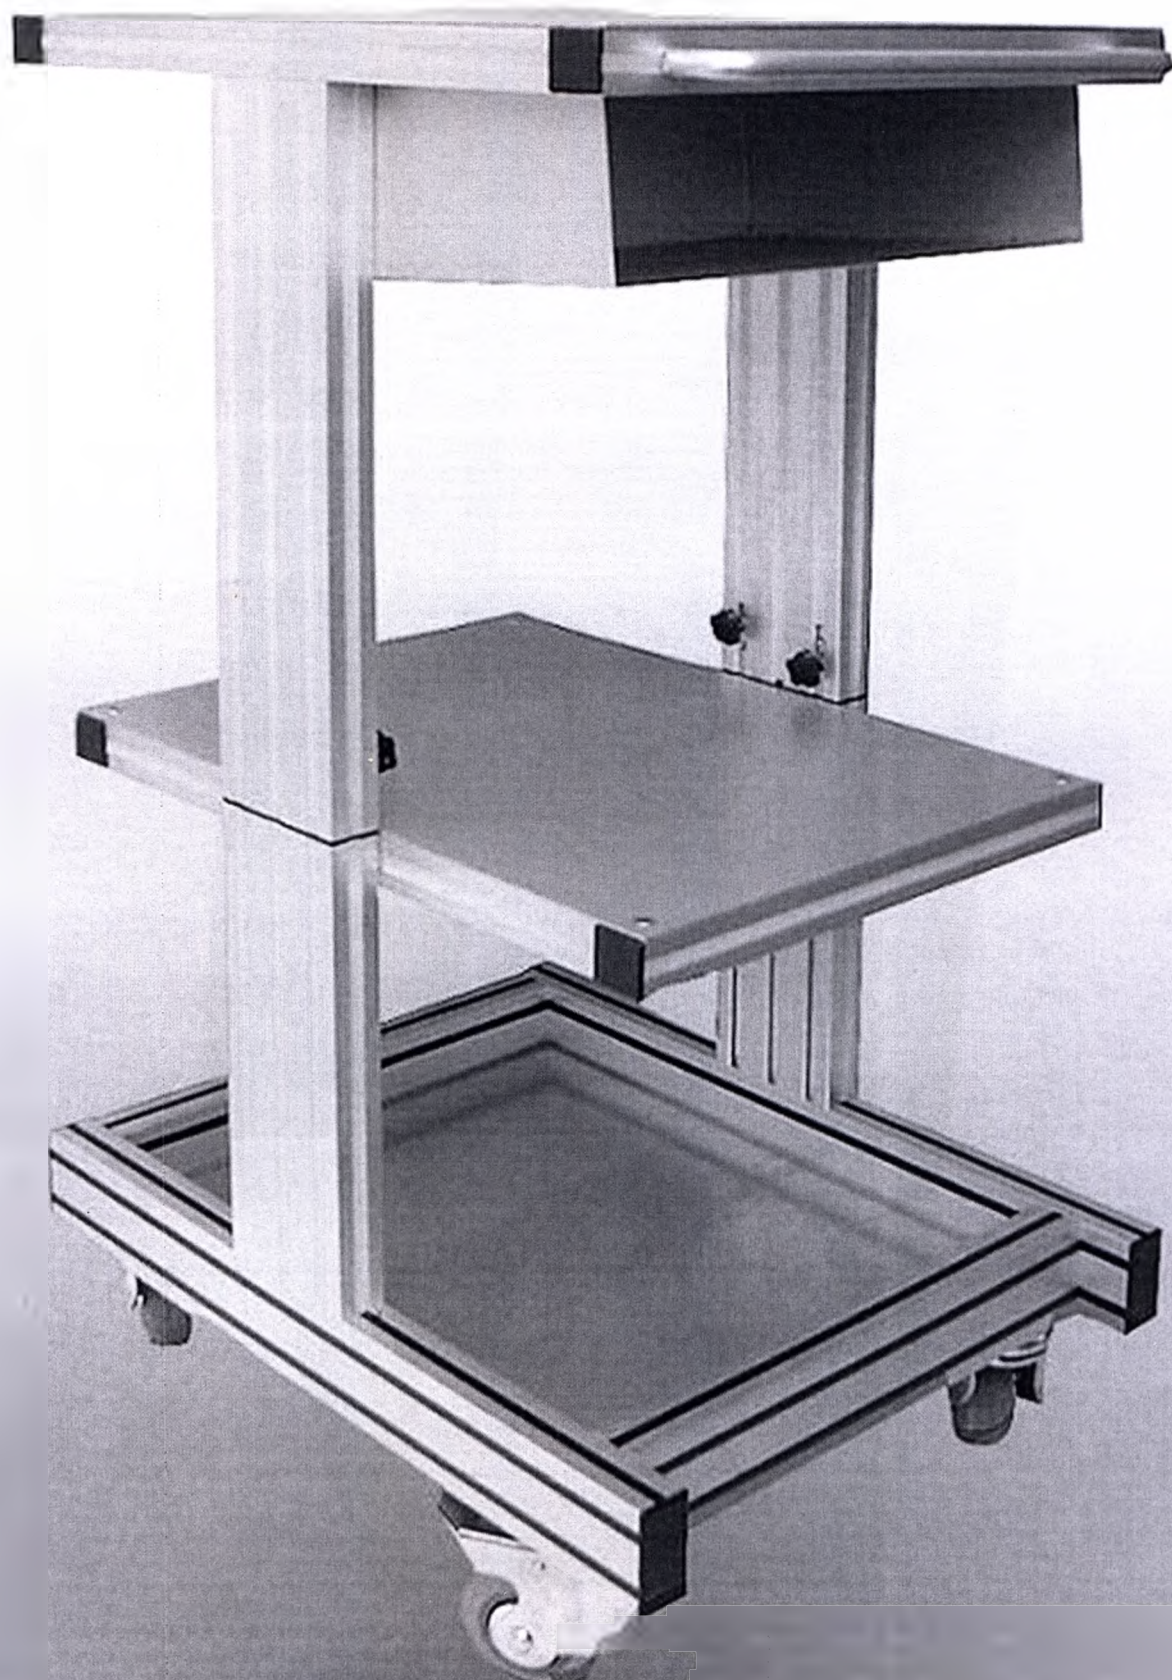

2.21. Аргонноплазменная приставка специальная





2.22. Педаль управления резанием/ковалция аргоном/лазменной приставки

2.23. Кабель ножного переключателя аргонноплазменной приставки



2.24. Монополярный кабель для аргонноплазменной приставки



2.25. Трубка кабеля с замками



2.26. Редуктор




2.27. Кабель датчика аргоноплазменной приставки



2.28. Датчик потока аргона в аргоноплазменной приставке



2.29. Баллон для аргоноплазменной приставки

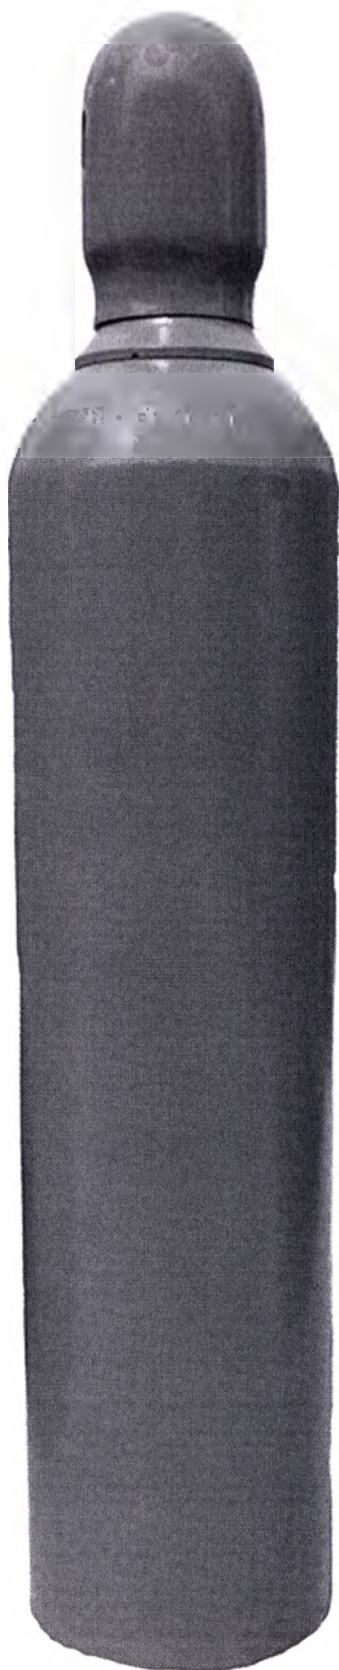

2.30. Держатель электродов для аргоноплазменной приставки



2.31. Электрод режущий аргоновый



2.32. Электрод игольчатый аргонный



2.33. Электрод коагулирующий аргоновый



ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
12 ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «МТО Стормовь»
Стрекалов И. А.

