

Фотографические изображения медицинского изделия

**«Анализатор гематологический автоматический
HumaCount для лабораторных исследований
in vitro с принадлежностями»**


Производства


HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

**(Хуман Гезельшафт фюр Биохемика унд
Диагностика мбХ)**


Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия)

Анализатор гематологический автоматический HumaCount для лабораторных исследований in vitro, вариант исполнения: HumaCount 30TS

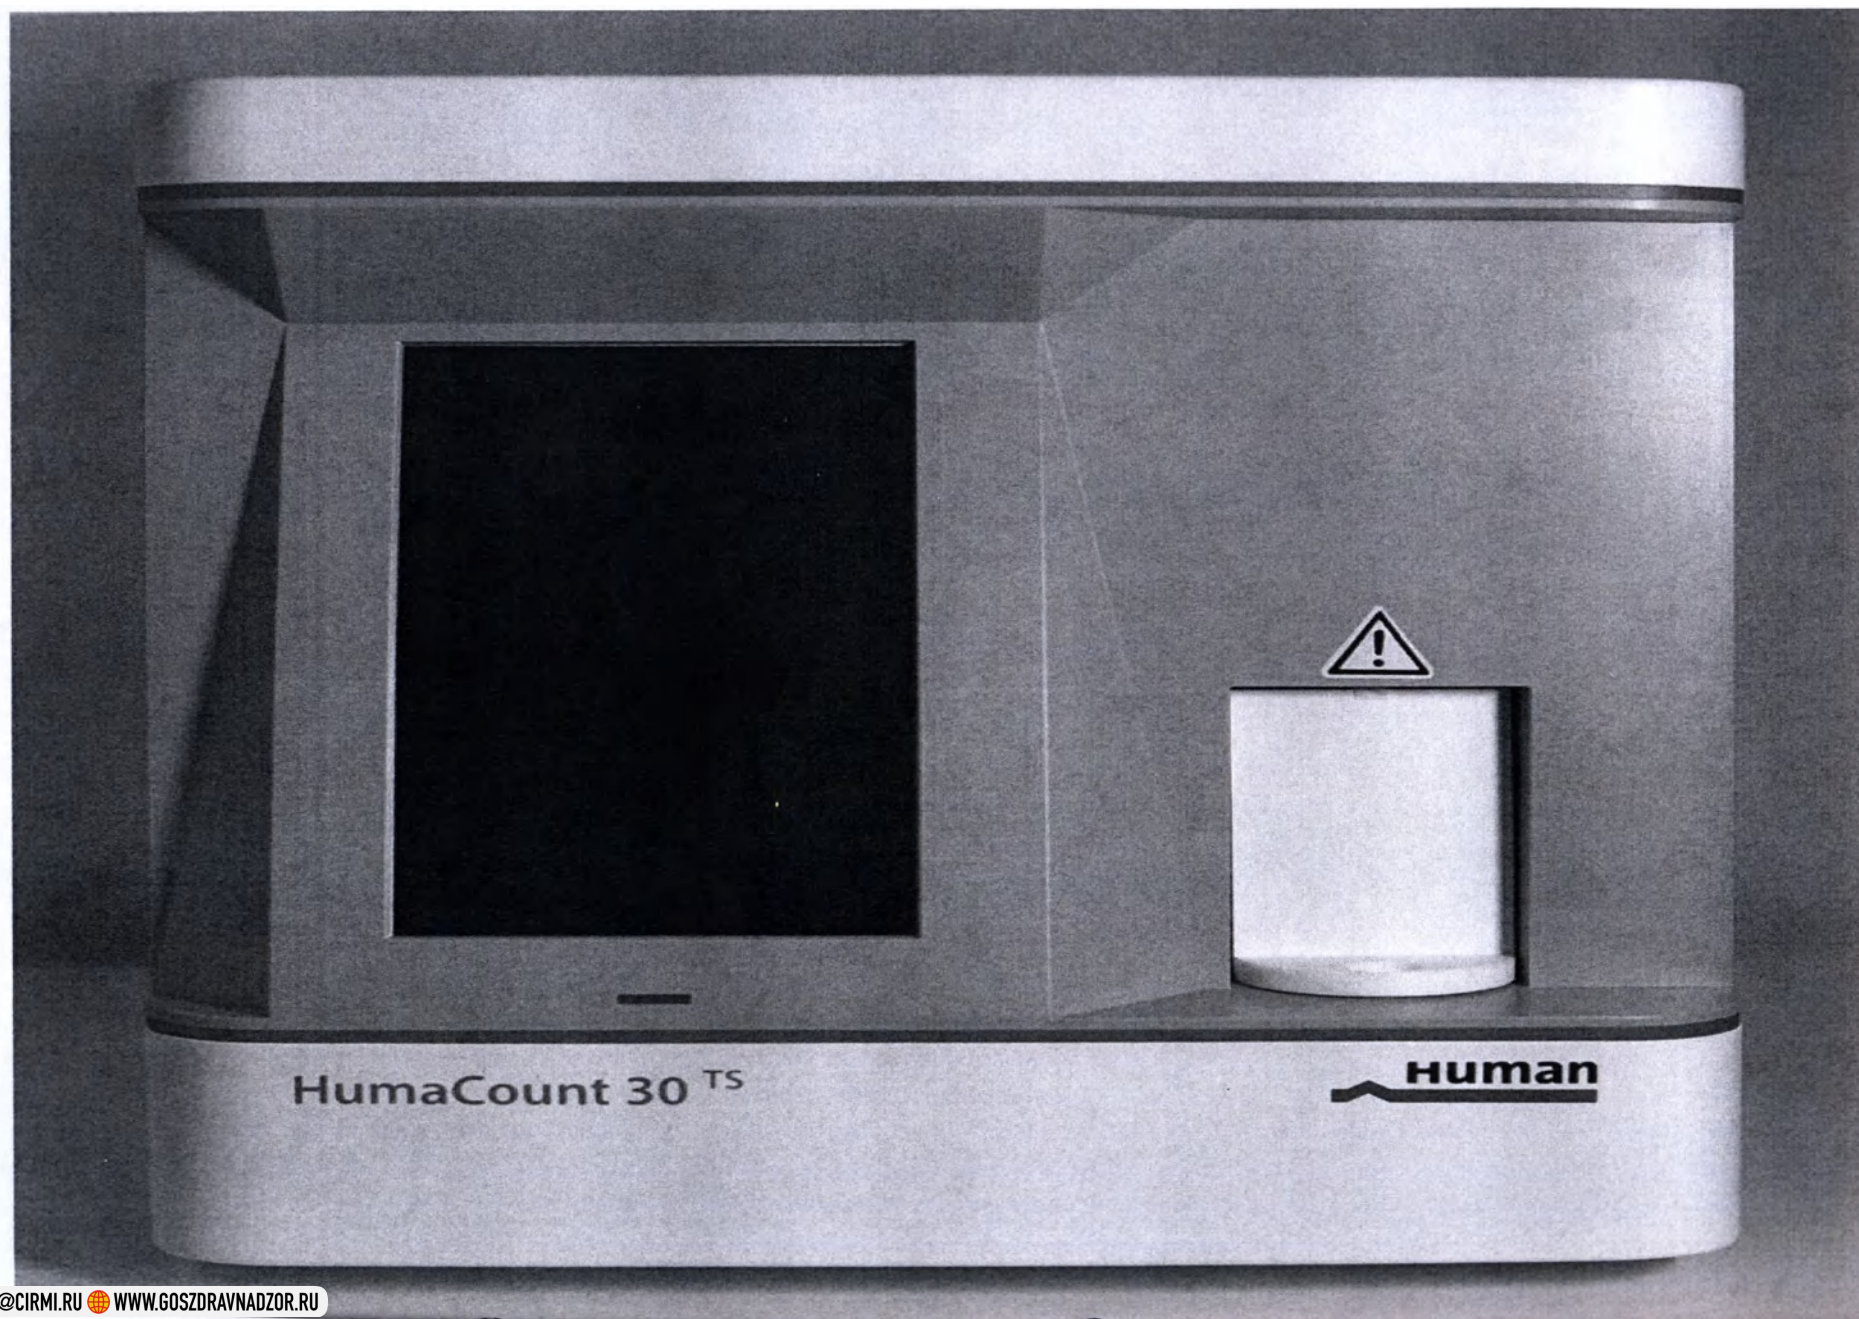


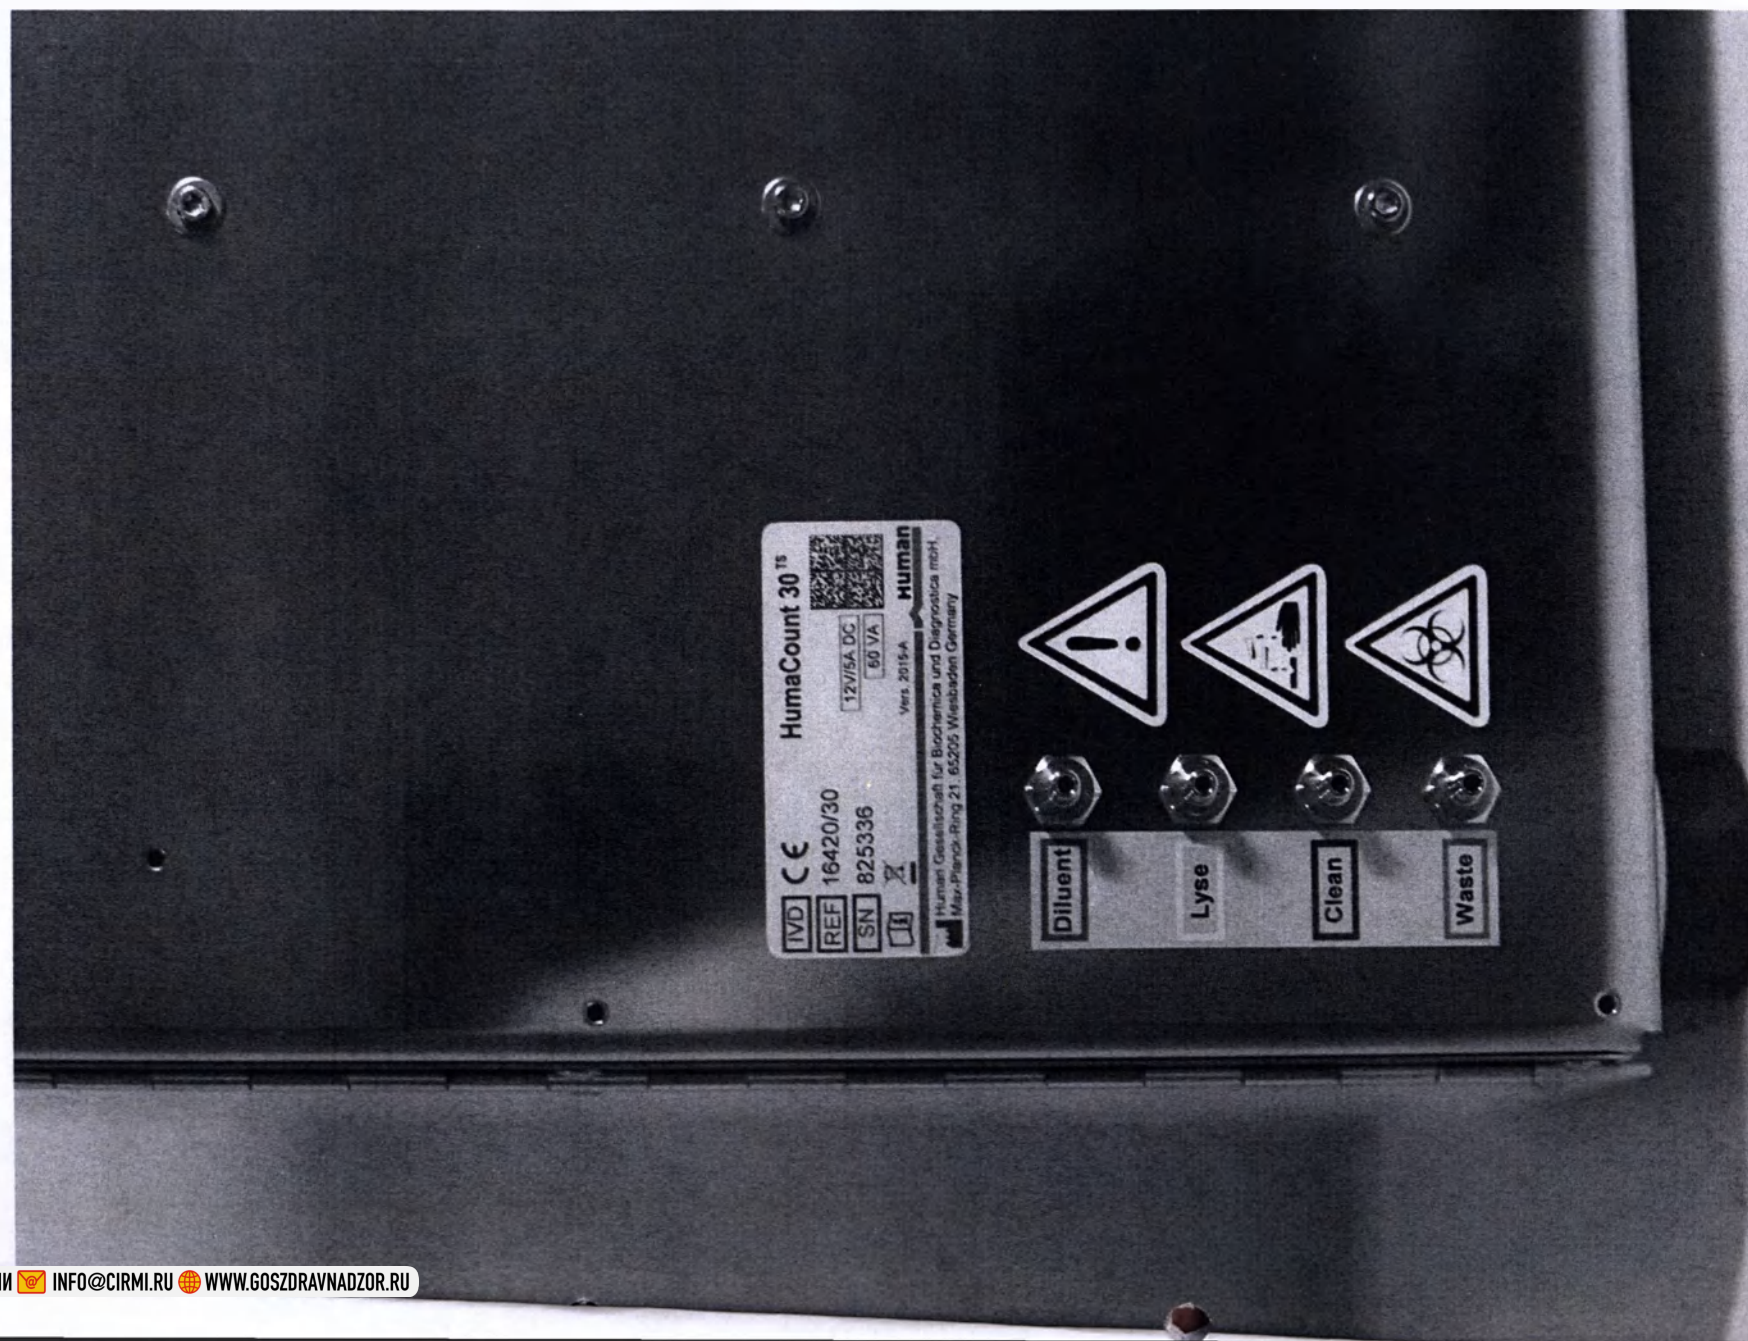


Анализатор гематологический автоматический HumaCount для лабораторных исследований in vitro, вариант исполнения: HumaCount 80TS

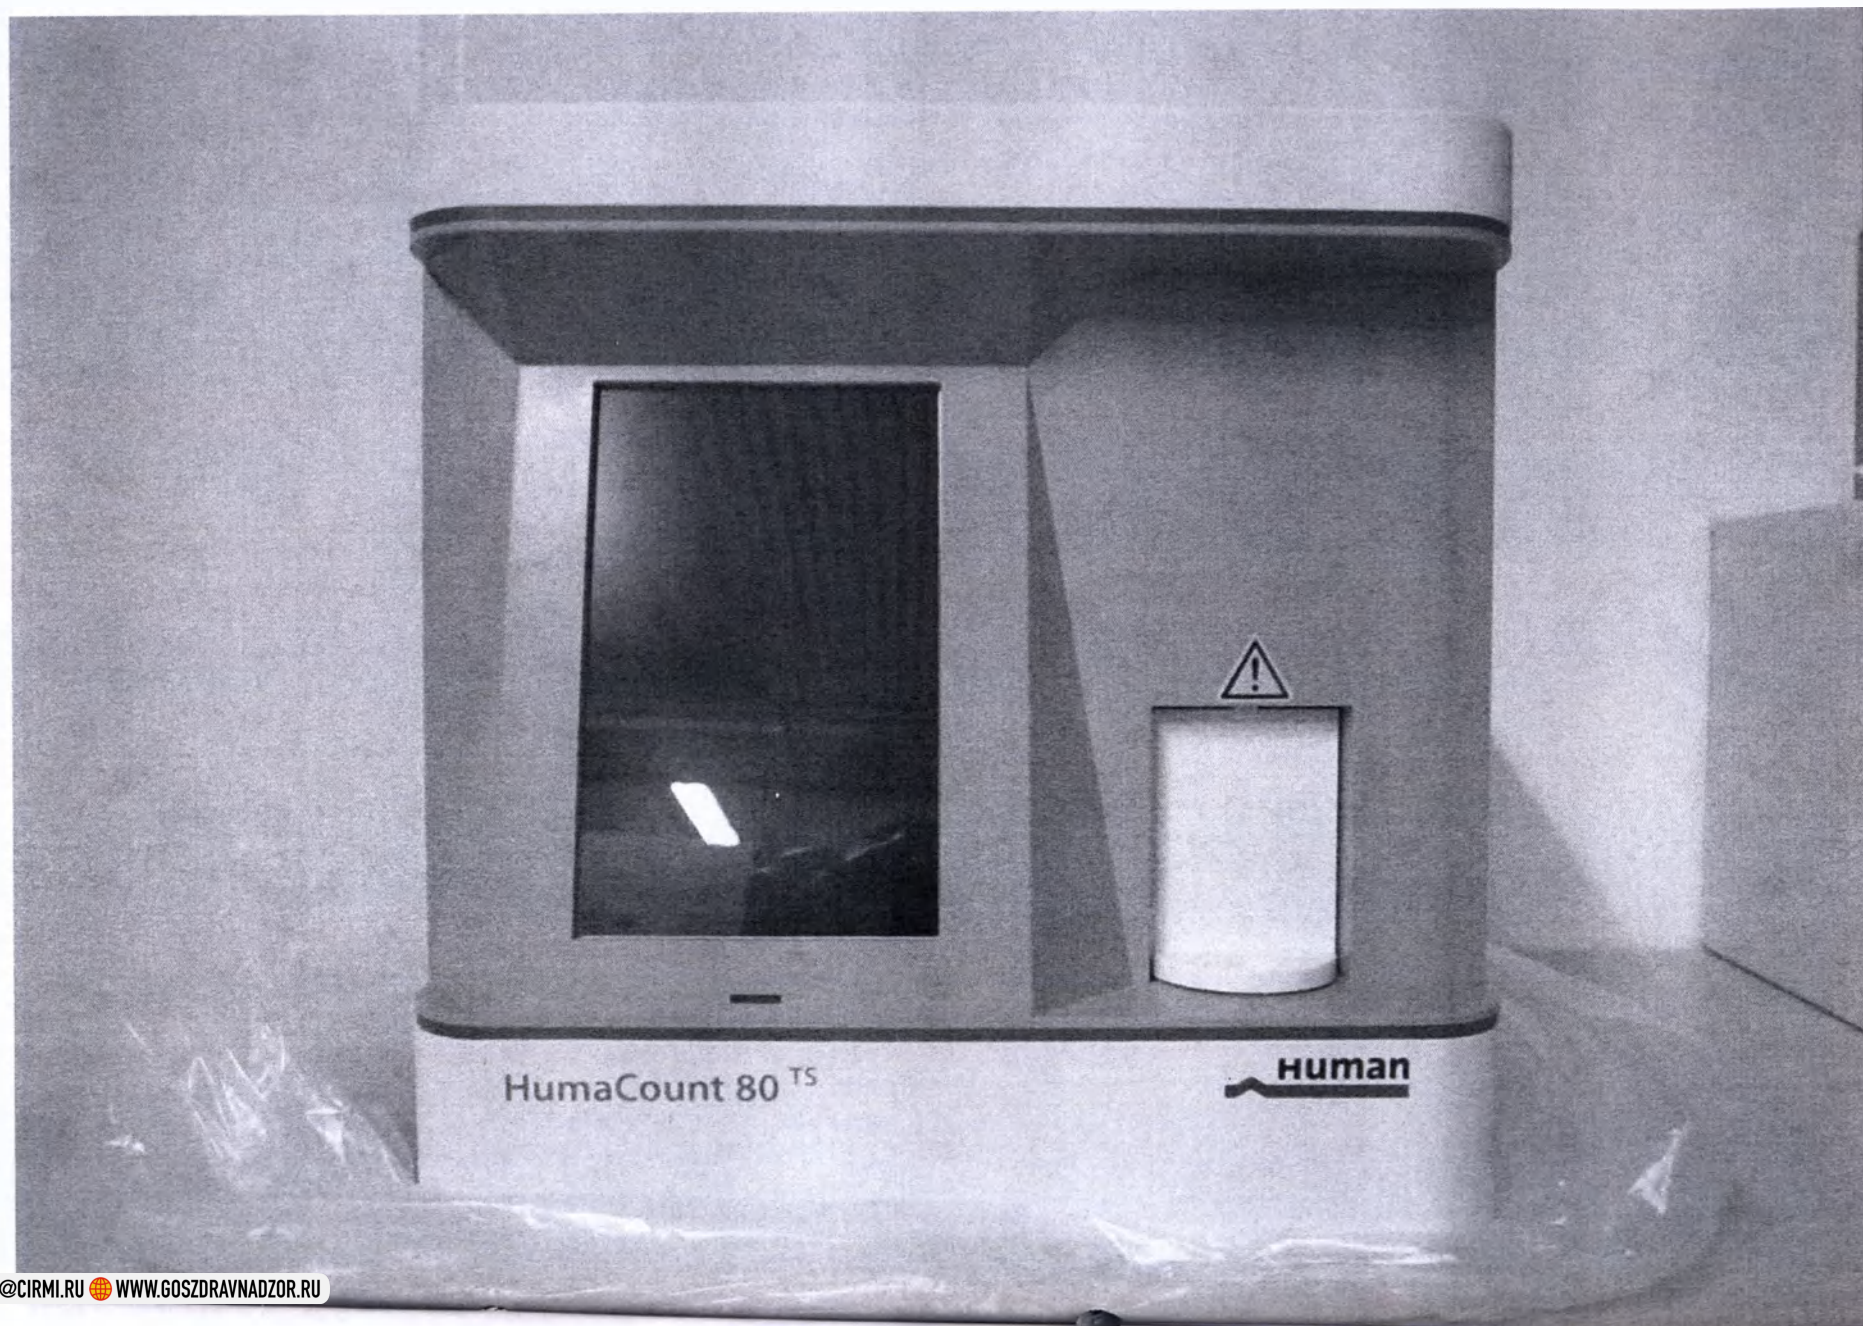


Анализатор гематологический автоматический HumaCount для лабораторных исследований *in vitro*, вариант исполнения: HumaCount 80TS

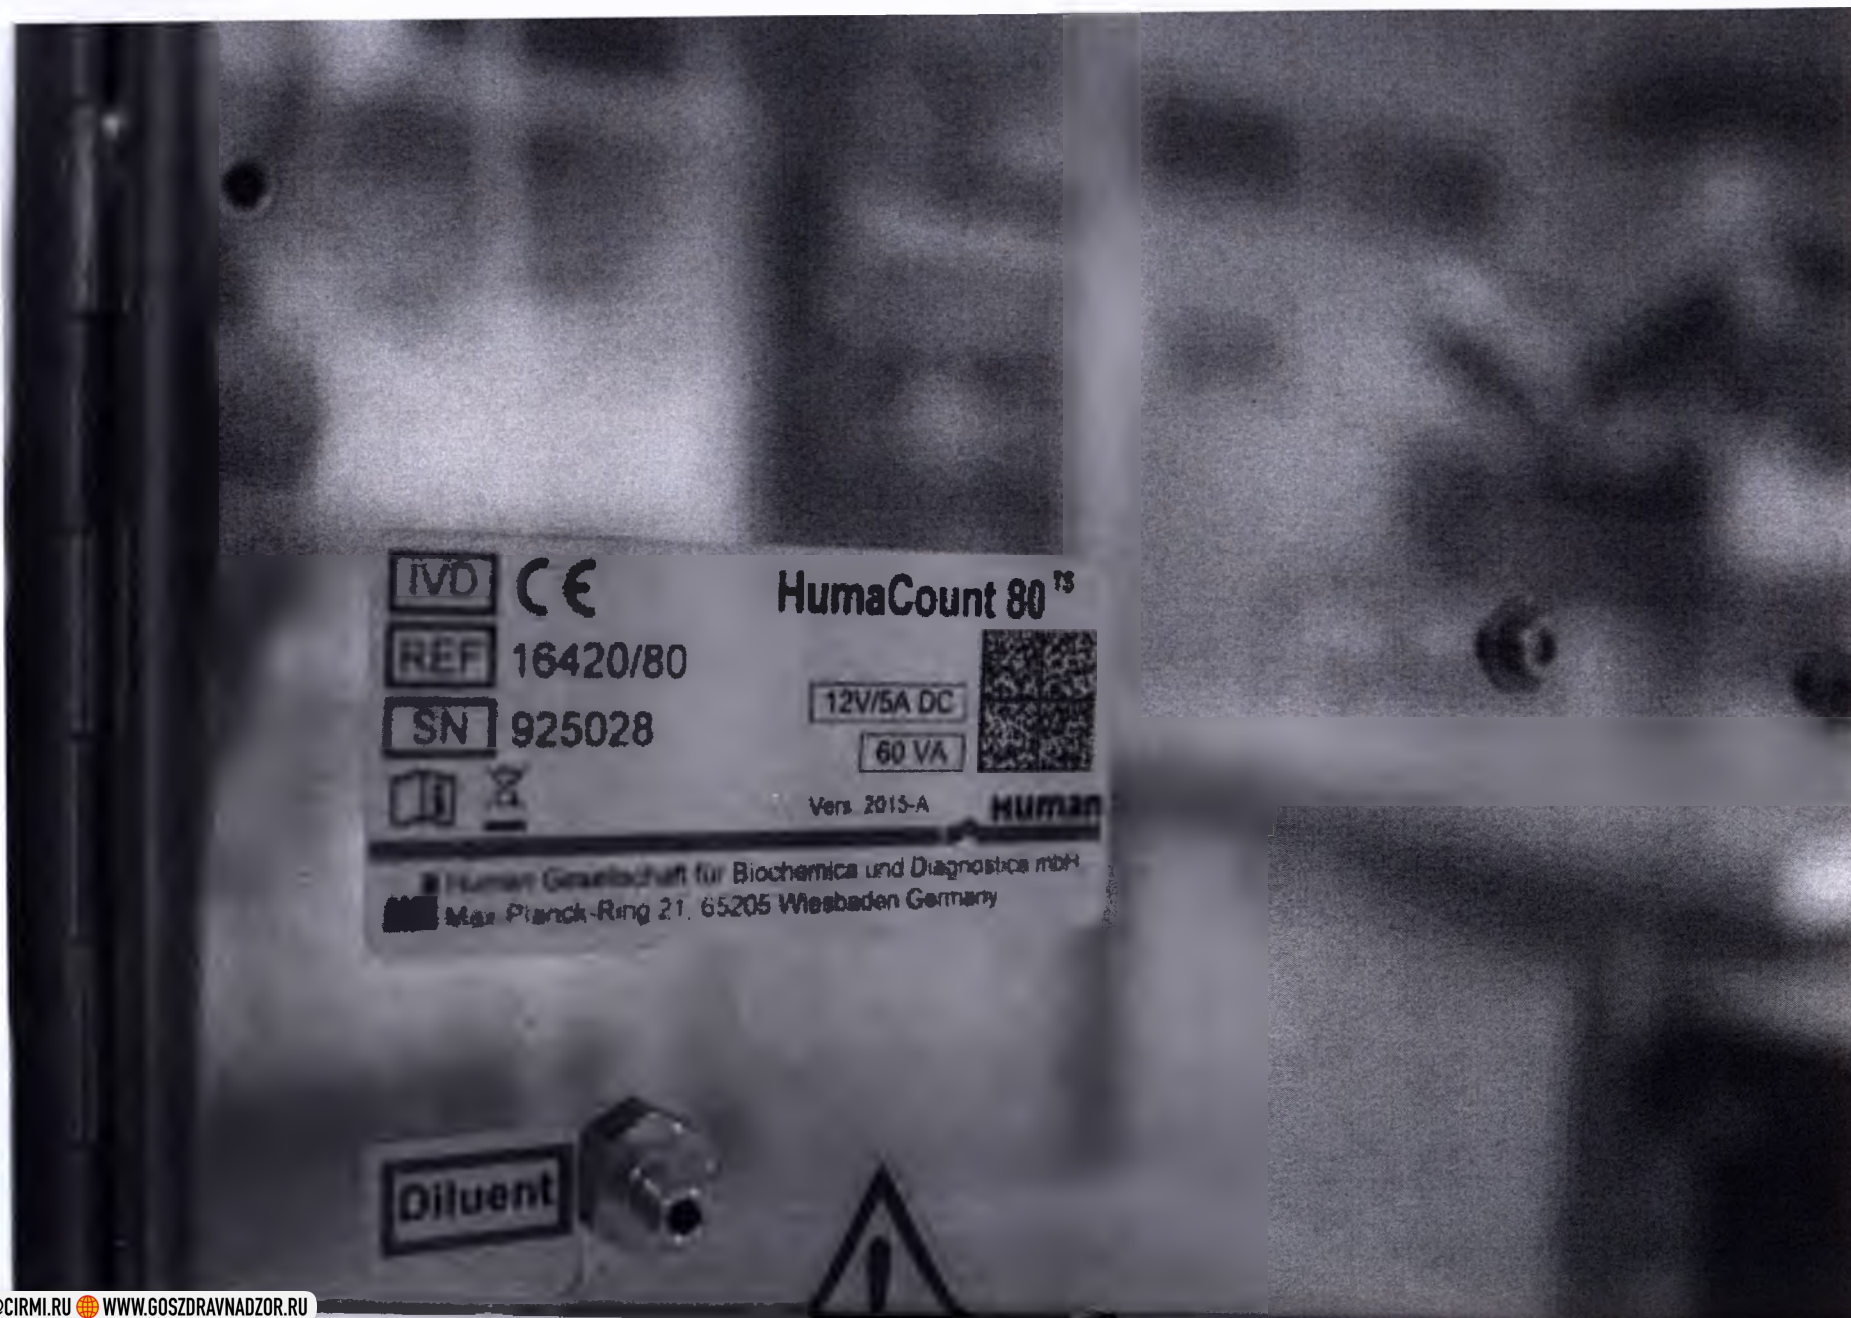


Адаптер питания с кабелем

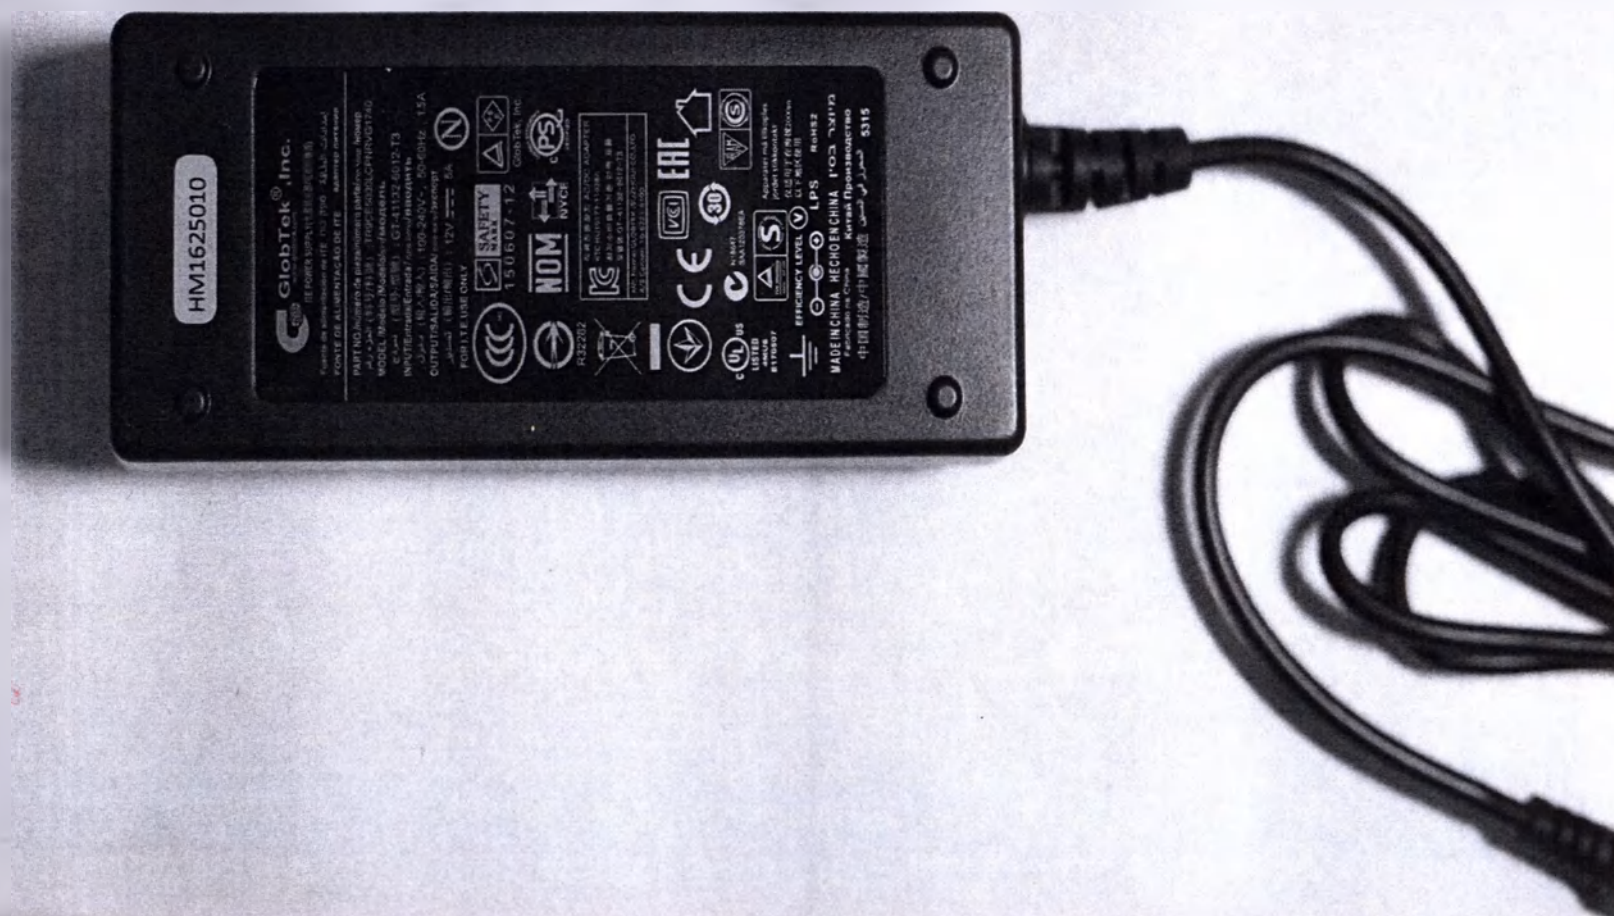


Кабель питания

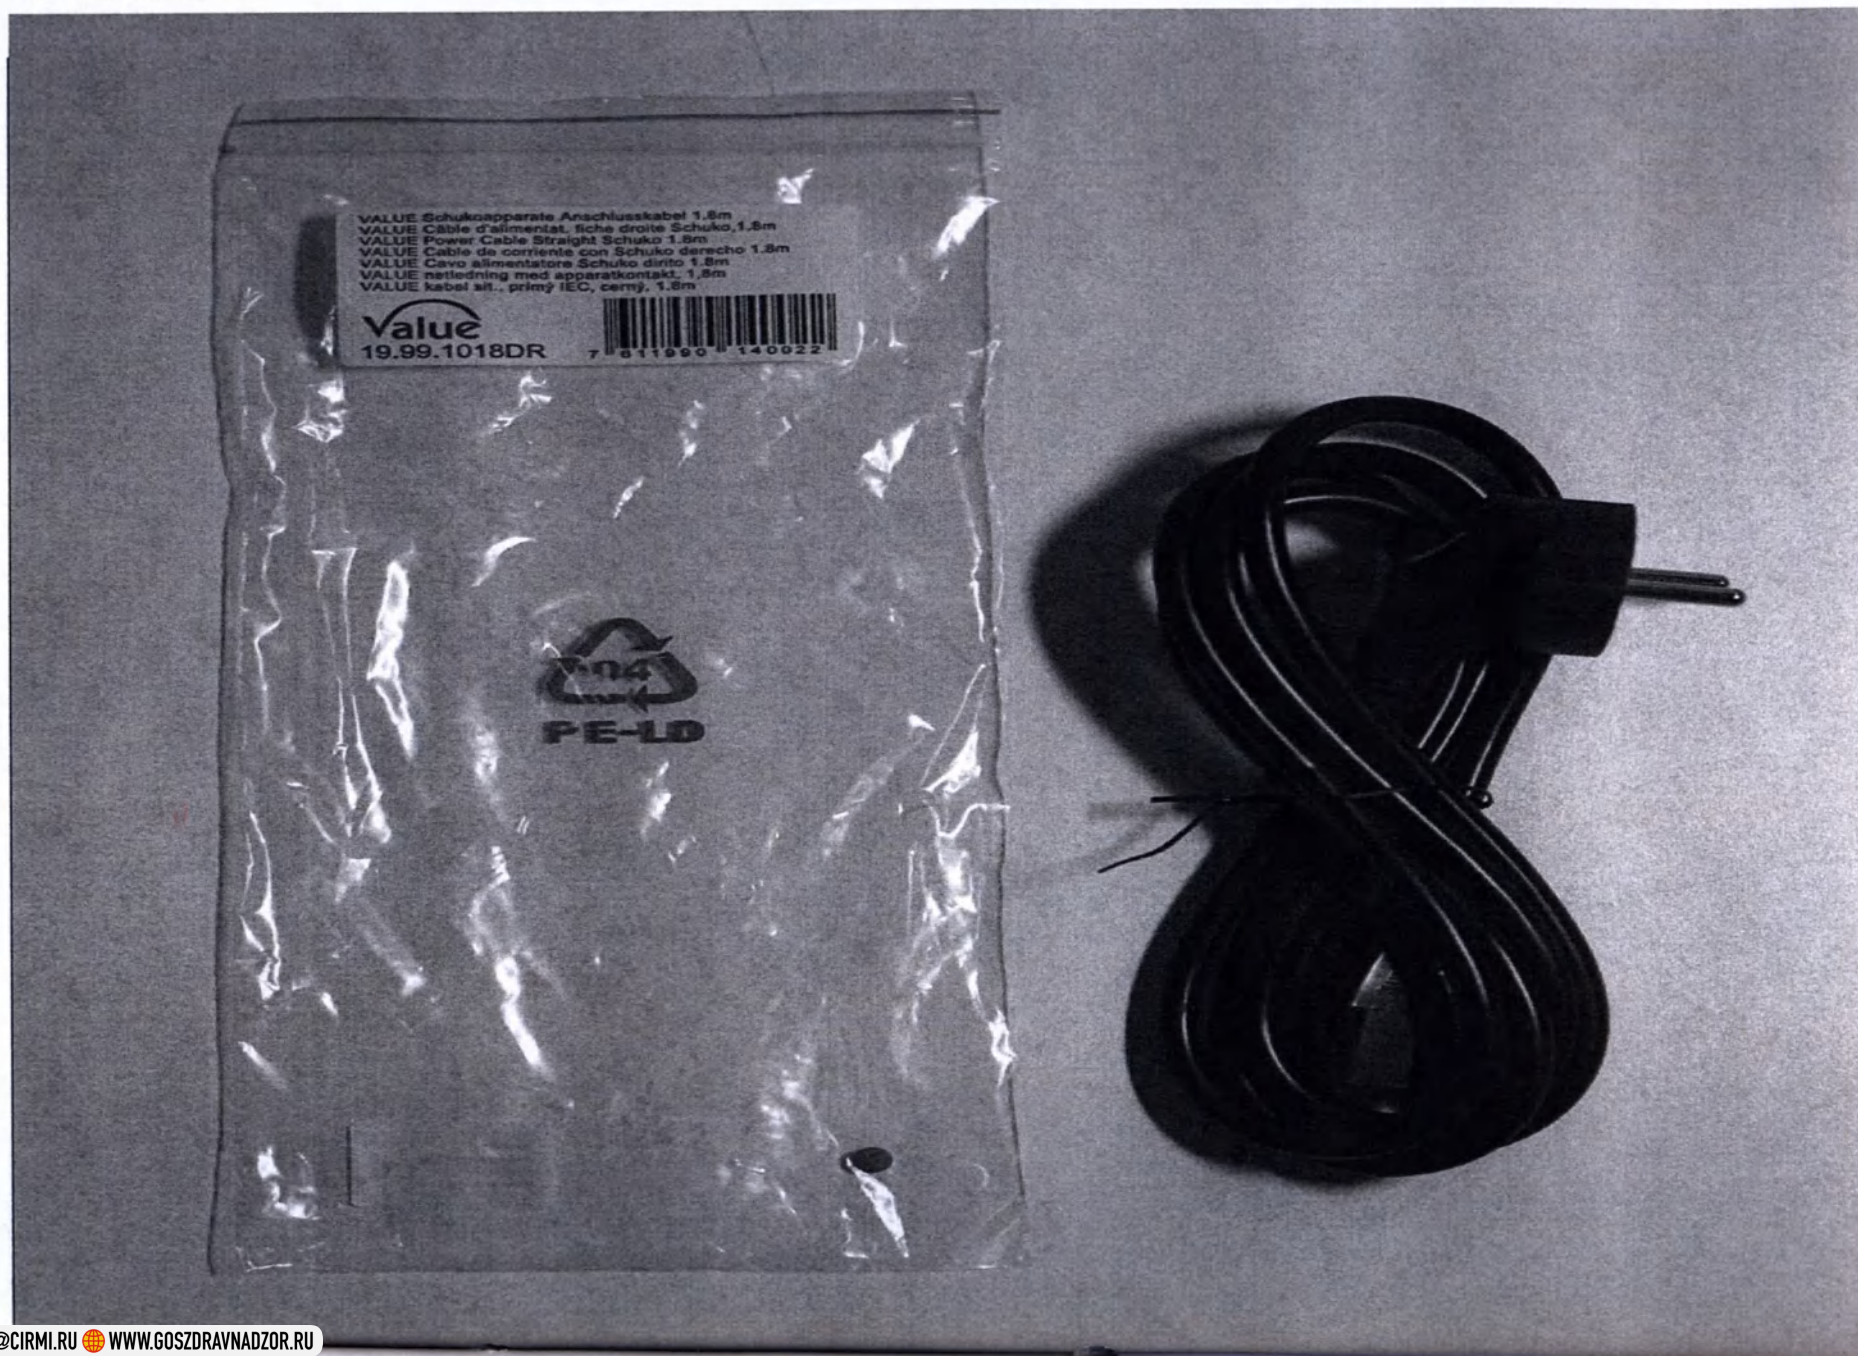


Набор трубок для подключения реагентов: трубка для разбавителя; трубка для лизирующего реагента; трубка для очищающего реагента; трубки для слива (2 шт.); трубка с отводами для очистки

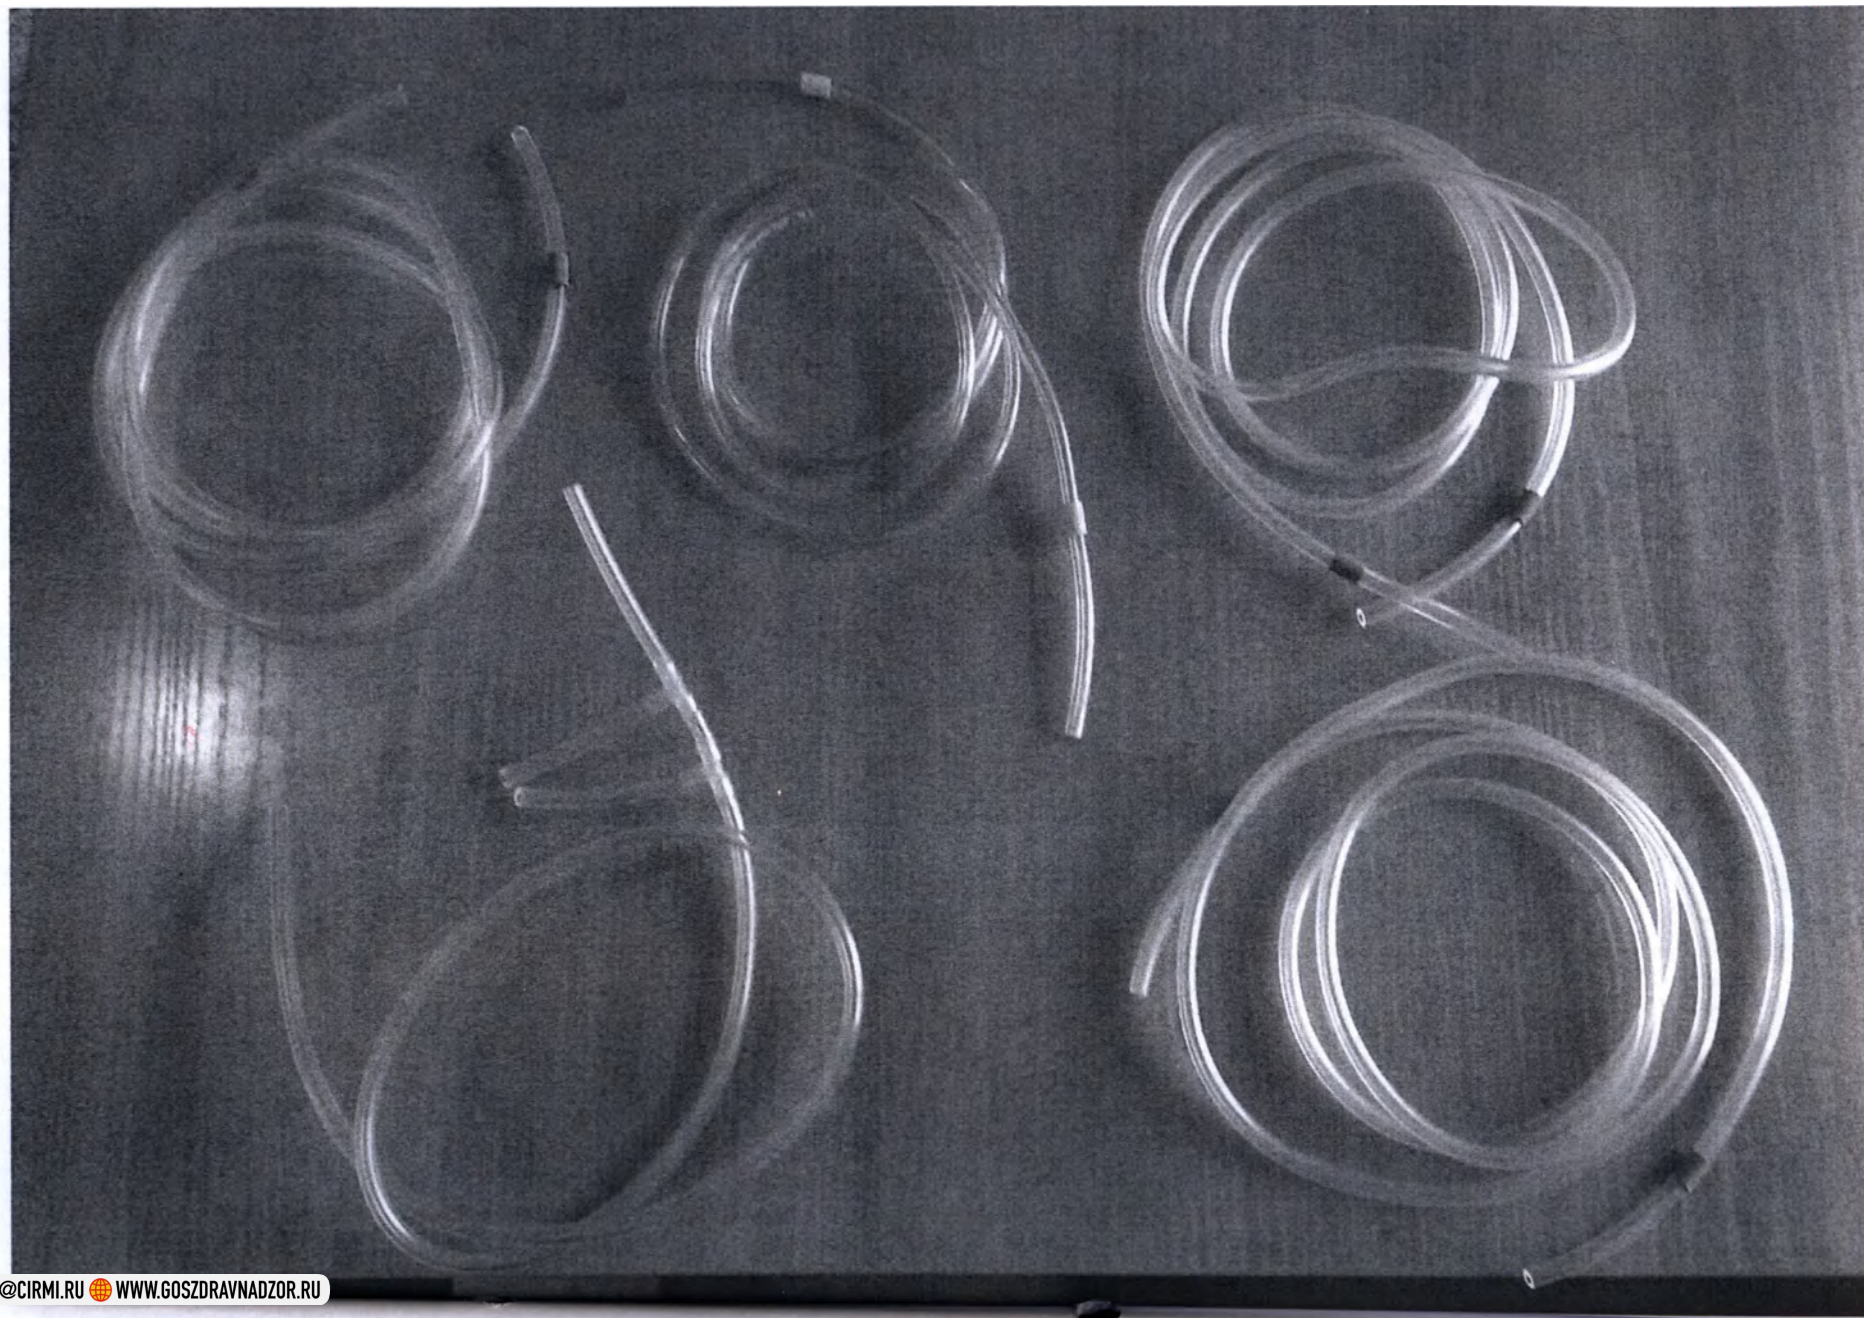


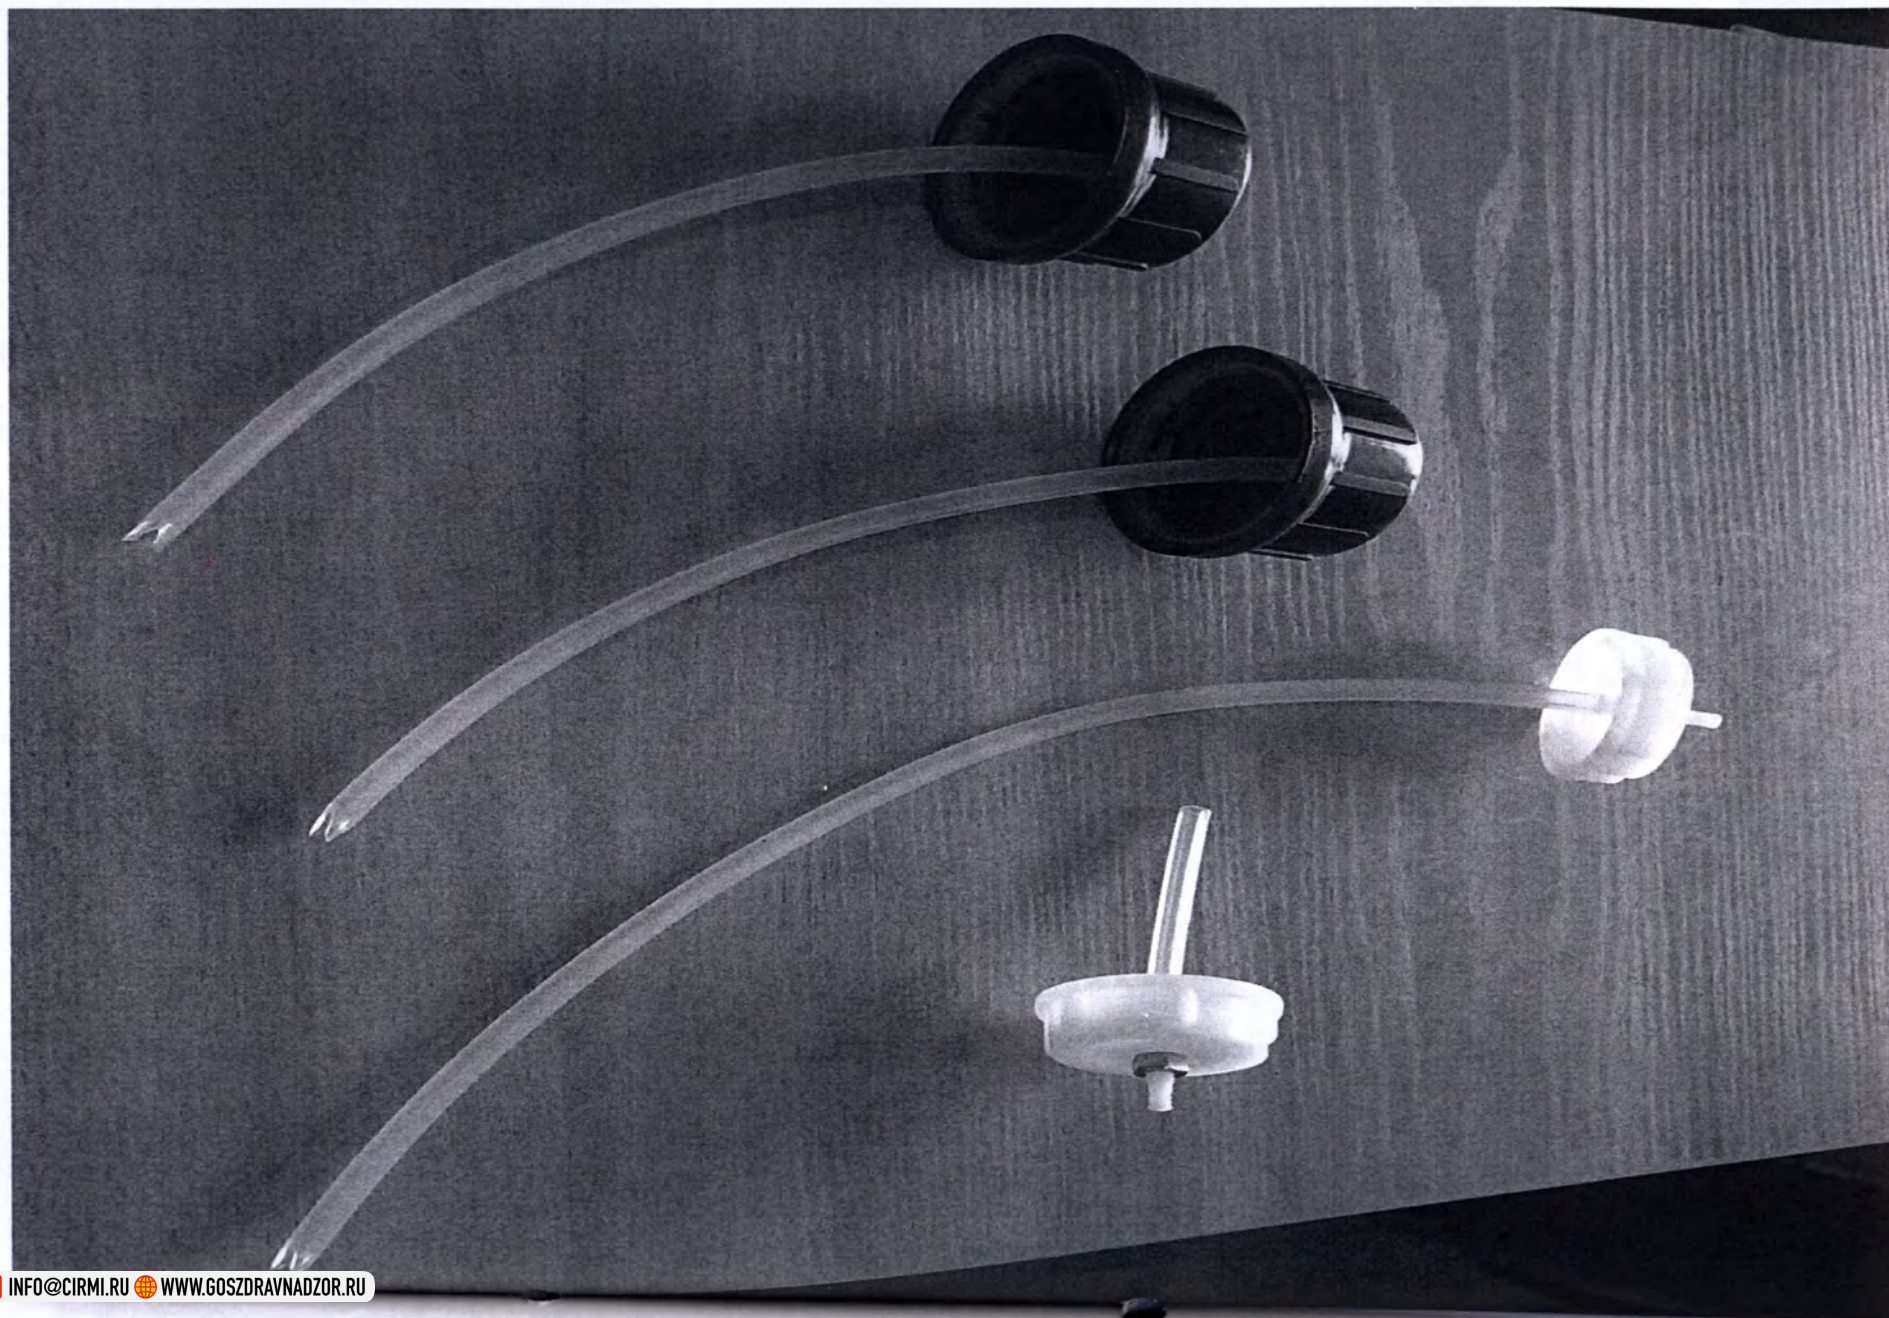

Адаптеры для пробирок , прокладки для адаптеров

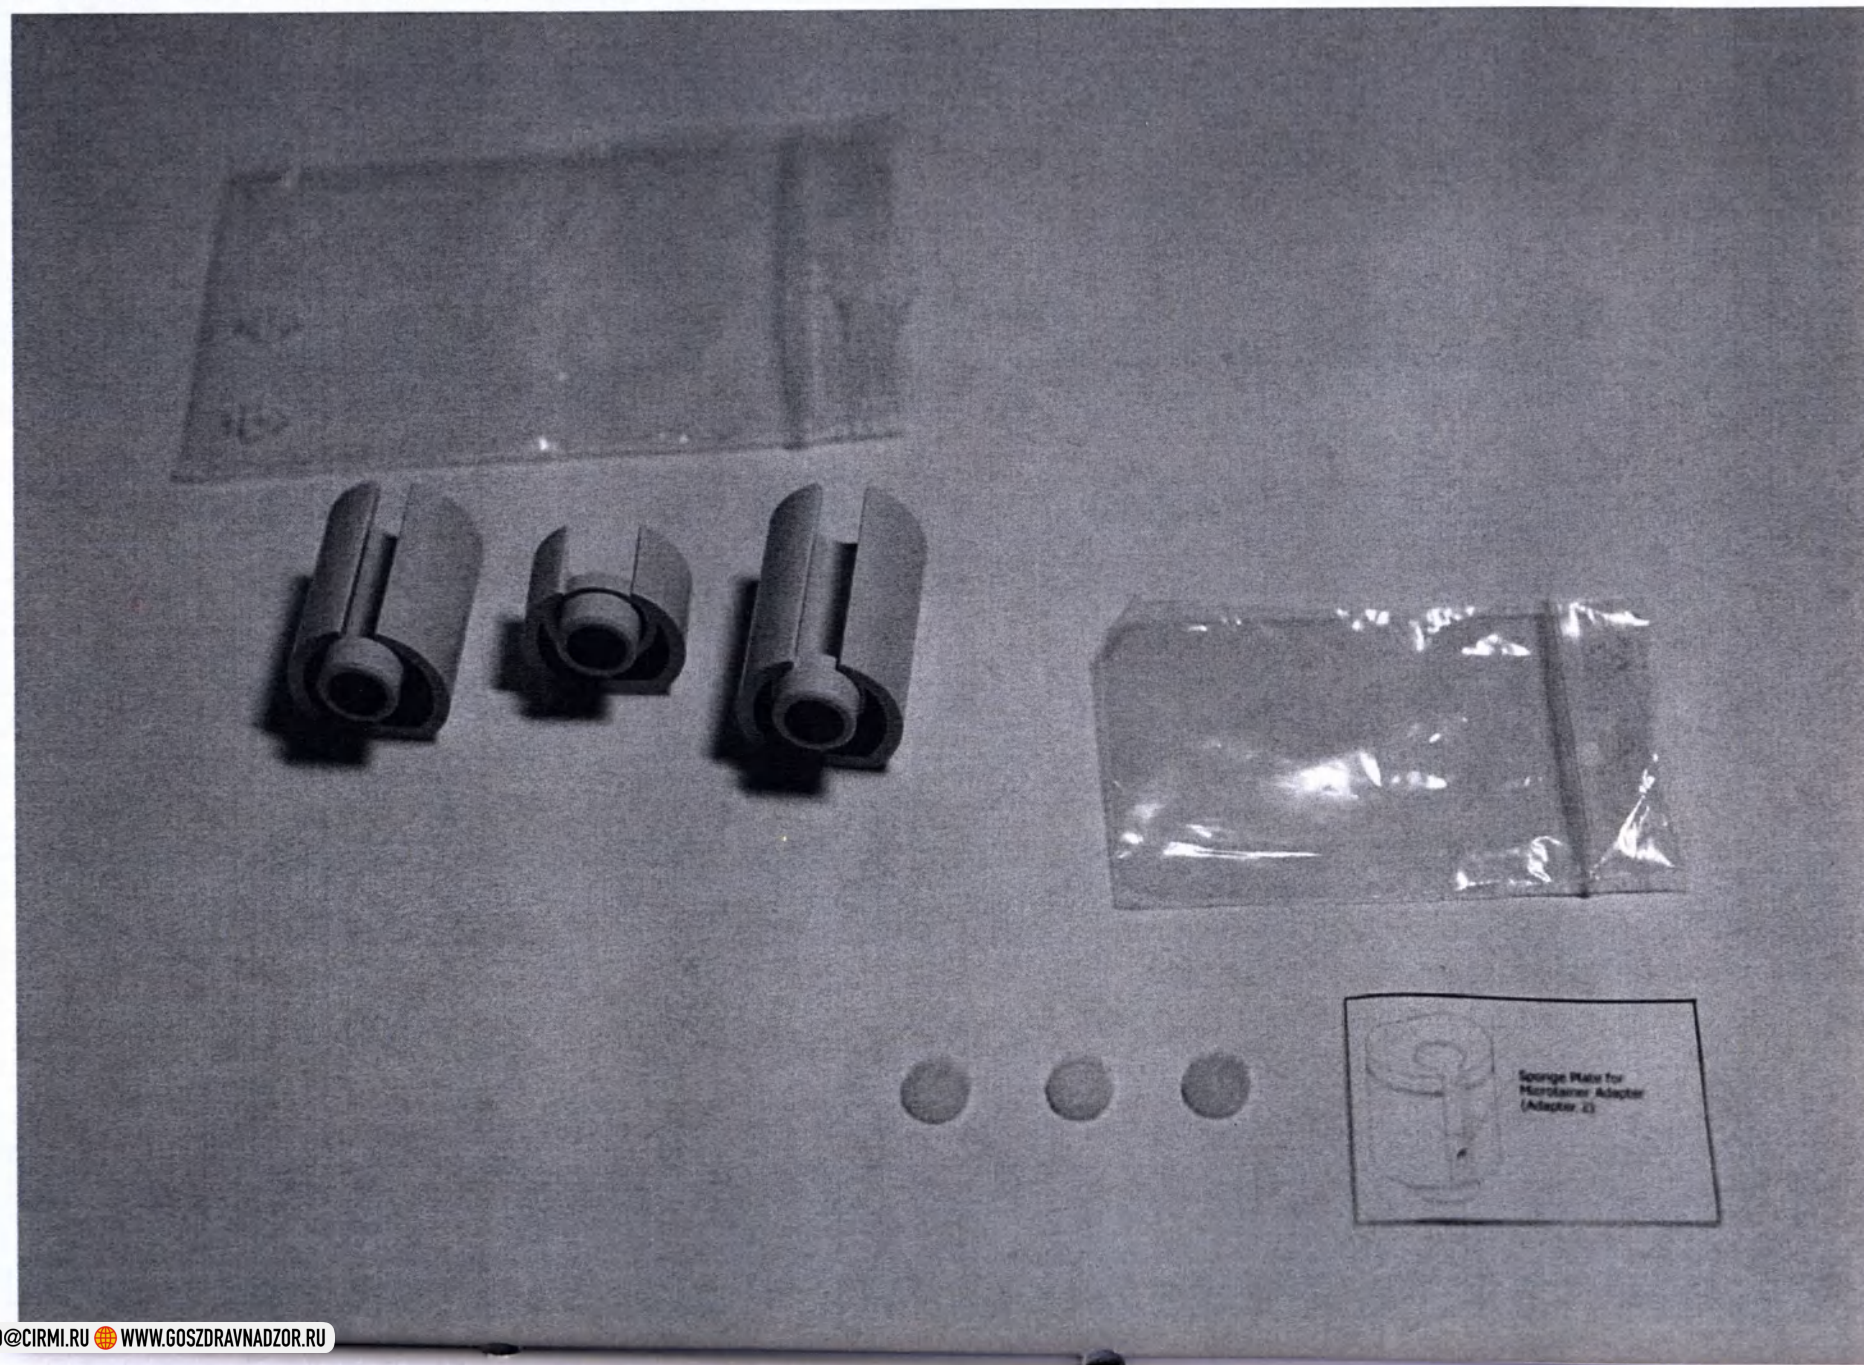


Бумага для термопринтера

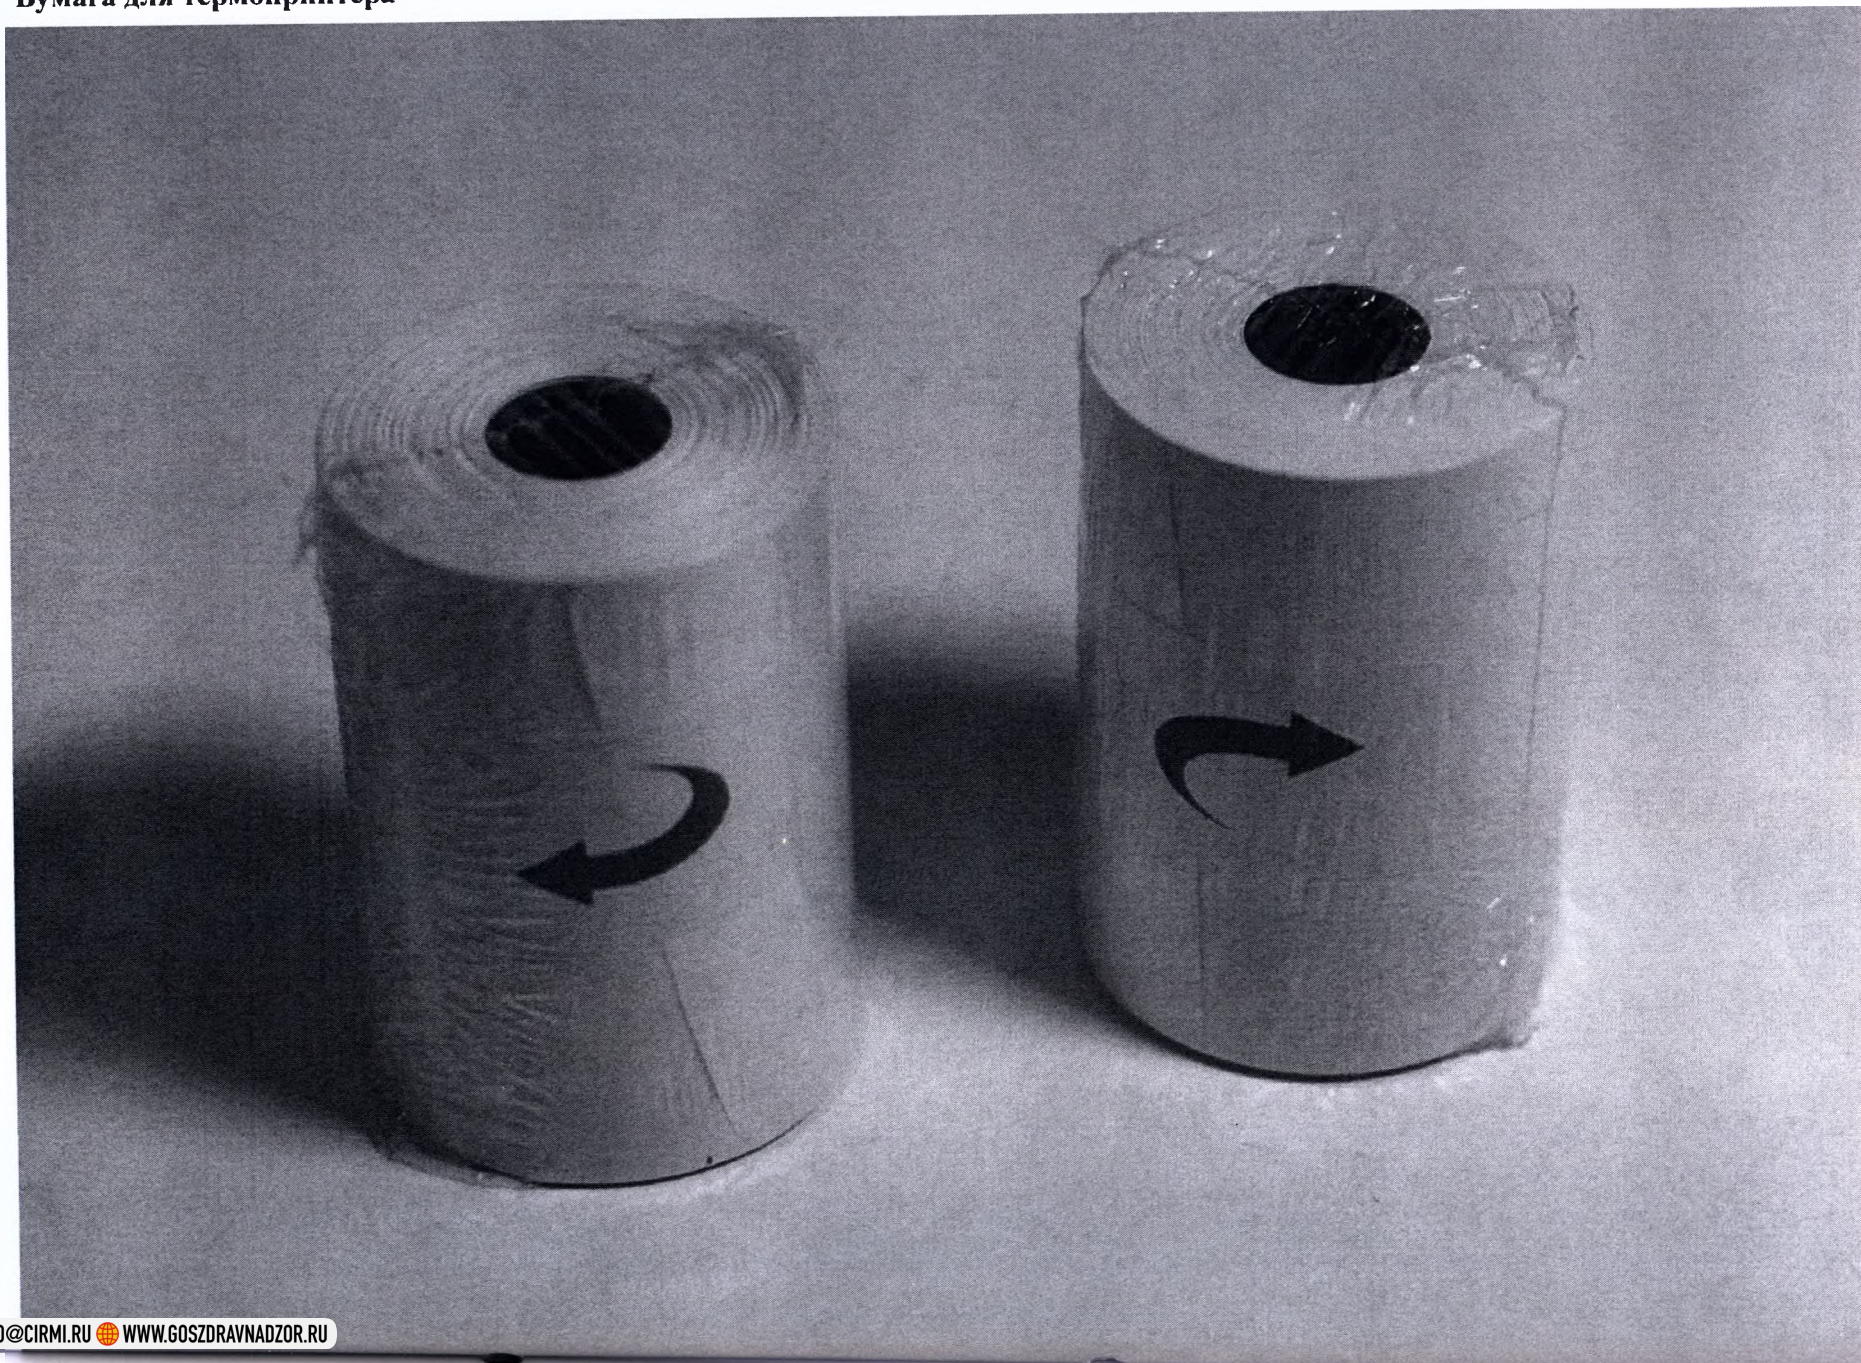


Сливная емкость.



Сканер штрихкодов

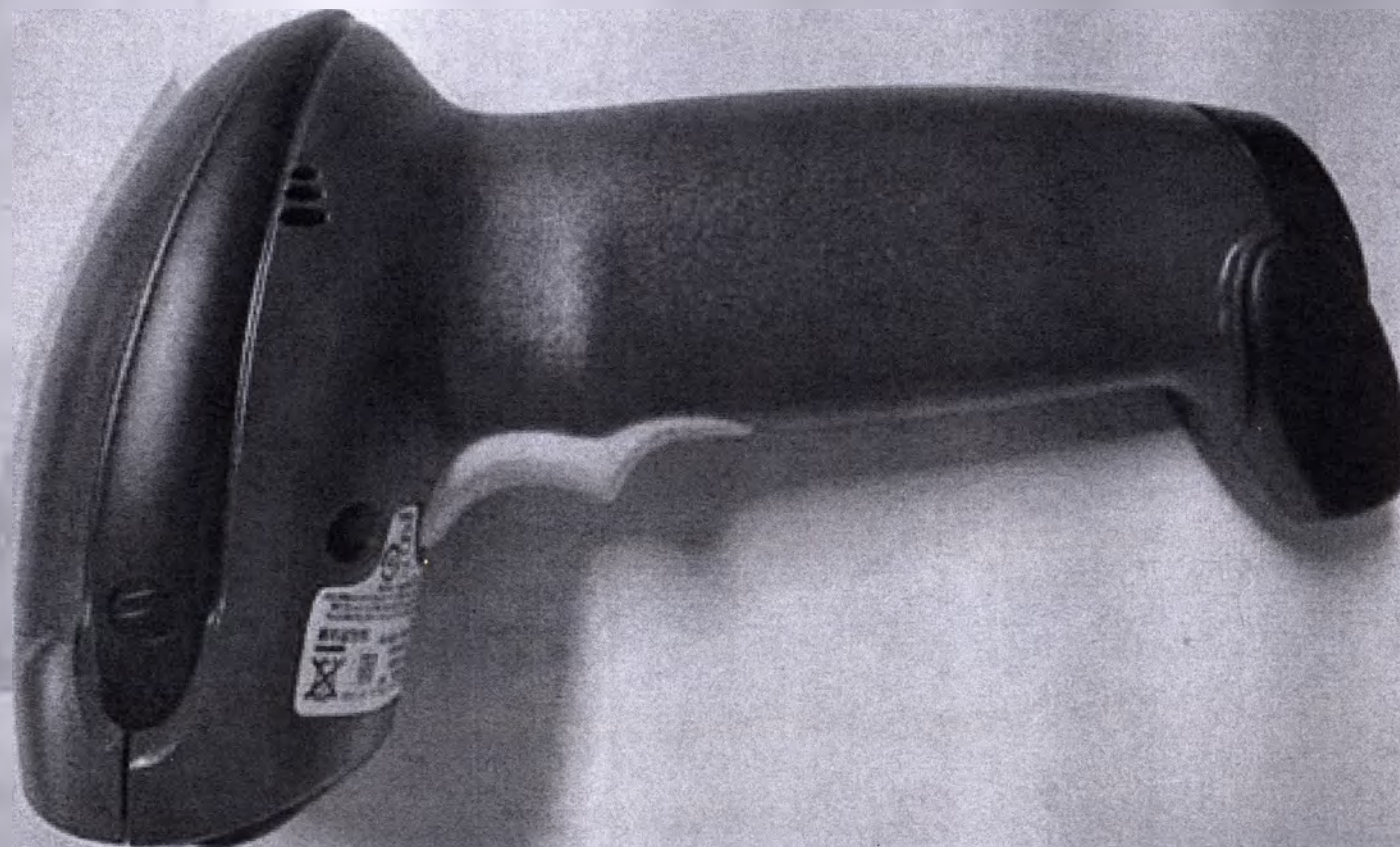



Сканер штрих-кодов и кабель. Упаковка.

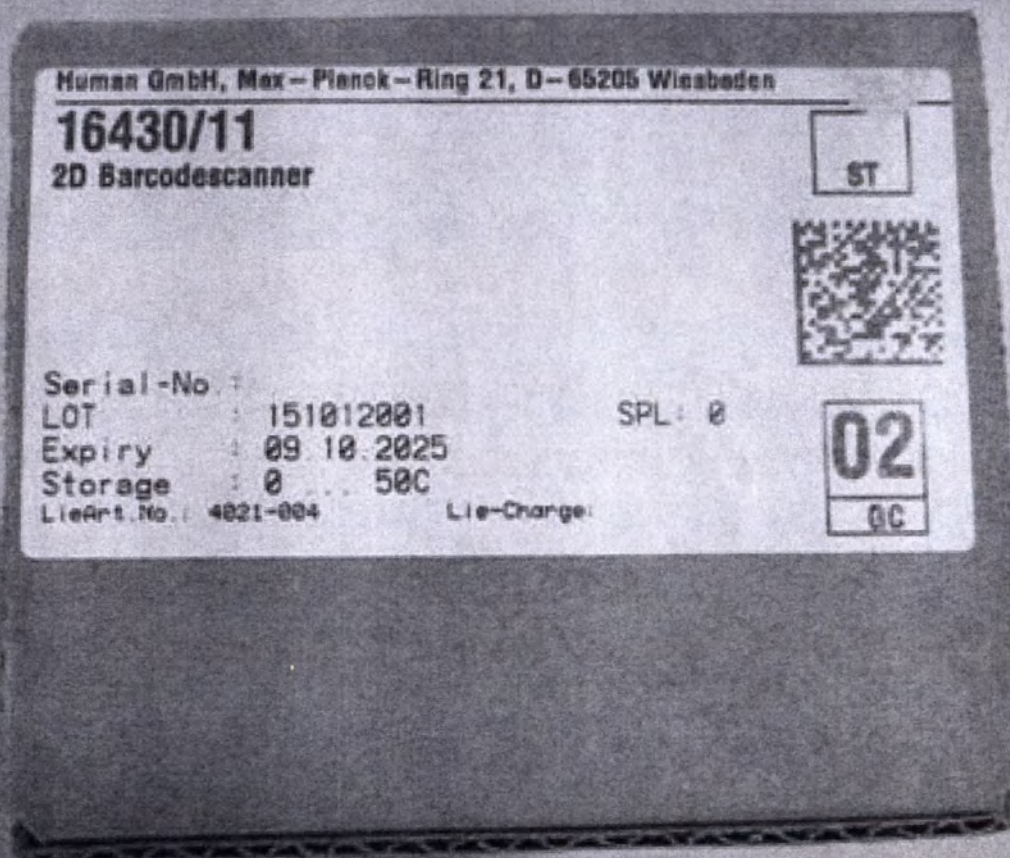



Батарея аккумуляторная Li-ion, общий вид упаковки

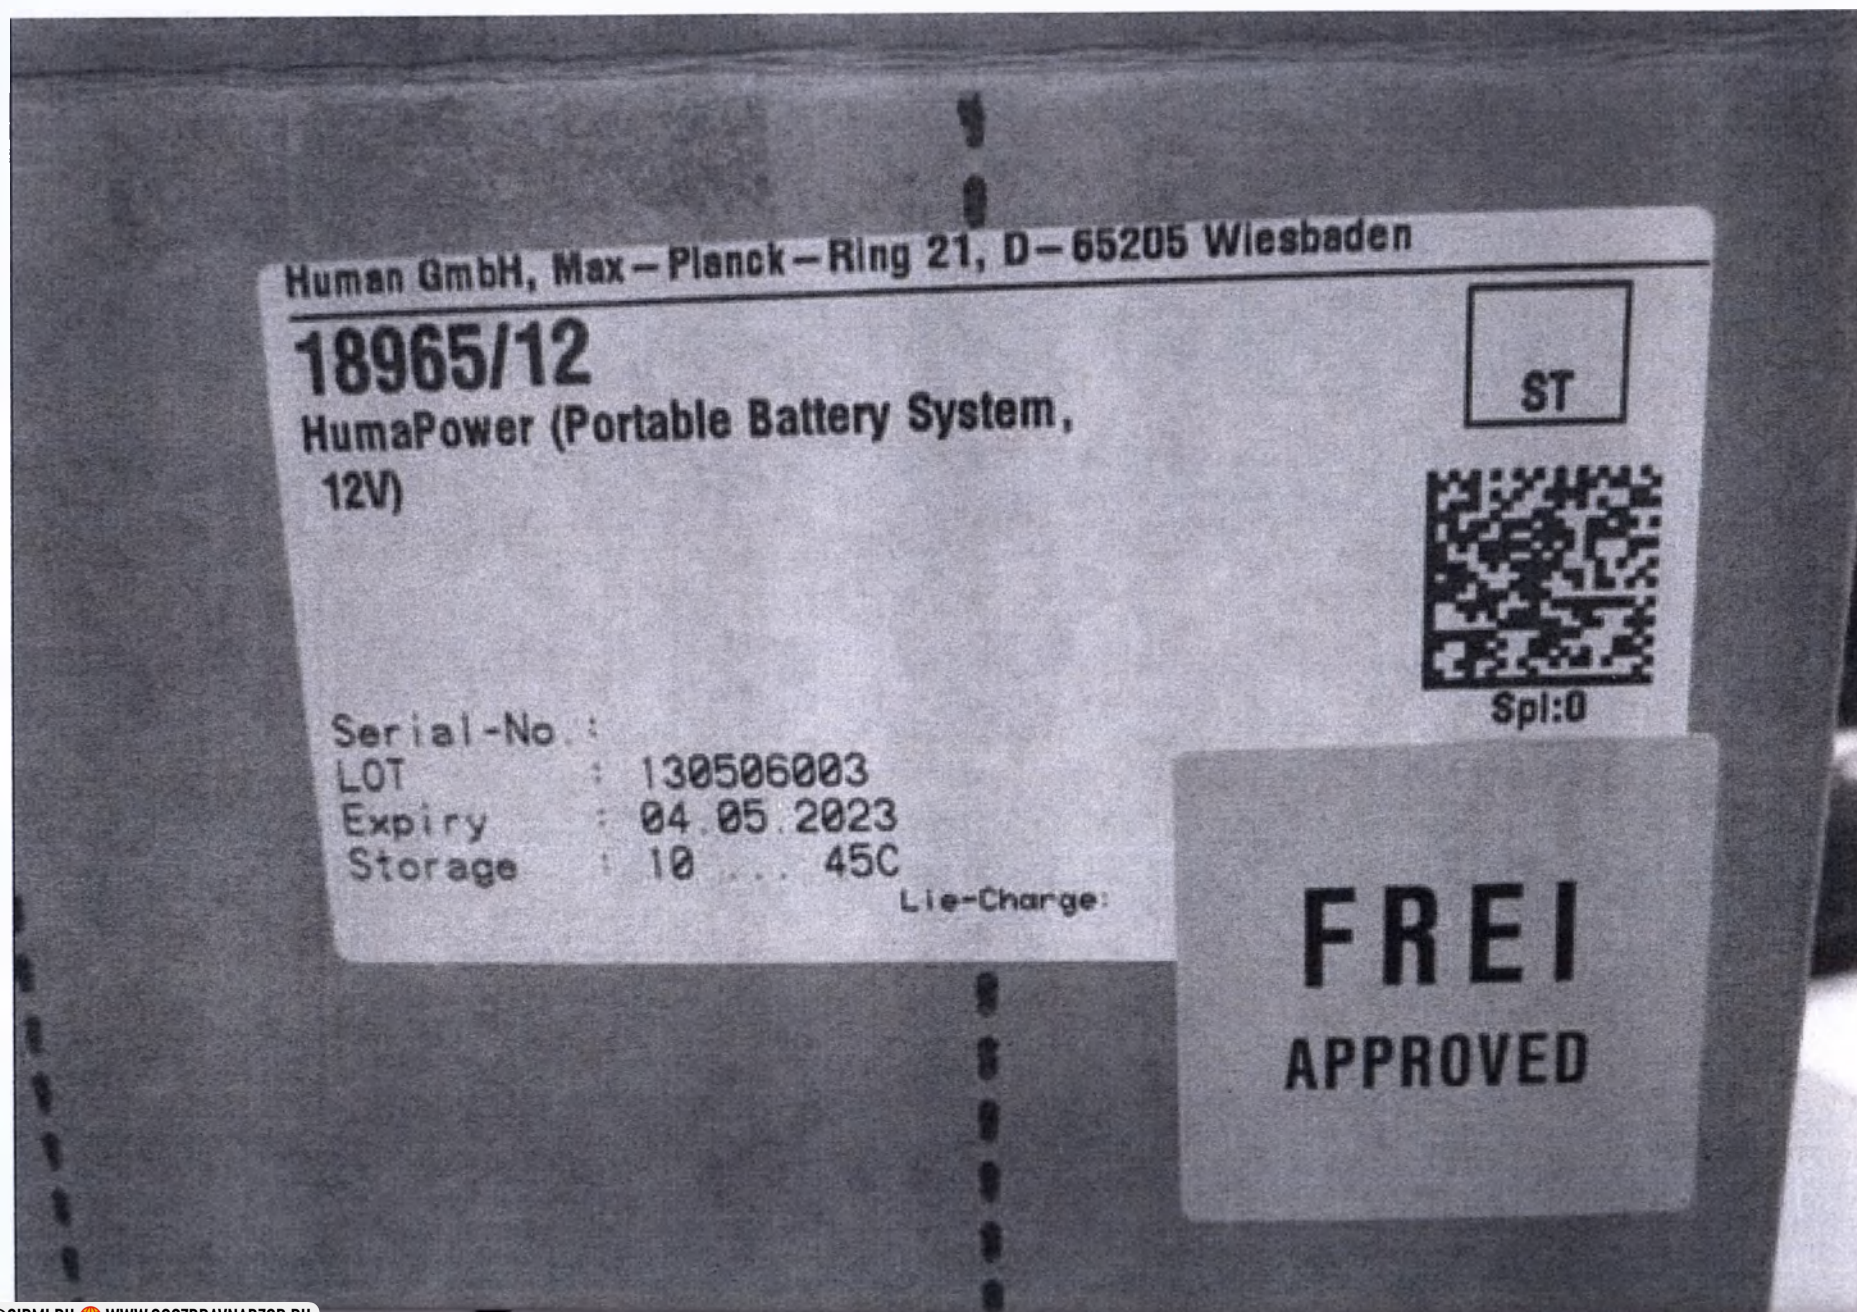

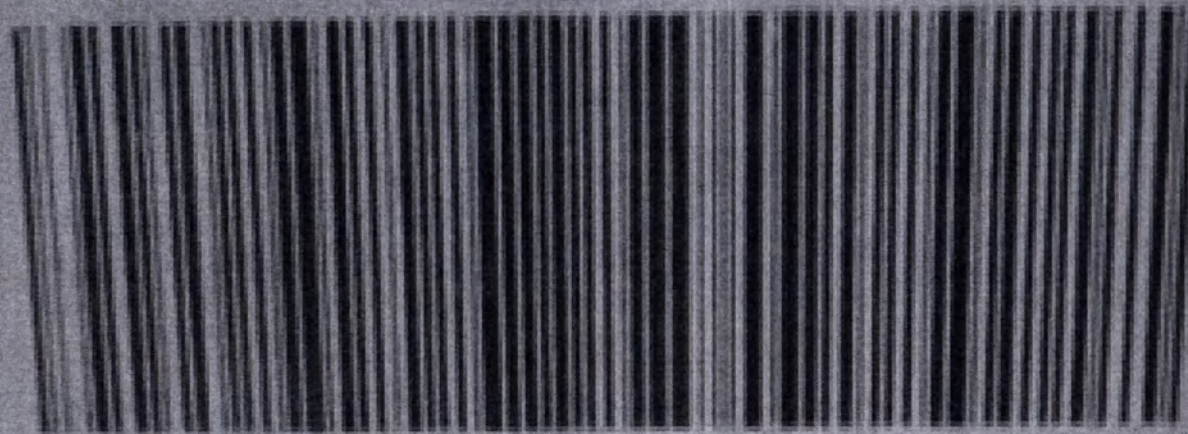

MYT 1620007 88806 1301

For: lithium-ion batt

Input: 100-240AC

Output: 12.6V 5A, 5.5*2.5mm

Батарея аккумуляторная Li-ion



Батарея аккумуляторная Li-ion




mobilePower 12V40Ah 444Wh
Lithium Polymer
Art. No.: 18465 V2
Nennspannung: 12 V
Kapazität: 40Ah
Type: Mangan
CE
Approved for use in the EU
Official Distributor in RU: Pelican Power Systems



PELI
1150 CASE

PELI PRODUCTS, S.L.U.

Кабель питания батареи аккумуляторной Li-ion

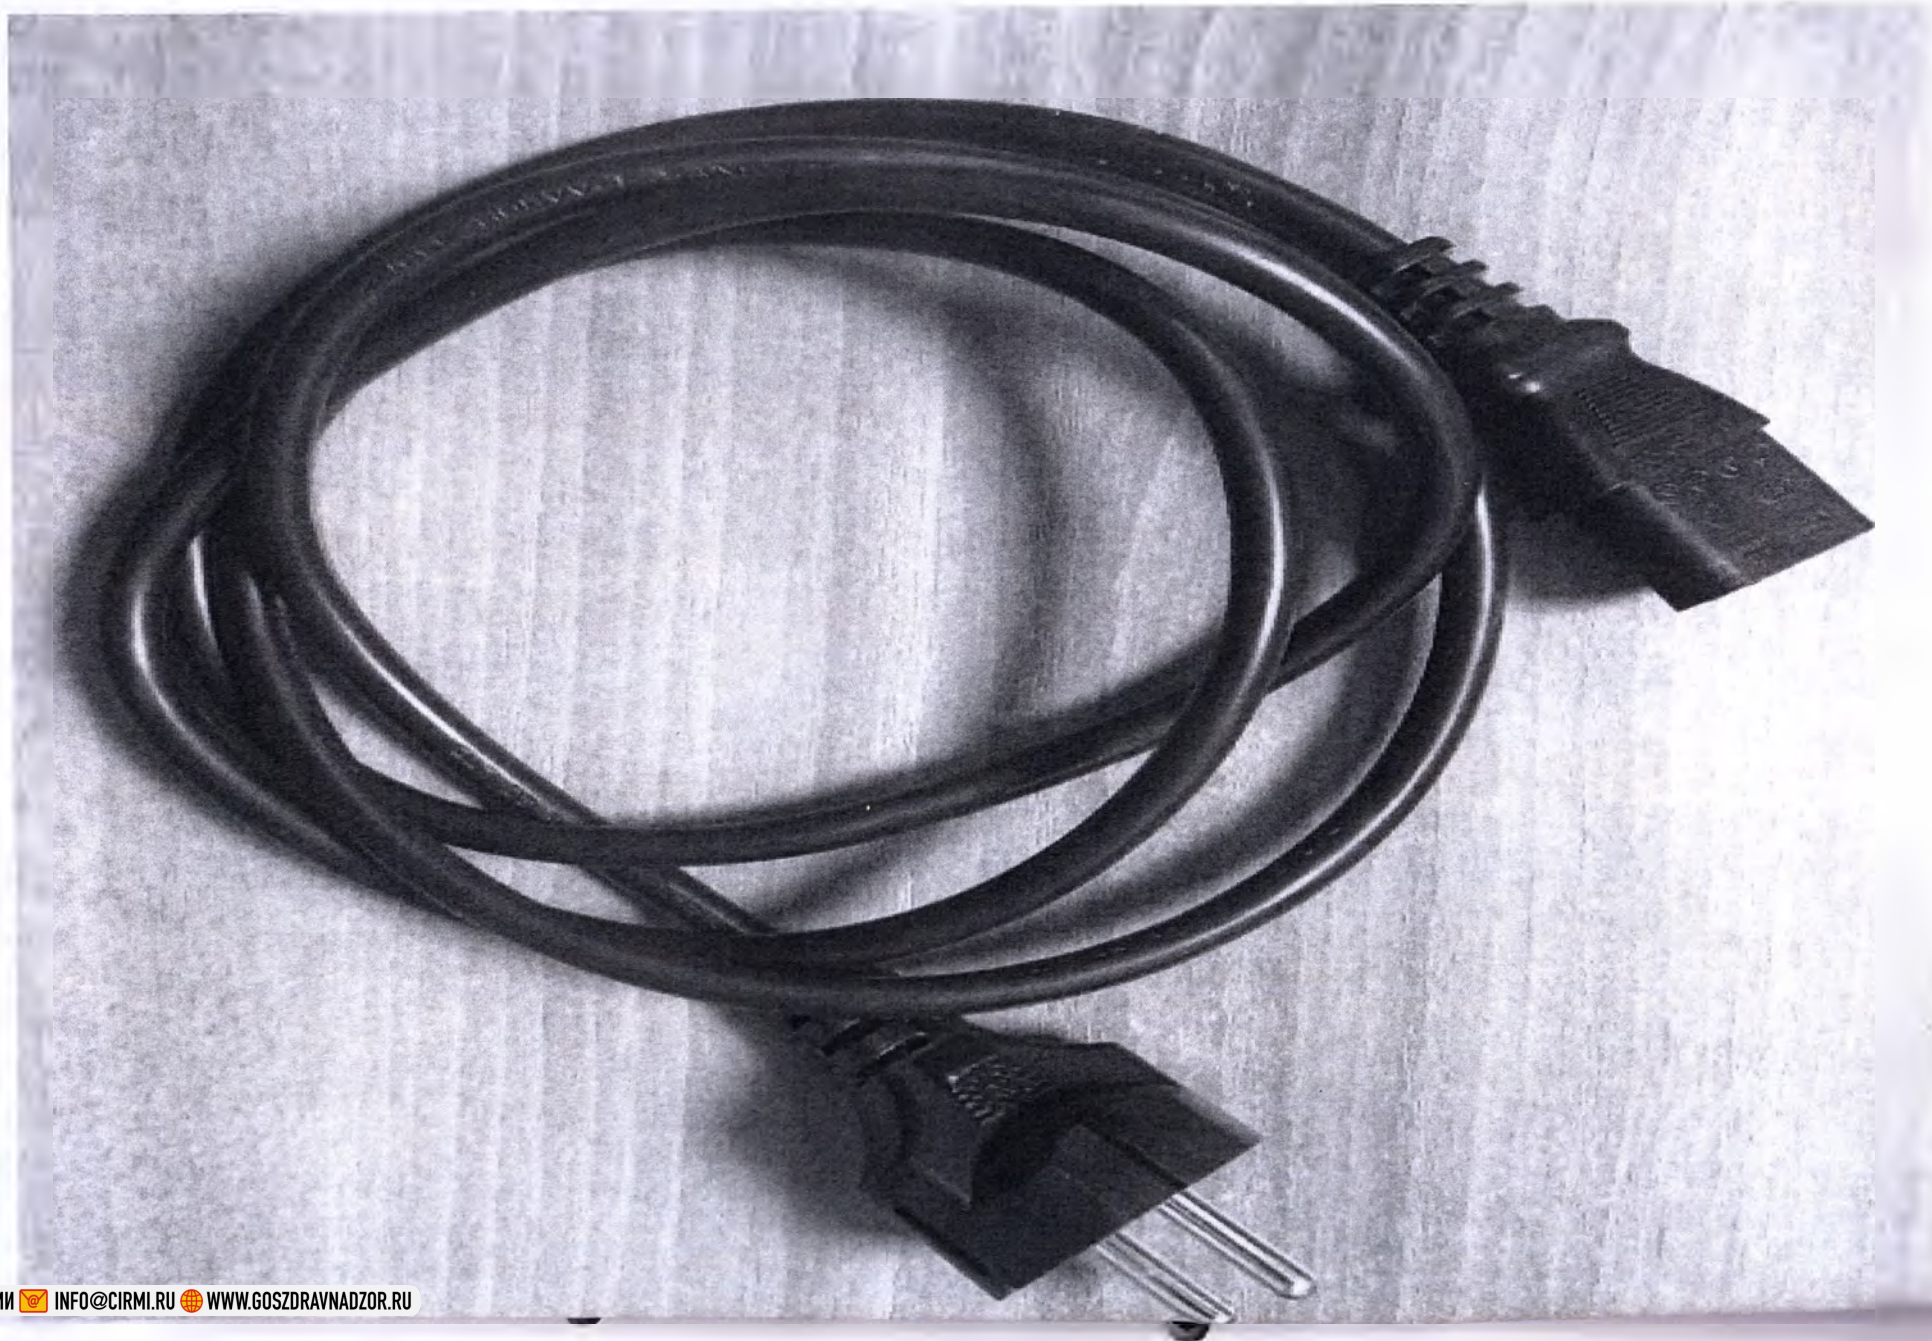

Адаптер питания для батареи аккумуляторной Li-ion.



Кабели для подключения батареи аккумуляторной Li-ion к анализатору (2 шт.) упаковка



Кабели для подключения батареи аккумуляторной Li-ion к анализатору (2 шт.)



HumaCount 30^{TS} HumaCount 80^{TS}

Анализатор гематологический
автоматический для лабораторных
исследований in vitro

Руководство пользователя

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 24 листов.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «АНАЛИТИКА»
КАЛЕНИК П. Г.