

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Диапроцесс»

М.В. Лосев

« 17 » *Анфели* 2016 г.




**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
вместе с принадлежностями**

**«Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита
человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 «ВИЧ-1,2-АГ/АТ»
по ТУ 9398-004-49073111-2016»**

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и
второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1

«ВИЧ-1,2-АГ/АТ»

по ТУ 9308-004-4007311-2016

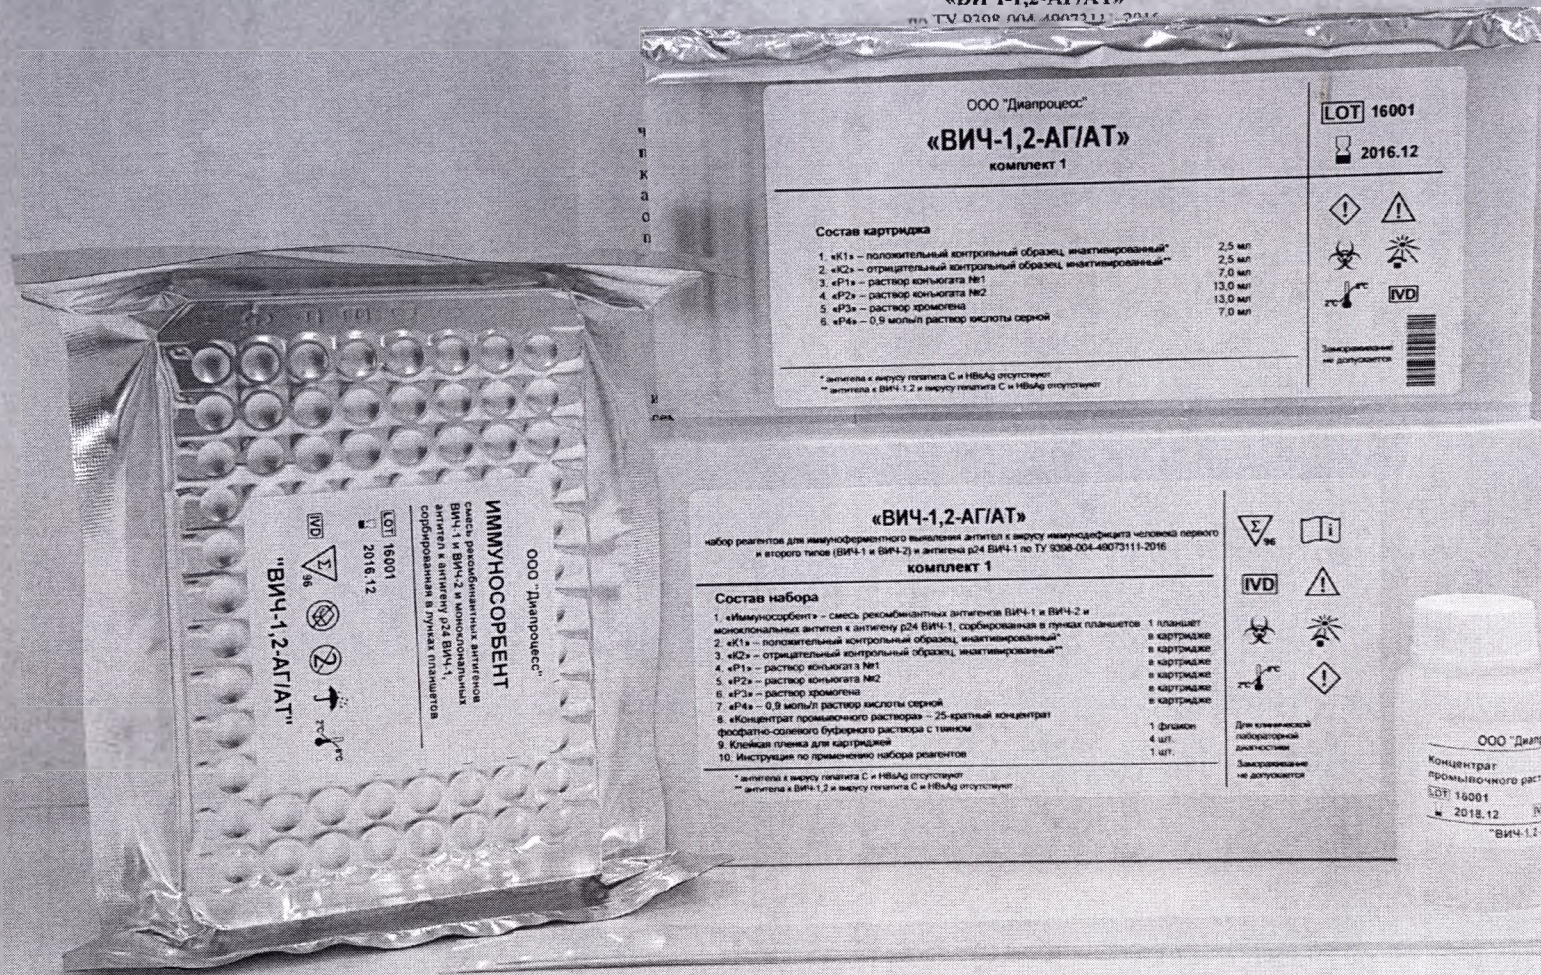

Комплект 1

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и
второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1
«ВИЧ-1,2-АГ/АТ»
по ТУ 9328-004-42073111-2016



ООО "Диапроцесс"
«ВИЧ-1,2-АГ/АТ»
КОМПЛЕКТ 2

Состав картриджа

1. «К1» – положительный контрольный образец, «интегрированный»	5,0 мл
2. «К2» – отрицательный контрольный образец, «интегрированный»	5,0 мл
3. «Р1» – раствор конъюгата №1	13,0 мл
4. «Р2» – раствор конъюгата №2	25,0 мл
5. «Р3» – раствор промывочной	25,0 мл
6. «Р4» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной	12,0 мл

1. Антиген к вирусу иммунодефицита С и HIVAg опускаться
2. Антиген к ВИЧ-1,2 и вирусу иммунодефицита С и HIVAg опускаться

LOT 16003
2016.12

IVD

Для клонирования
лаборатории
диагностики
Замораживание
не допускается

«ВИЧ-1,2-АГ/АТ»
набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого
и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 по ТУ 9328-004-42073111-2016
КОМПЛЕКТ 2

Состав набора


1. «Иммуносорбент» – смесь реакционных дендритов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и «интегрированный» антиген к антигену р24 ВИЧ-1, сорбированный в латекс латекса	2 флакона
2. «К1» – положительный контрольный образец, «интегрированный»	5 мл
3. «К2» – отрицательный контрольный образец, «интегрированный»	5 мл
4. «Р1» – раствор конъюгата №1	13 мл
5. «Р2» – раствор конъюгата №2	25 мл
6. «Р3» – раствор промывочной	25 мл
7. «Р4» – 0,9 моль/л раствор кислоты серной	12 мл
8. «Концентрат промывочного раствора» – 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с Tween	25 мл
9. Клейкая пленка для картриджей	1 шт.
10. Инструкция по применению набора реагентов	1 шт.

1. Антиген к вирусу иммунодефицита С и HIVAg опускаться
2. Антиген к ВИЧ-1,2 и вирусу иммунодефицита С и HIVAg опускаться

LOT 16003
2016.12

IVD

Для клонирования
лаборатории
диагностики
Замораживание
не допускается

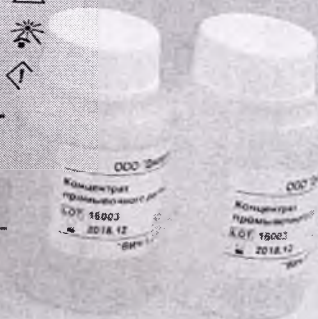

Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (3) листах
Генеральный директор
ООО «Диапроцесс»

