

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Диапроцесс»

М.В. Лосев

« 23 » 2016 г.



**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики in vitro
вместе с принадлежностями**

«Анализатор иммуноферментный «Элиза» по ТУ 9443-001-49073111-2016»

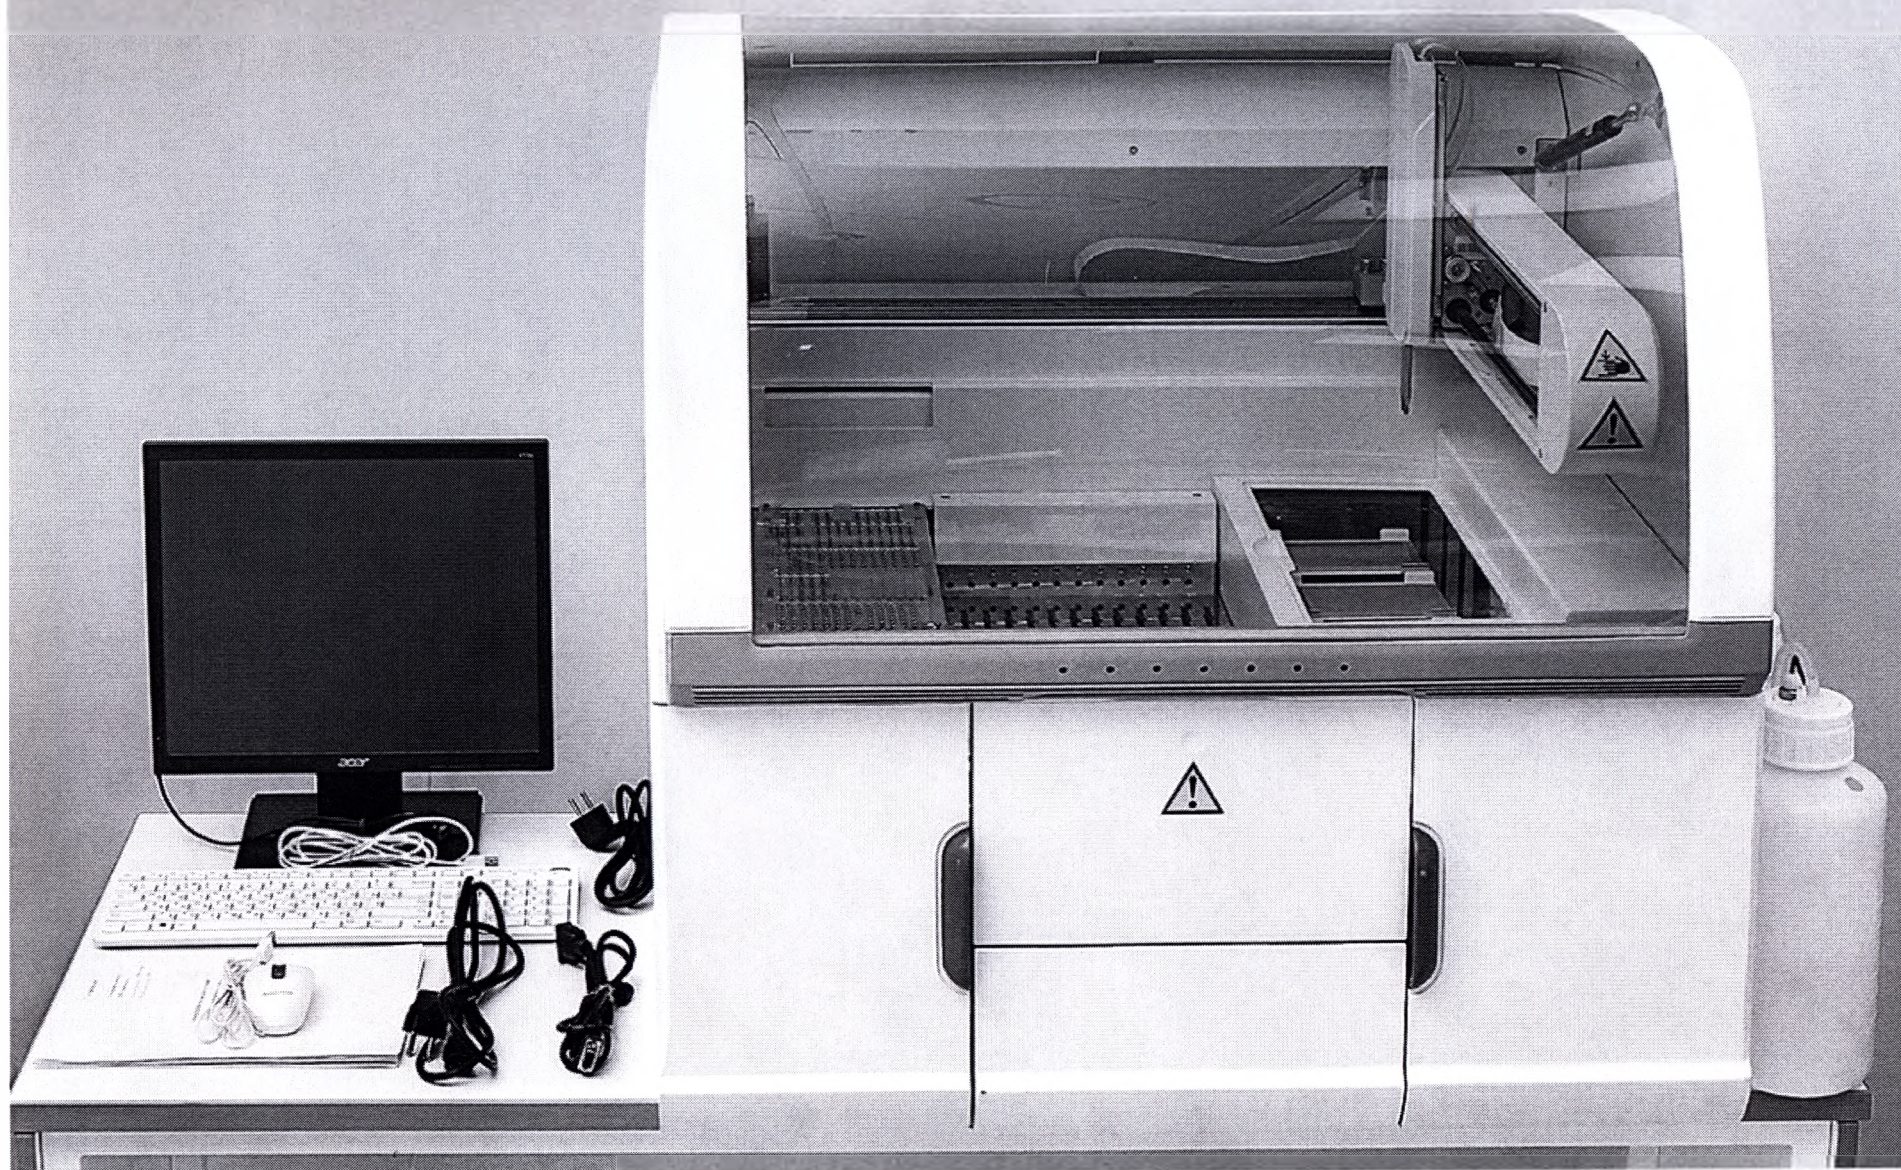


Рисунок 1 – Внешний вид Анализатора

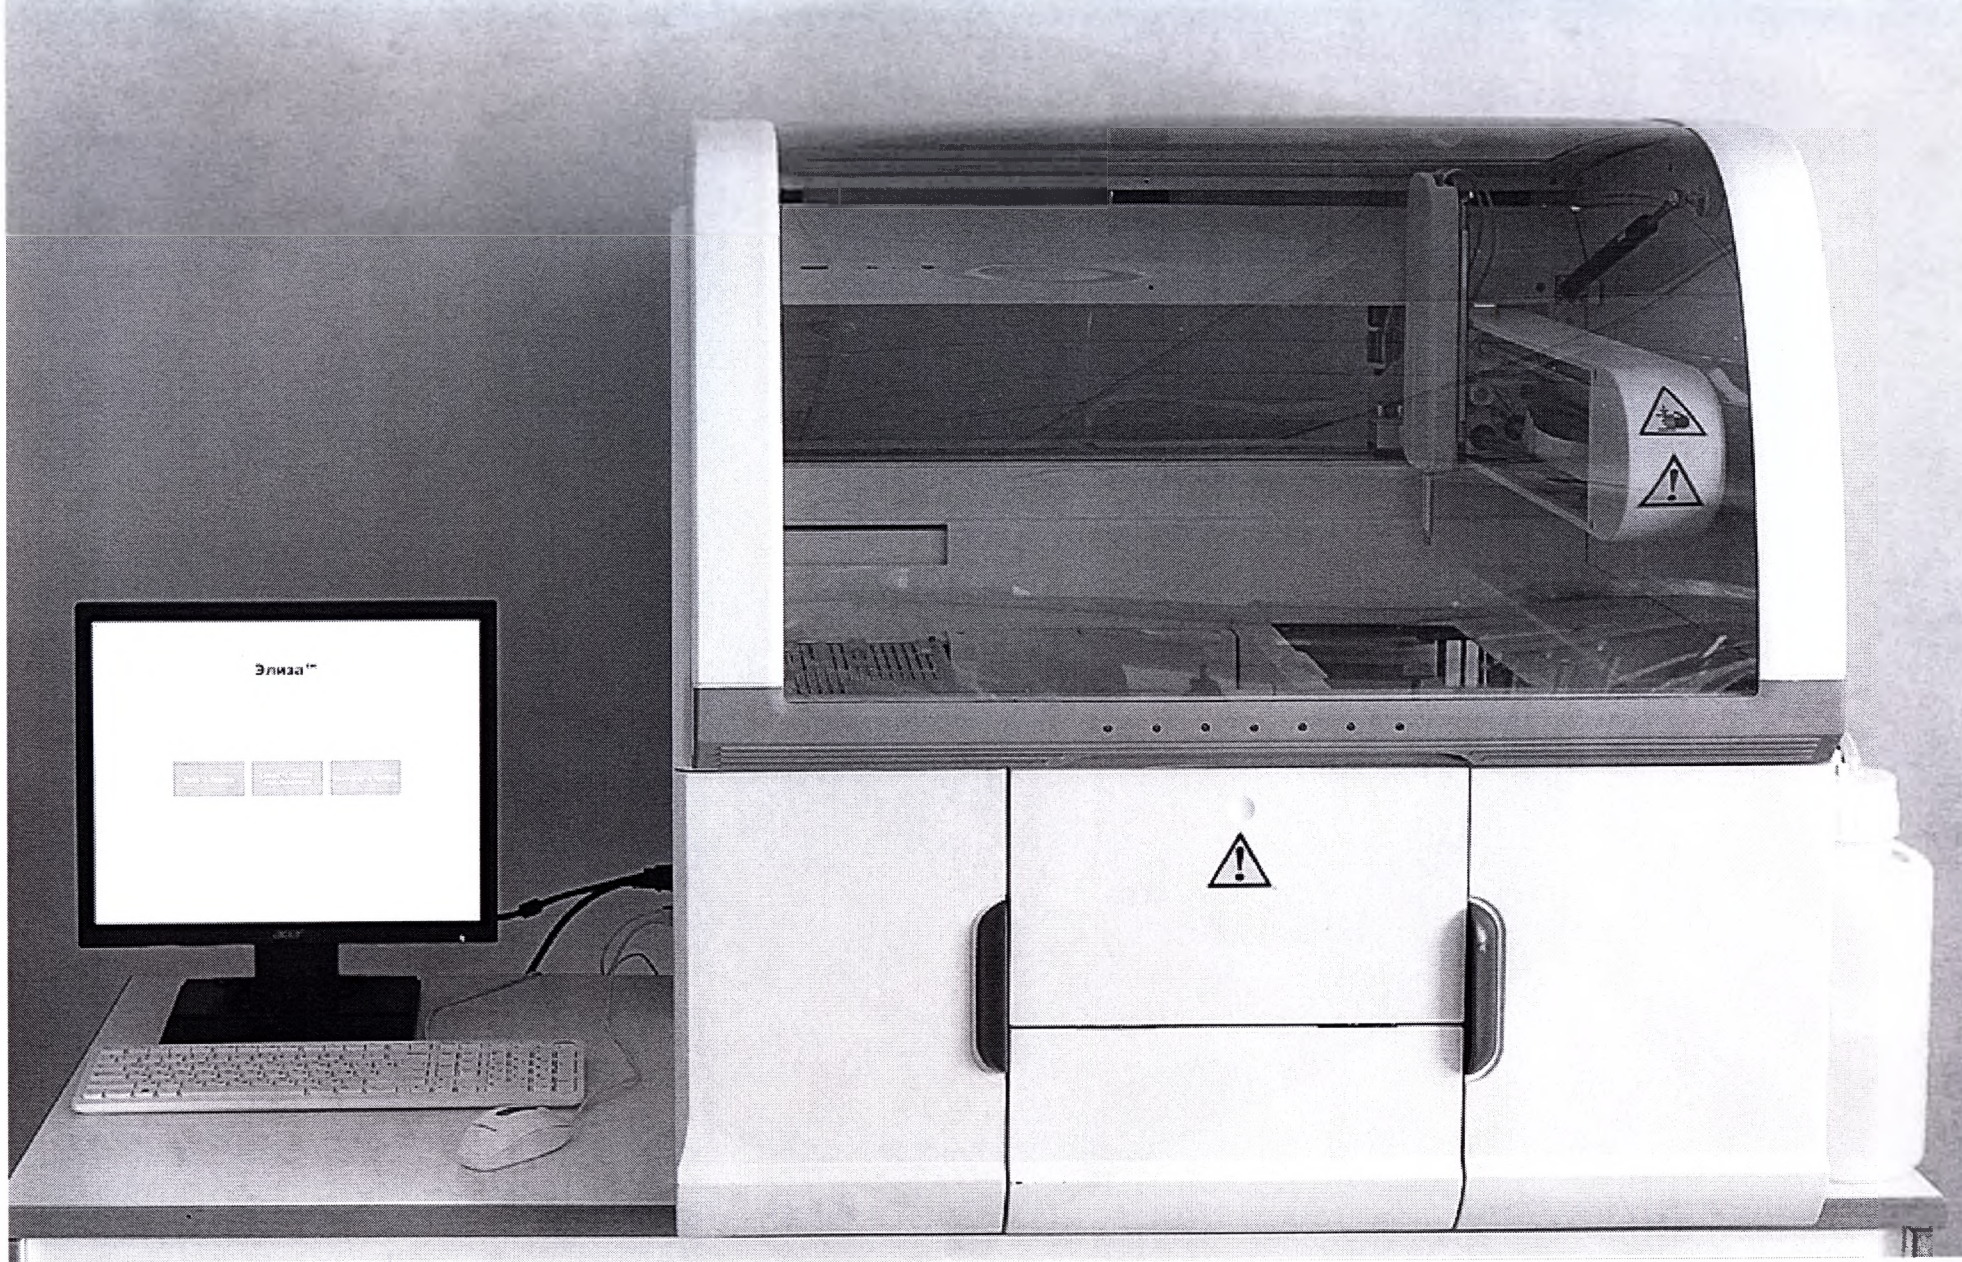


Рисунок 2 – Внешний вид Анализатора (подключенного)



Рисунок 3 – Внешний вид блока Анализатора

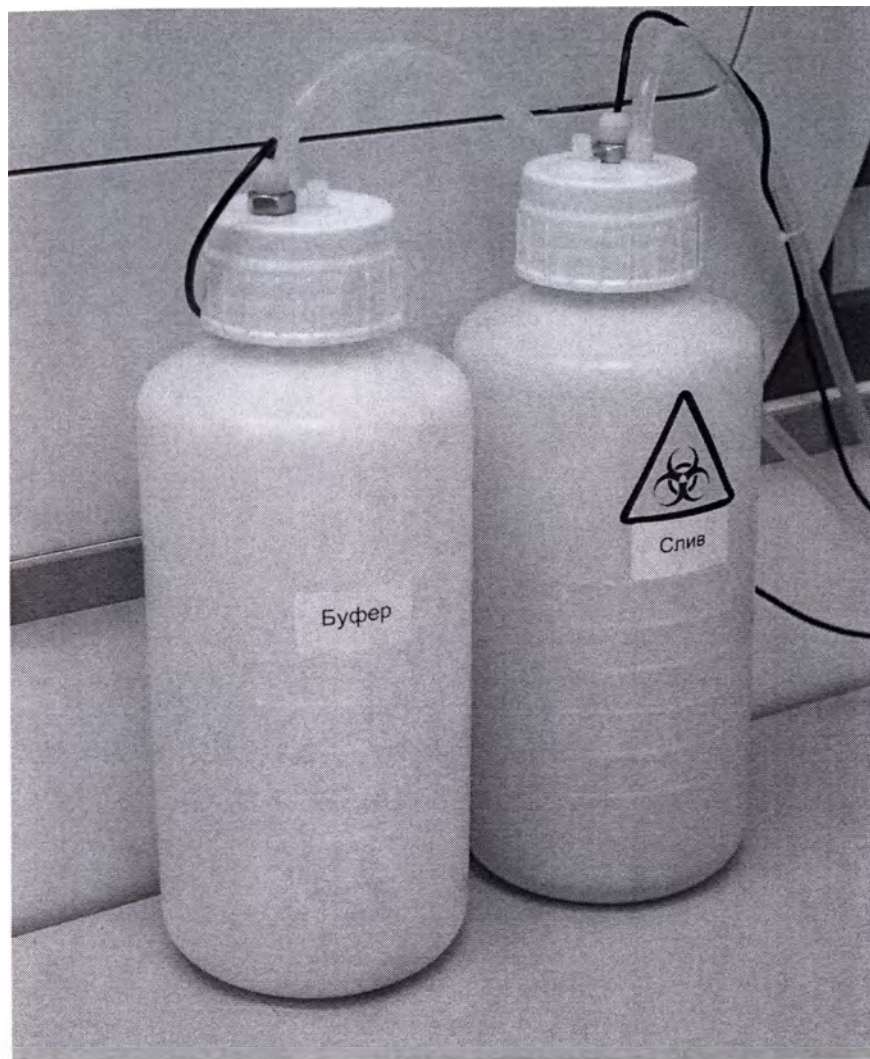


Рисунок 4 - Емкость для промывочного и консервирующего растворов с датчиком и соединительными штуцерами и Емкость для жидких отходов с датчиком и соединительными штуцерами (слева на право)

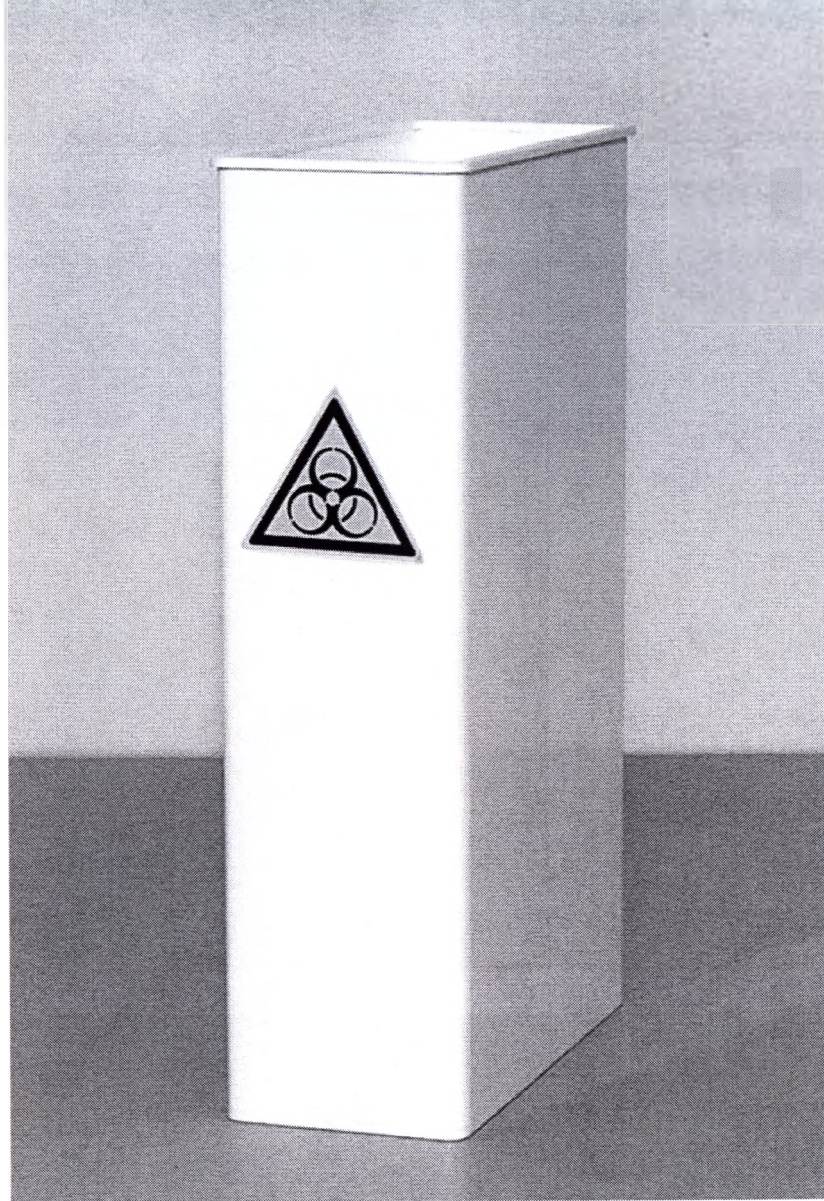


Рисунок 5 - Контейнер для использованных наконечников

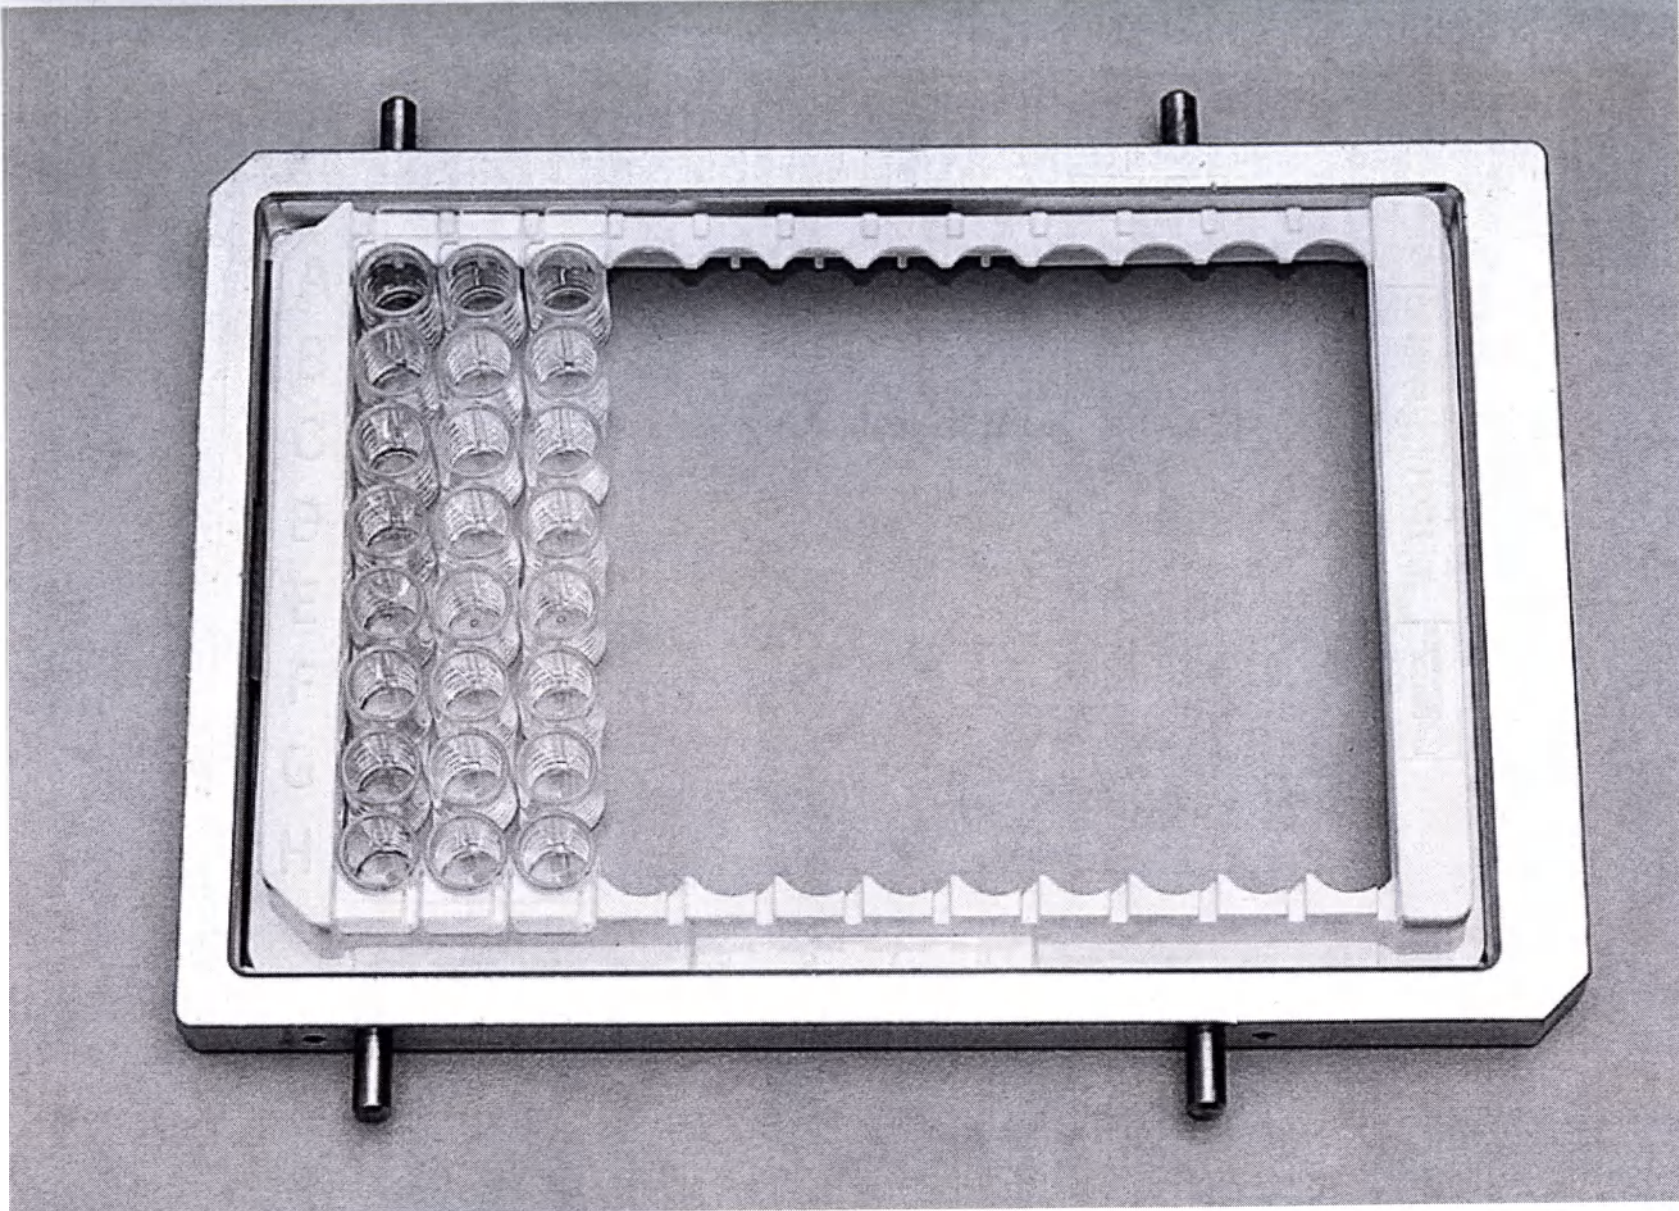


Рисунок 6 - Рамка-держатель

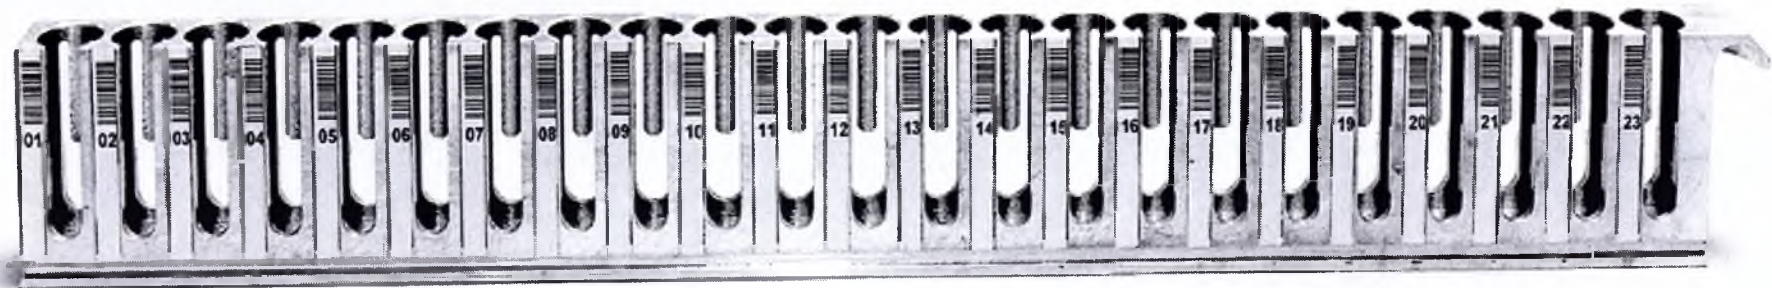


Рисунок 7 - Штатив для образцов

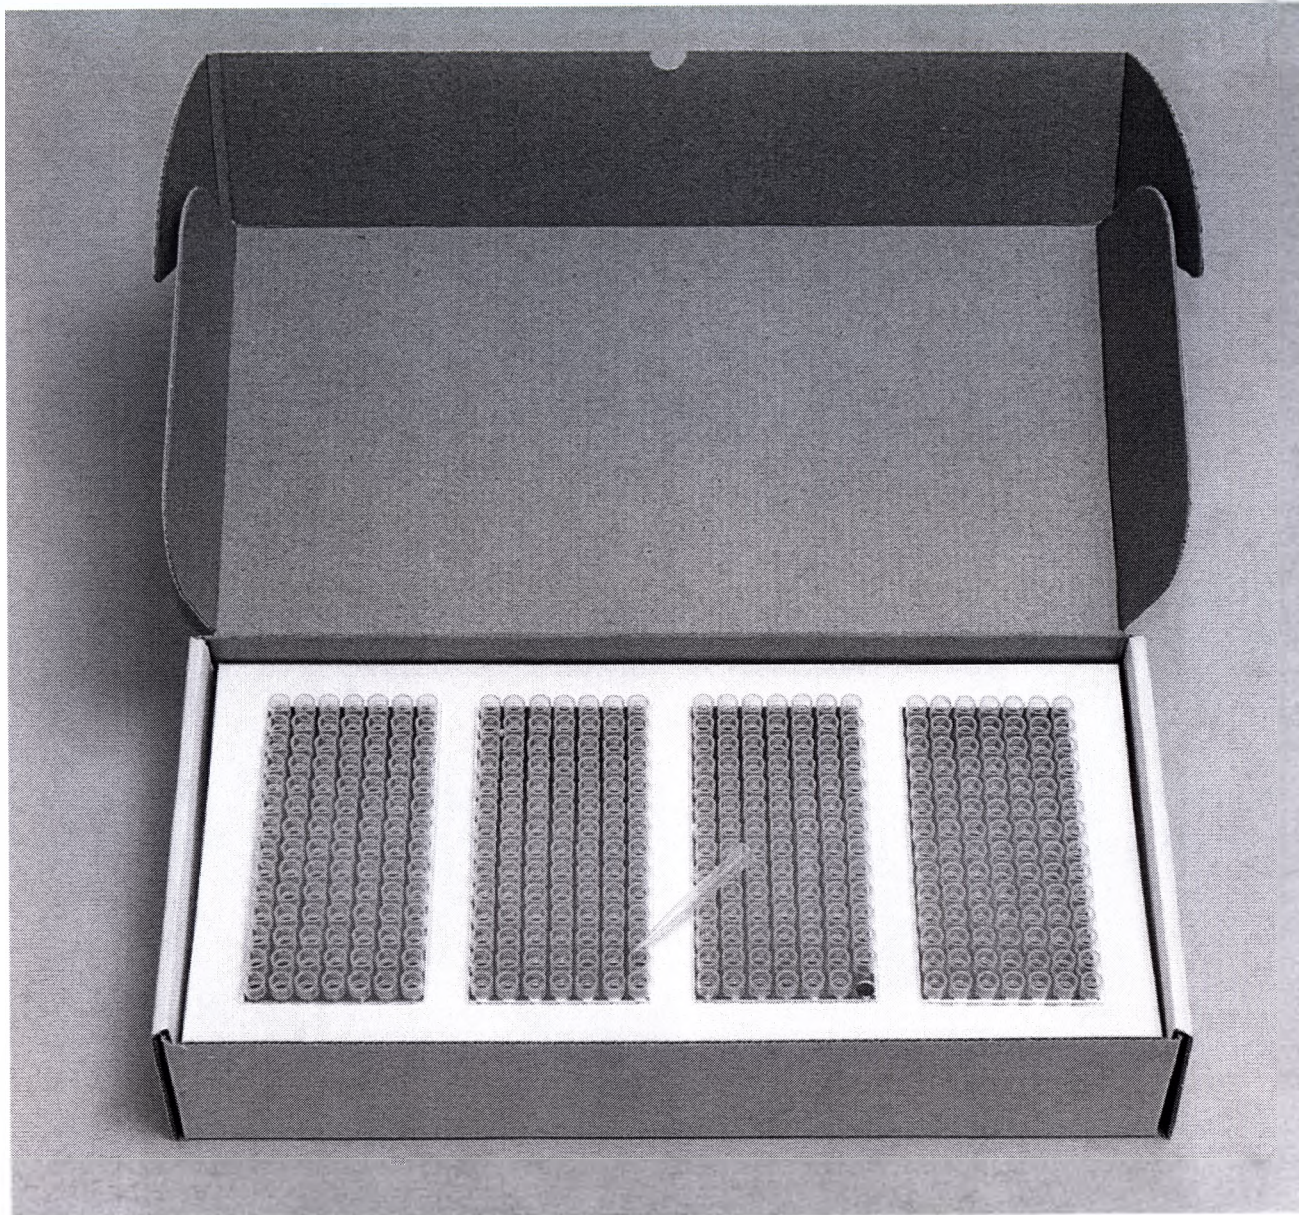


Рисунок 8 - Наконечники одноразовые вместимостью до 300 мкл, предварительно установленные в штатив для одноразовых наконечников, упакованы в картонную коробку

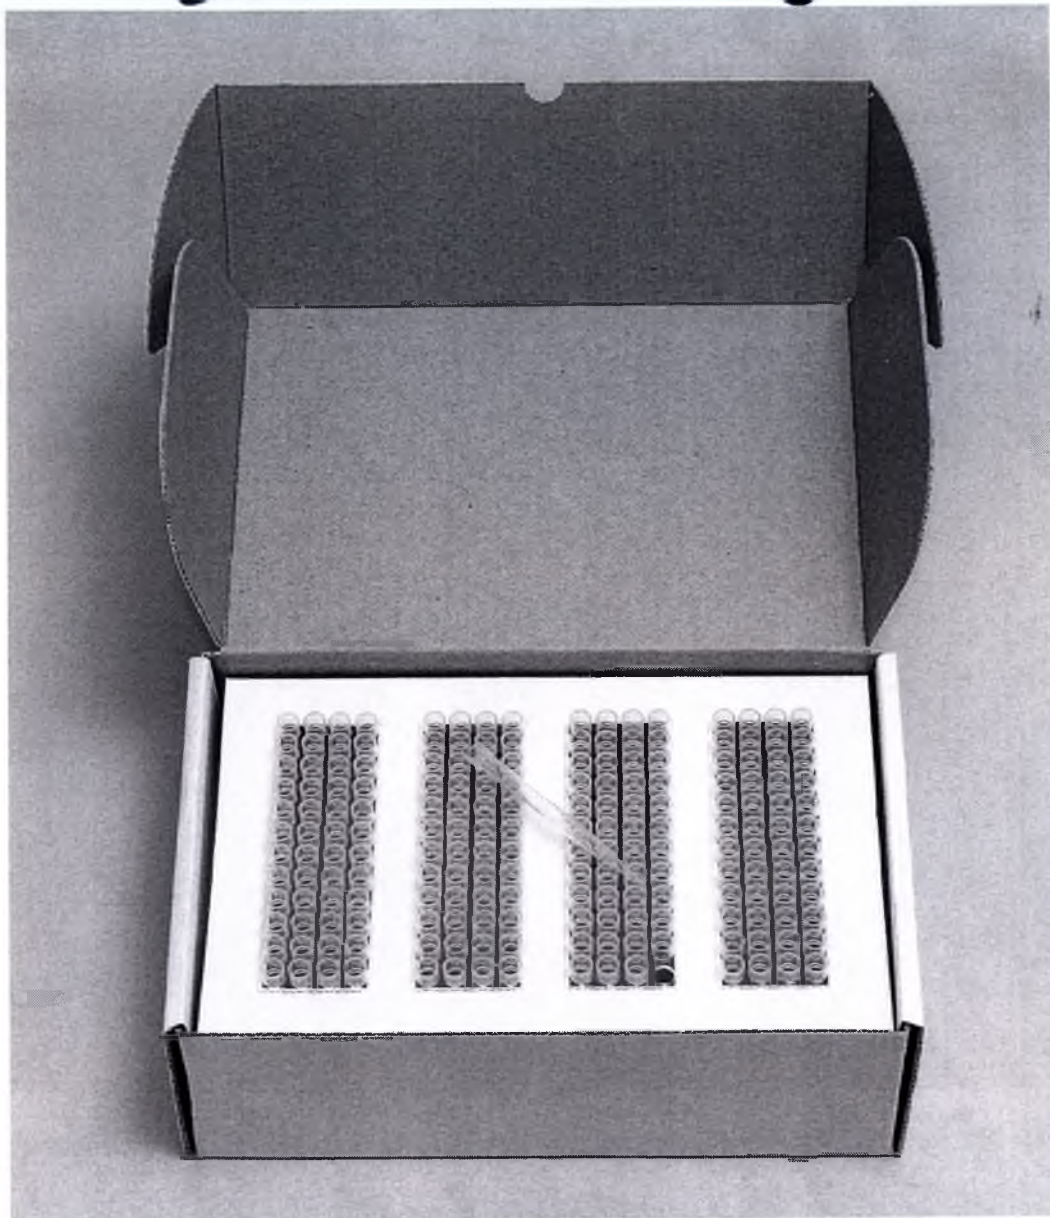


Рисунок 9 - Одноразовые наконечники вместимостью до 800 мкл, предварительно установленные в штатив для одноразовых наконечников, упакованы в картонную коробку

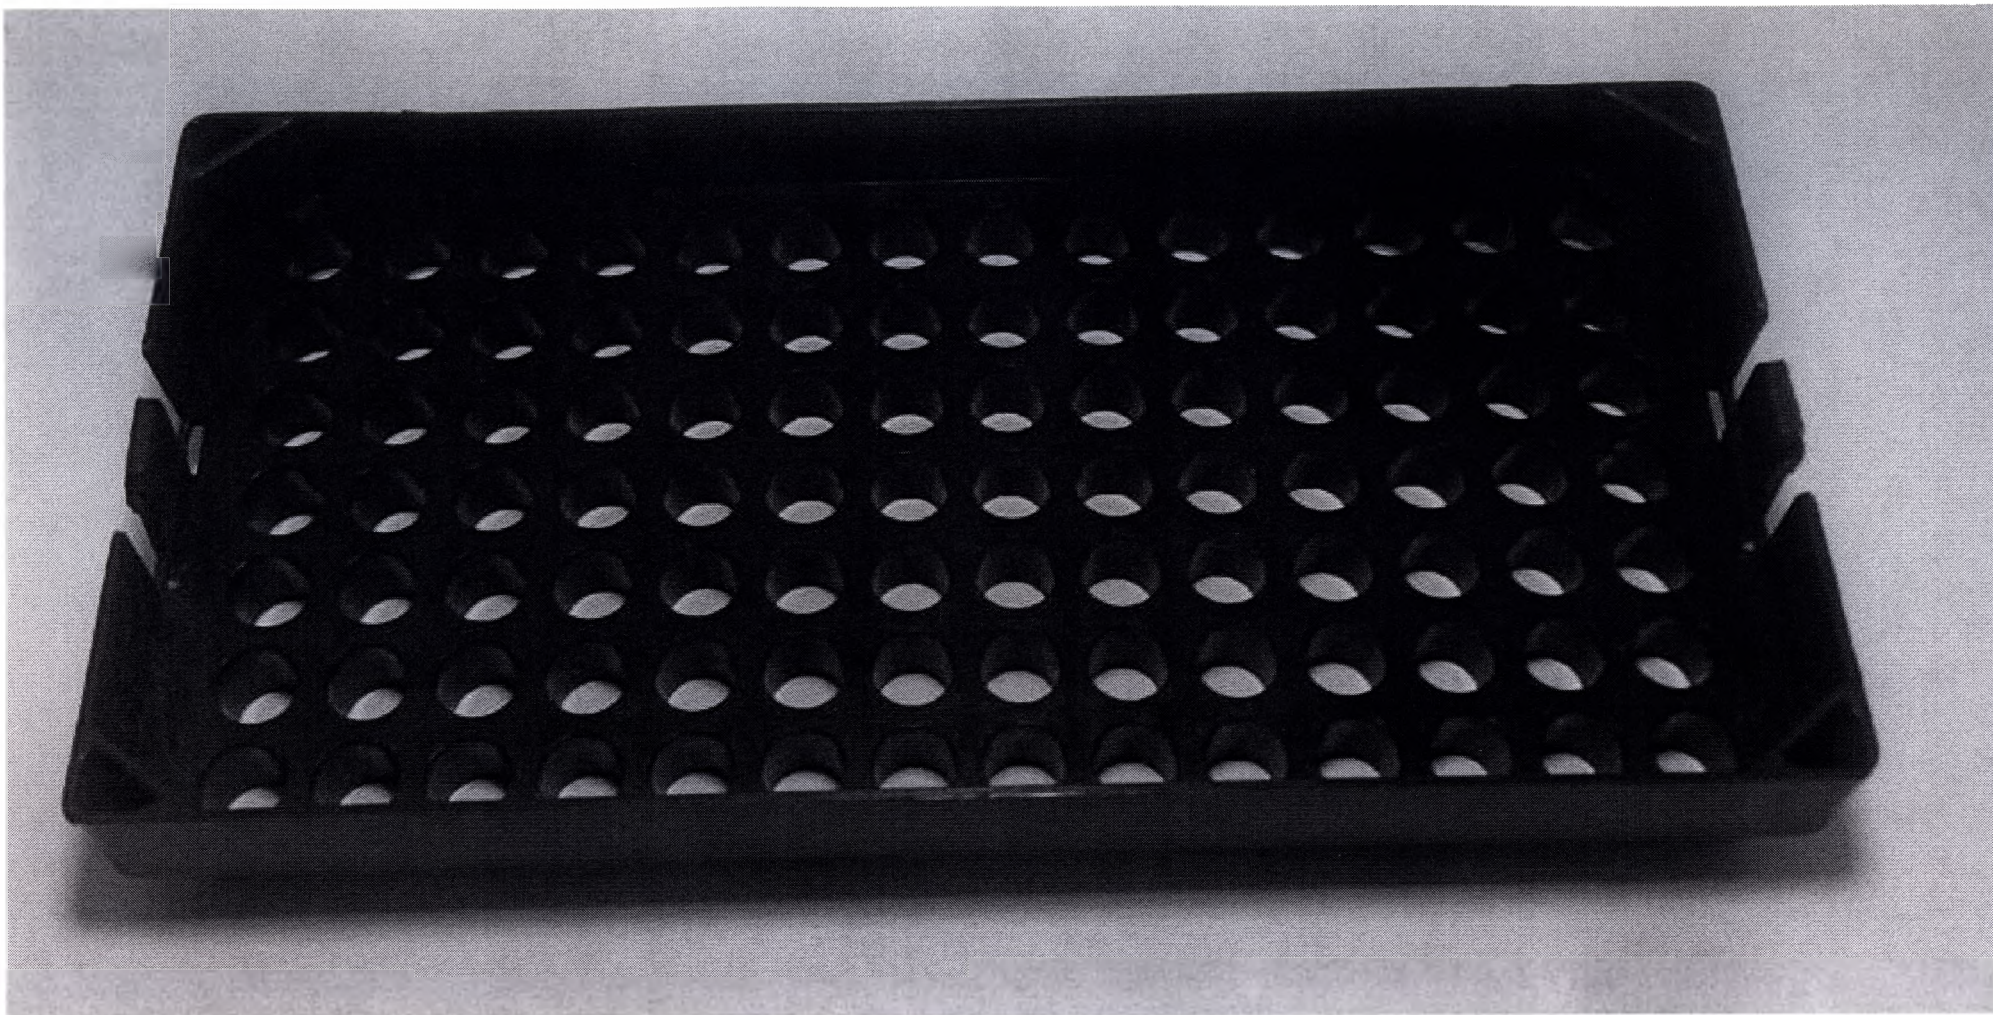


Рисунок 10 - Штатив для одноразовых наконечников без фильтра до 300 мкл

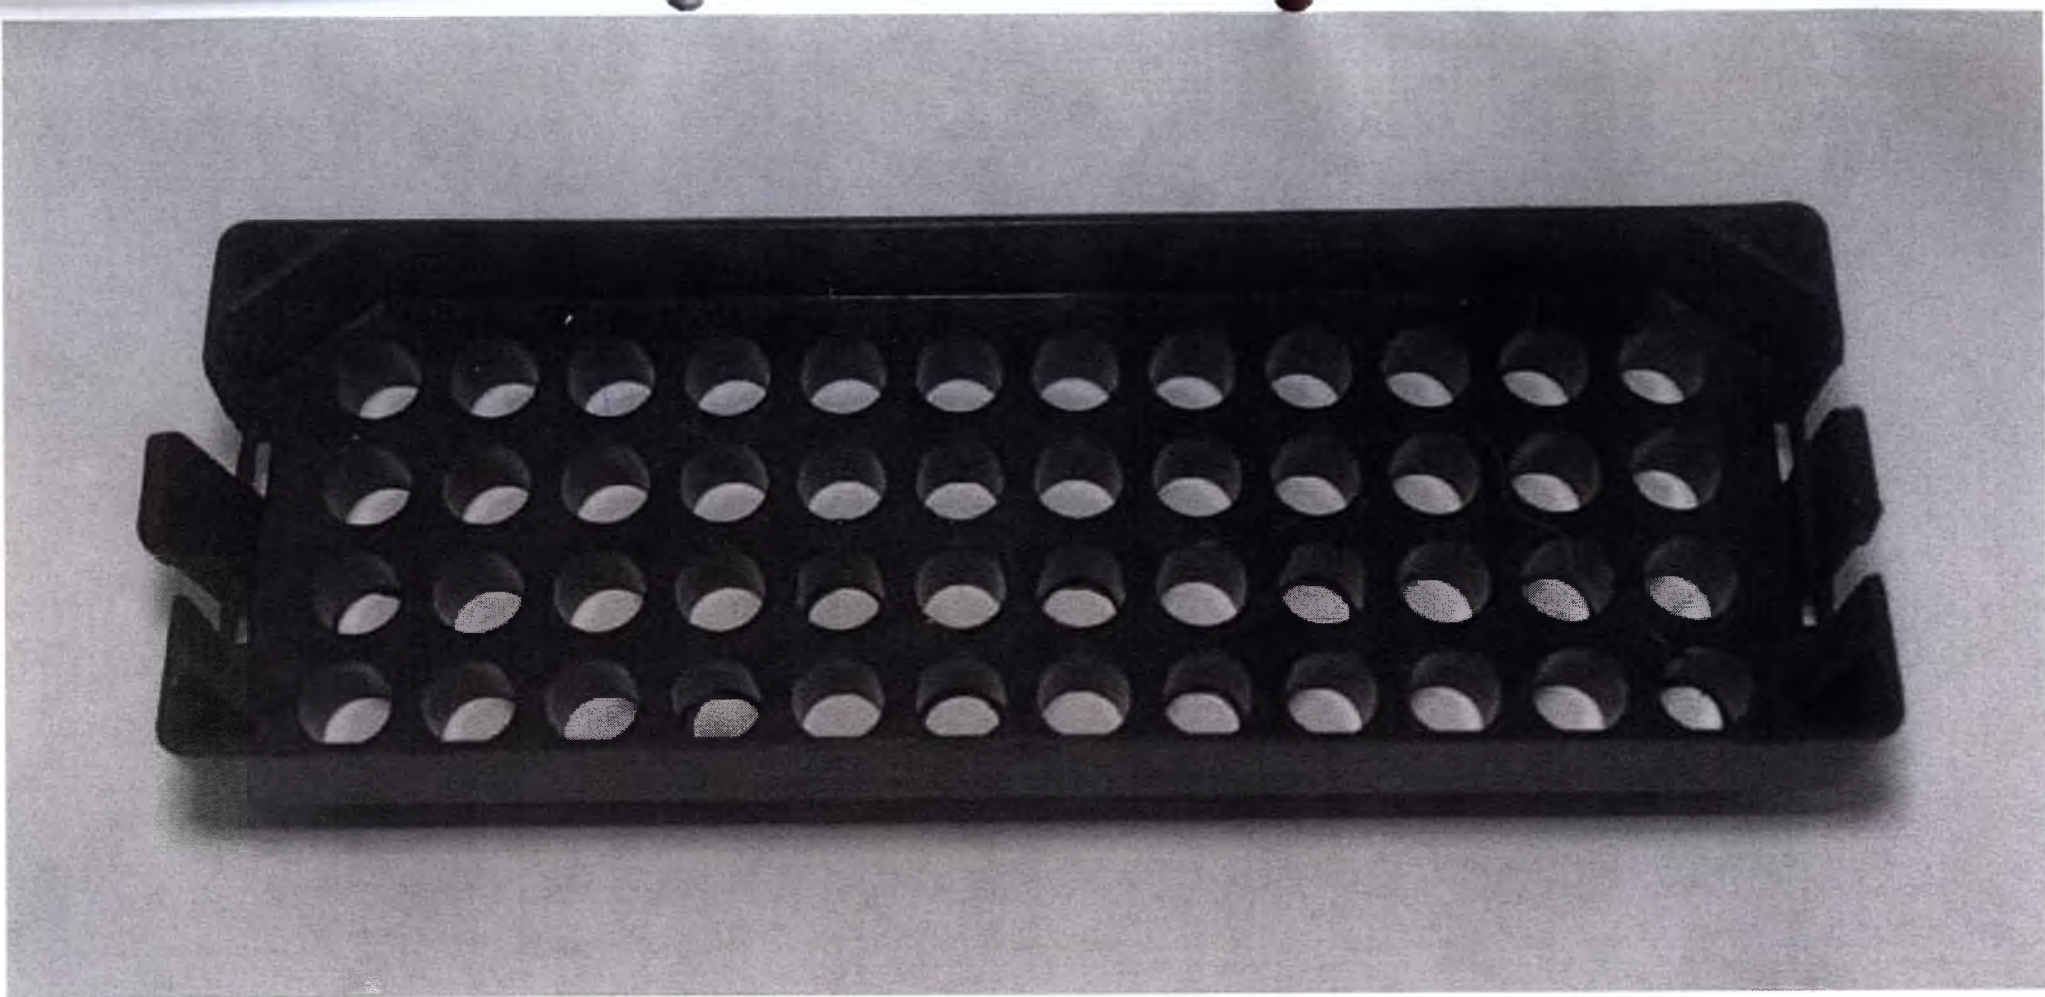


Рисунок 11 - Штатив для одноразовых наконечников без фильтра до 800 мкл

Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (12) листах
Генеральный директор
ООО «Диaproцесс»

