

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛИМПАС МОСКВА»

107023, РОССИЯ, МОСКВА, УЛ. ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ, Д. 27, СТР. 8

УТВЕРЖДАЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР


МИРОНОВА В.А.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

Микроскоп медицинский инвертированный СКХ для лабораторных исследований, вариант исполнения СКХ53SF с принадлежностями

Микроскоп медицинский инвертированный СКХ53

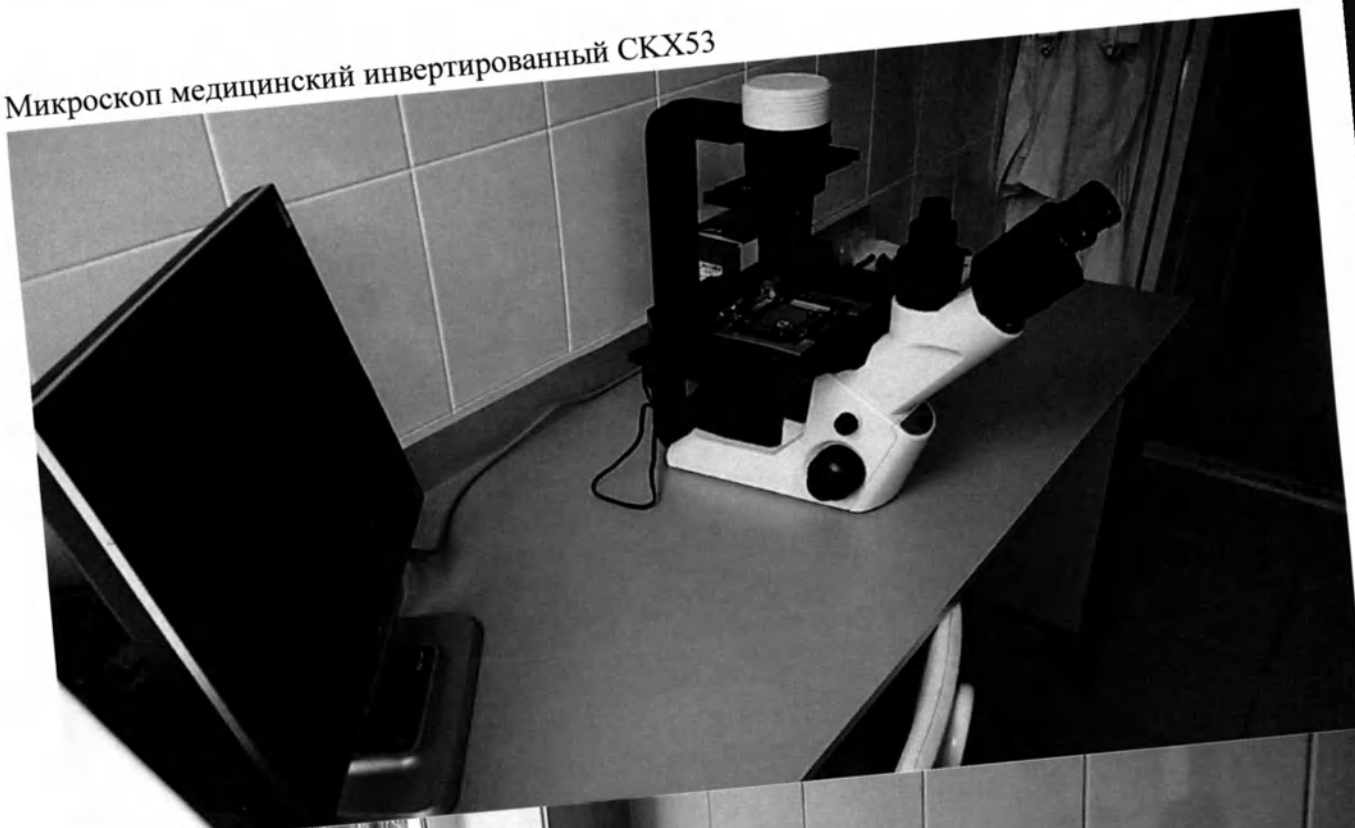


1. Тубусы - бинокулярный, тринокулярный, эргономичный наклоняемый - не более 2 шт.

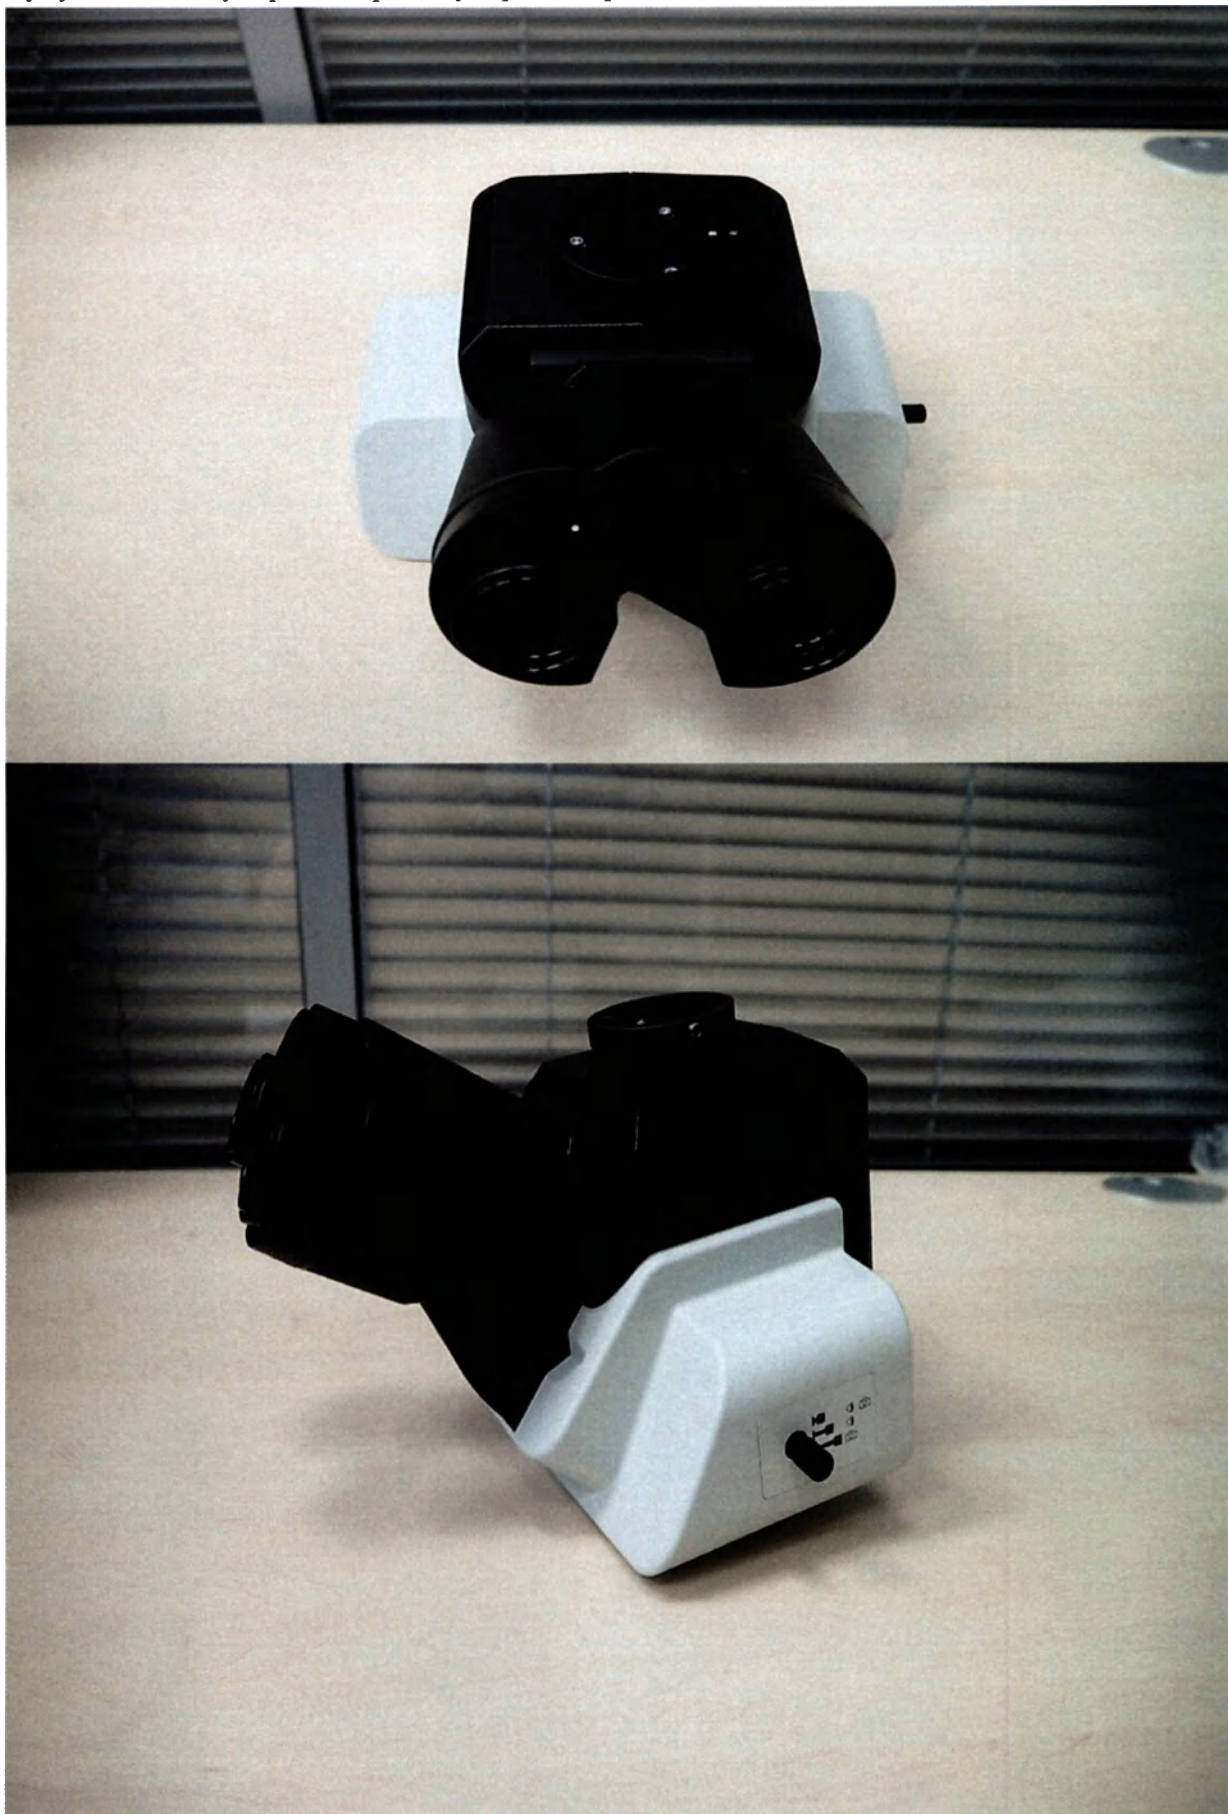


2. Окуляры, микрометры окулярные, держатели микрометров окулярных - не более 4 шт.



3. Столики предметные, механические - не более 2 шт.

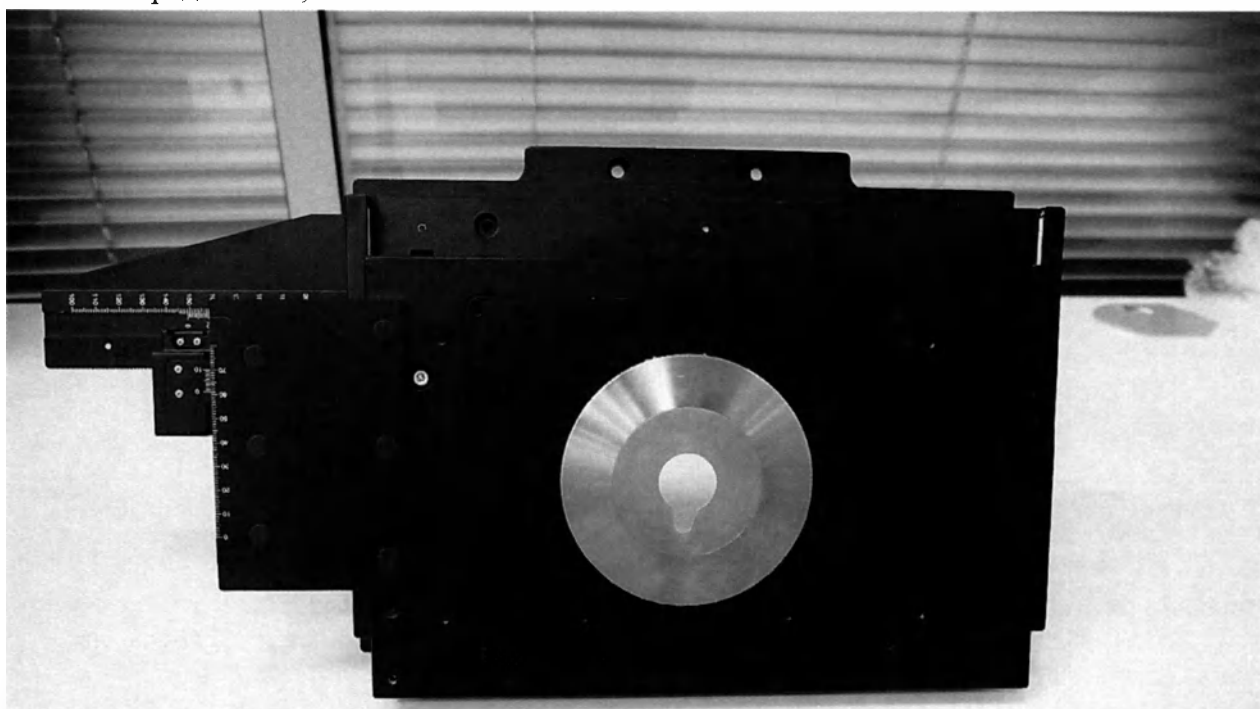

4. Столики предметные - моторизированные, нагревательные с блоком контроля - не более 2 шт.

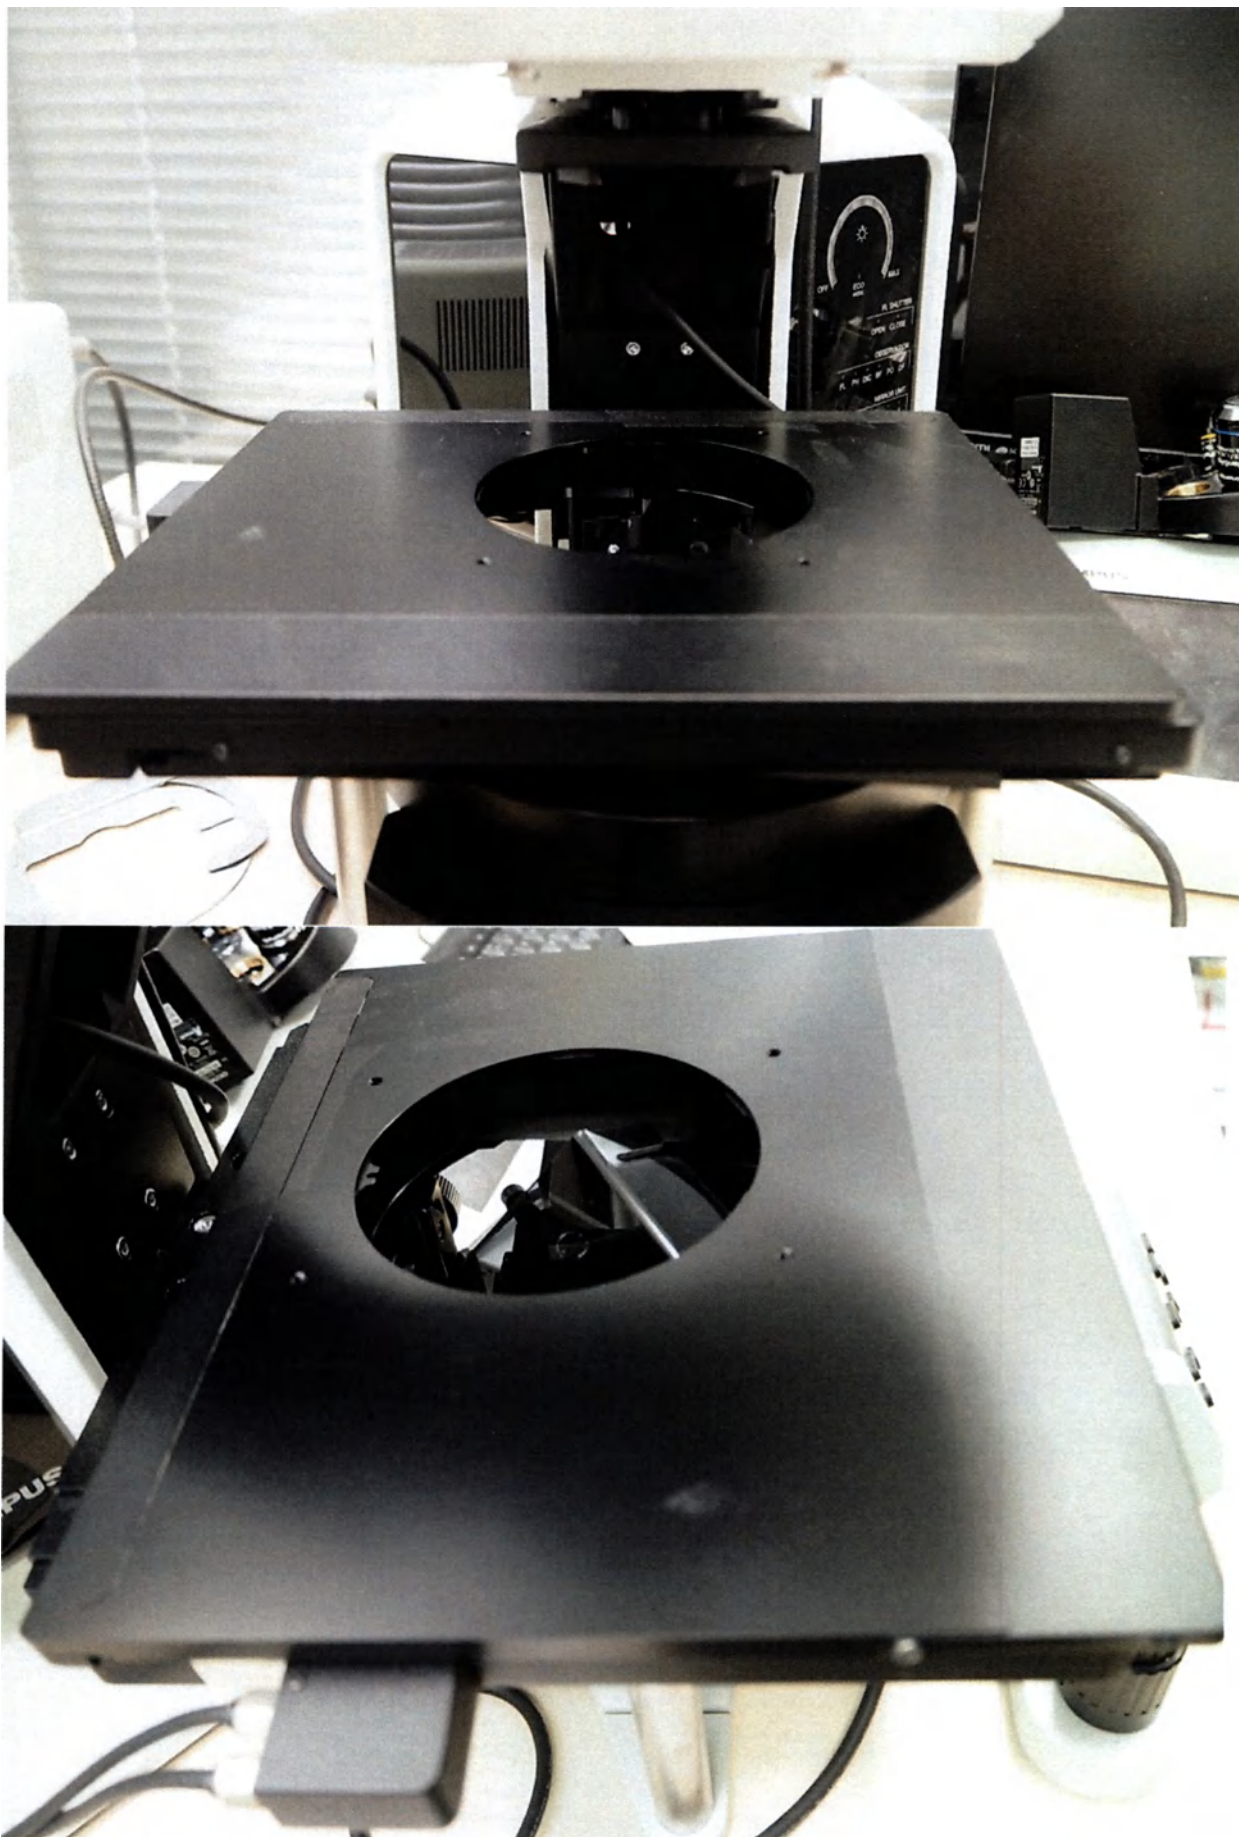


5. Держатели образца и препаратоводители - не более 3 шт.




6. Объективы - не более 5 шт.



7. Конденсоры - не более 3 шт.

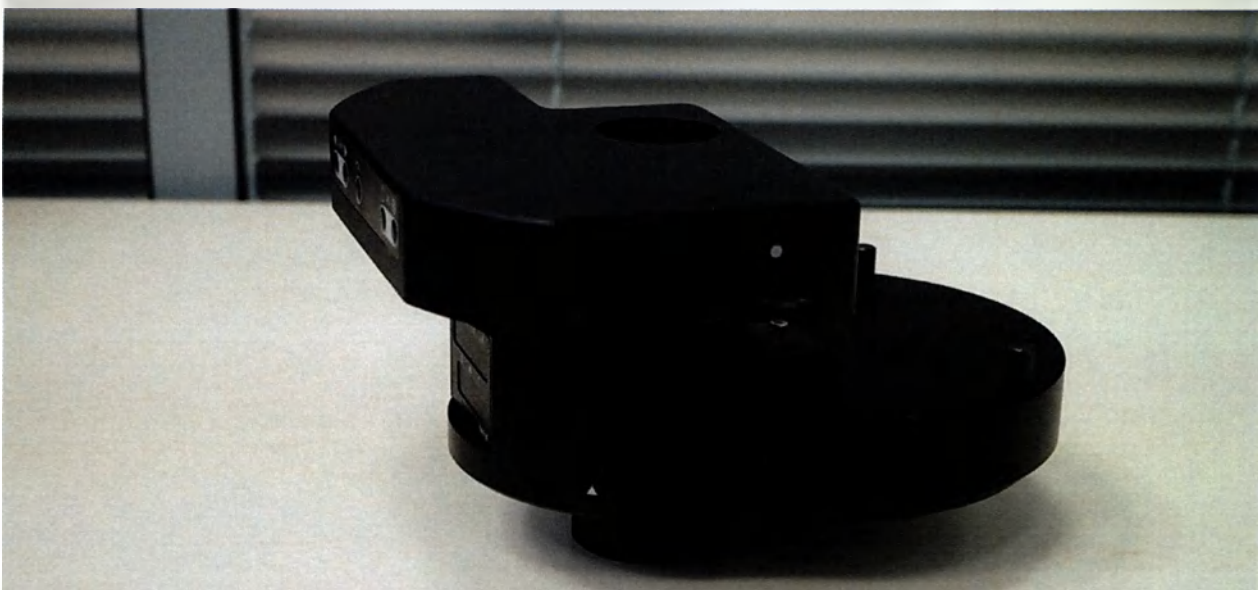

8. Светофильтры и кубы флуоресцентные фильтровые - не более 10 шт.

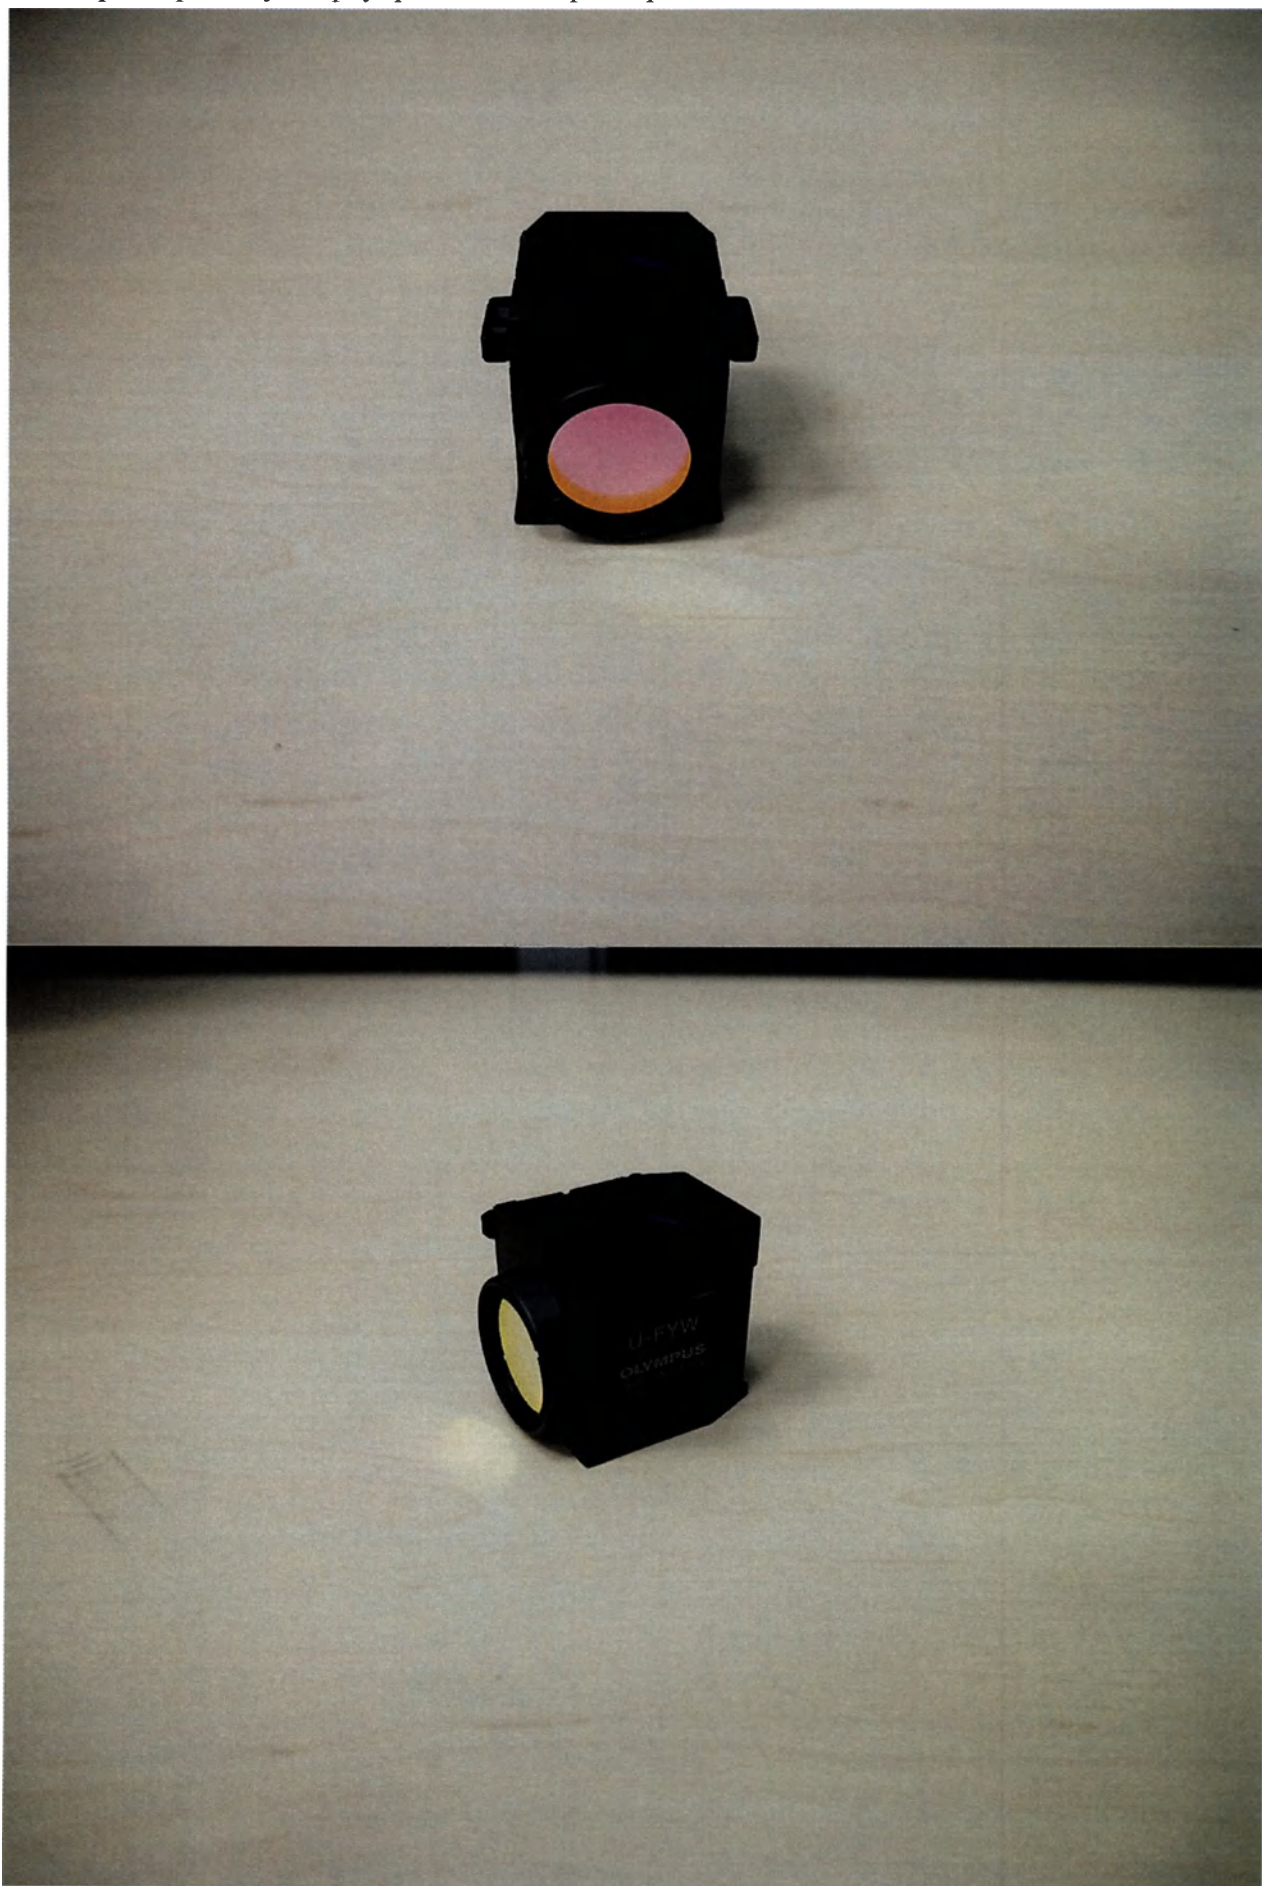

9. Призмы ДИК, светоделительные, анализаторы, поляризаторы, фазовые кольца, вставки темнопольные, вставки для Рельефного и ХOFFмана контраста - не более 8 шт.



10.Револьверные головки и головки для крепления объективов и приспособлений - не более 2 шт.




11. Осветители - флуоресцентные, светодиодные, оптоволоконные - не более 3 шт.



12. Источники света – серии X-Cite, MT10, MT20, precisExcite - не более 3 шт.



13. Лампы - галогеновые, светодиодные, ртутные, металл-галлидные, ксеноновые, ртутно-ксеноновые - не более 10 шт.

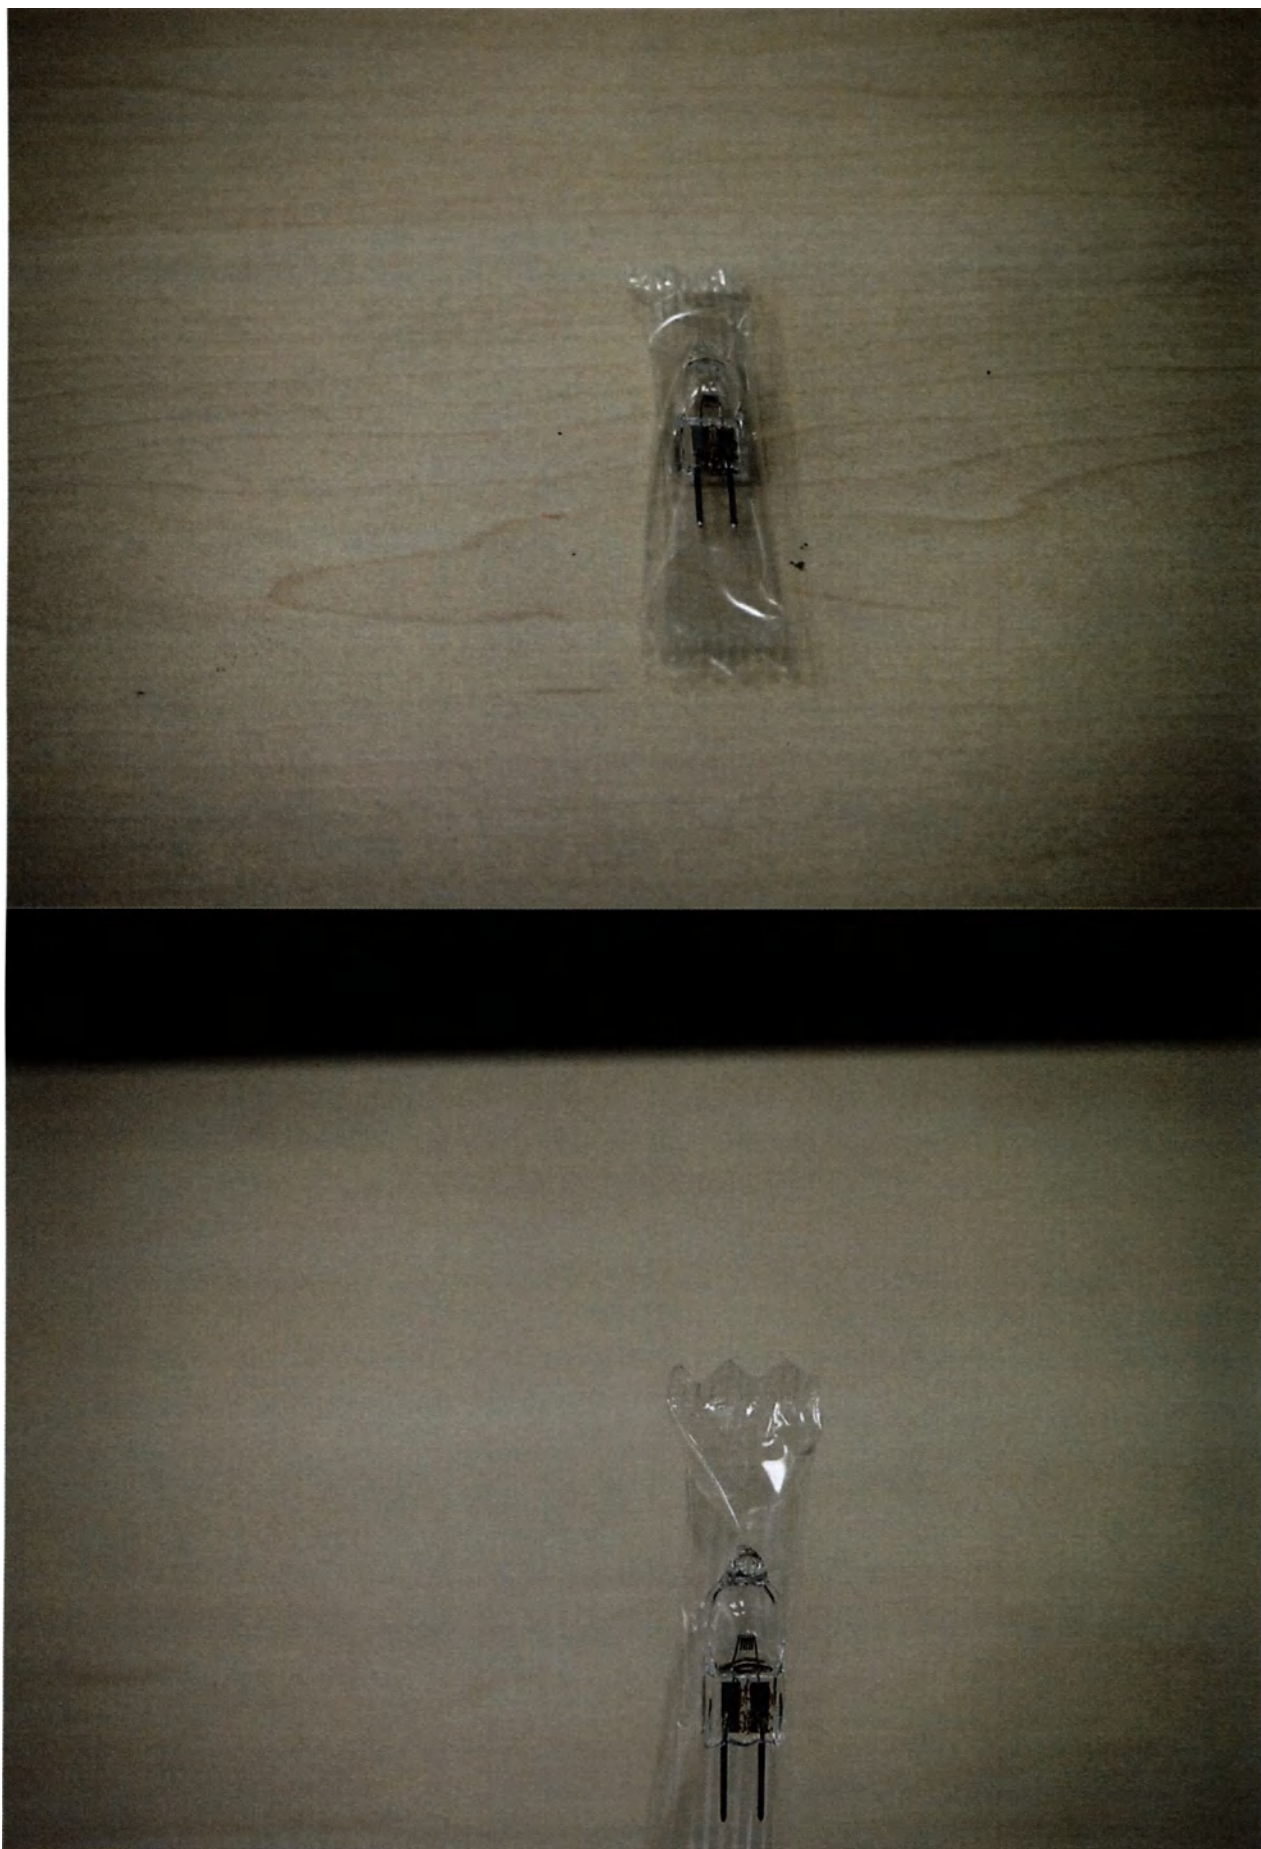

14.Блоки питания ламп, домики ламп - не более 3 шт.



15.Центрирующий телескоп - не более 1 шт.



16. Камера цифровая серий - DP, SC, UC, UM, XC, XM, LC - не более 3 шт.



17. Программное обеспечение серии CELL, DP, CKX-CCSW, FV, BitPlane, VS, CellSens, Stream, LabSens и программные модули к ним – не более 3 шт.




18. Адаптеры для крепления цифровых камер, световодов, модулей и блоков, адаптеры C-mount - не более 6 шт.



19.Блок для получения и архивации изображения с монитором, программным обеспечением, принтером - не более 1 шт.




20. Приставка с системой SMARTCUT – не более 1 шт.

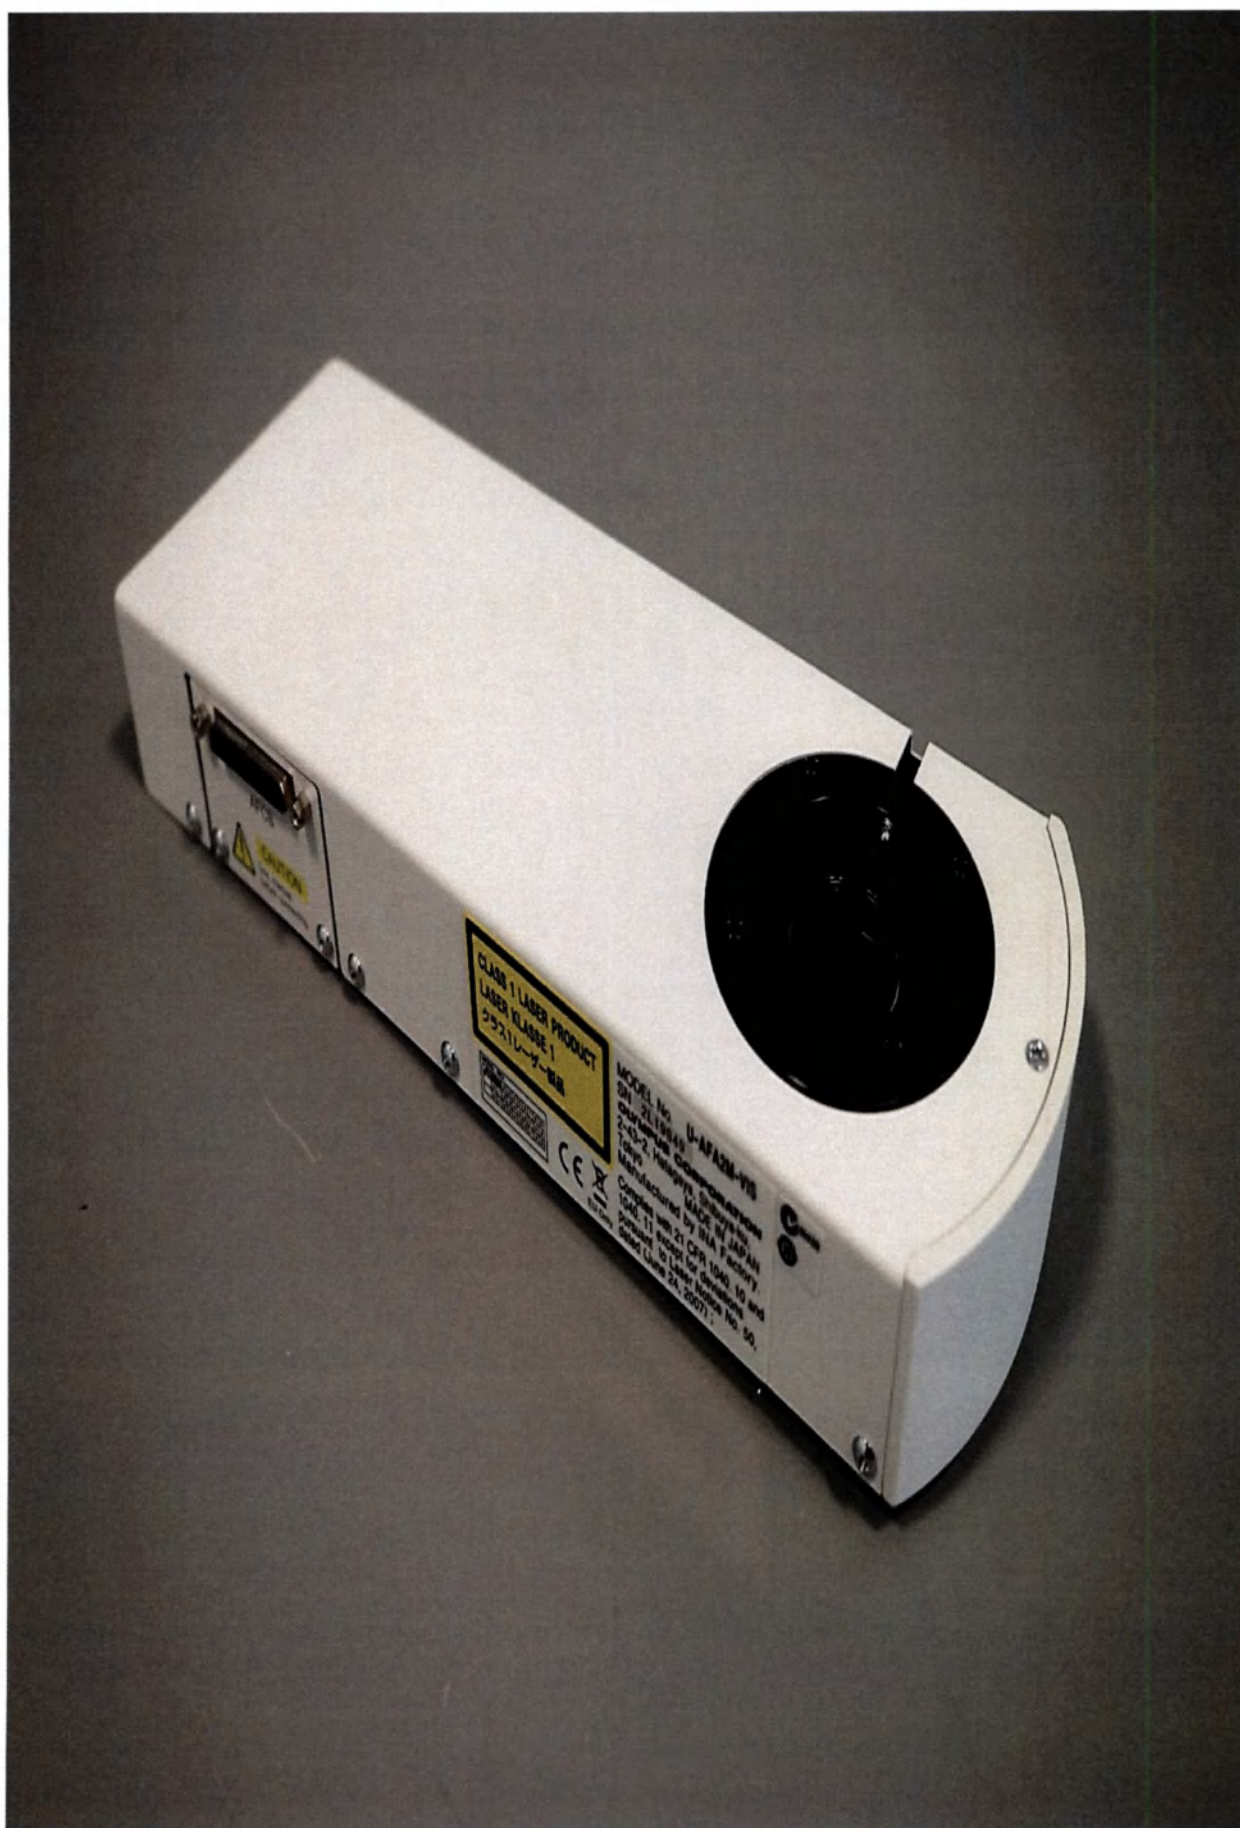

21. Дискуссионные насадки – не более 18 шт




22. Микроманипуляторы – не более 6 шт

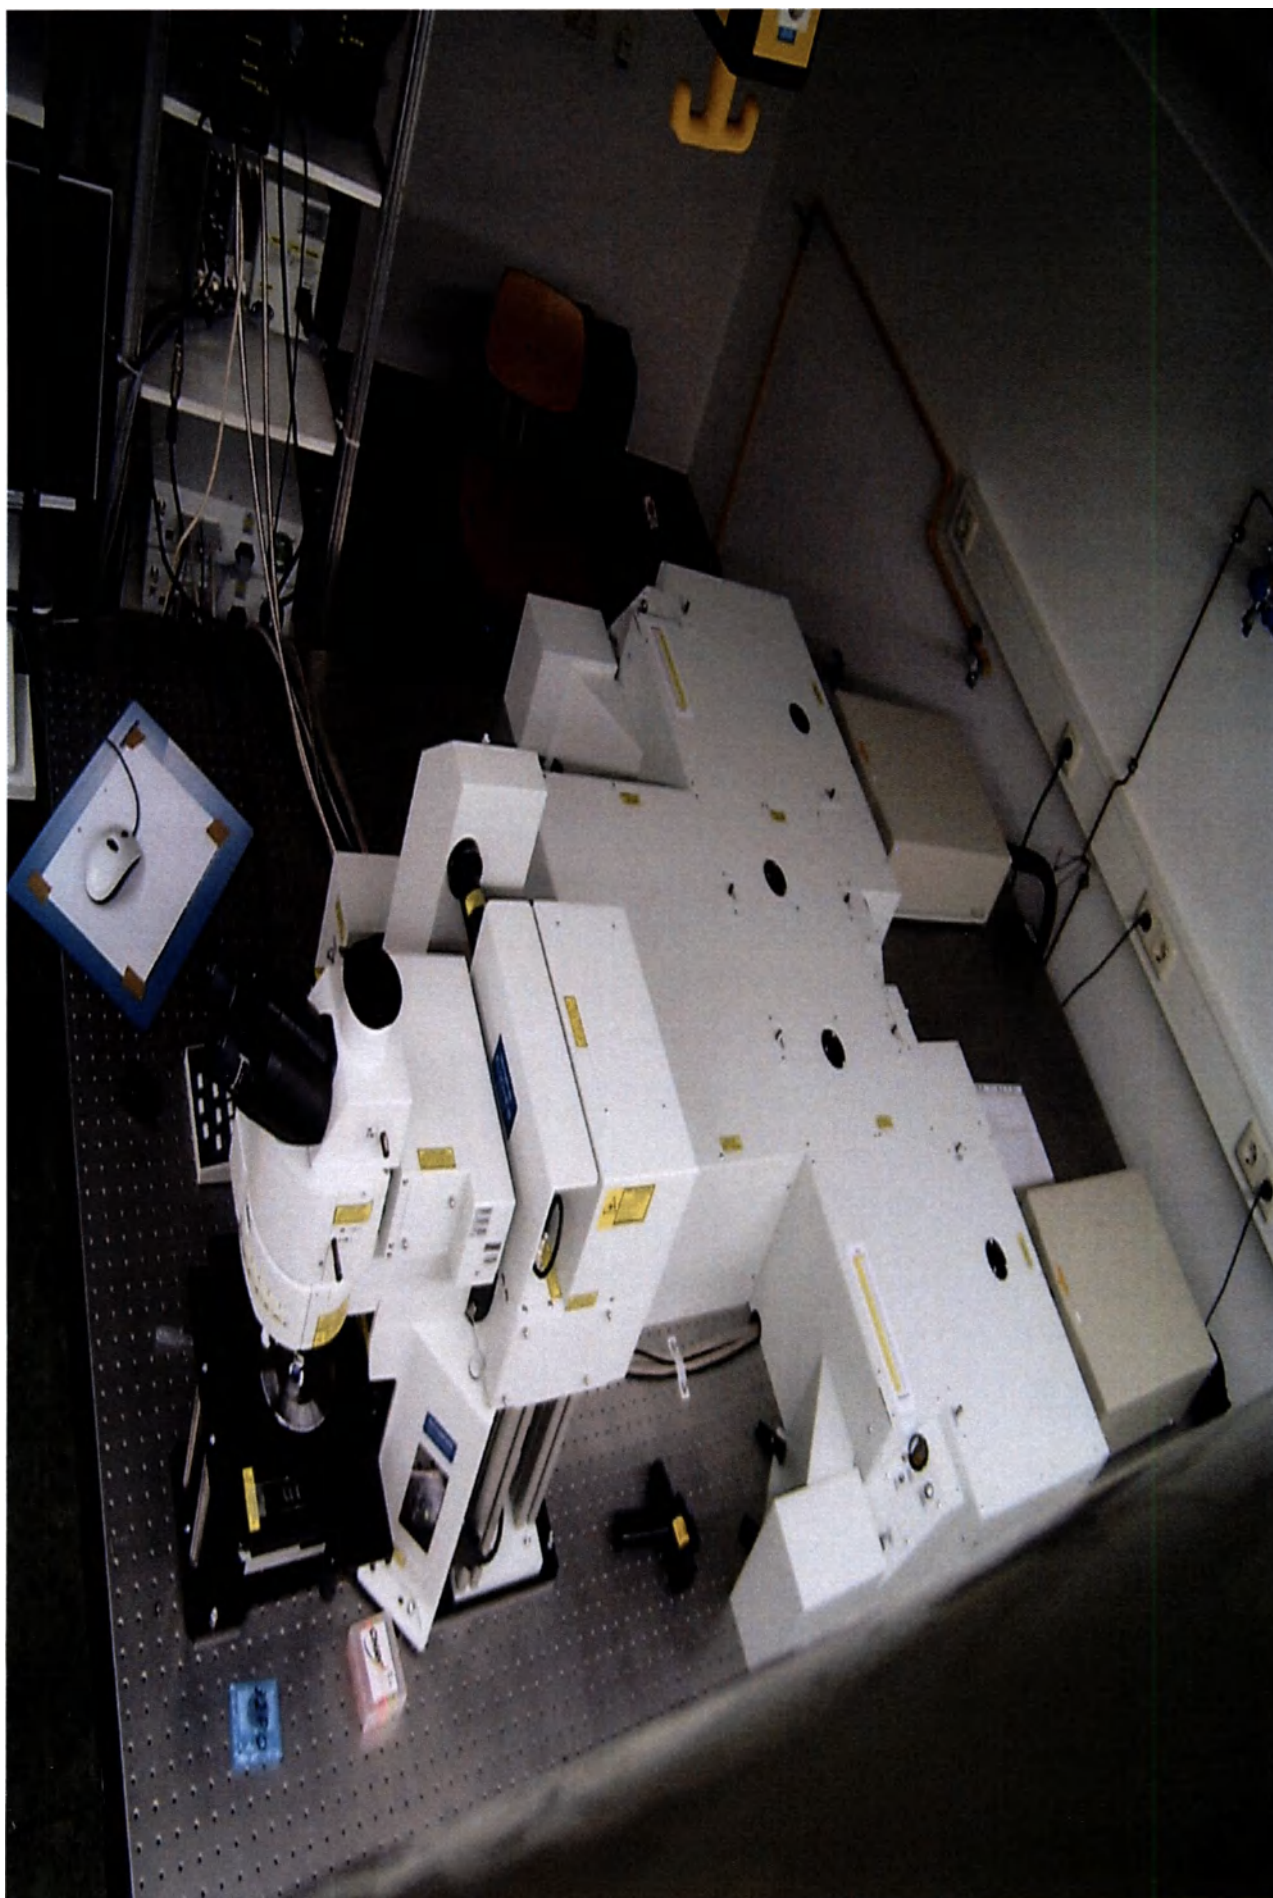

23. Промежуточные вставки - увеличитель рабочего расстояния, оптовары, дополнительные порты, светоделители. – не более 4 шт.




24. Держатели вставок и светофильтров, слайдеры, фильтровые турели, шторка автоматическая - не более 4 шт.

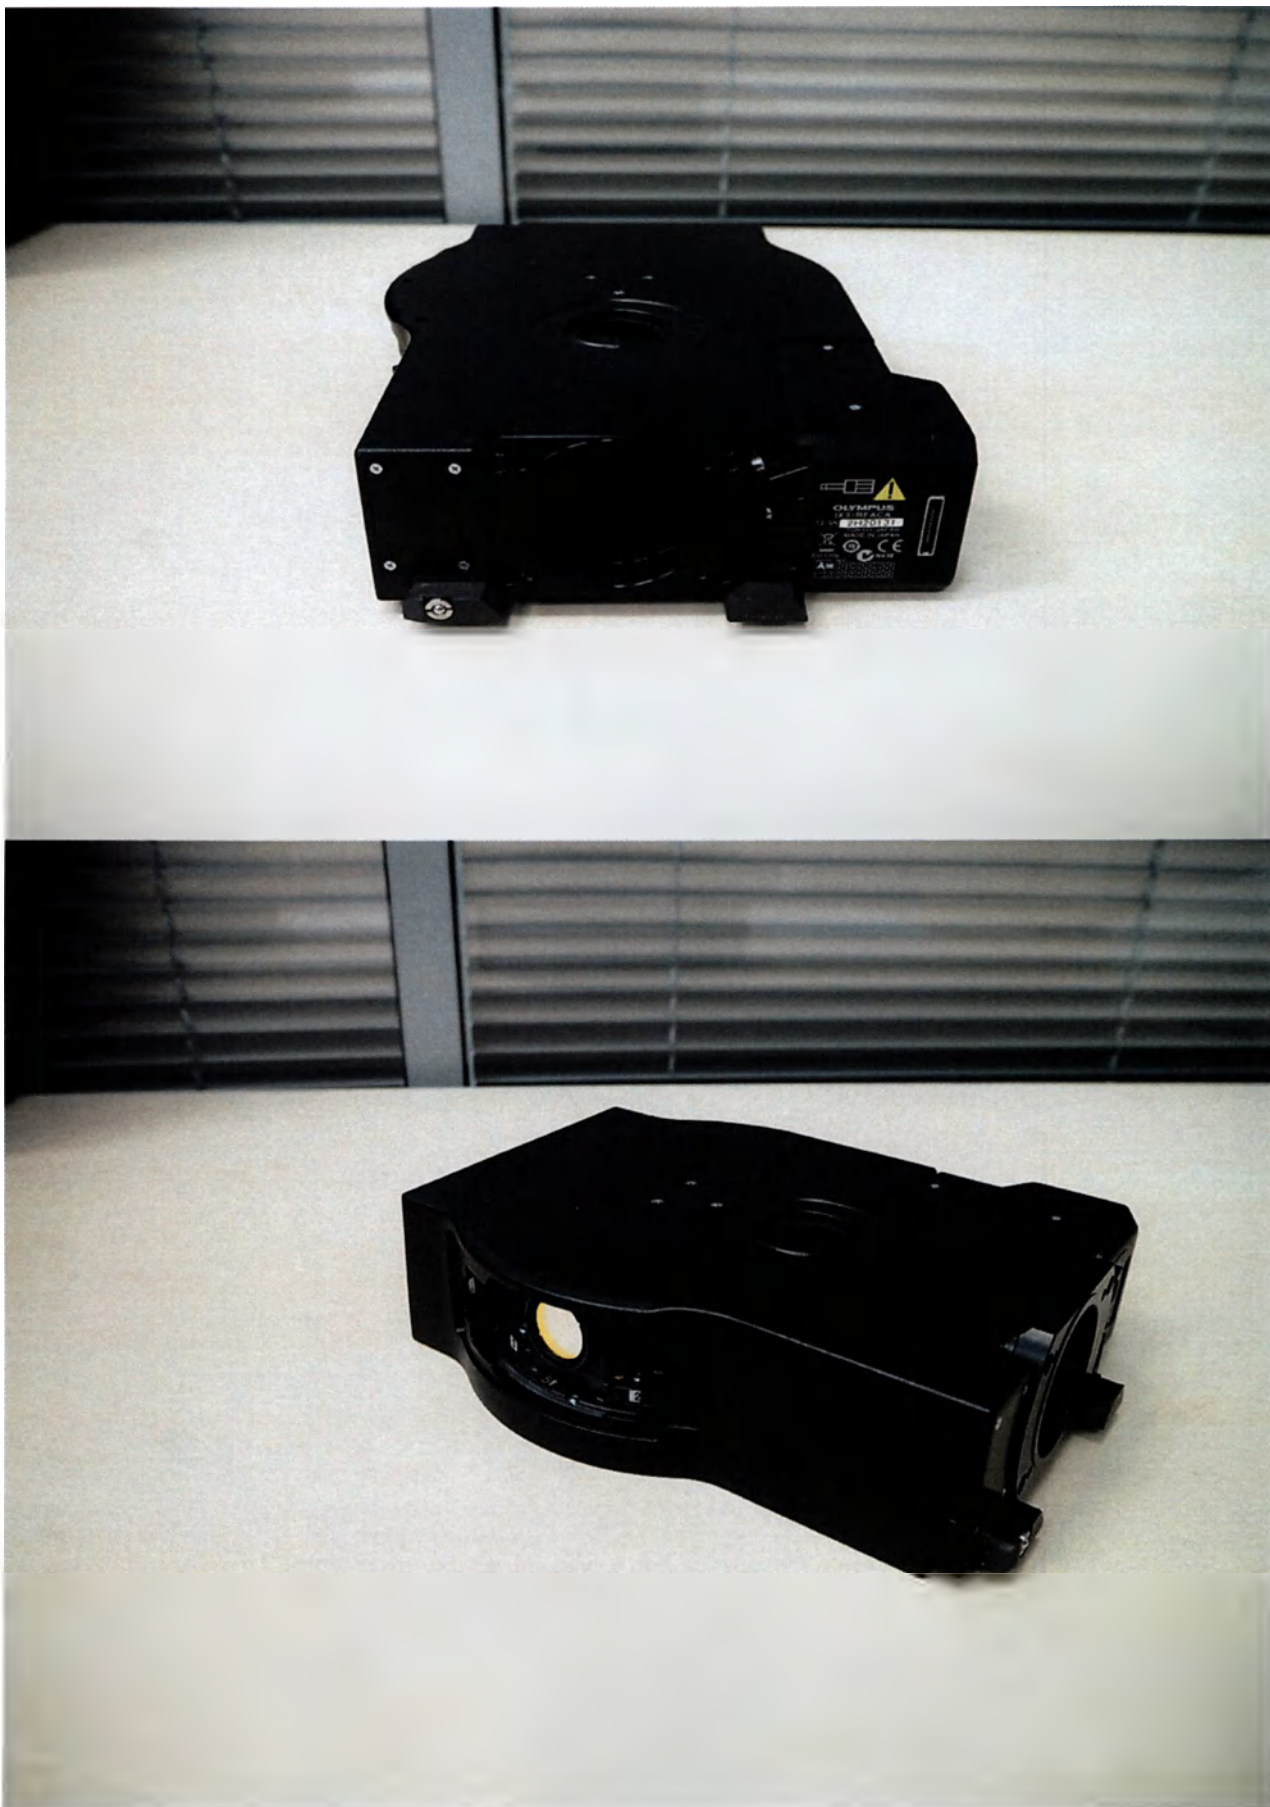


25. Антивибрационные столики и подставки. – не более 1 шт



26. Диафрагмы

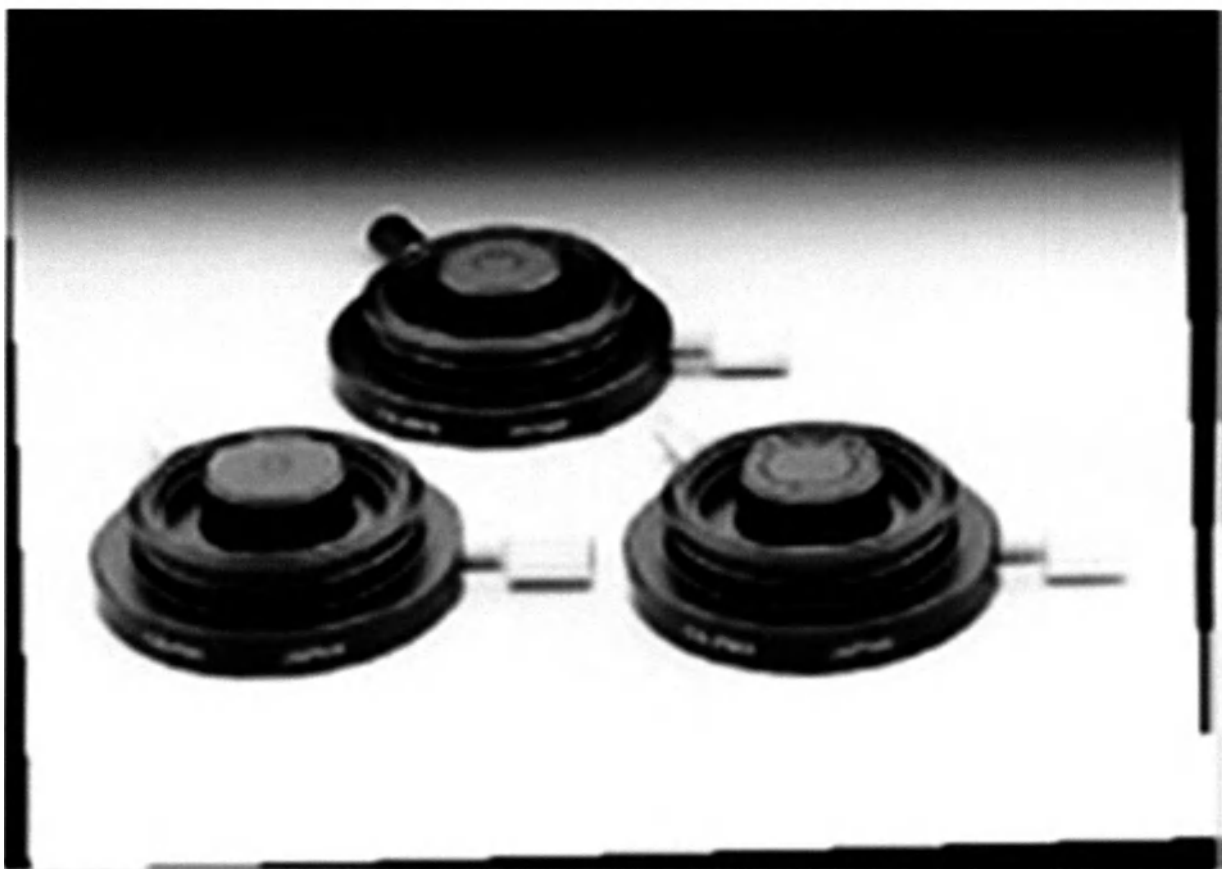


27. Объект-микрометры. – не более 5 шт.

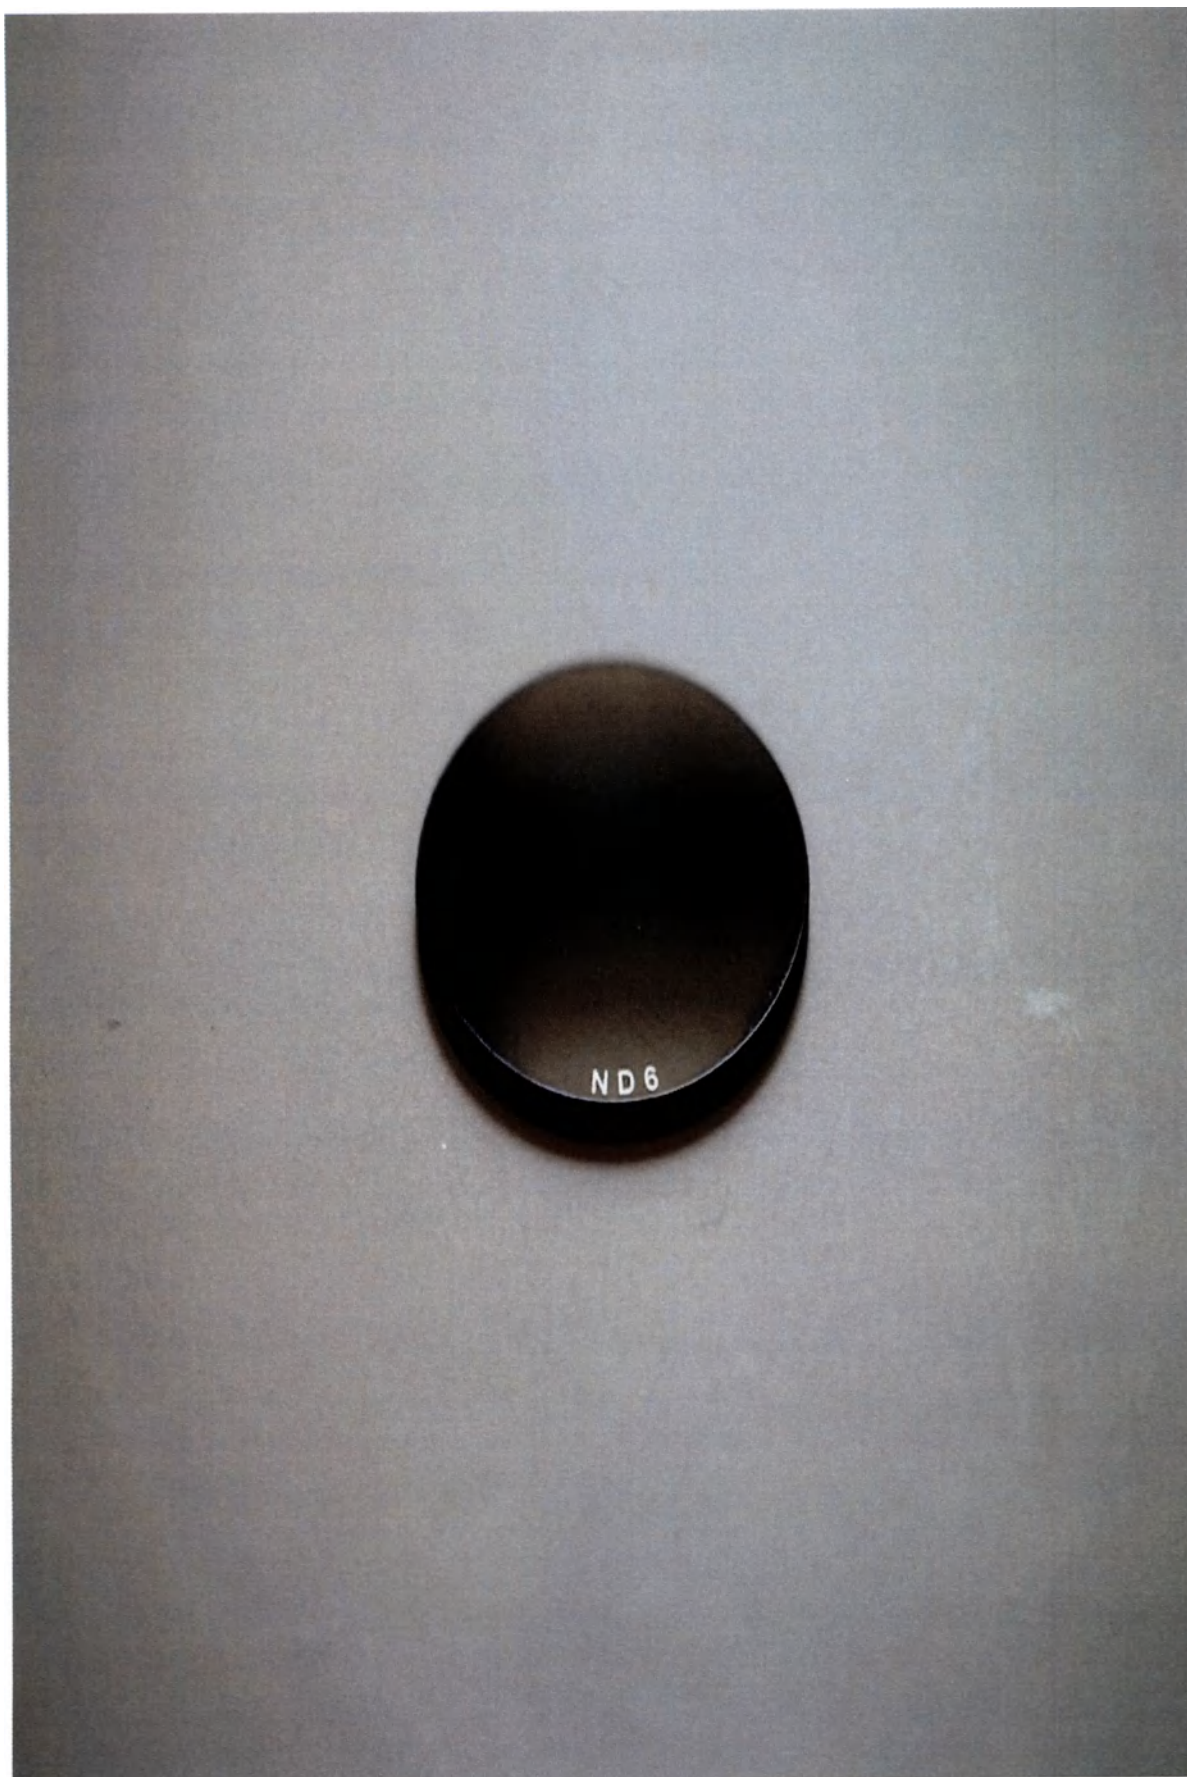


28. Центровочные окуляры, тестовые пластины, компенсаторы – не более 4




29. Эргономичные резиновые насадки на рукоятки управления – не более 5 шт

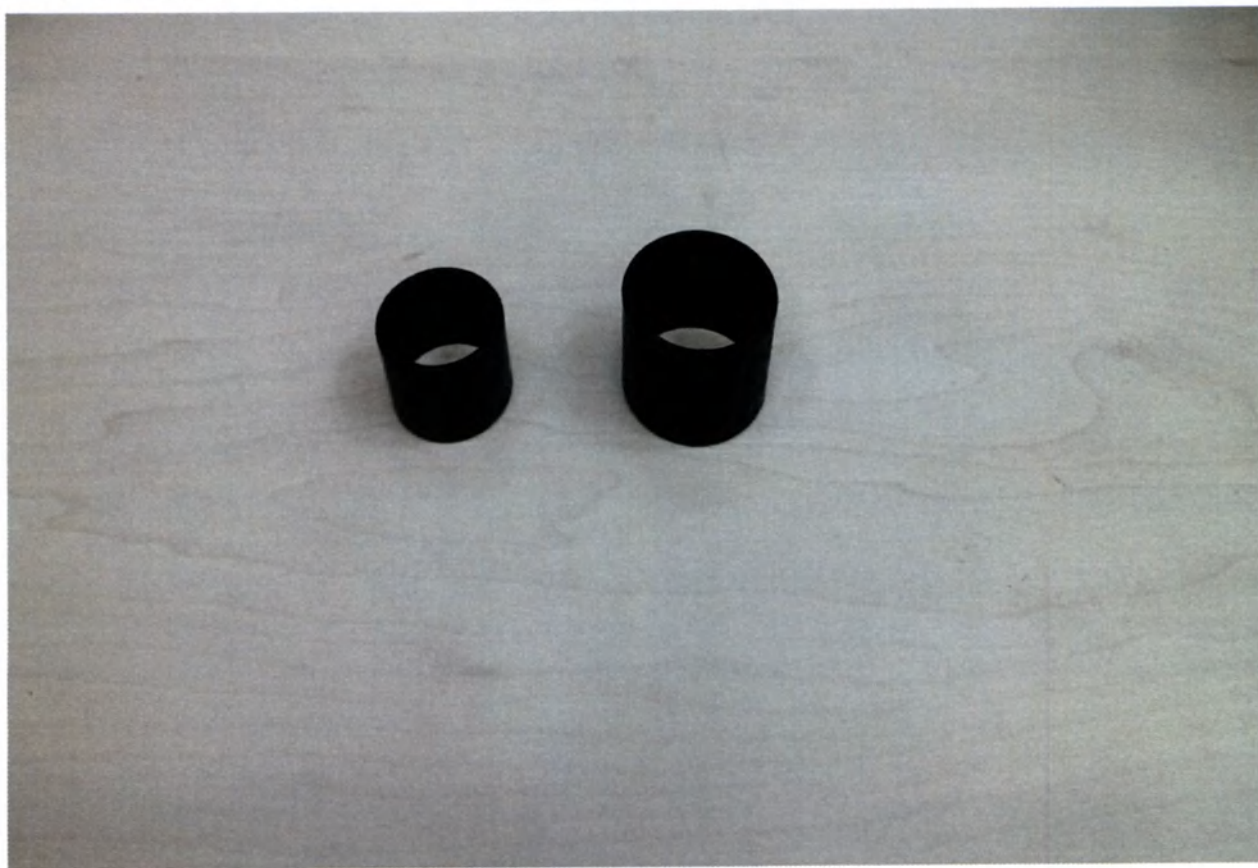

30. Иммерсионное масло - не более 5 шт.

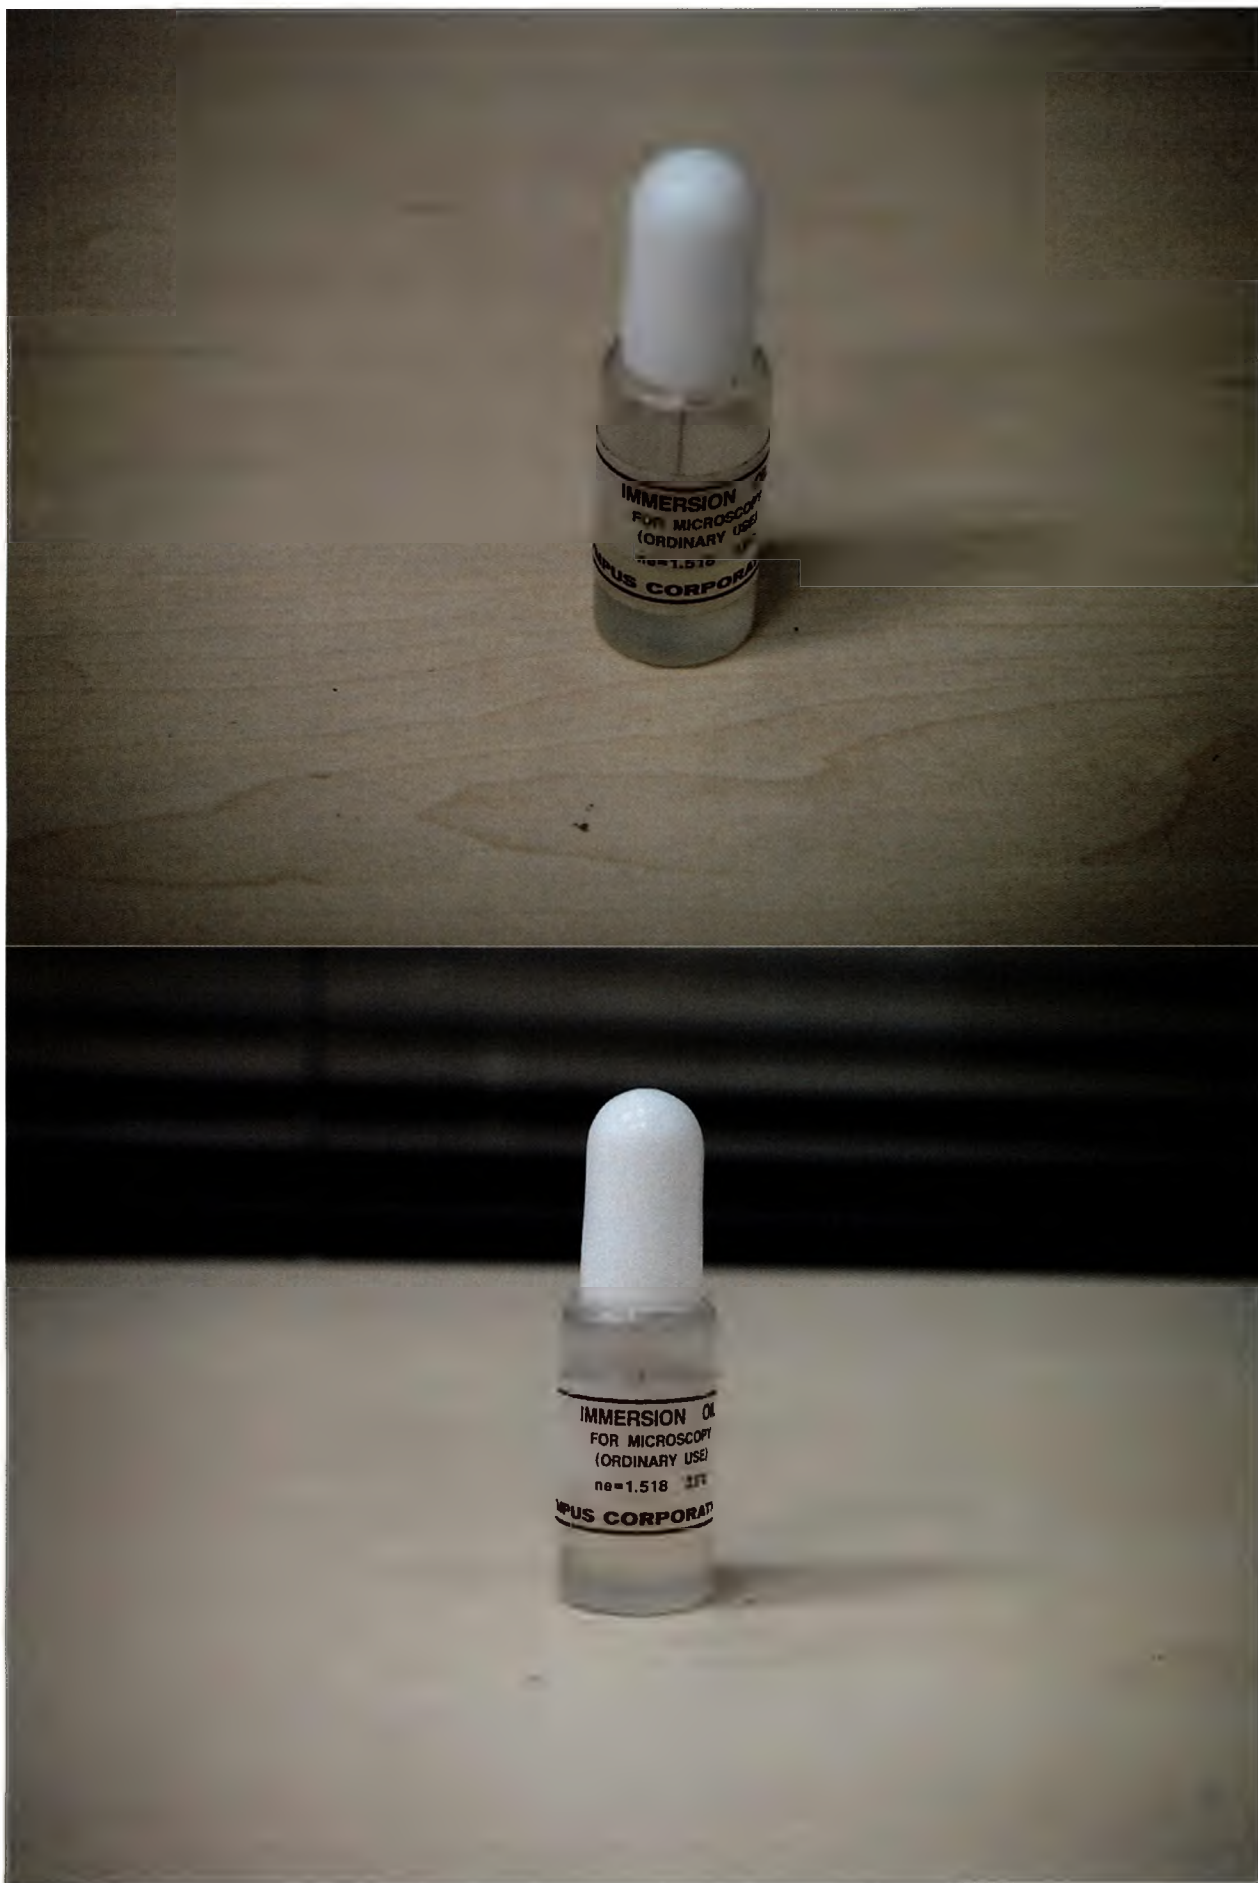


31. Салфетки для чистки оптики. – не более 5 шт.

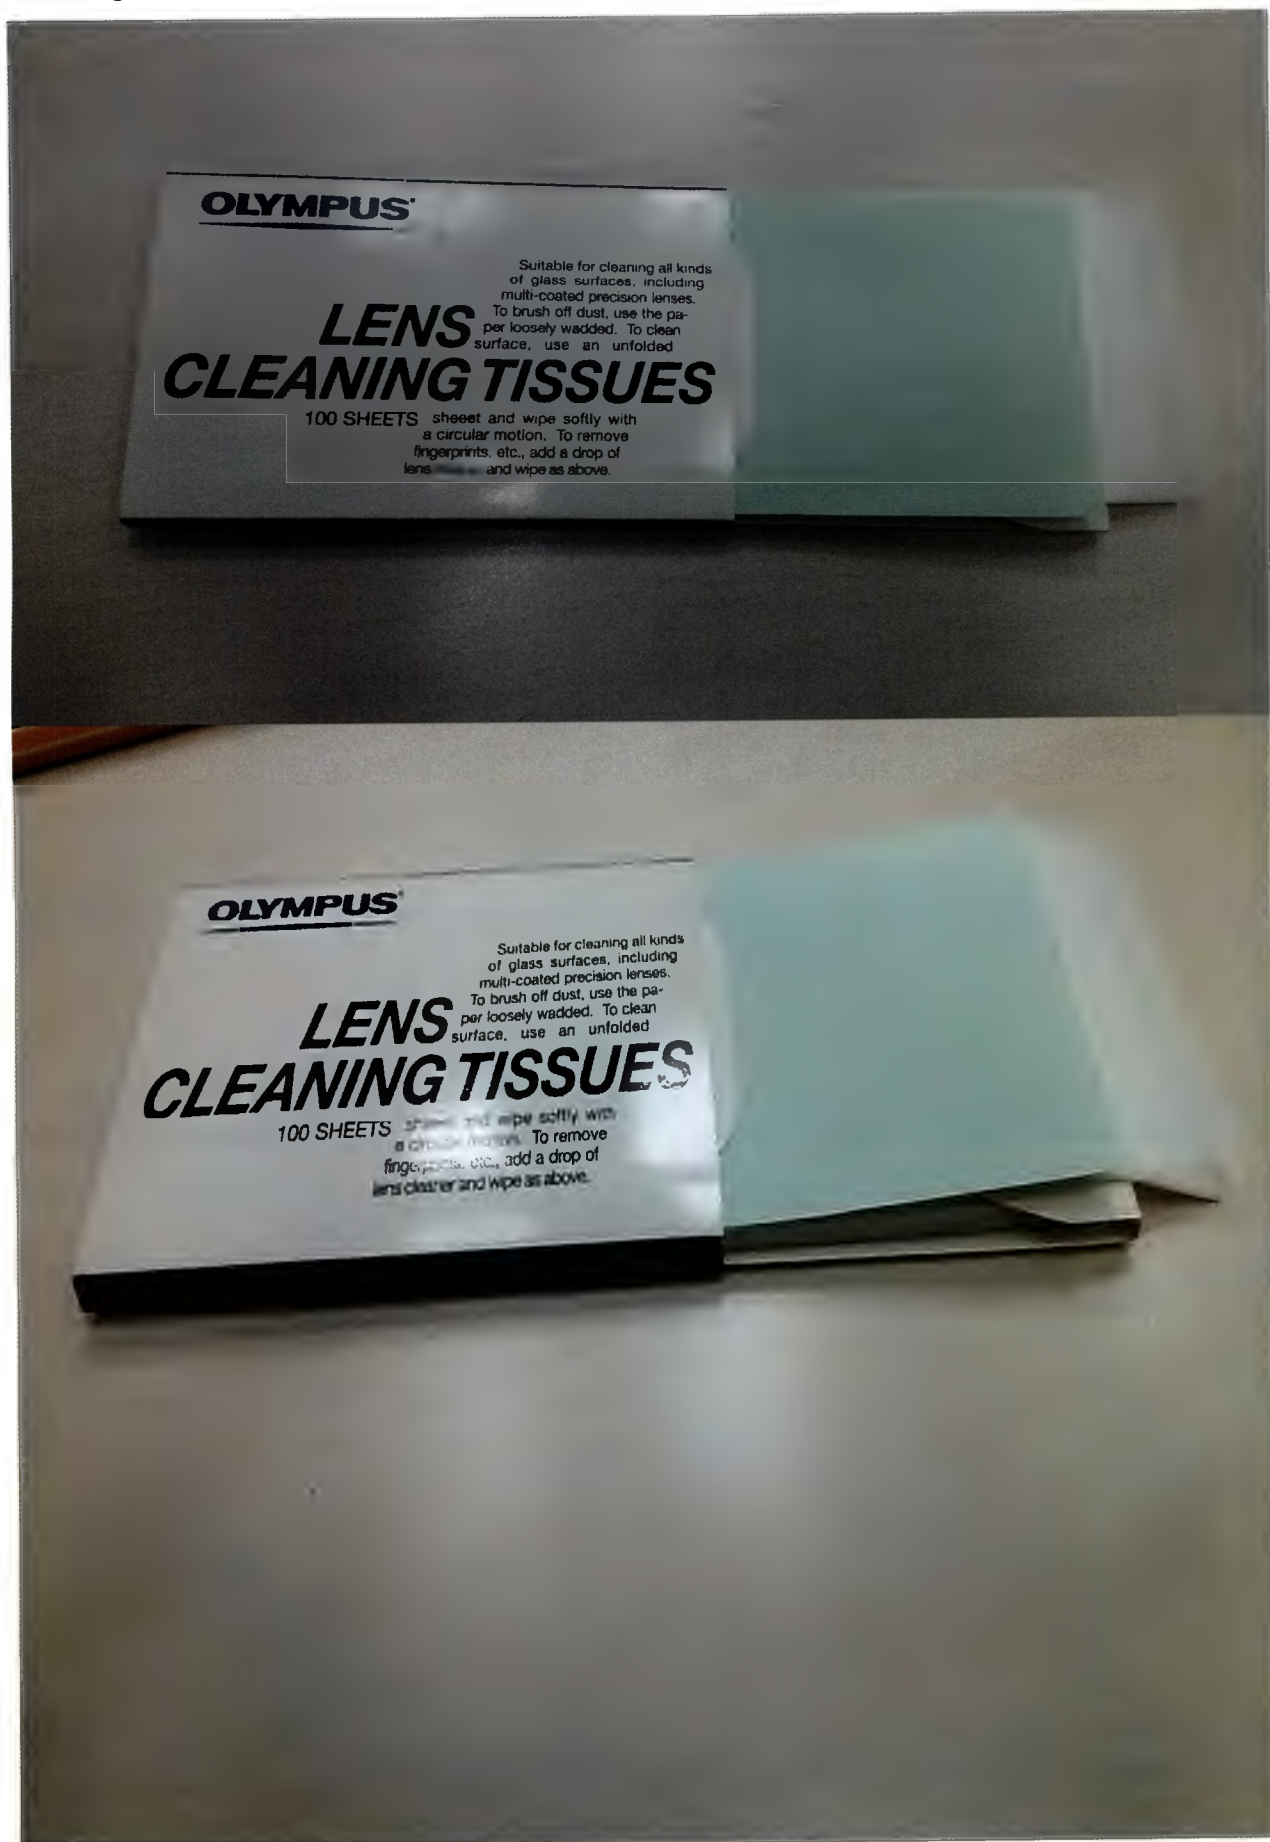

32. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.



33. Сетевой кабель - не более 4 шт.

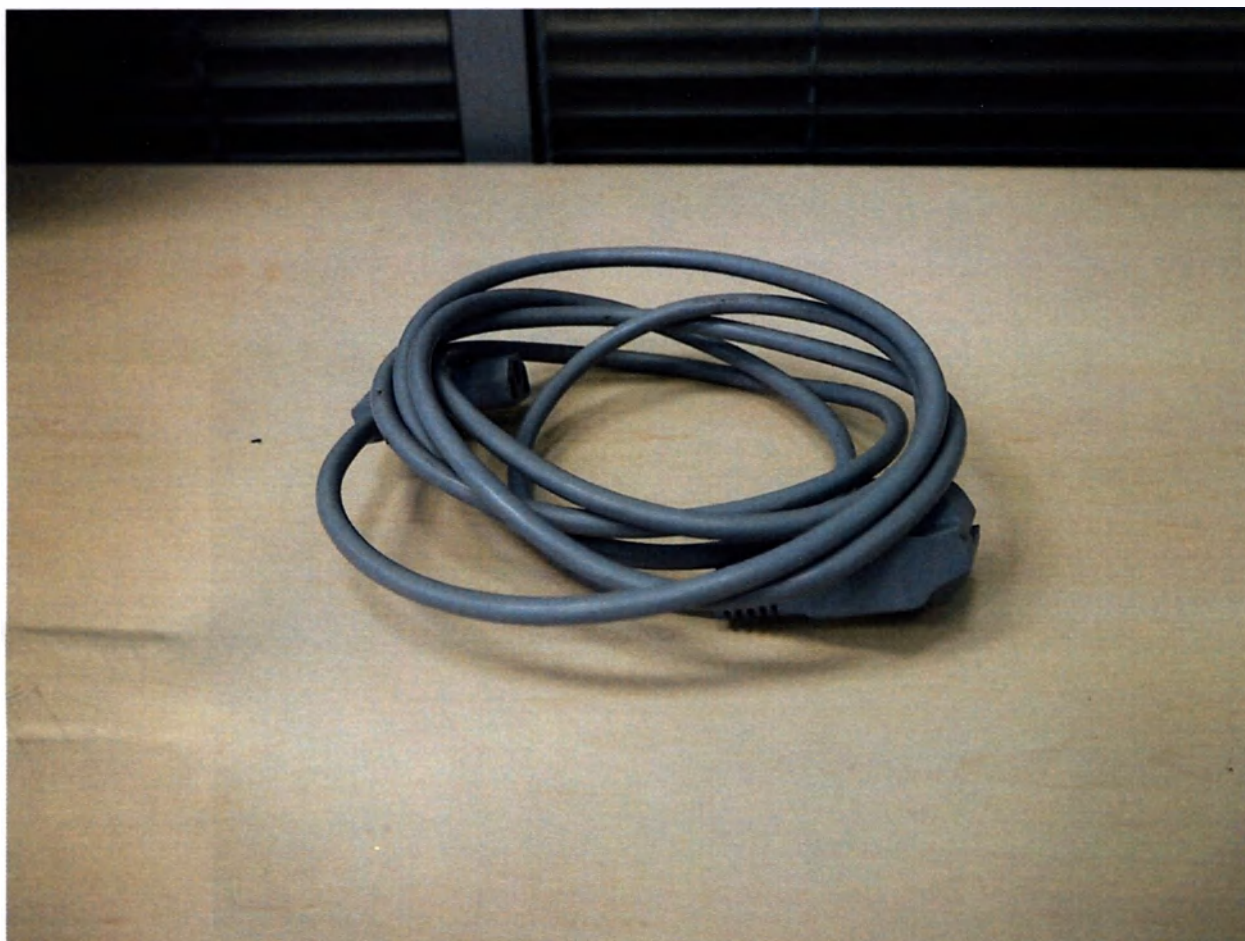

1
Пронумеровано, прошнуровано, прошито
и скреплено печатью

35 (тридцать пять) листов

Генеральный директор
ООО «Олимпас Москва»

В.А. Миронова
В.А. Миронова

