
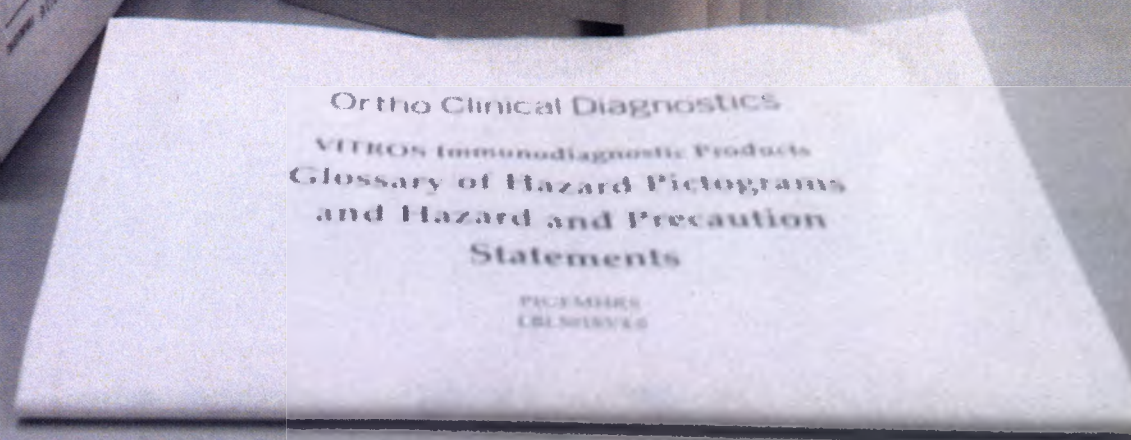


**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия:**

**Реагент VITROS Сифилис ТРА в кассете (VITROS Syphilis TPA Reagent Pack) для
иммунодиагностического определения антител к *Treponema pallidum* на анализаторах серии
VITROS**

необходимыми для применения медицинских изделий по назначению

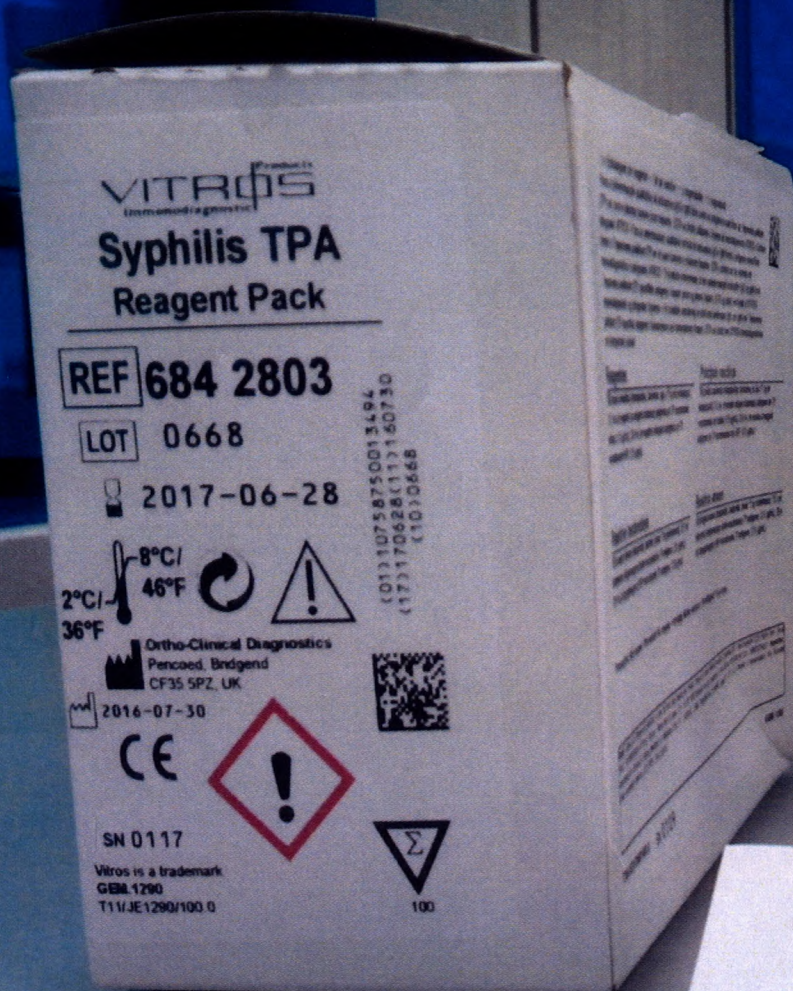

ВСЕГО 2 листов а
«11» 05 2017 г.

Генеральный Директор

ООО «Орто-Клиникал Диагностикс»

Истомина Н.Е

