



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

**«Материал для изготовления стоматологических реставраций IPS e.max Press в различных вариантах исполнения
с принадлежностями»,
производства: Ivoclar Vivadent AG, Лихтенштейн**

Заготовки IPS e.max Press Ingots HO, цвета: 0 (5 шт/уп)

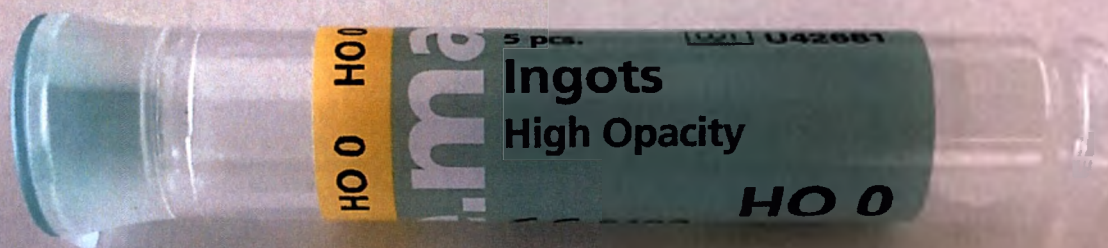

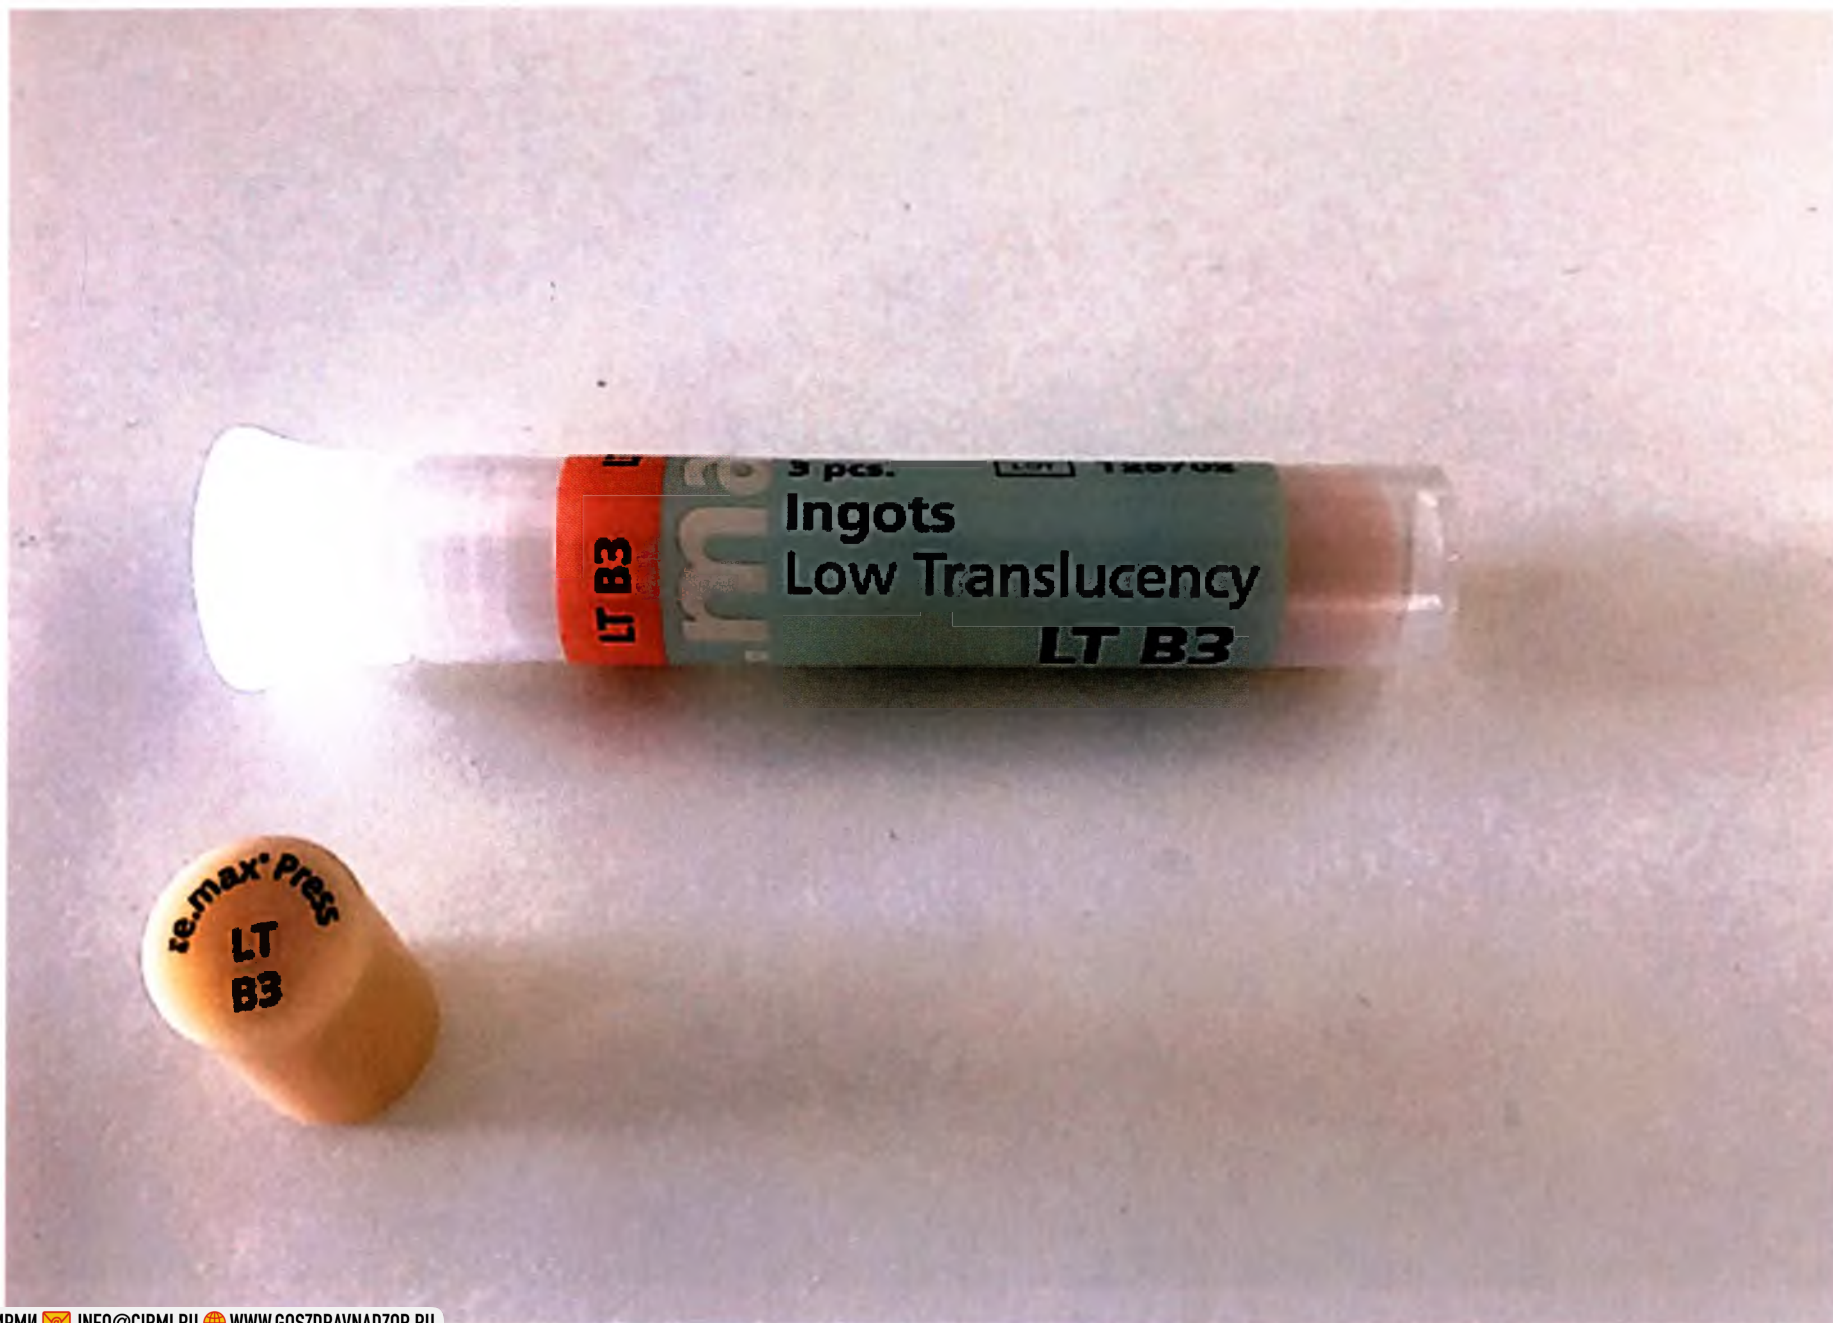


Заготовки IPS e.max Press Ingots HT, цвета: А4 (5 шт/уп)



Заготовки IPS e.max Press Ingots Impulse, цвета: Opal 1 (5 шт/уп)




Заготовки IPS e.max Press Ingots MT L, цвета: A2 (3 шт/уп)

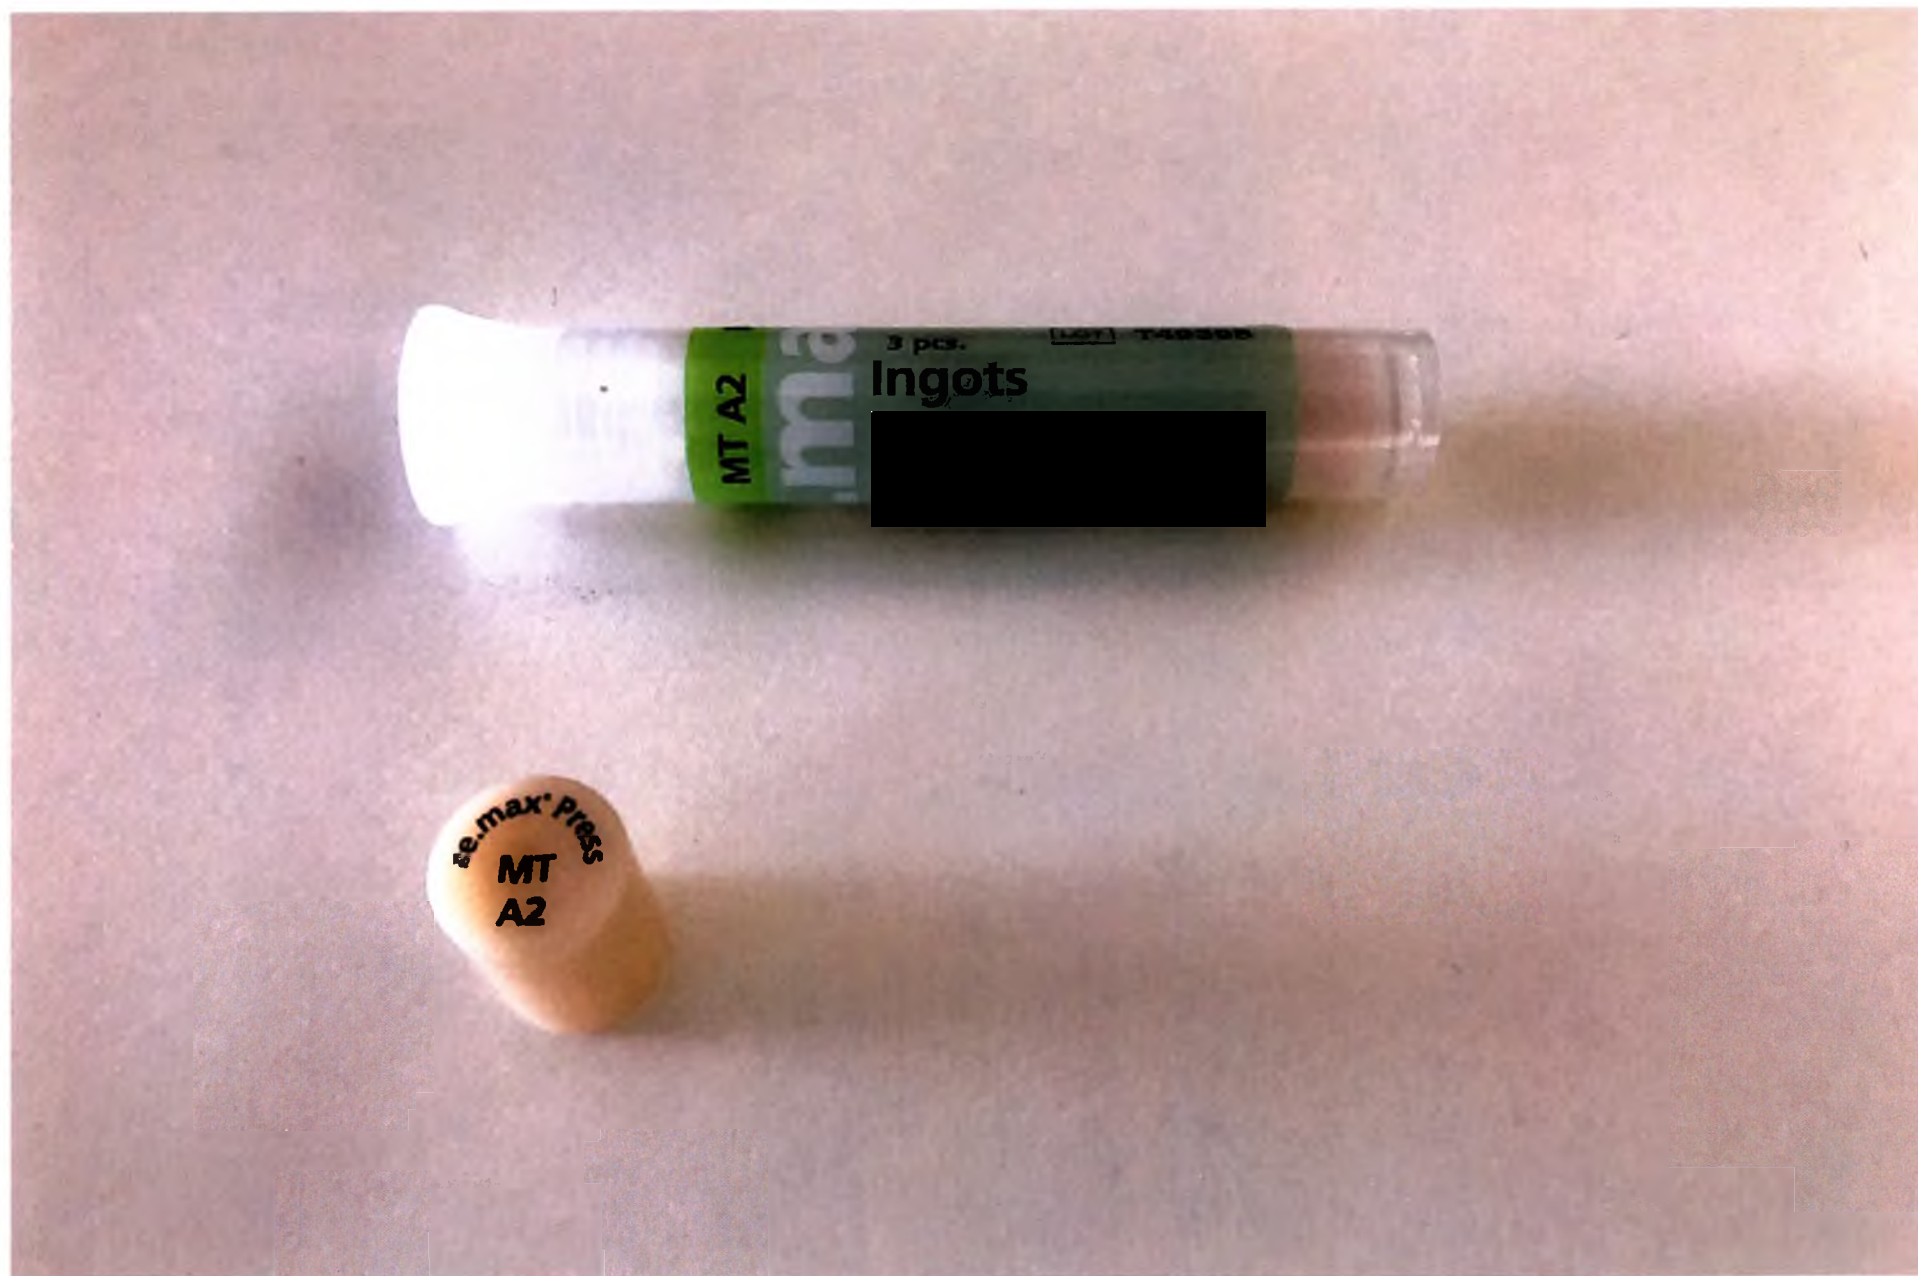

Шаблон IPS Multi Wax Pattern Form A (80 шт/уп)



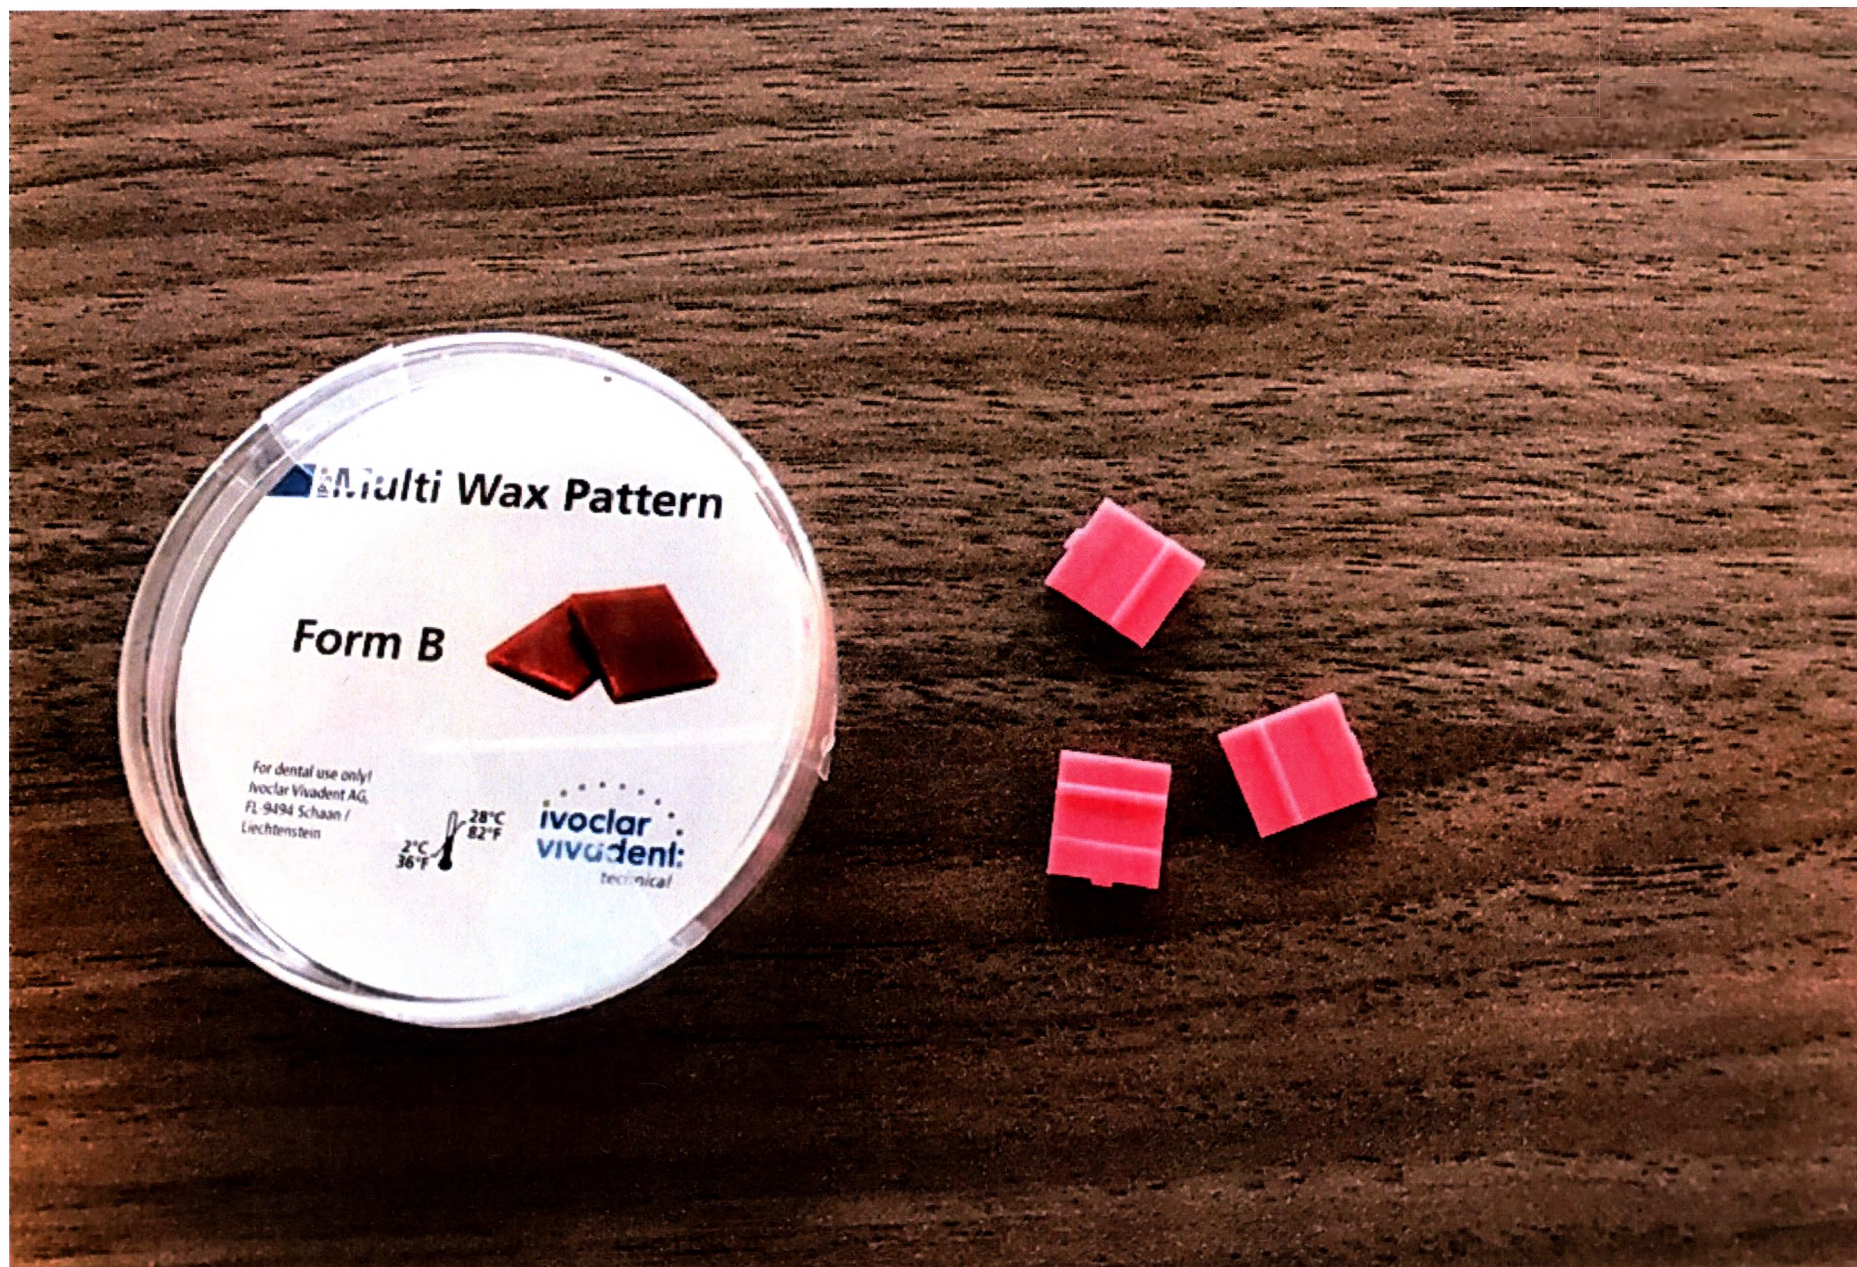






Deutsch


Sie erhalten anbei die Anstiftlehre IPS Sprue Guide. Ihnen auf einfache Art und Weise hilft, die korrekte Anstiftung der zu pressenden Objekte auf der Muffenbasis zu kontrollieren.


- Fügen Sie vor der Verwendung die zwei Einzelteile miteinander zusammen.
- Die Anstiftlehre wurde bewusst so gestaltet, dass sie in der einen Hälfte die äussere Begrenzung der Muffel darstellt und in der anderen Funktions-Hälfte die notwendigen Abstände sowie die Anstiftposition zeigt.
- Durch Drehen des IPS Sprue Guides auf der Muffenbasis können sie gut alle Objekte kontrollieren.
- Bitte die Hinweise in der Material-Verarbeitungsanleitung beachten.

Расцветка IPS e.max Press HO/MO Shade Guide




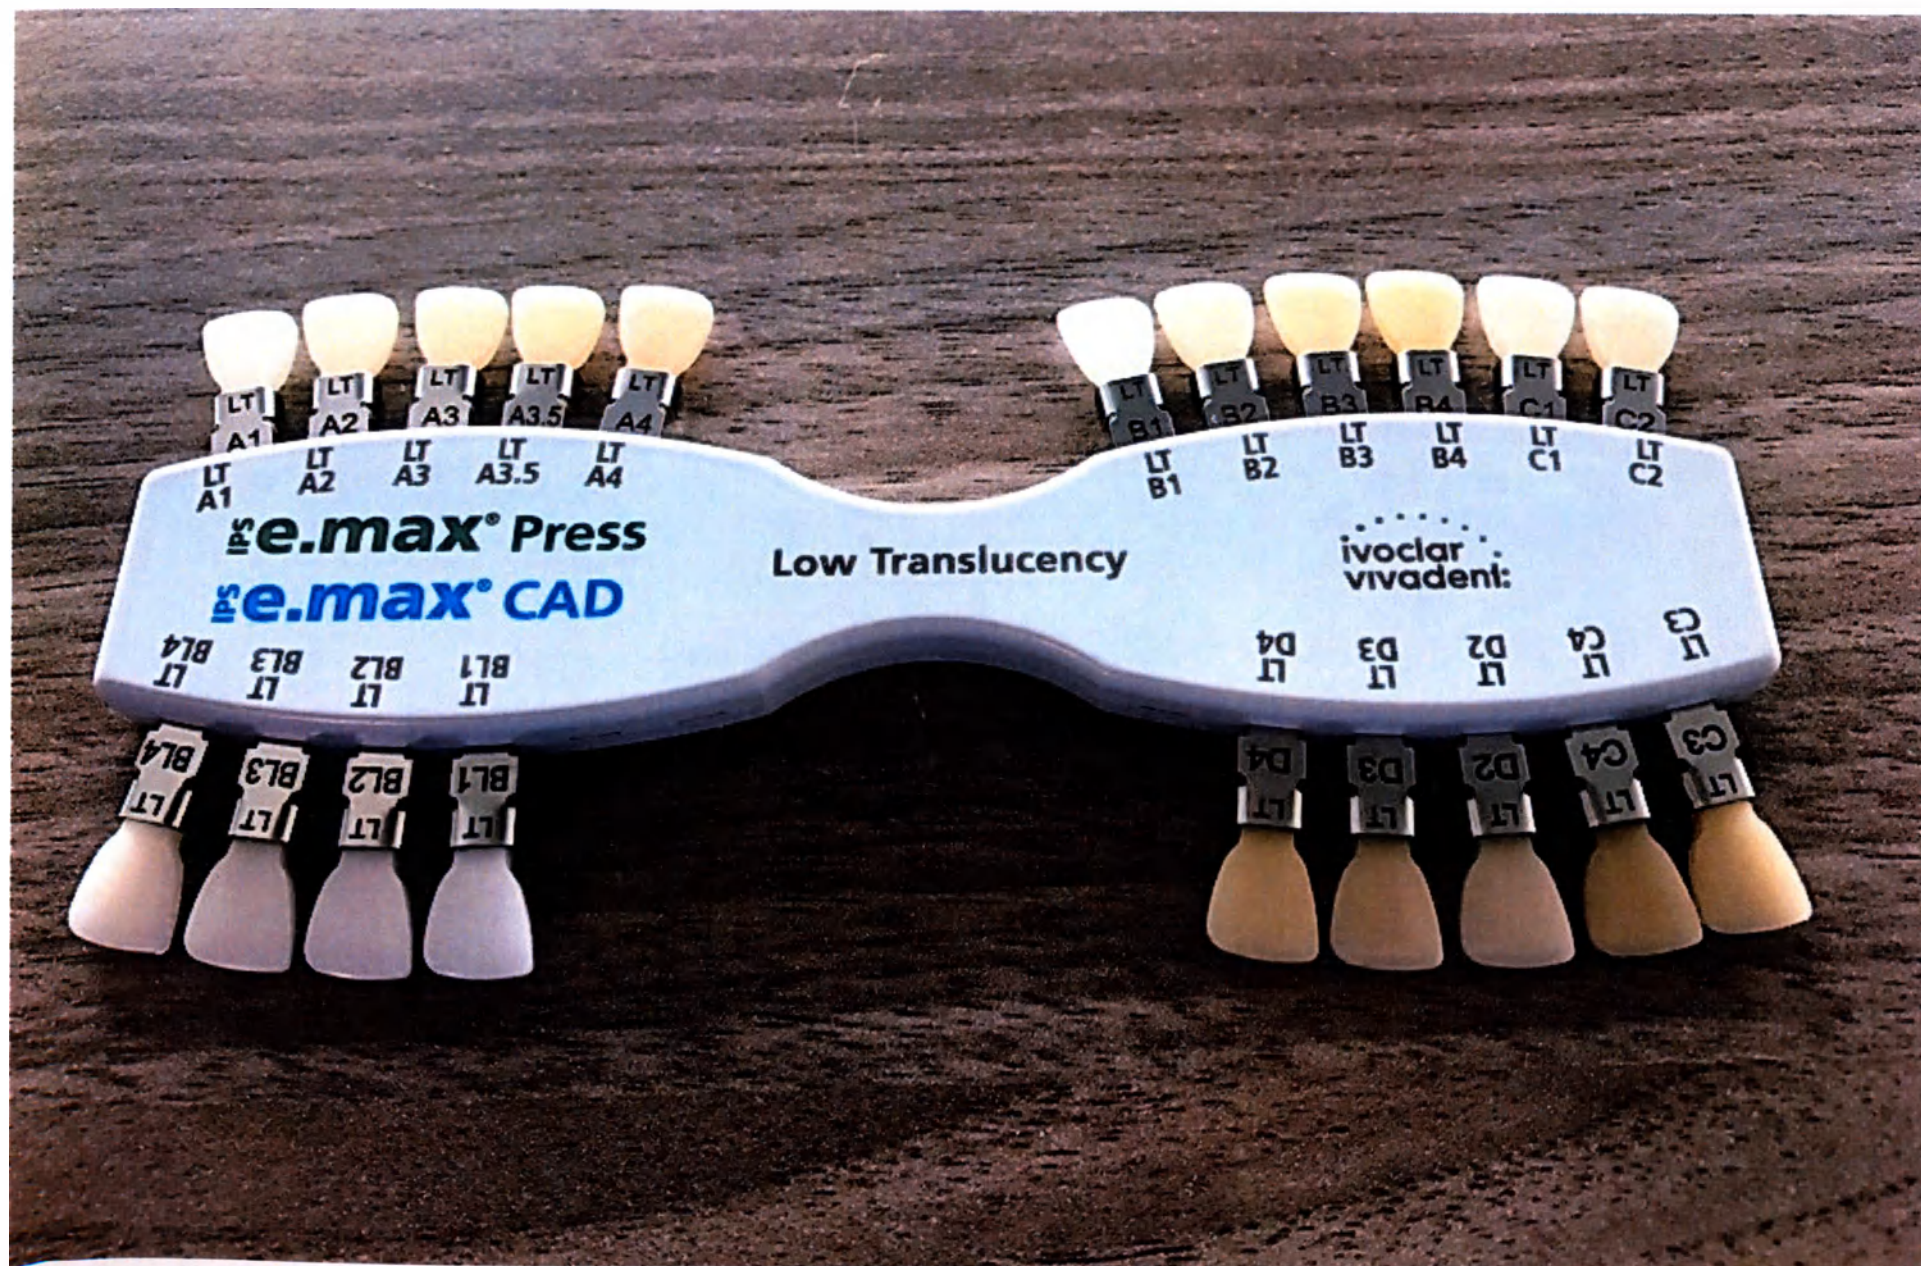

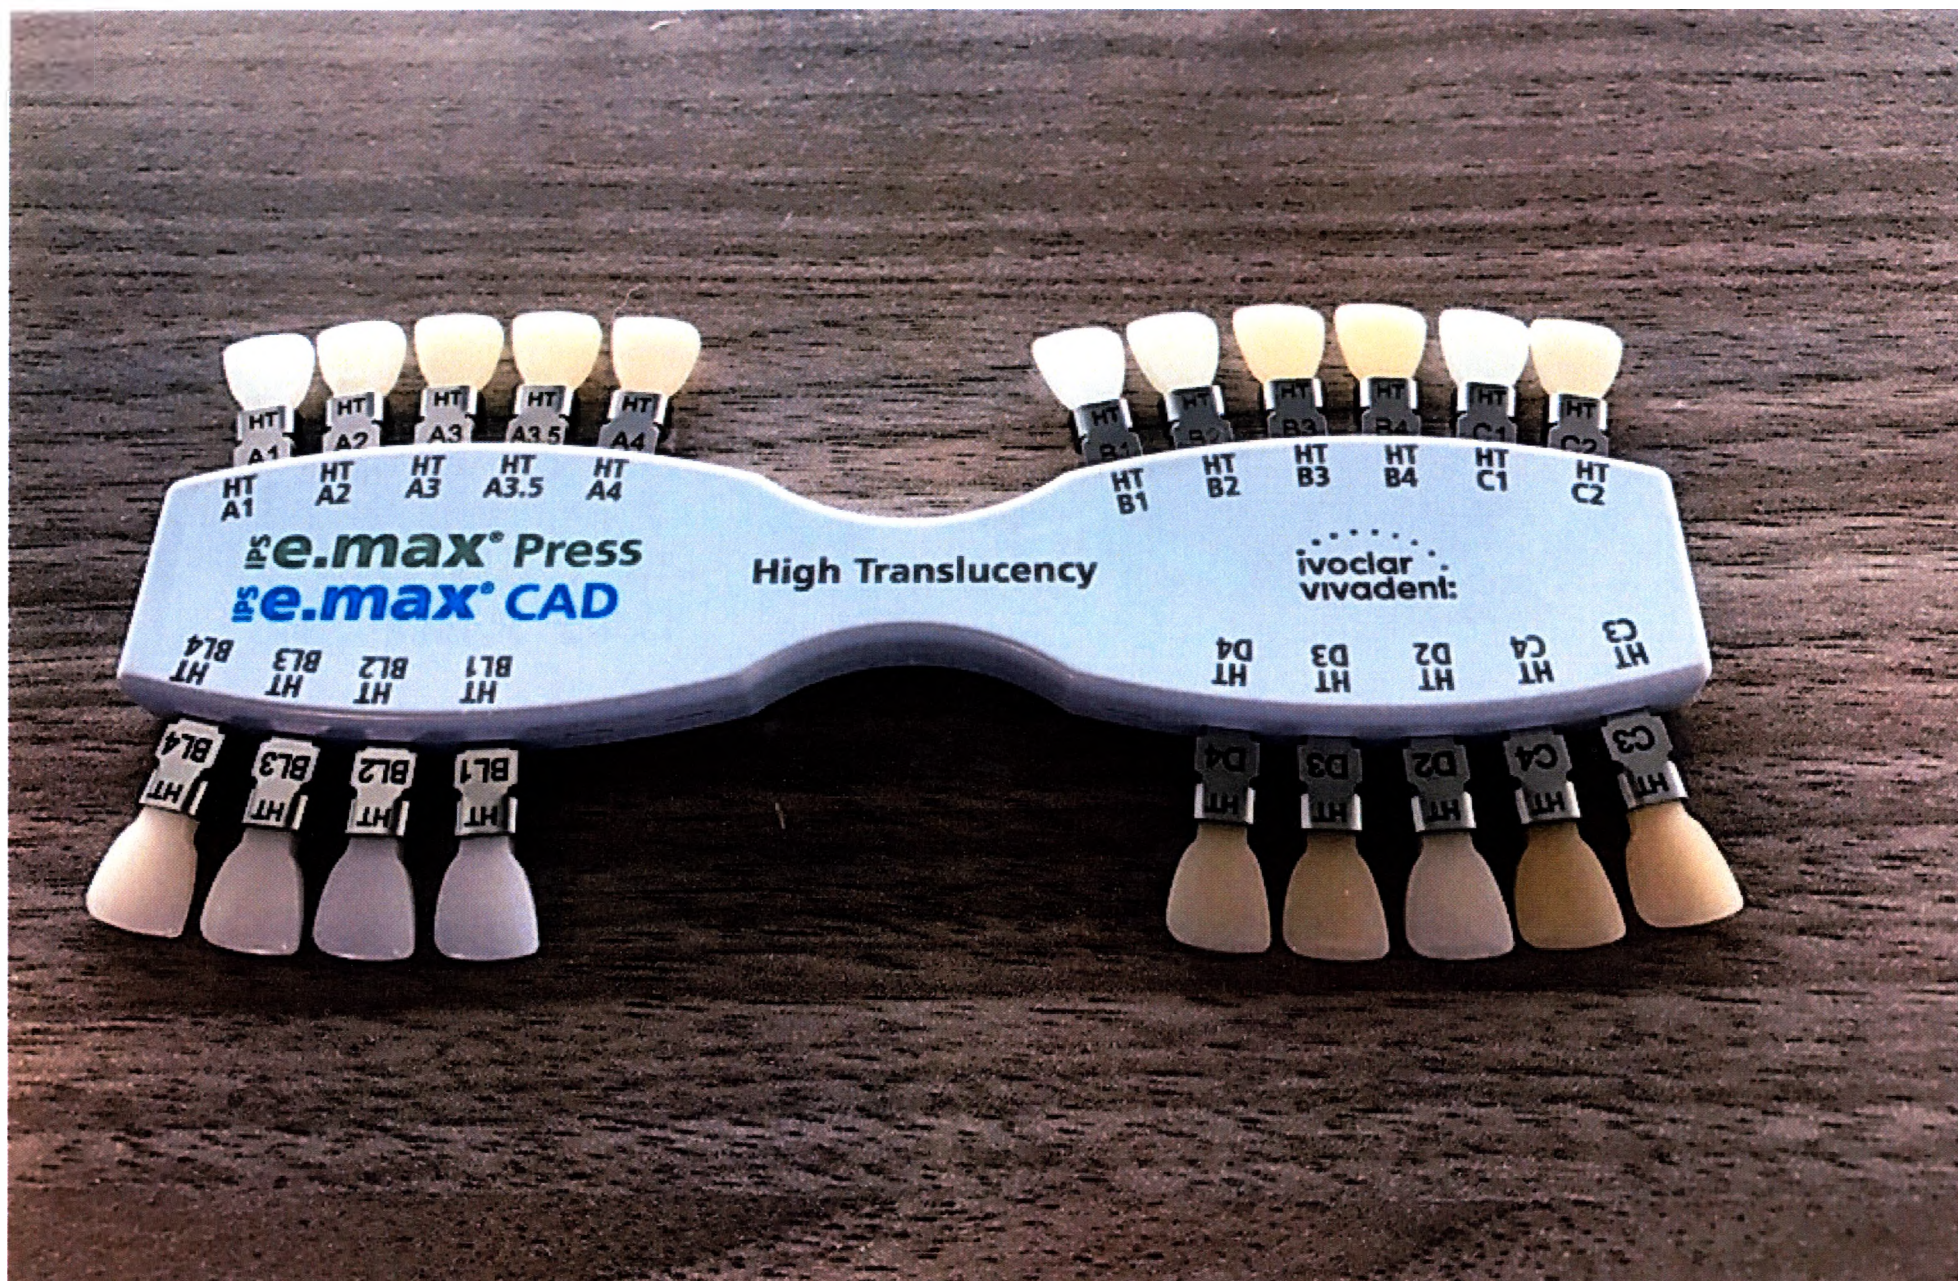

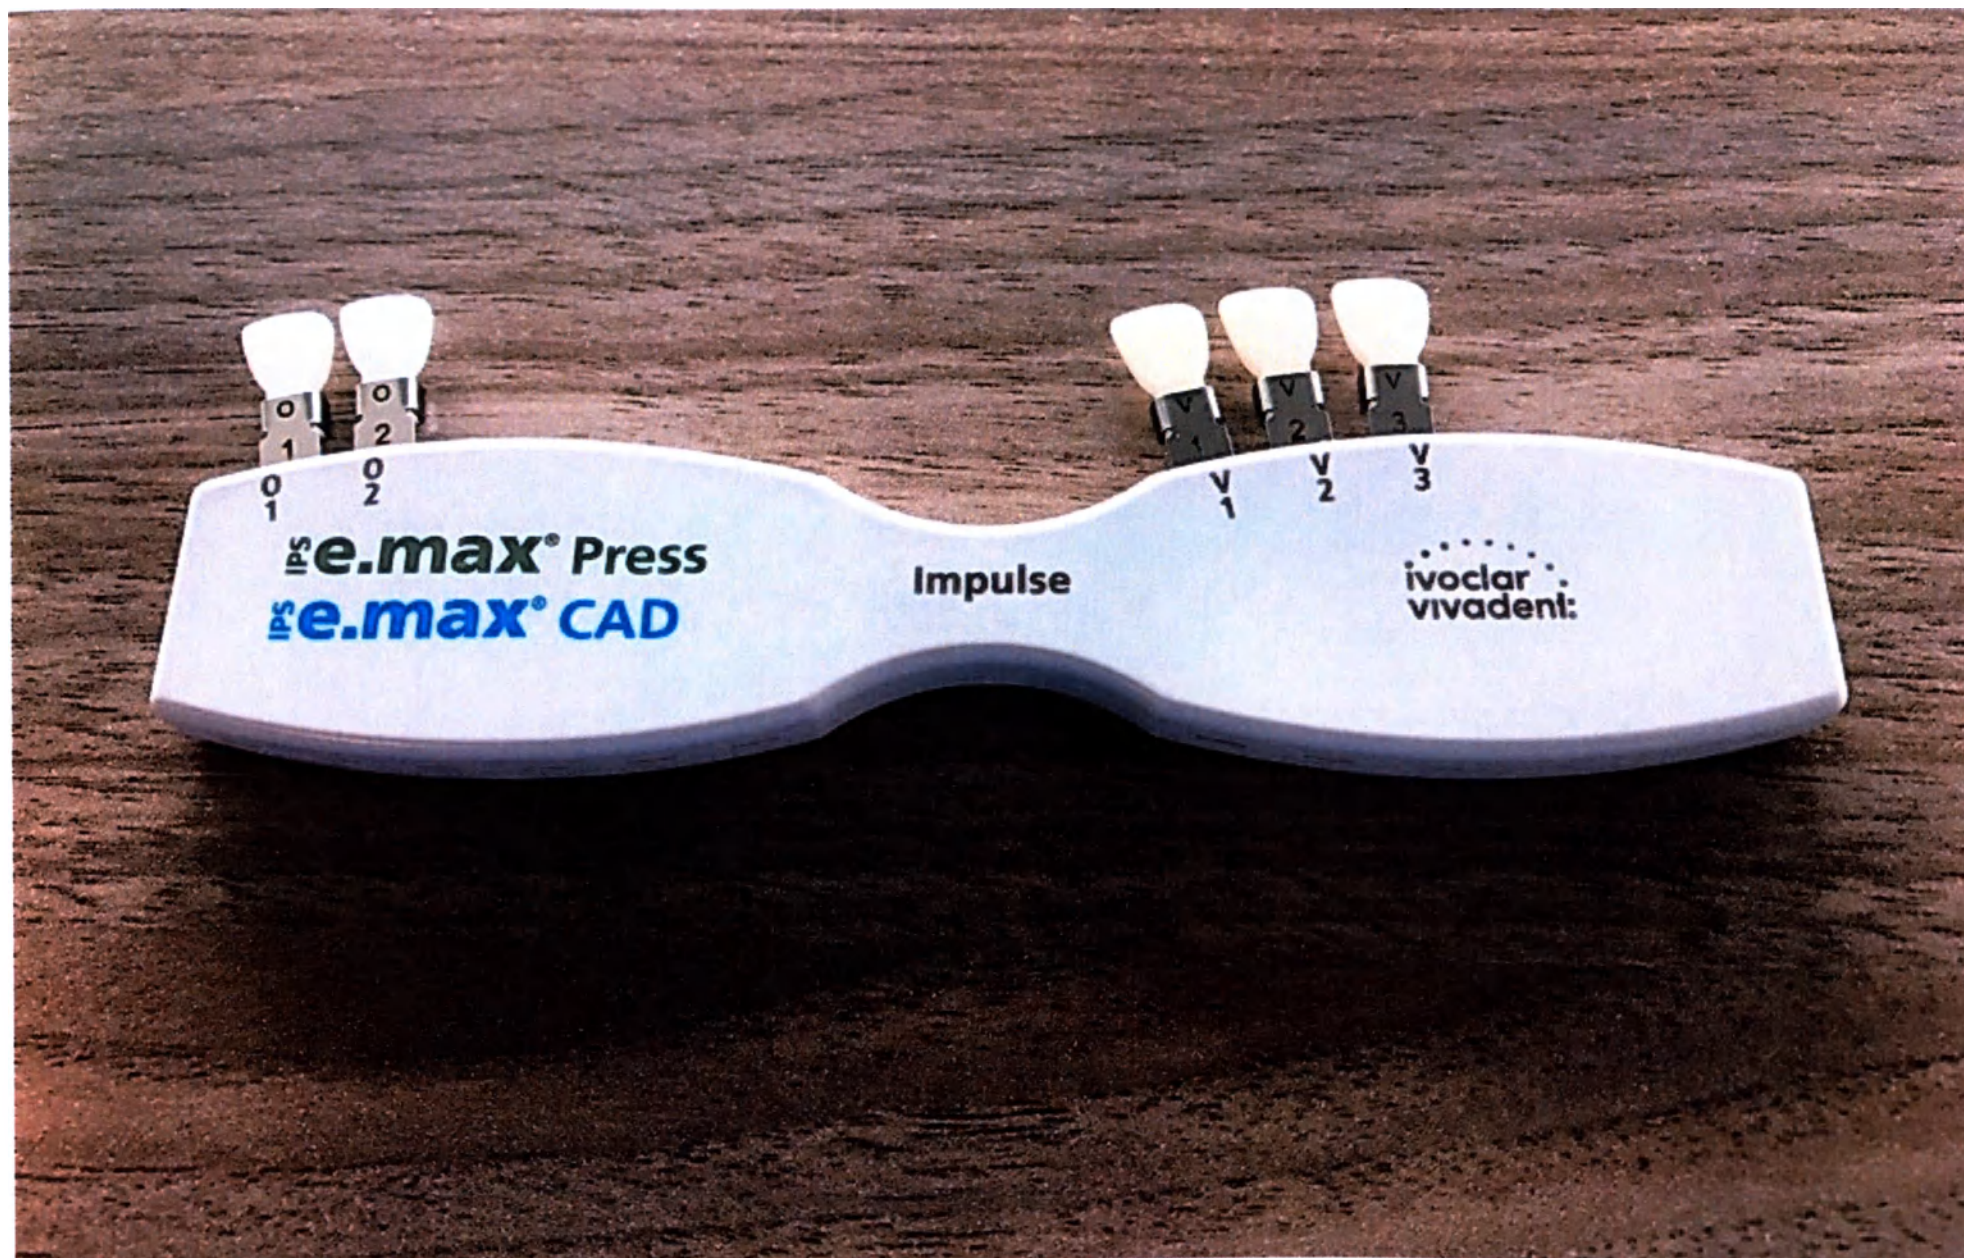

Расцветка IPS e.max Press/CAD MT Shade Guide

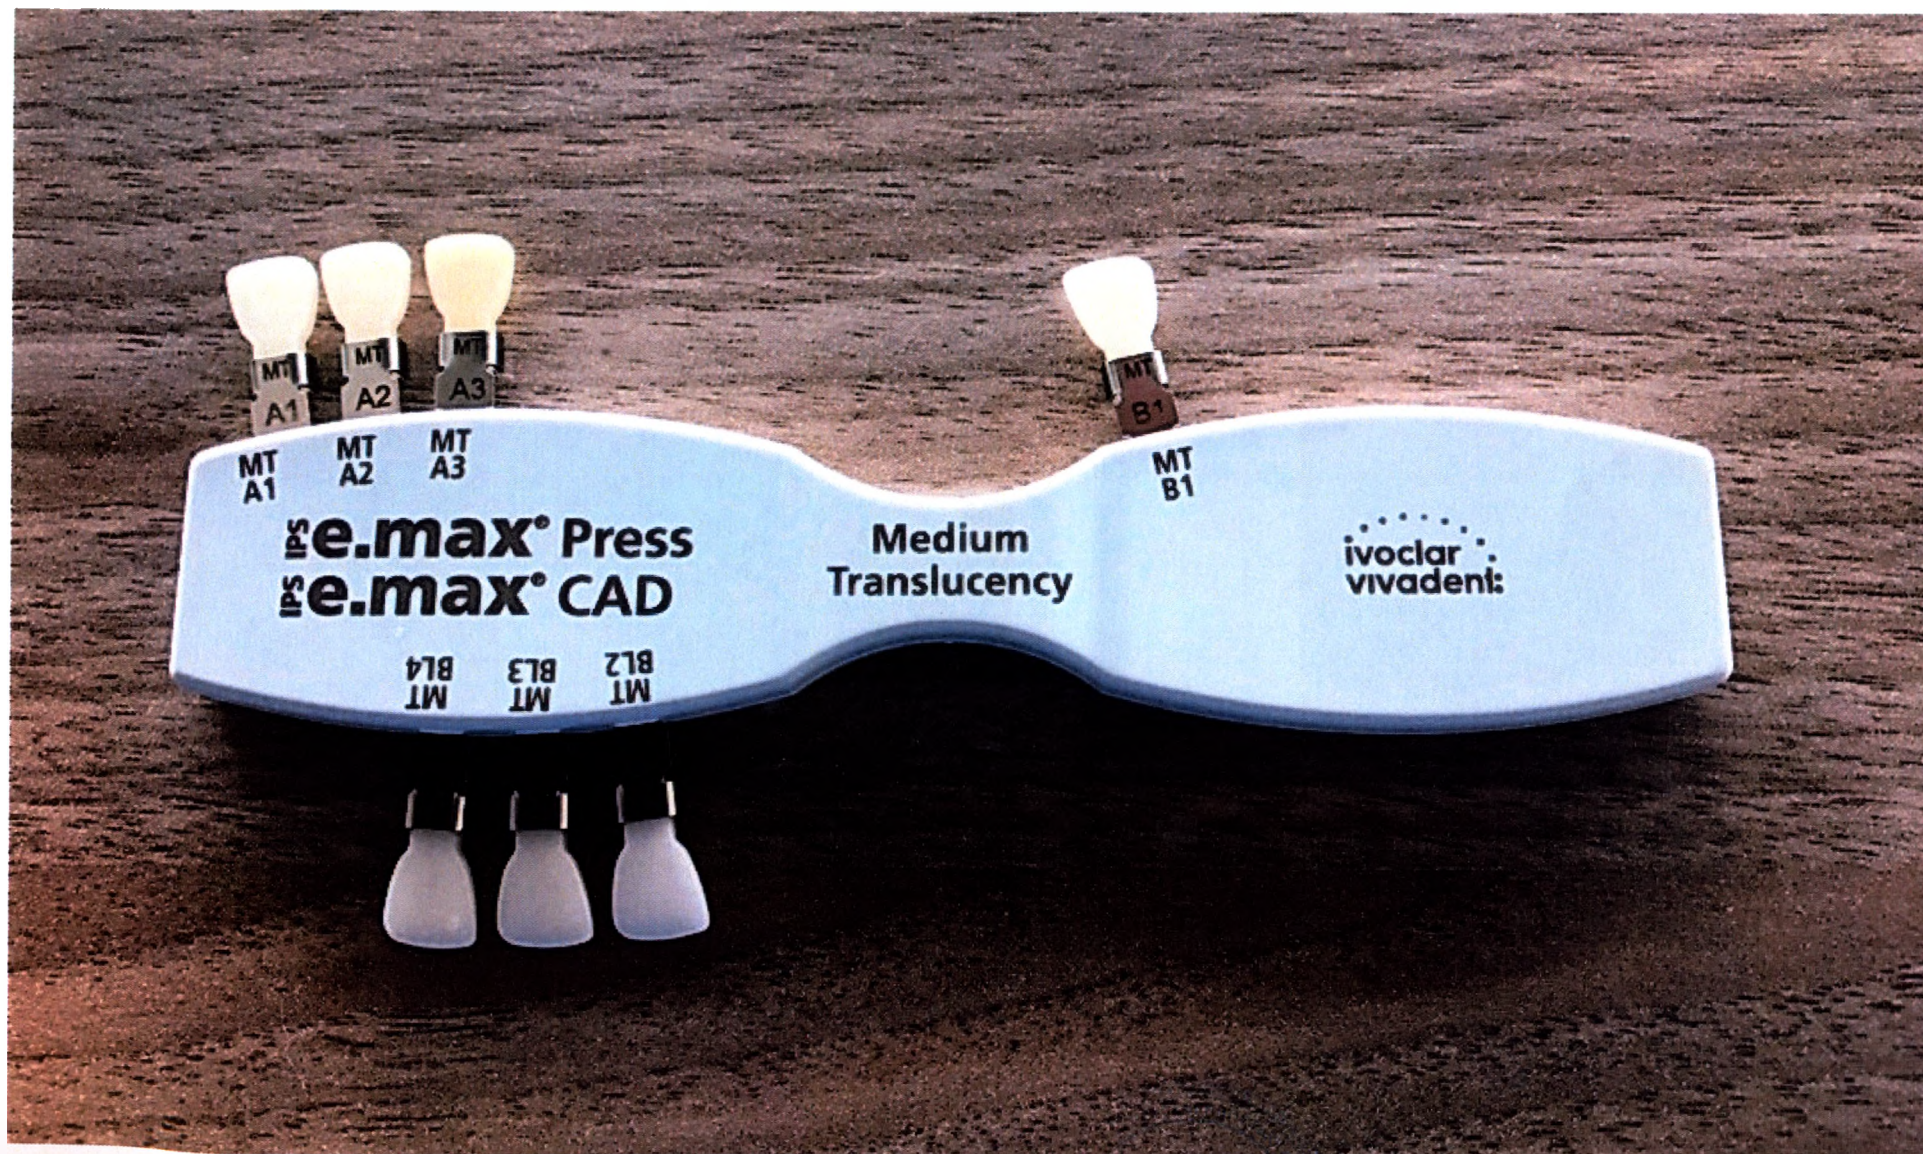

Генеральный директор

ООО «Ивоклар Вивадент»
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Штефан Ульманн

Пронумеровано, прошито, скреплено печатью 18 листов

ООО Ивоклар Вивадент

Штефан Ульманн
Генеральный директор

