


Фотография


Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный O-антигенный комплексный (1,2,3,4,6,7,8,9,10,12), жидкий» (Тест комплексный РПГА)
Комплект №1 рассчитан на 20 определений: серийный номер 010215 годен до 10.2016 г.
Вид с лицевой стороны упаковки

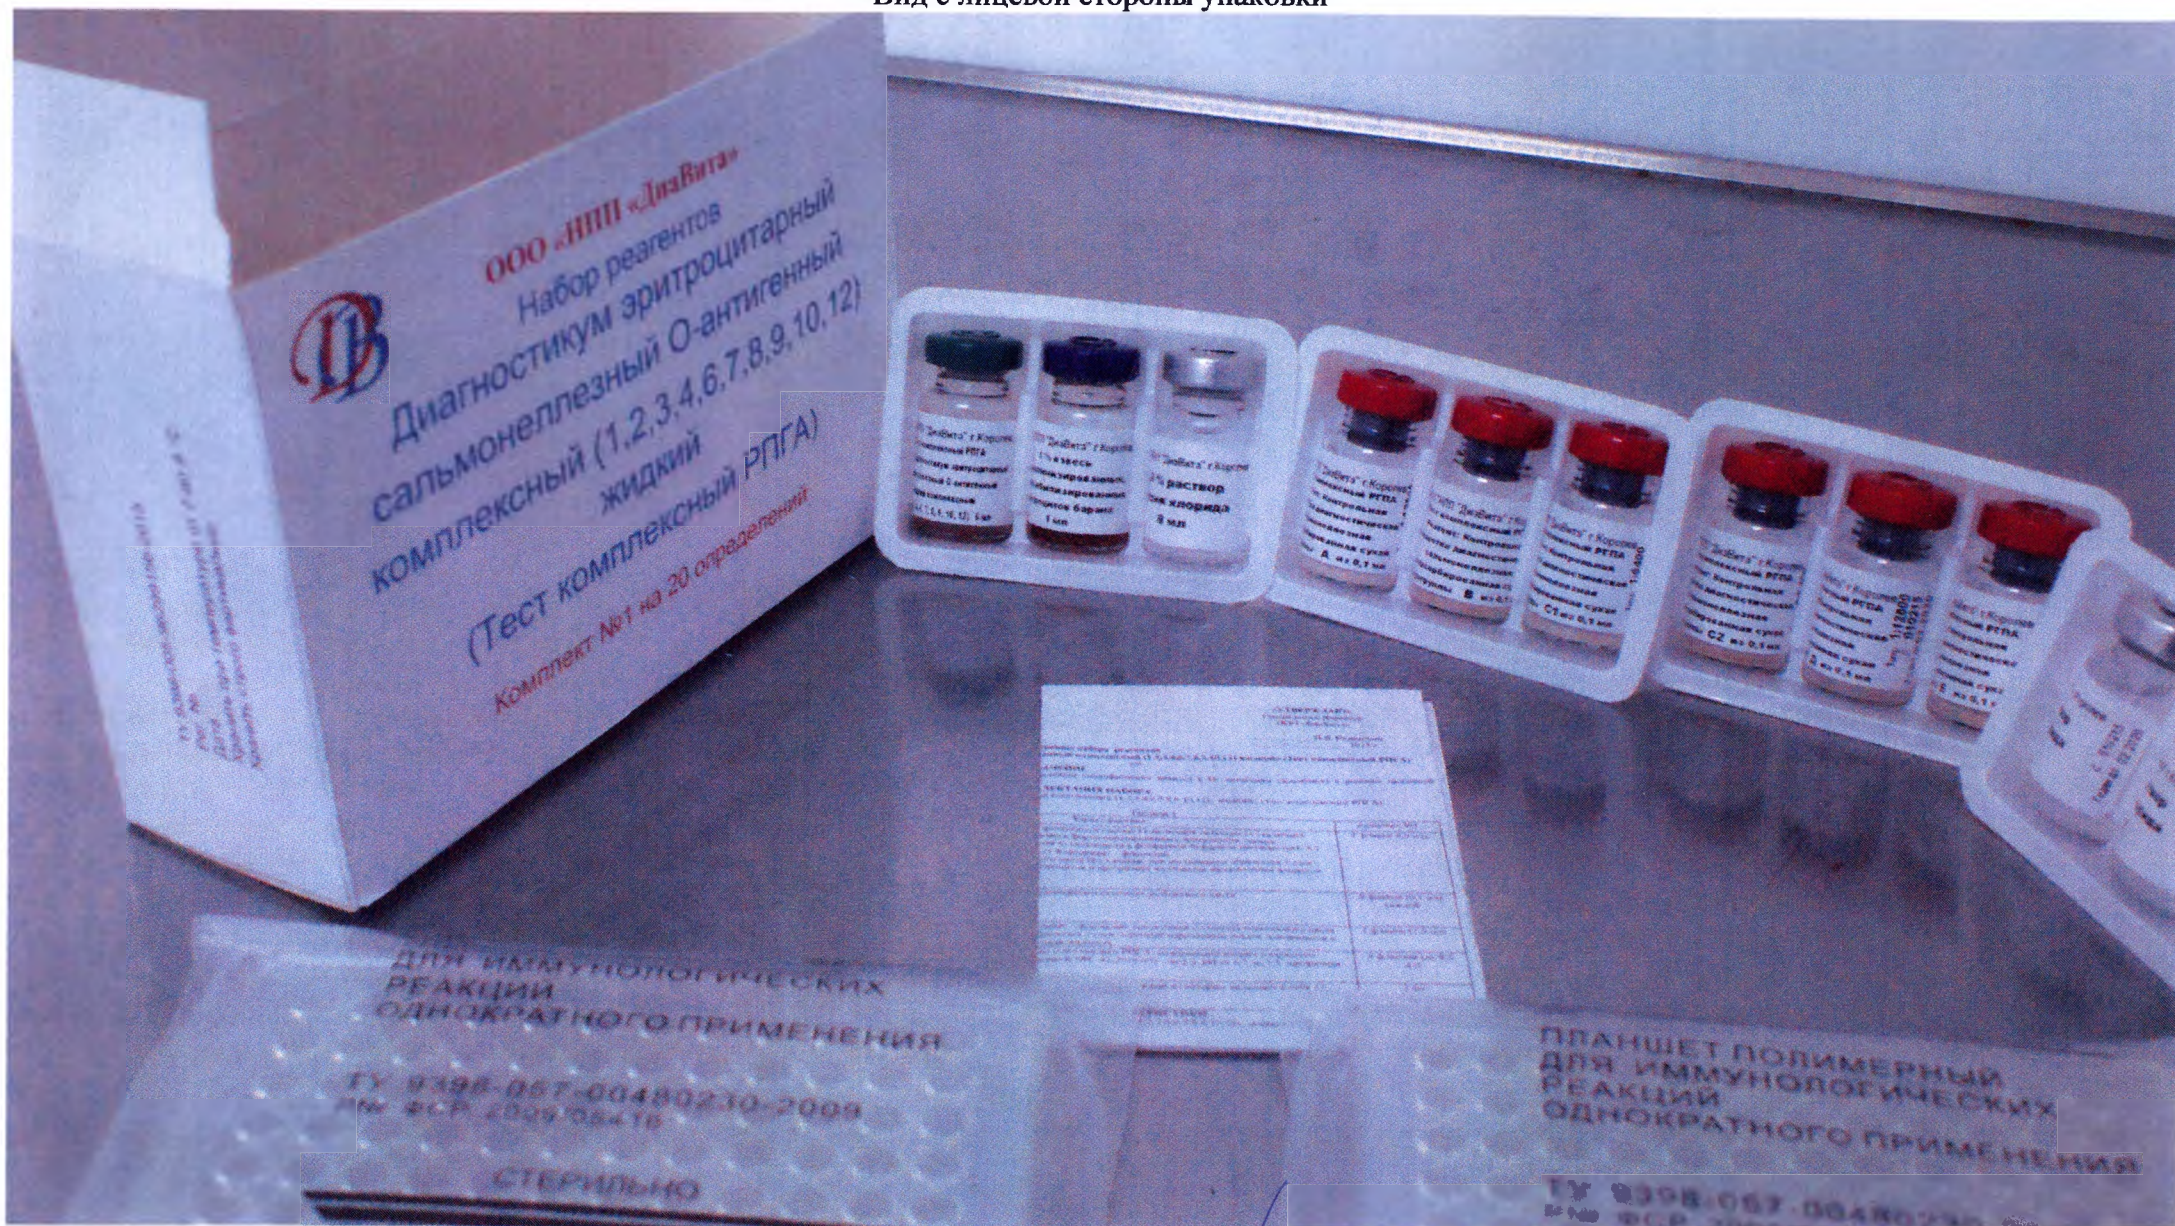

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских


Комплект №1 рассчитан на 20 определений: серийный номер 010215 годен до 10.2016 г.
Вид с обратной стороны упаковки

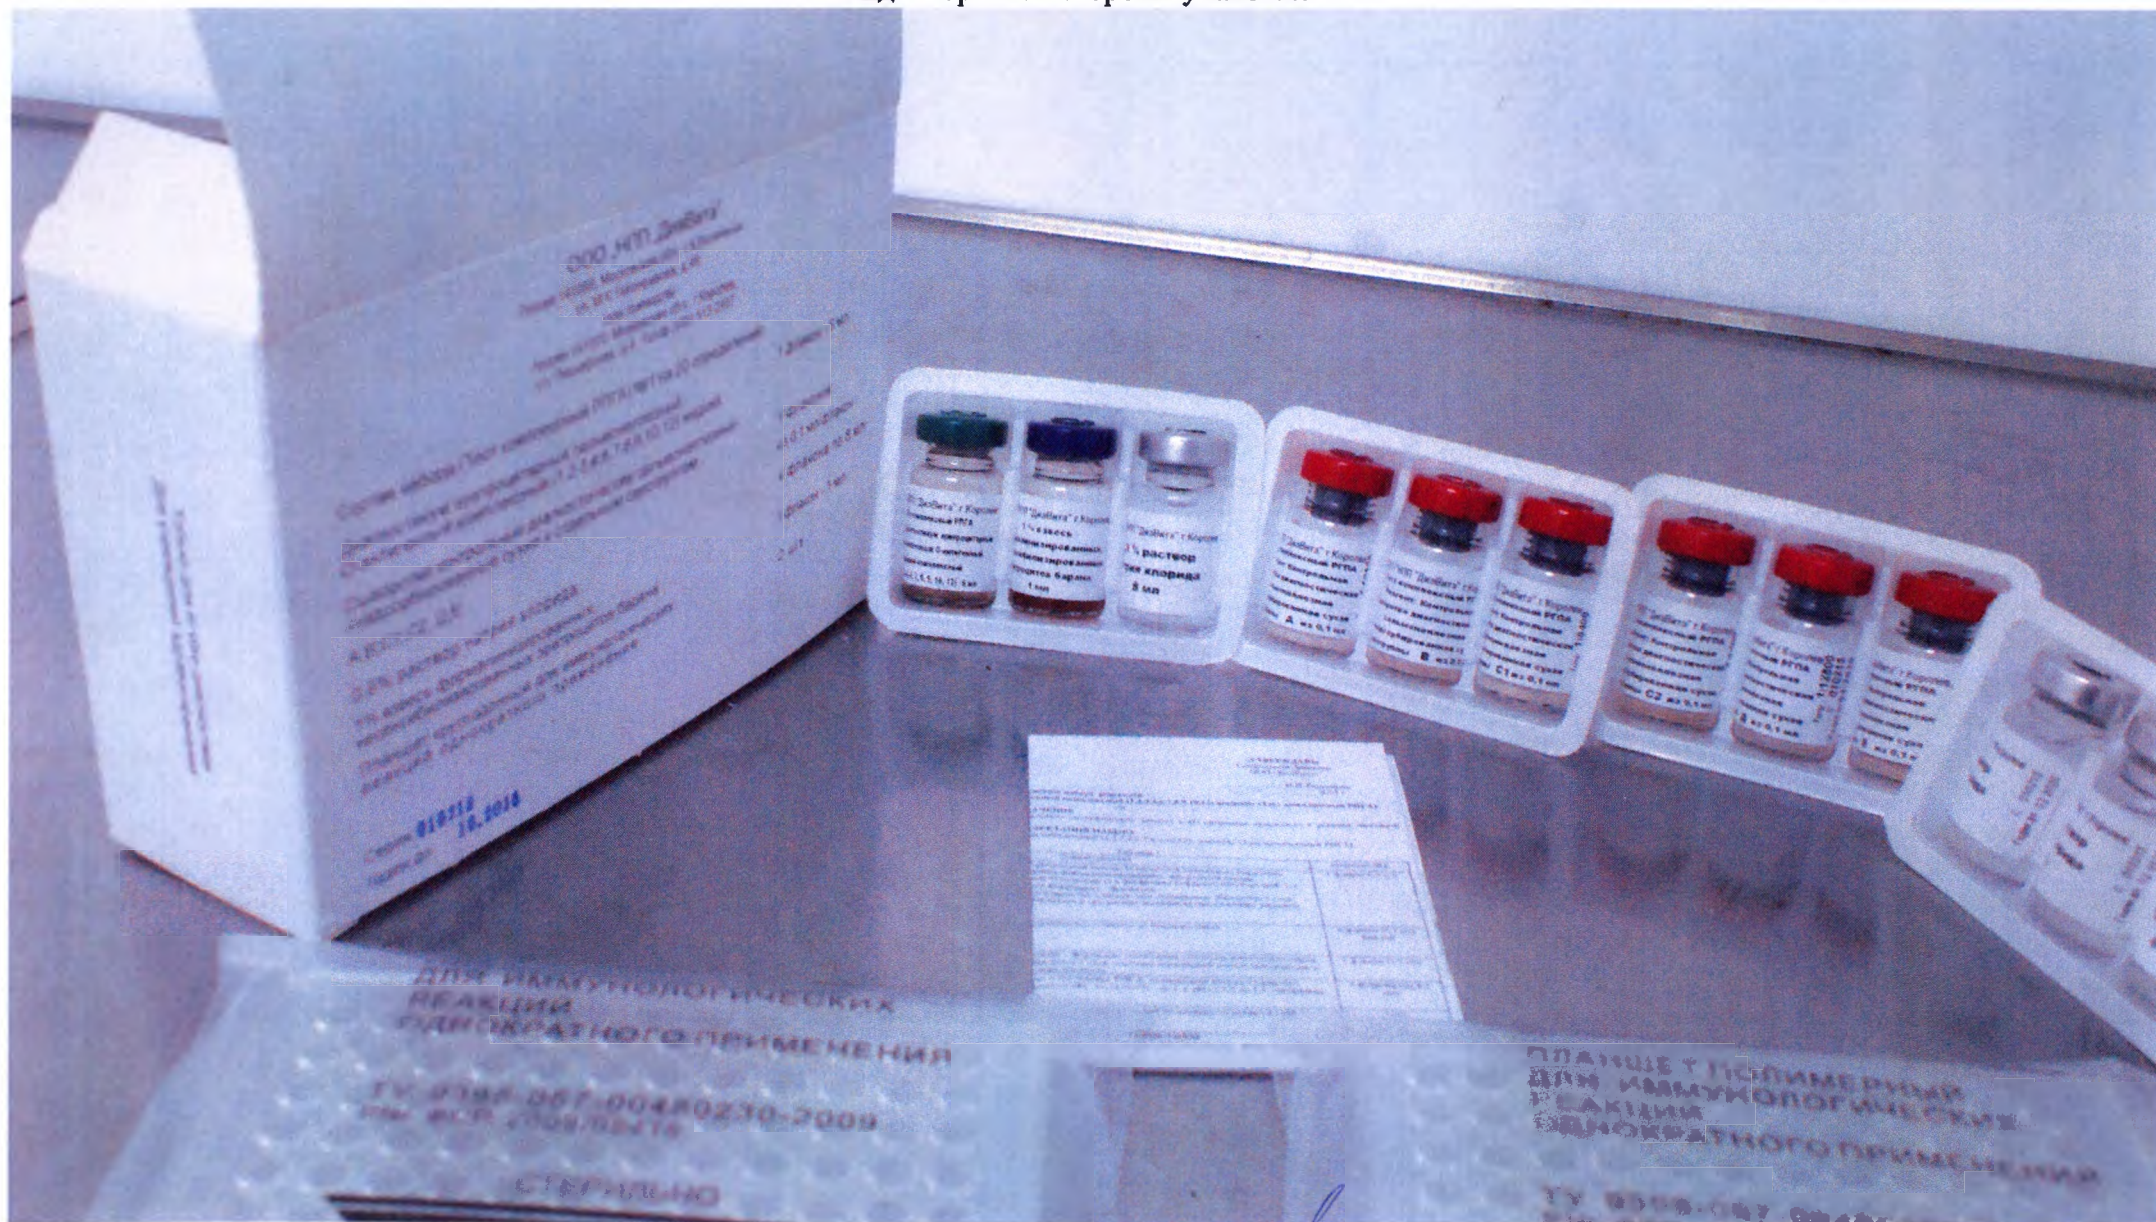

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских


Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный комплексный (1,2,3,4,6,7,8,9,10,12)» (Тест комплексный РПГА)
 Комплект №1 рассчитан на 20 определений: серийный номер 020315 годен до 11.2016 г.
 Вид с лицевой стороны упаковки

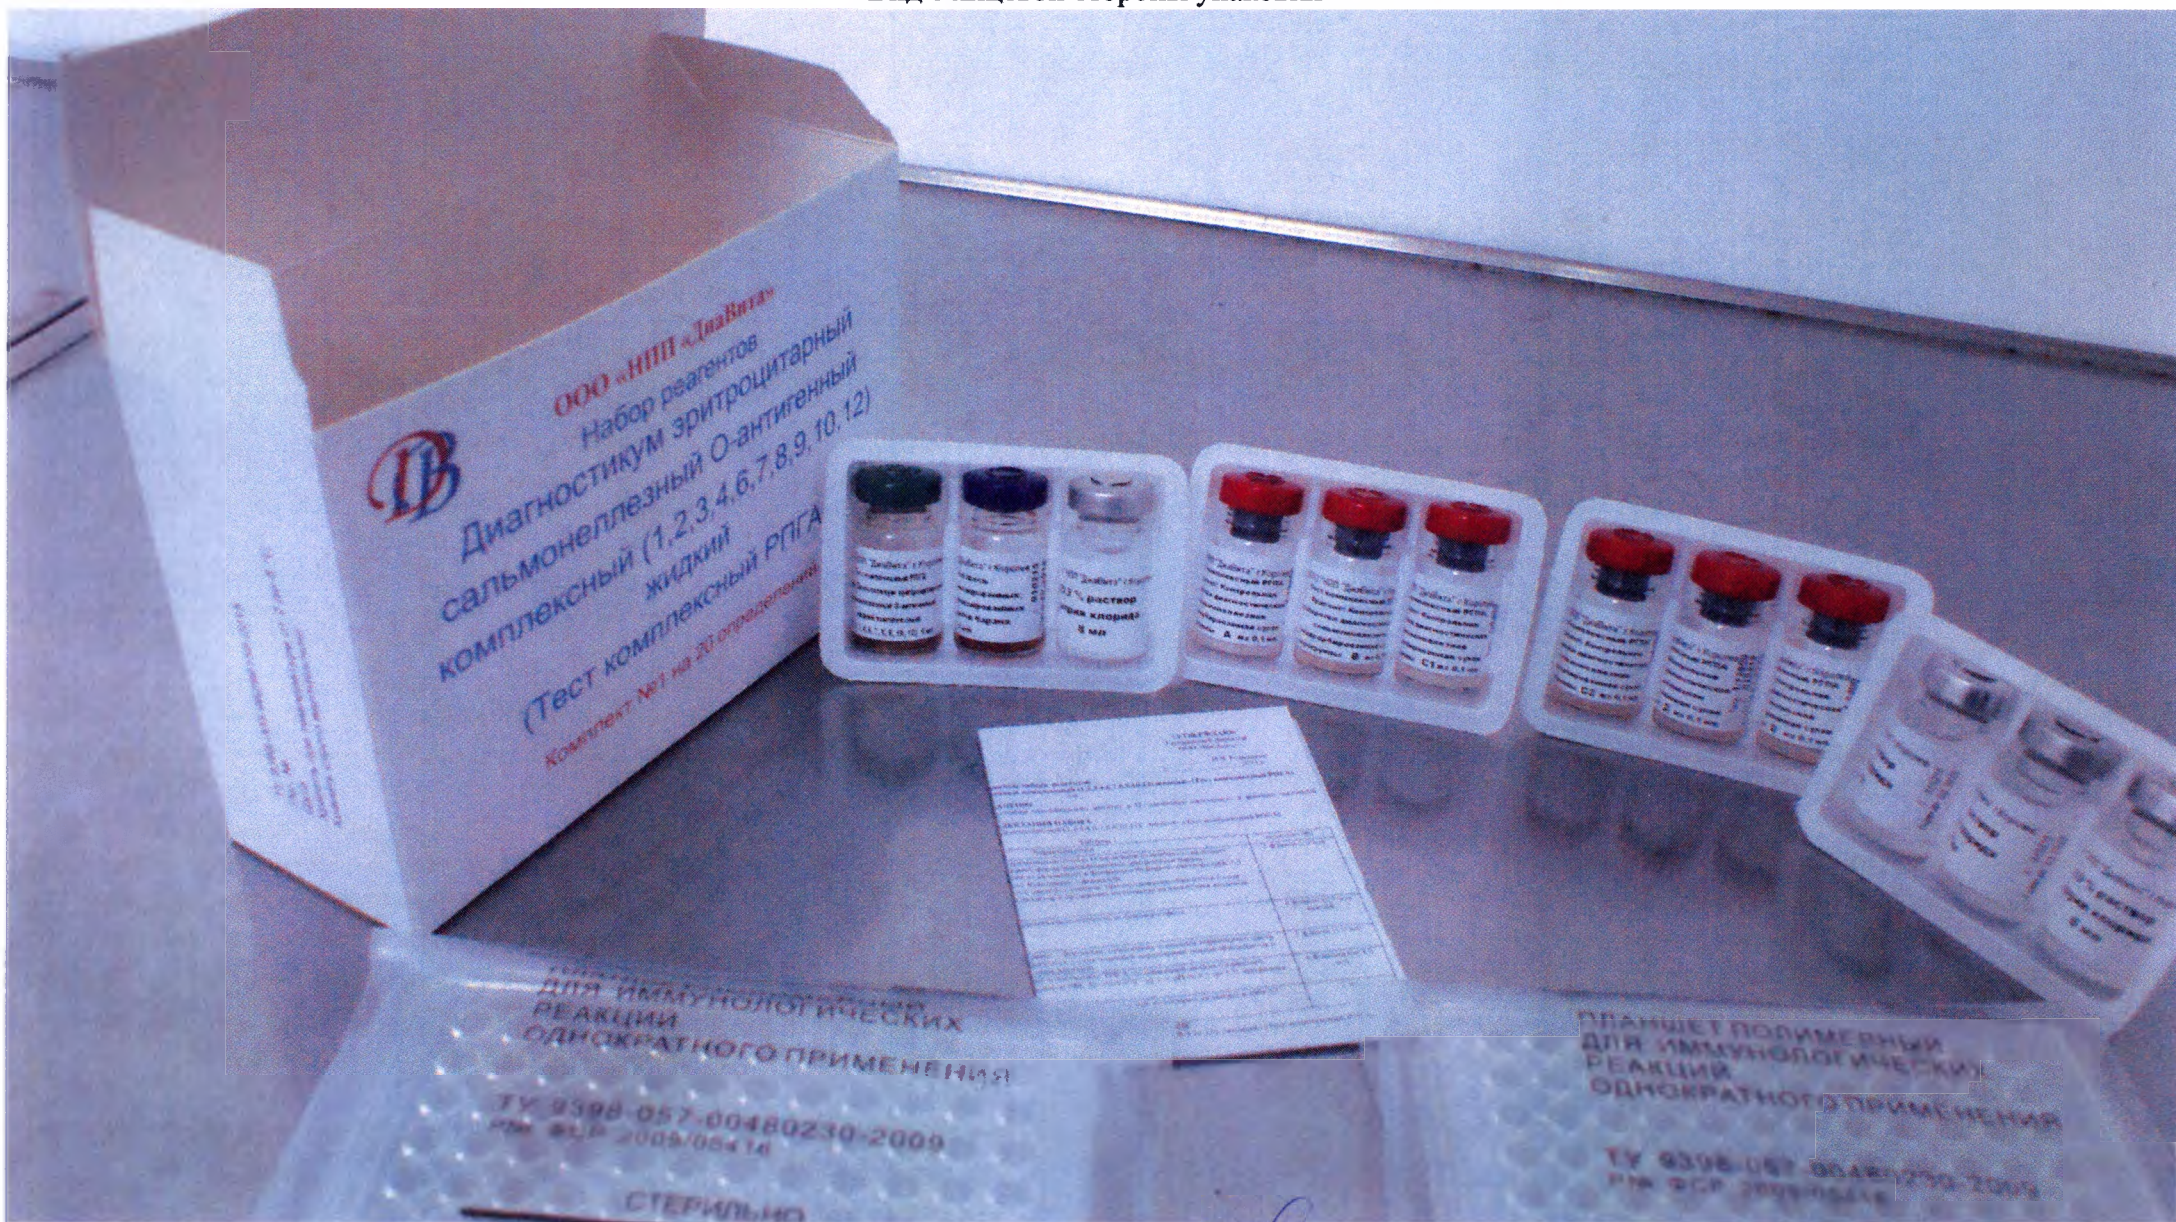

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских


Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный комплексный (1,2,3,4,6,7,8,9,10,12), жидкий» (Тест комплексный ГИП А)
 Комплект №1 рассчитан на 20 определений: серийный номер 020315 годен до 11.2016 г.
 Вид с обратной стороны упаковки

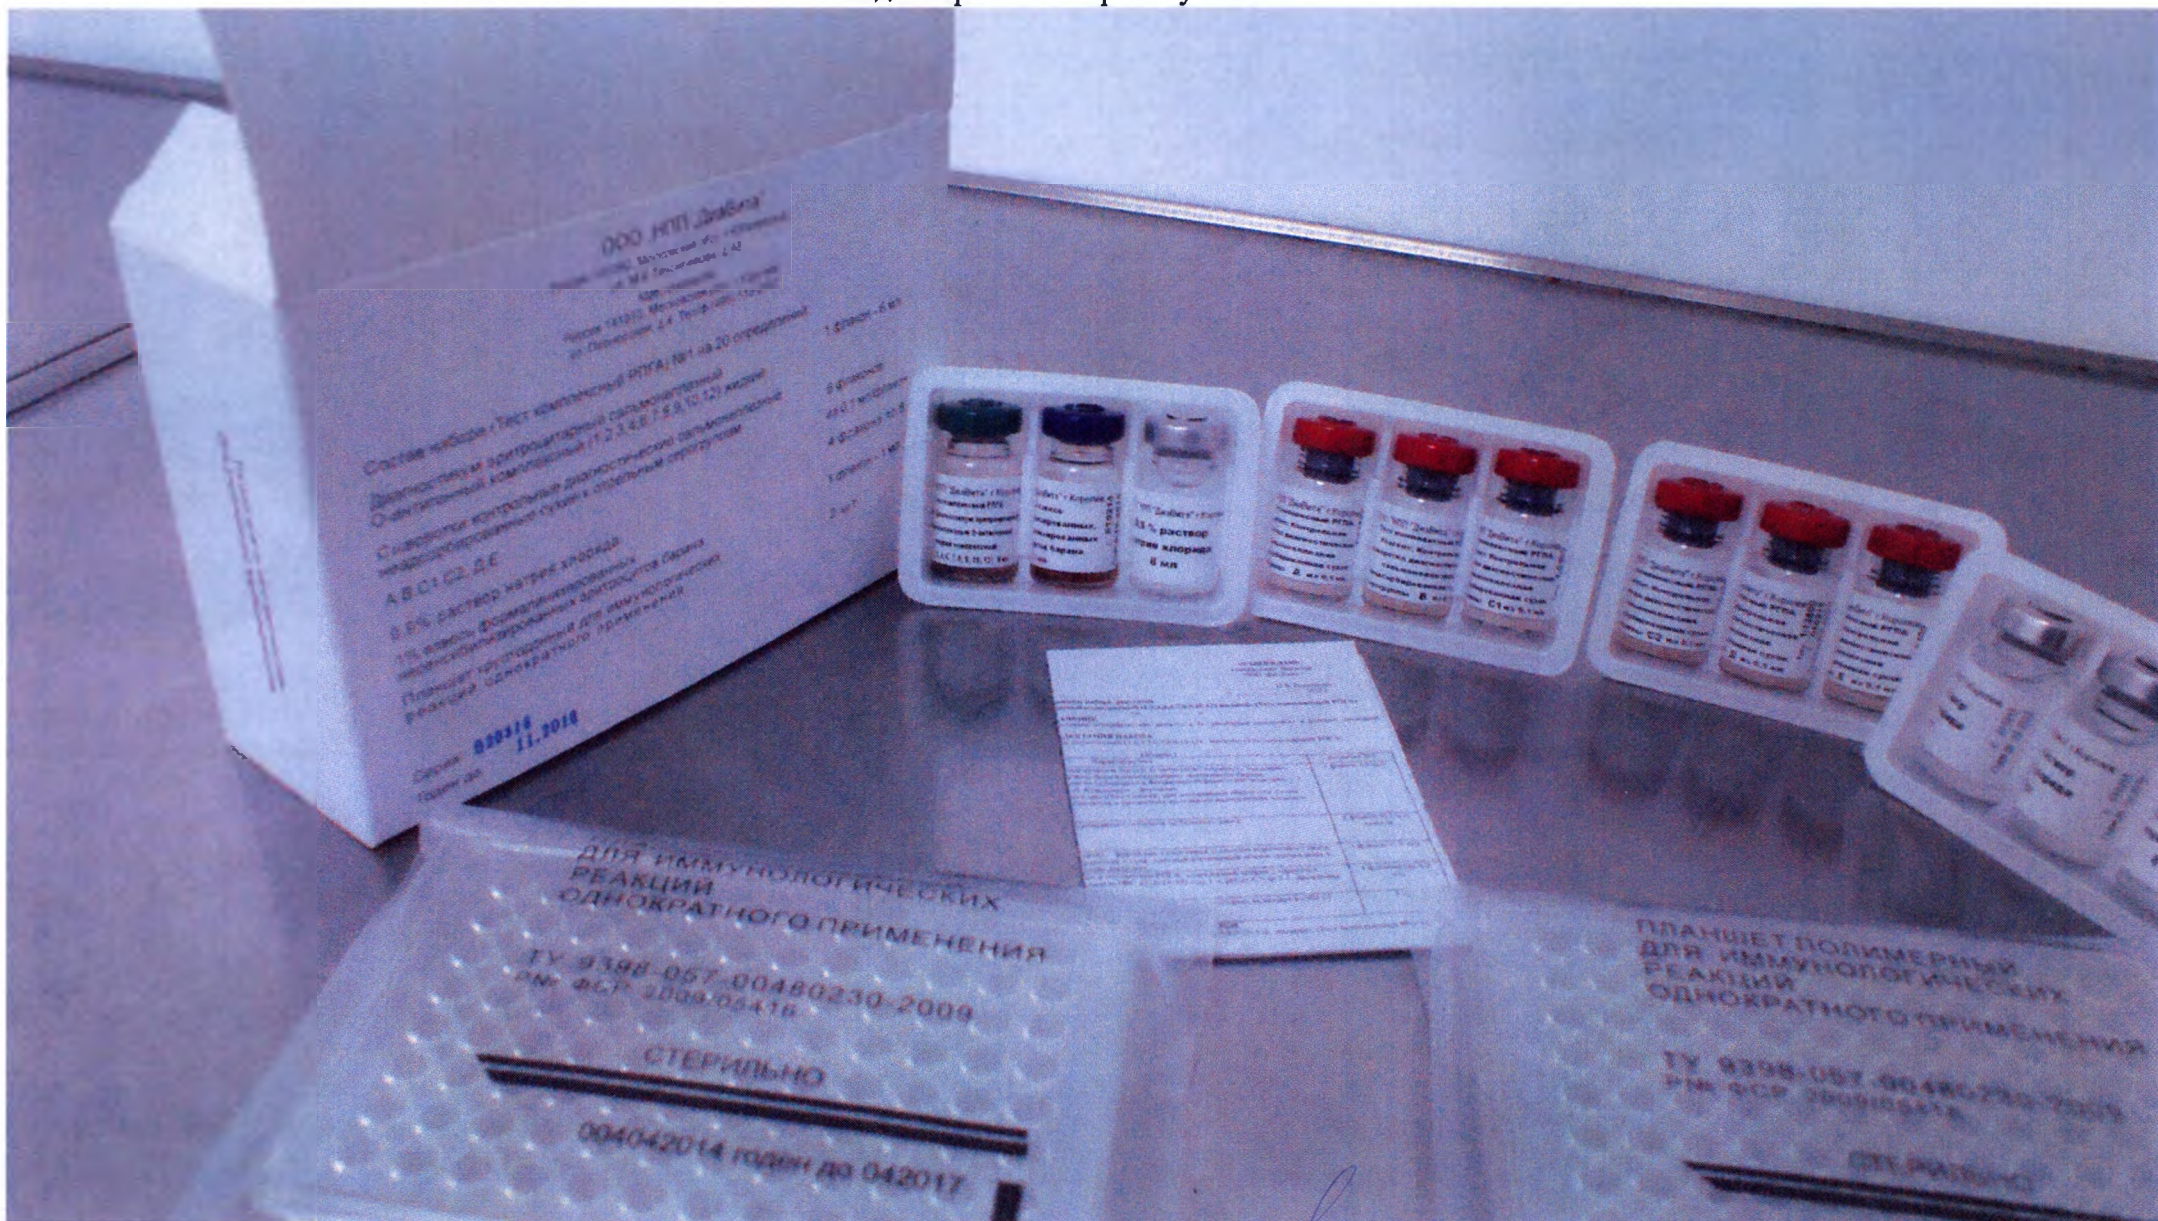

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный комплексный (1,2,3,4,6,7,8,9,10,12), жидкий» (Тест комплексный РПГА)
Комплект №2 рассчитан на 26 определений: серийный номер 010215 годен до 10.2016 г.
Вид с лицевой стороны упаковки

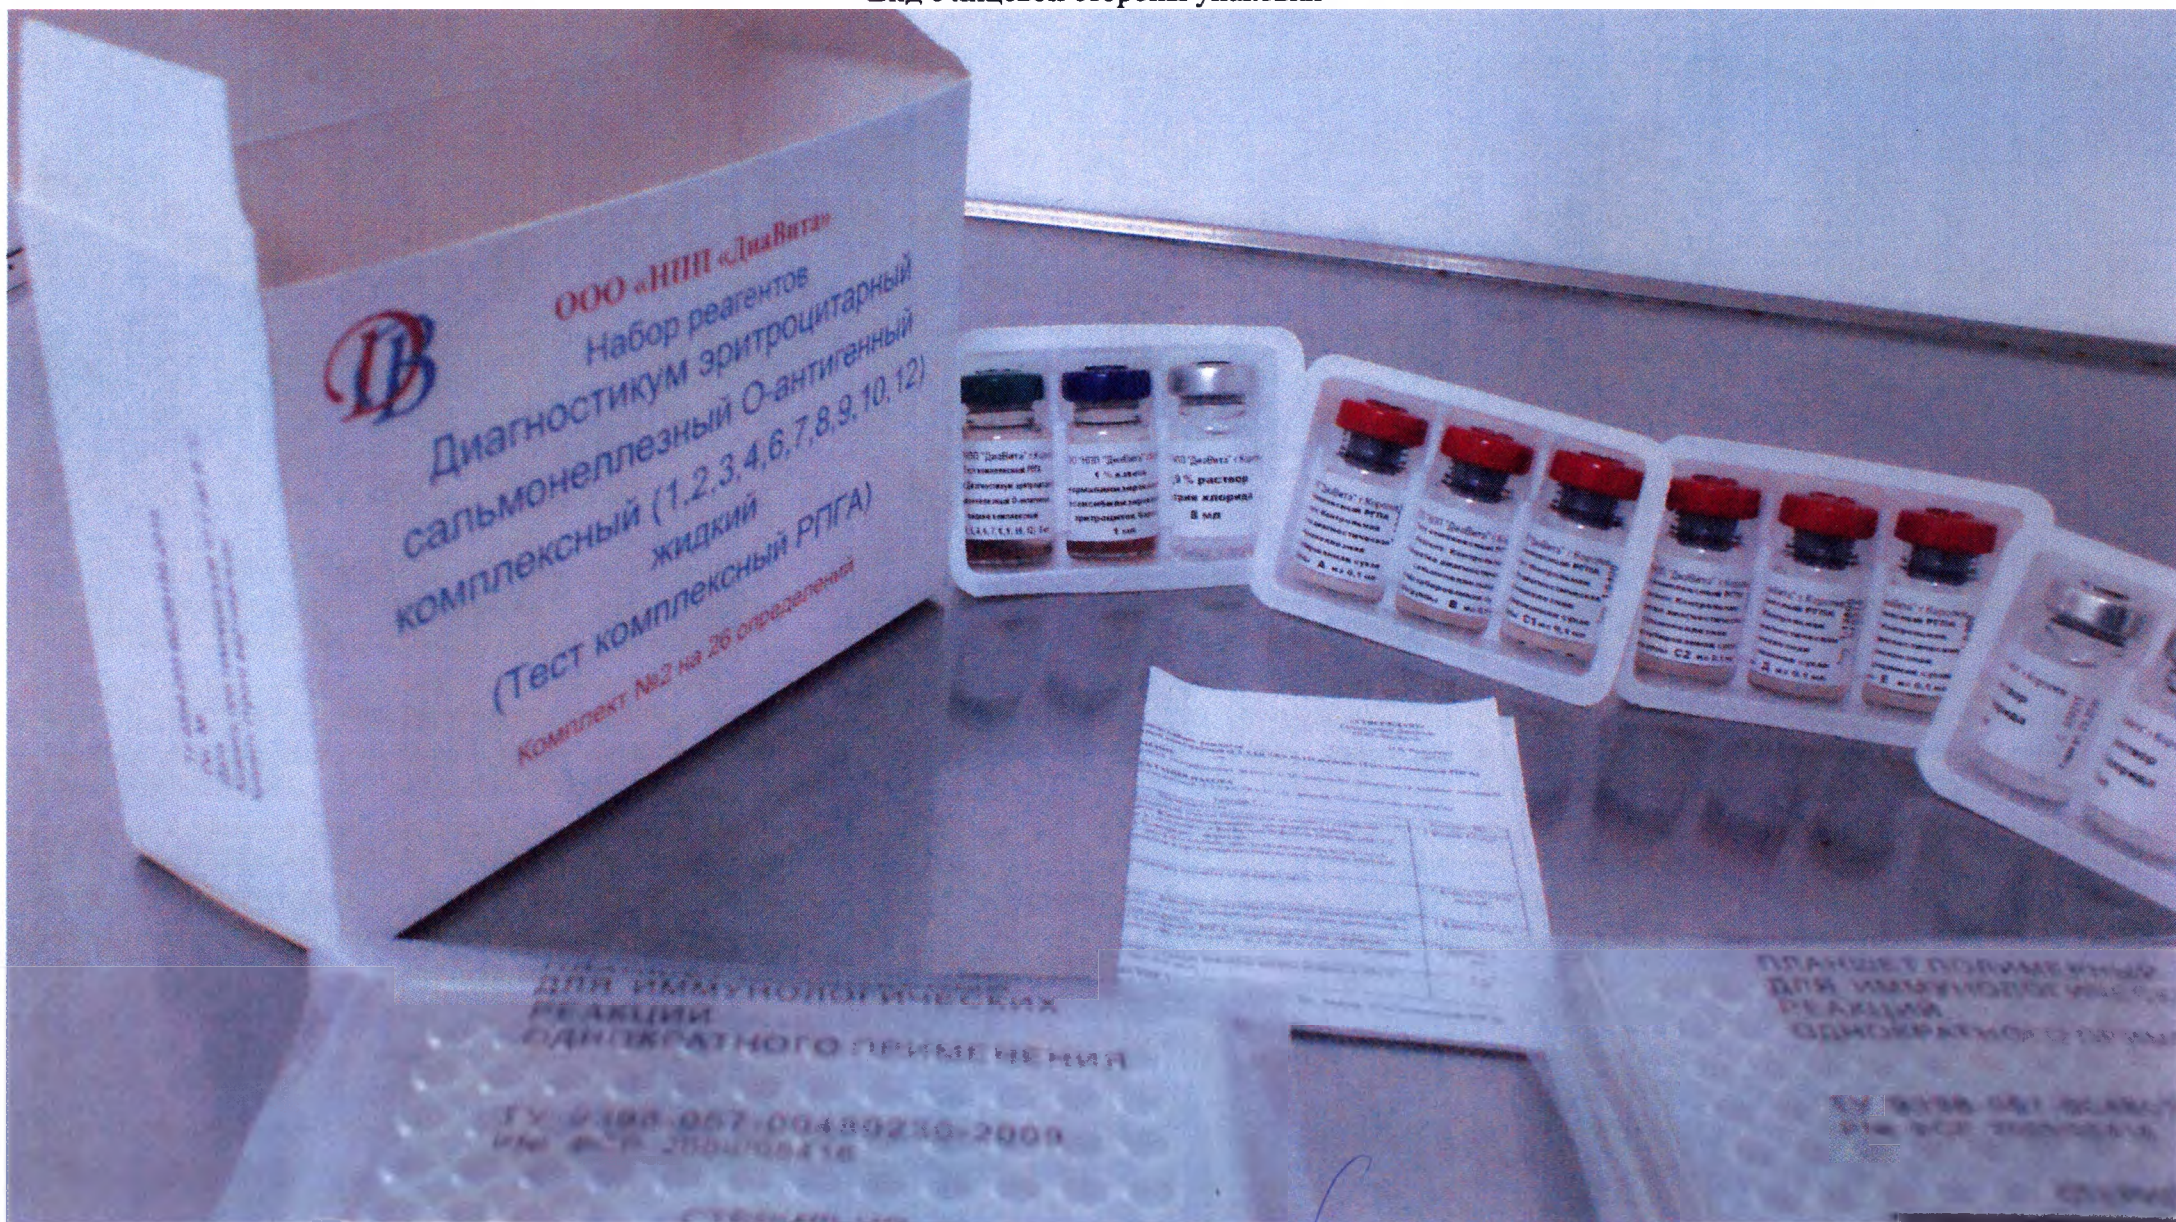


Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный комплексный (1,2,3,4,6,7,8,9,10,12), «ДиаВита» (Тест комплексный РНН А)

Комплект №2 рассчитан на 26 определений: серийный номер 010215 годен до 10.2016 г.

Вид с обратной стороны упаковки

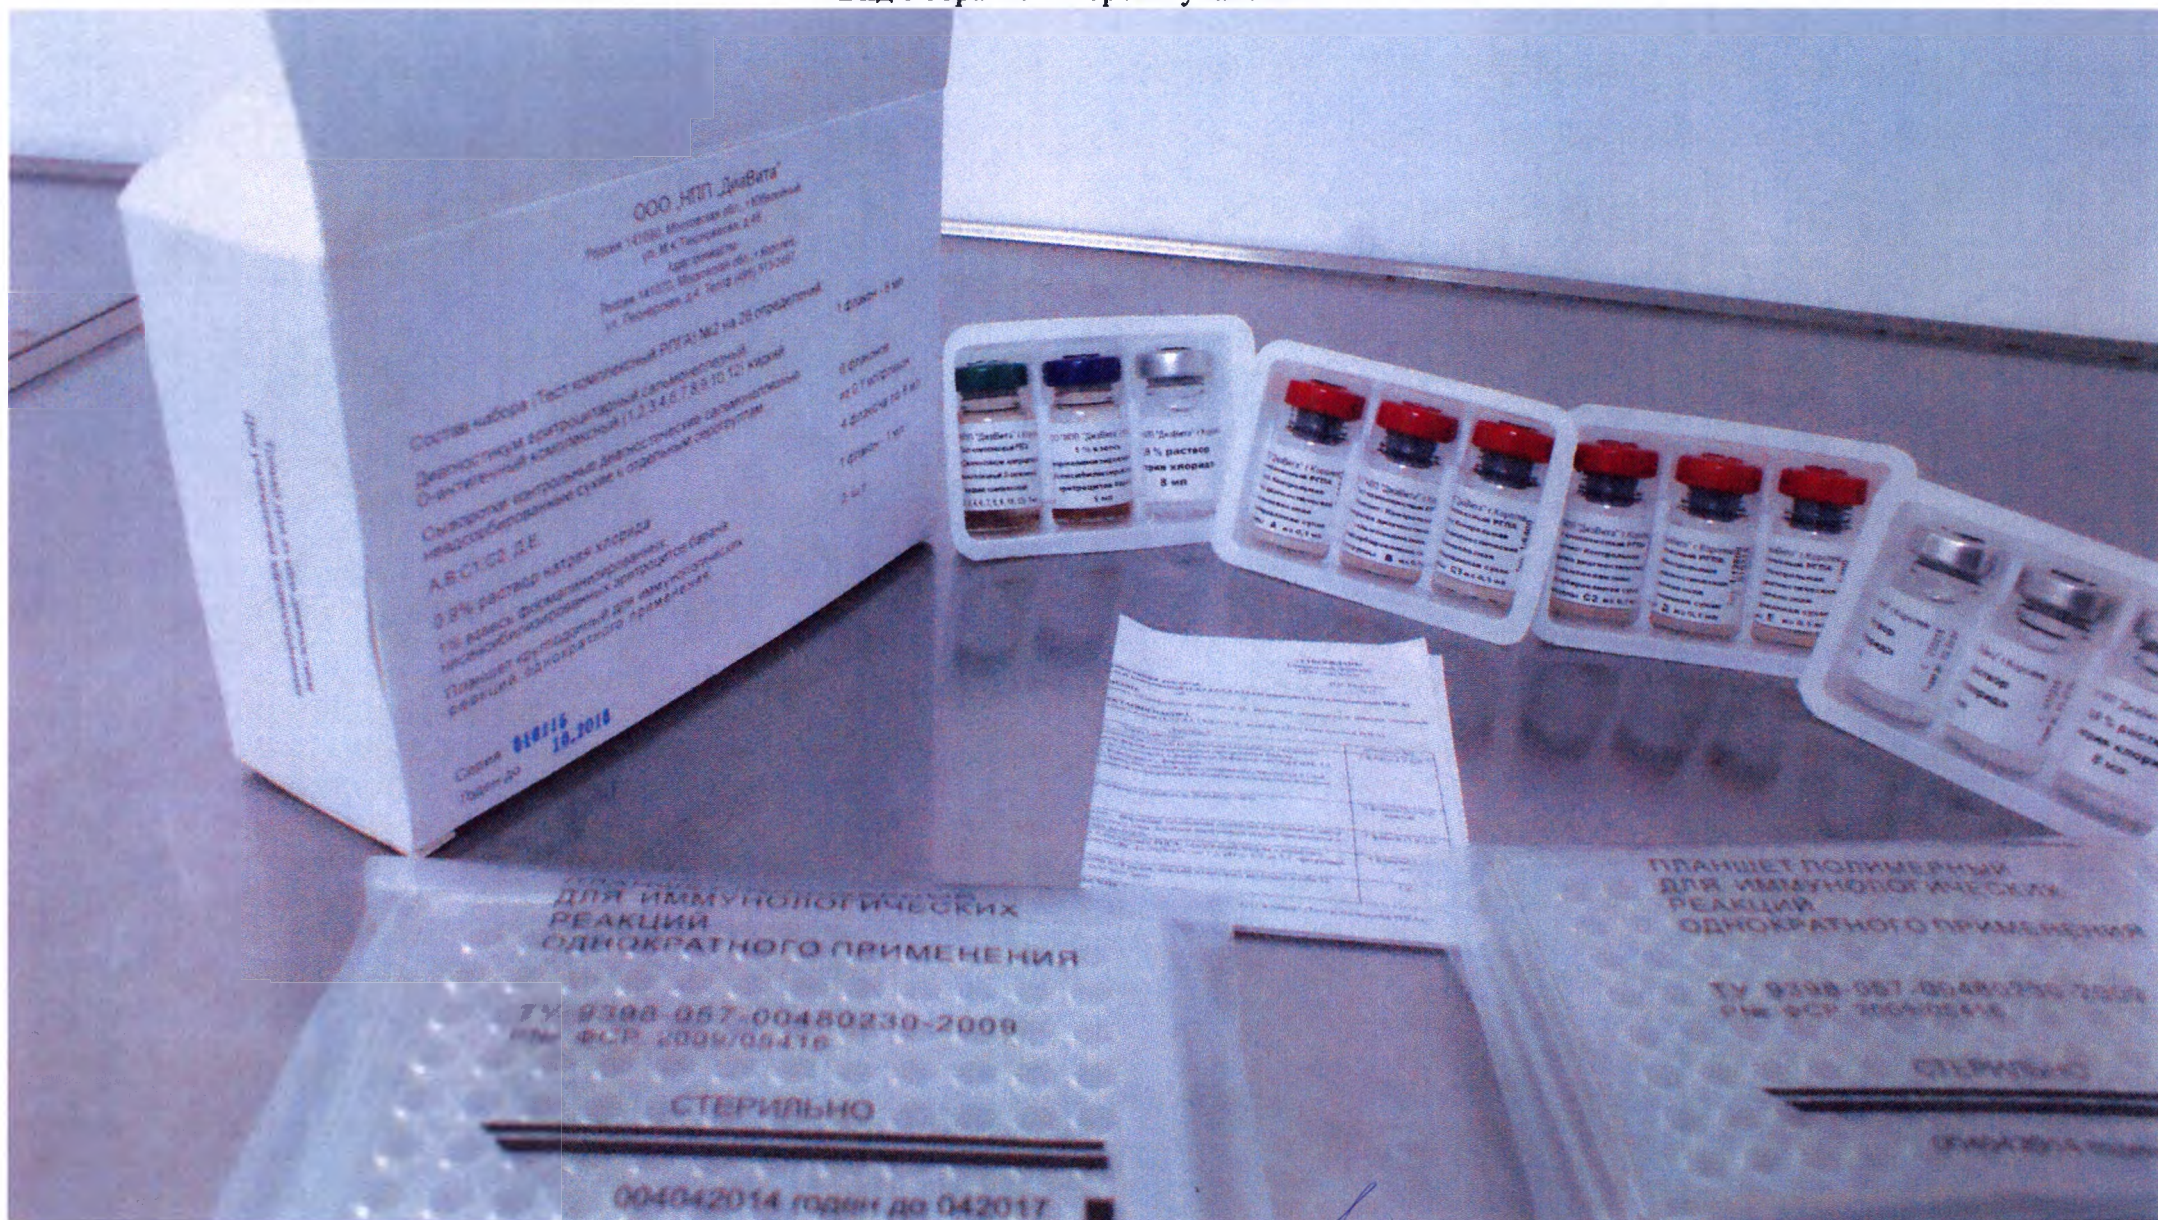


Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Комплект №2 рассчитан на 26 определений: серийный номер 020315 годен до 11.2016 г.

Вид с лицевой стороны упаковки

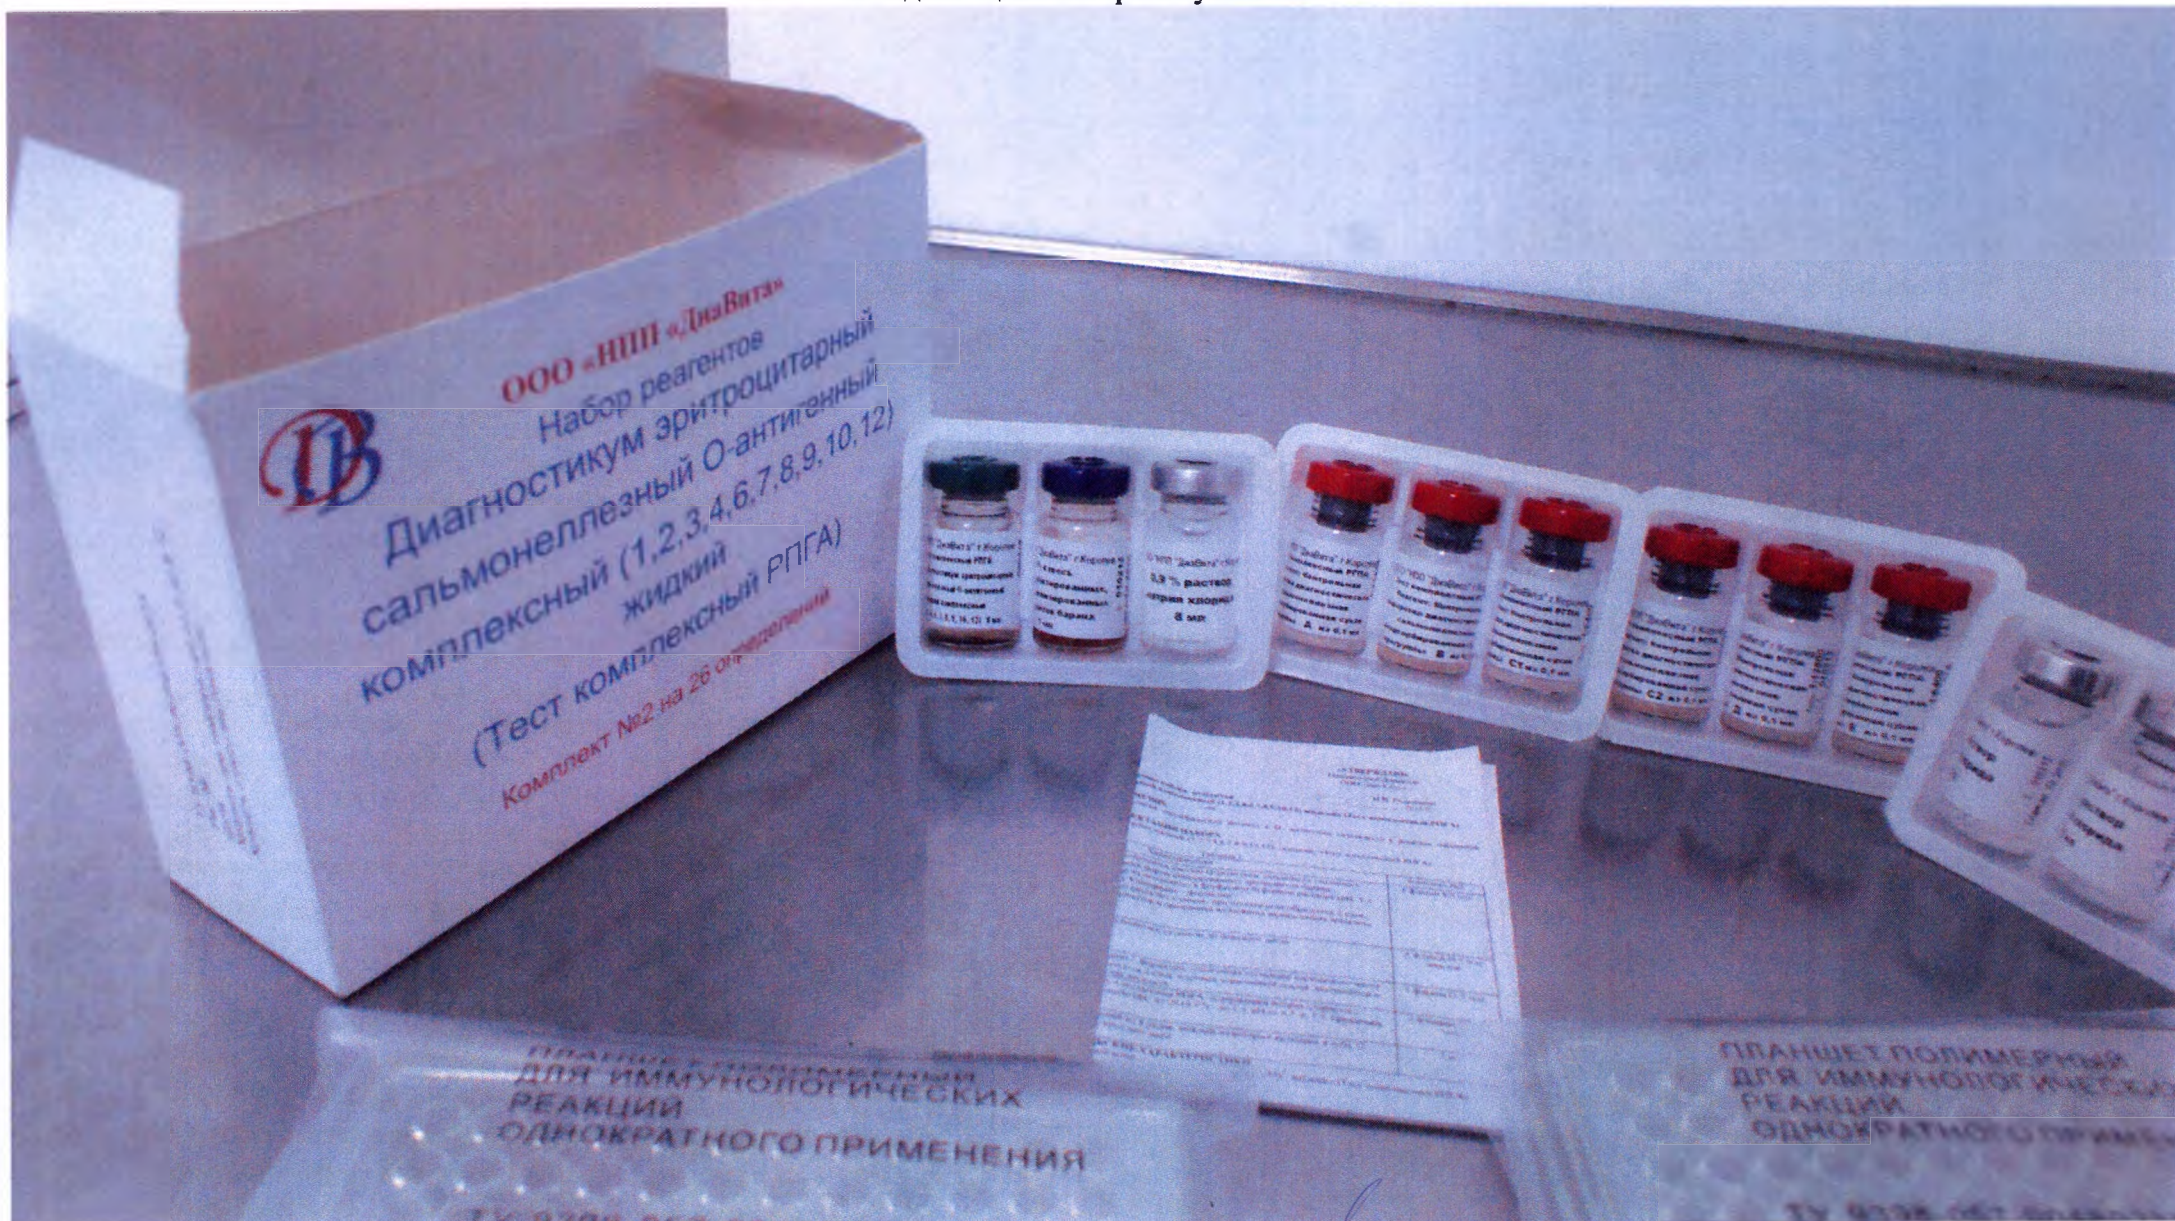


Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Комплект №2 рассчитан на 26 определений: серийный номер 020315 годен до 11.2016 г.

Вид с обратной стороны упаковки

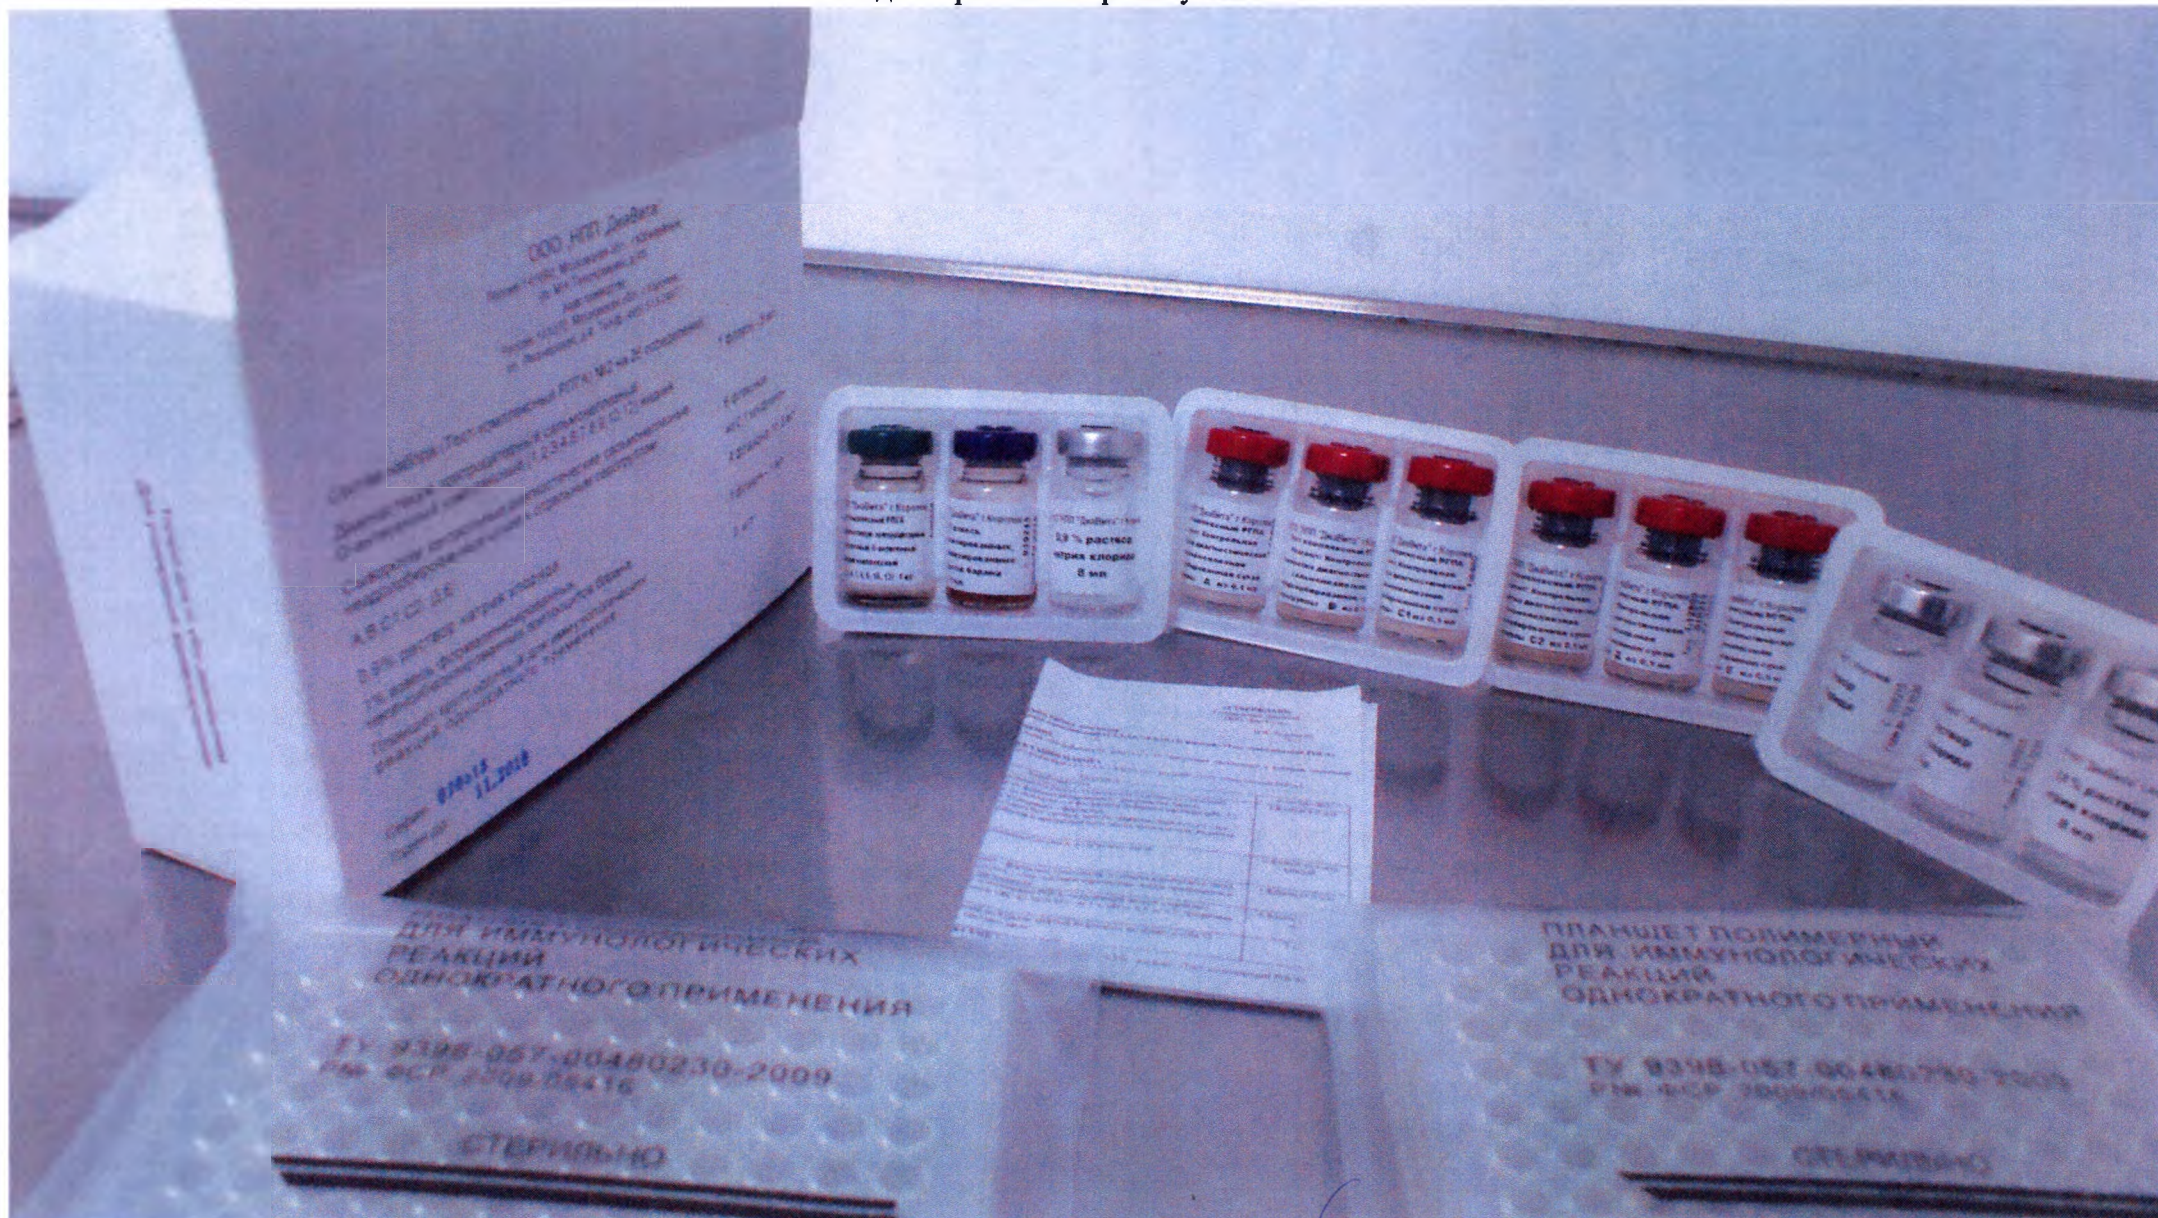


Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Комплект №3 рассчитан на 23 определения: серийный номер 010215 годен до 10.2016 г.

Вид с лицевой стороны упаковки

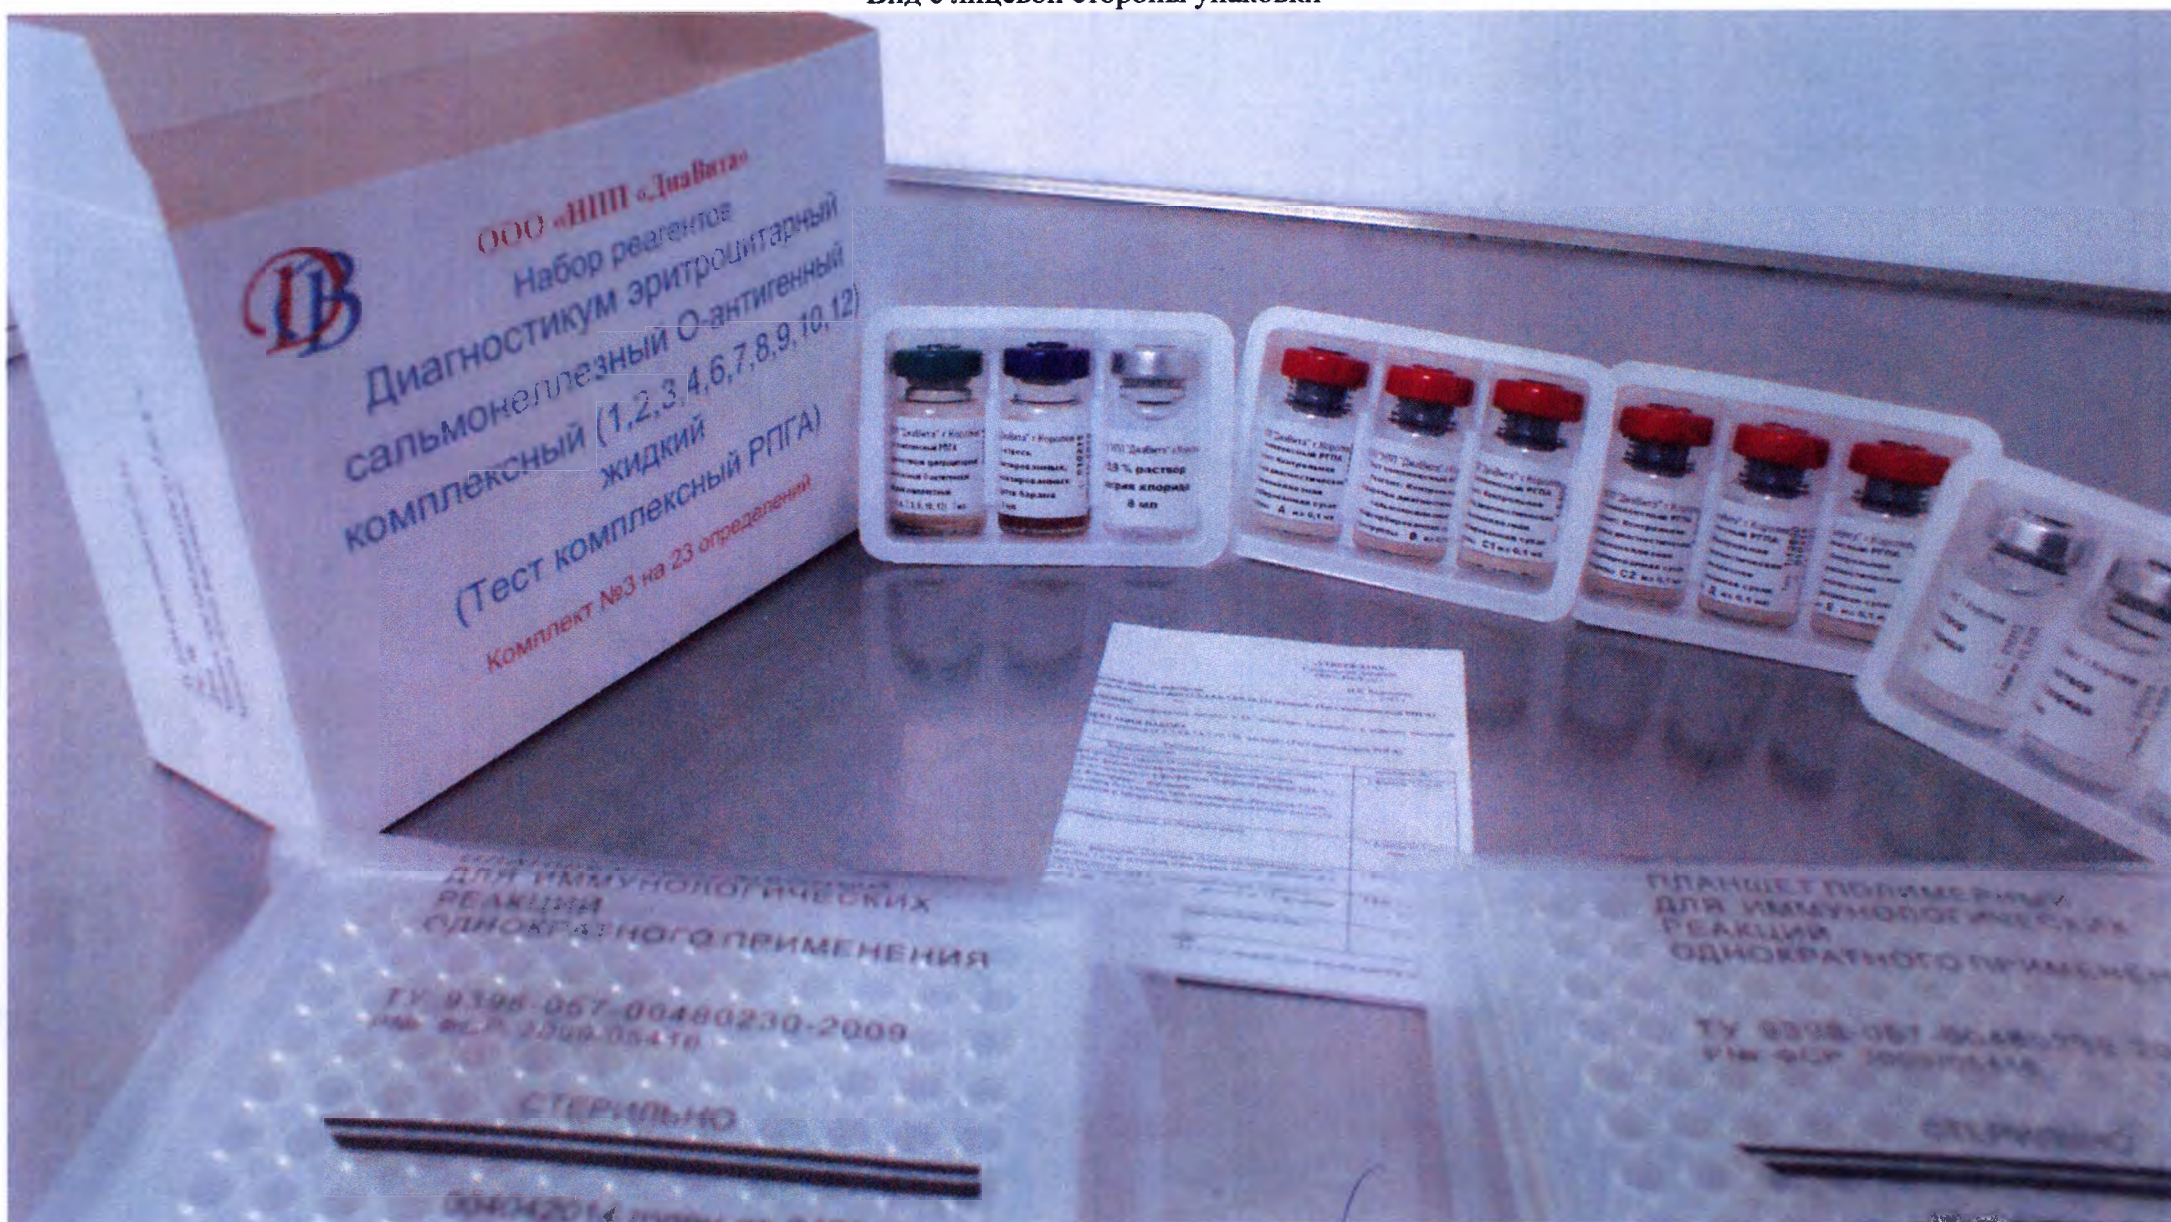


Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Комплект №3 рассчитан на 23 определения: серийный номер 010215 годен до 10.2016 г.

Вид с обратной стороны упаковки

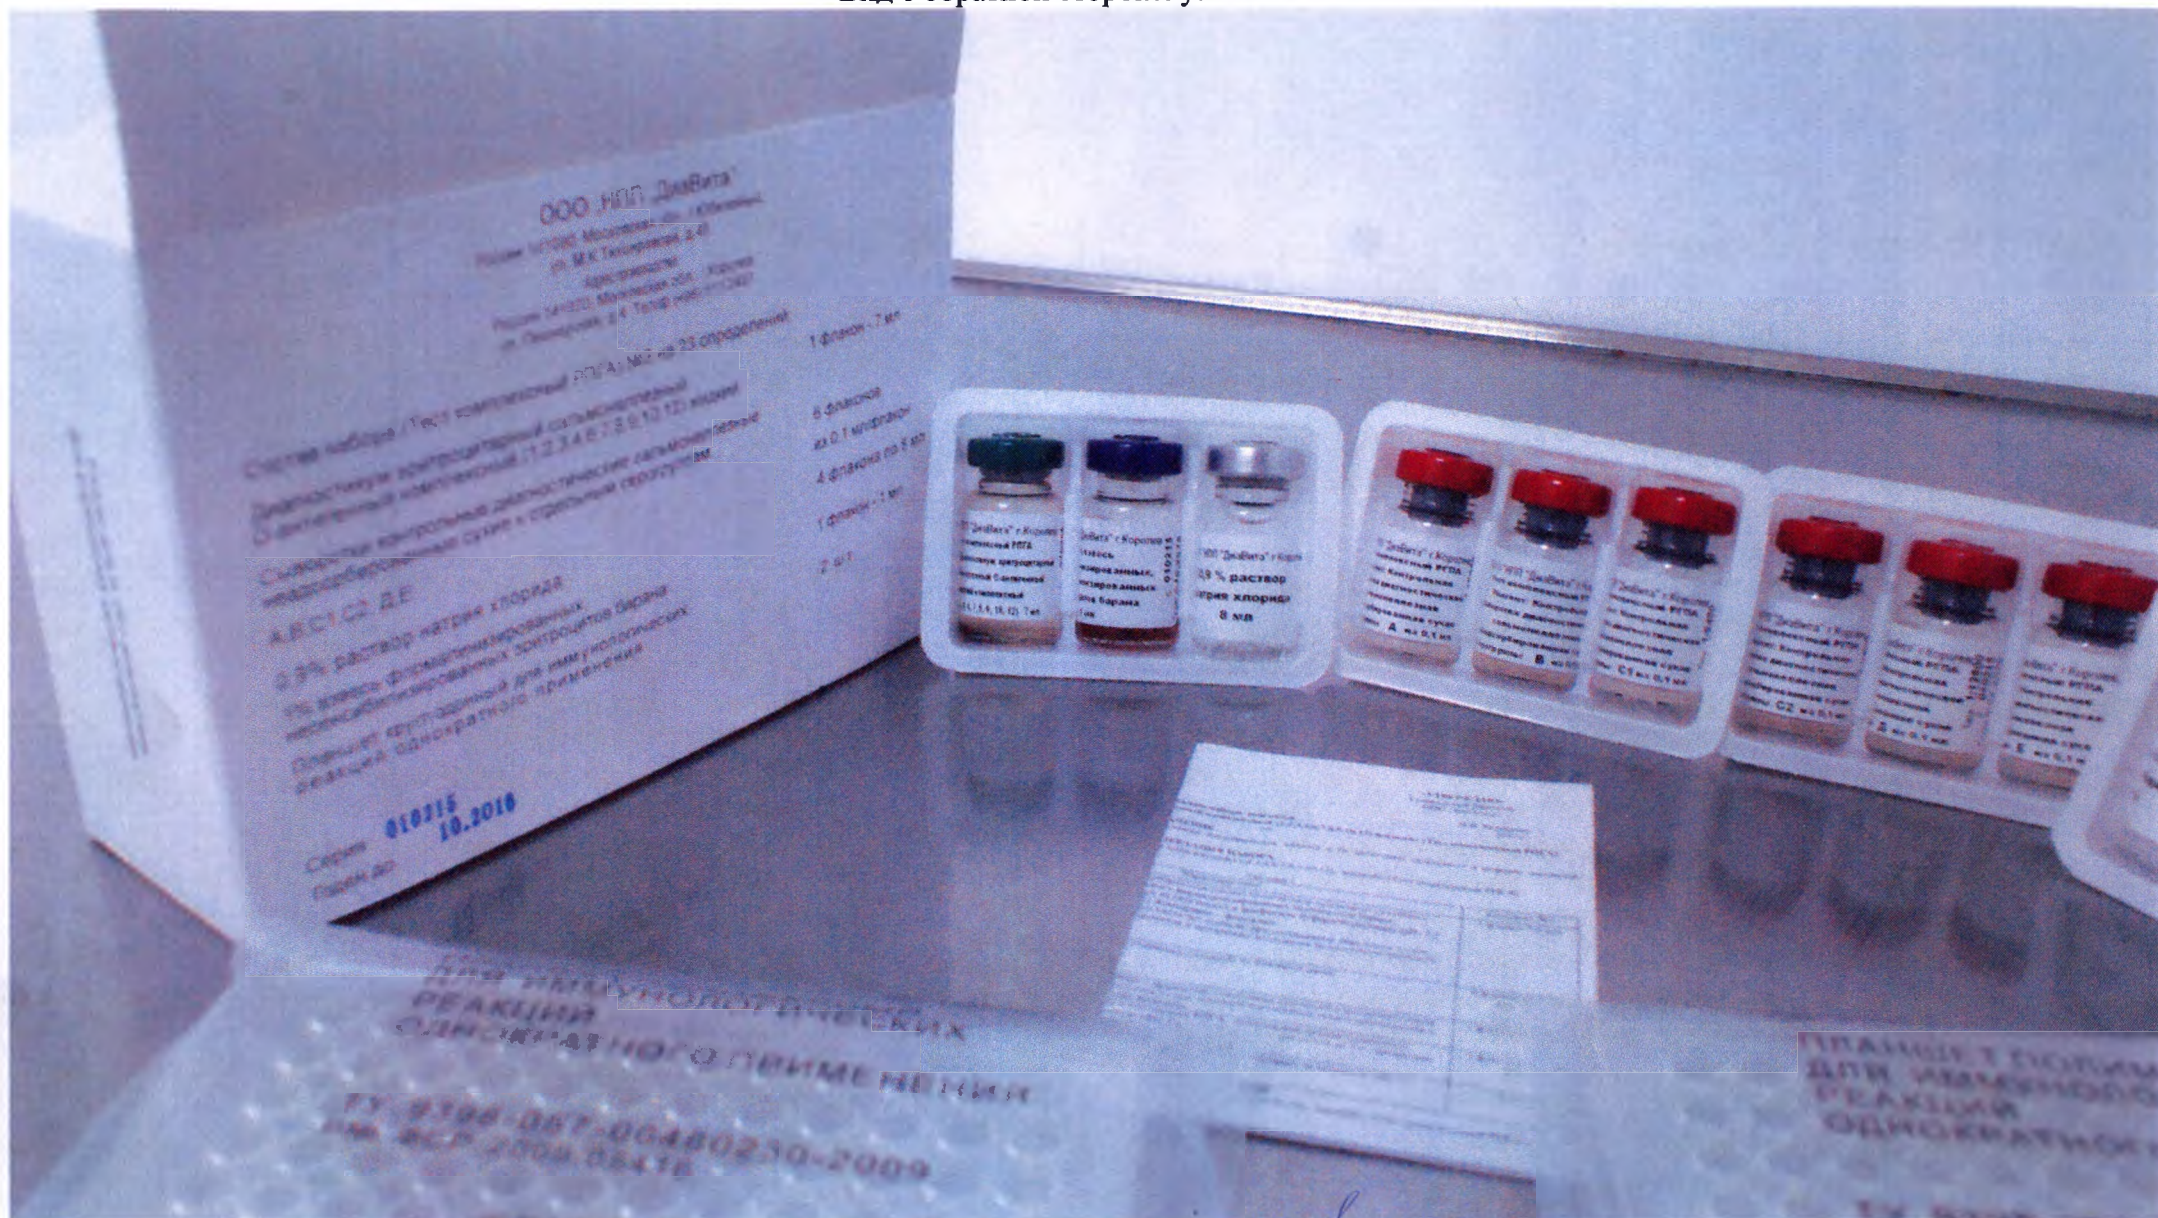


Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный комплексный (1,2,3,4,6,7,8,9,10,12)»

Комплект №3 рассчитан на 23 определения: серийный номер 020315 годен до 11.2016 г.


Вид с лицевой стороны упаковки

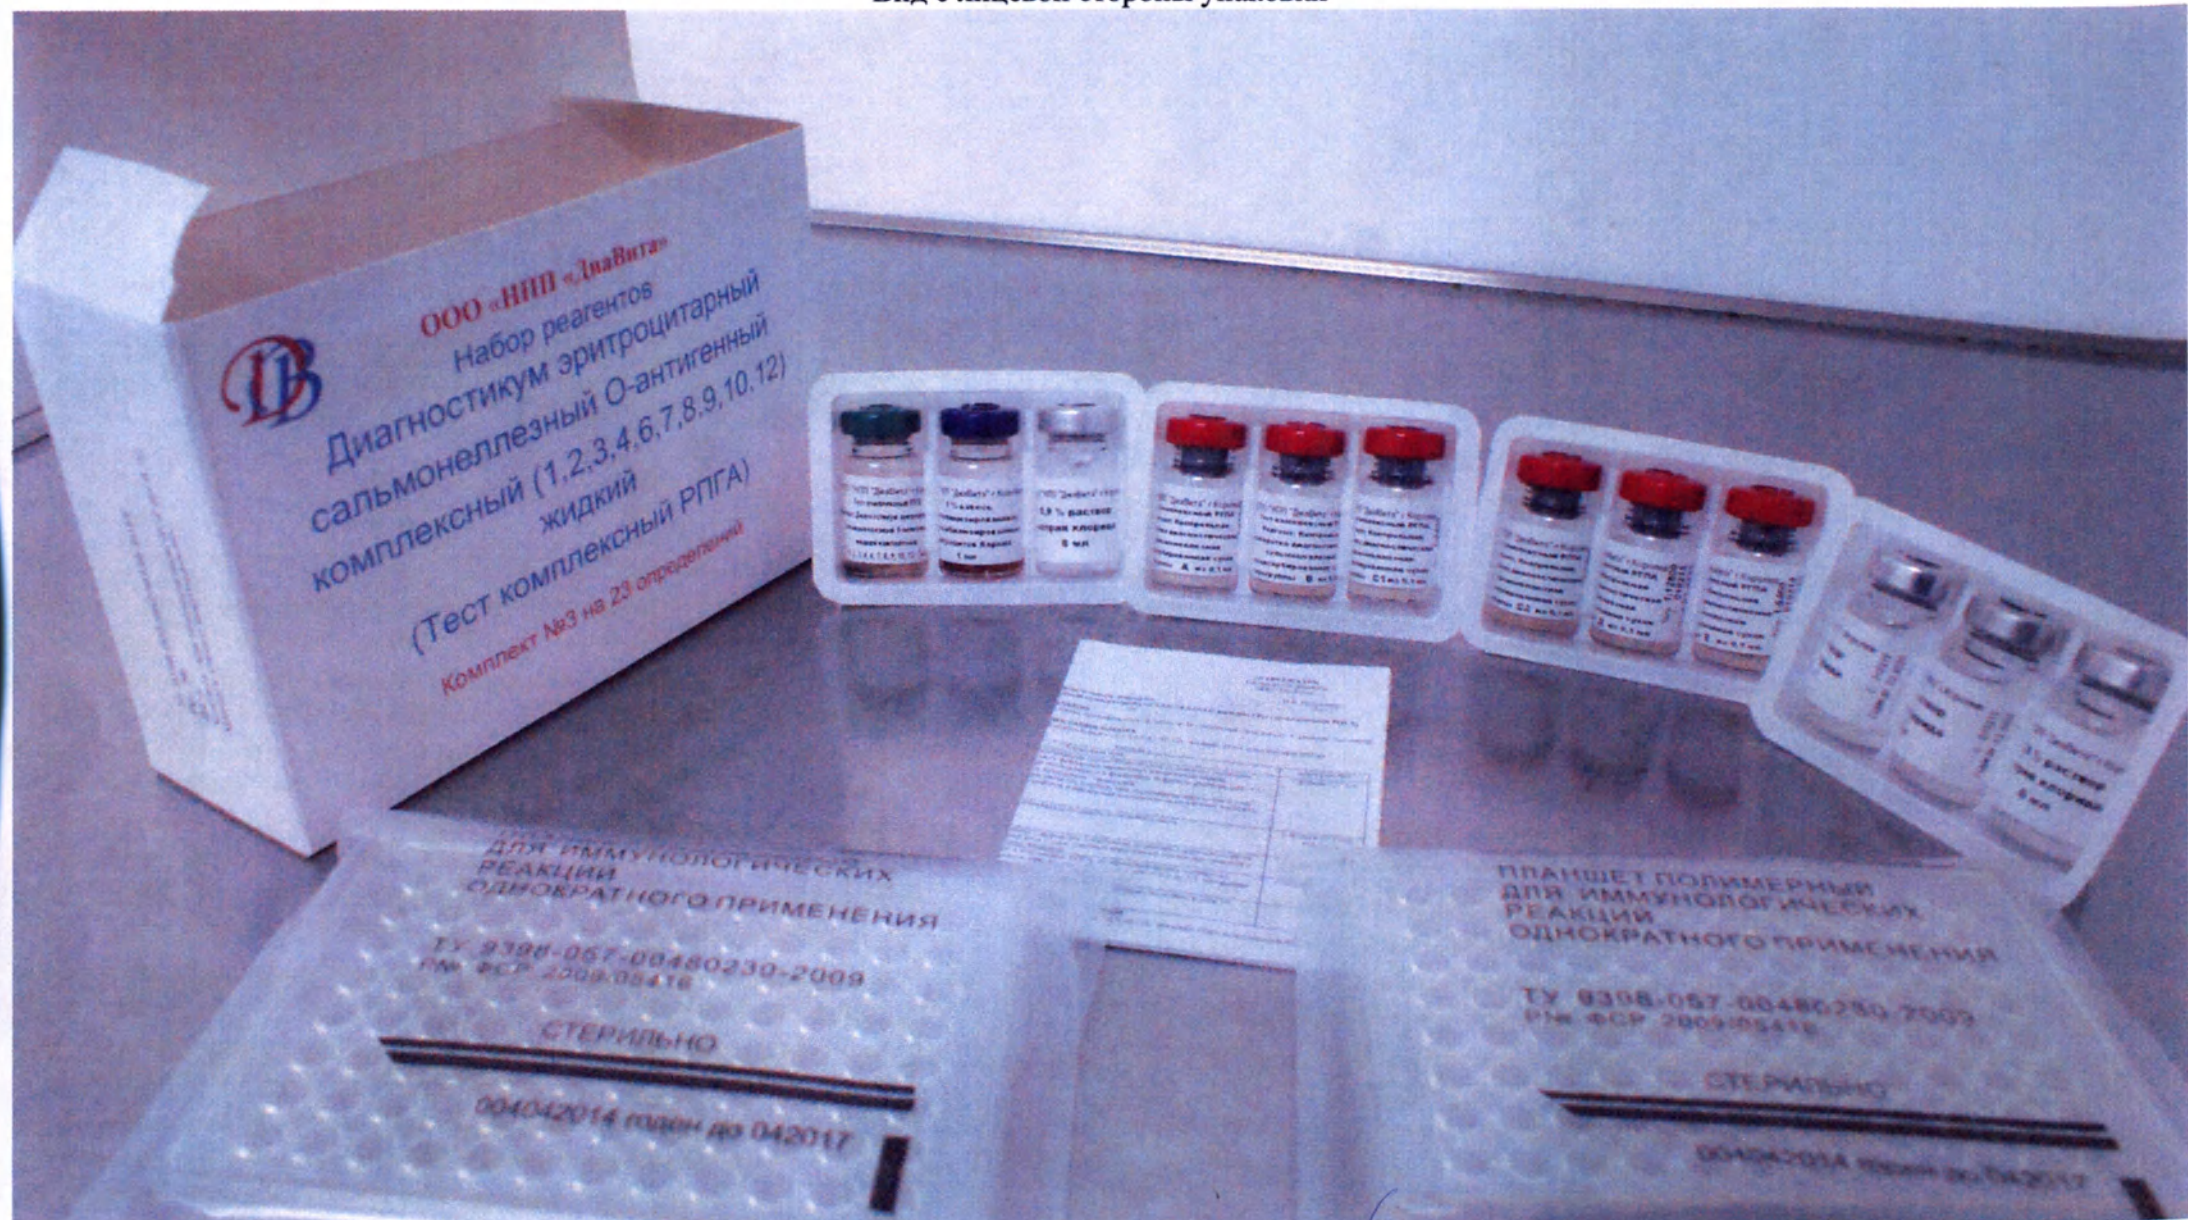

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Комплект №3 рассчитан на 23 определения: серийный номер 020315 годен до 11.2016 г.
Вид с обратной стороны упаковки

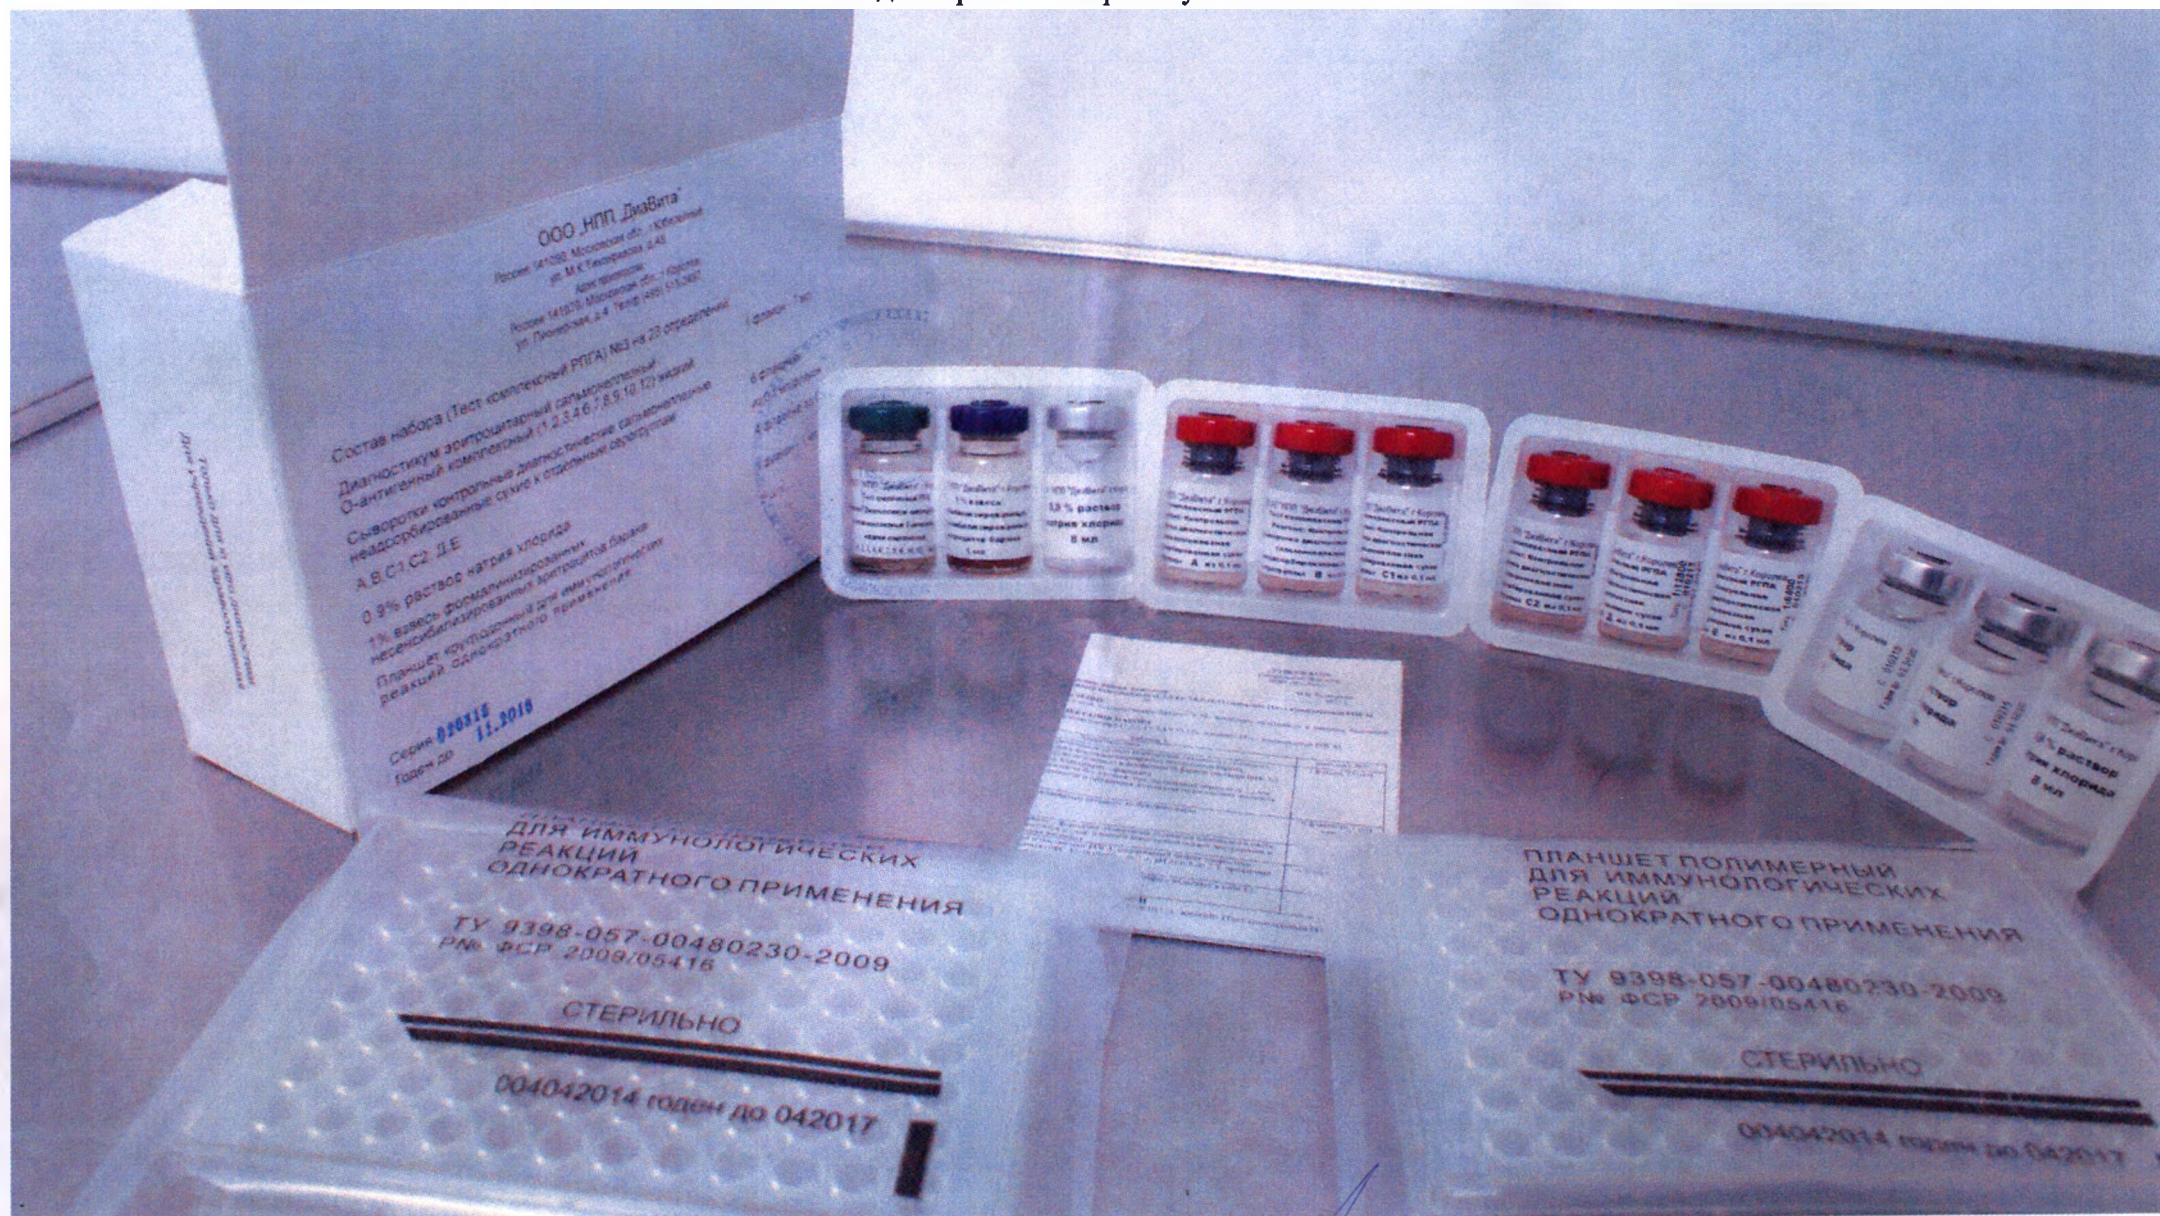

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

12 лист 06.

Генеральный директор ООО
«НПП «ДиаВита»

Губоковских А.О.

“05”

