


СТЕРИЛЬНО • НЕТОКСИЧНО • АПИРОГЕННО



Эндопротезы керамические
суставов и костей стопы

ТУ 32.50.22-001-88201166-2016

Дистальный компонент
плюснефалангового сустава

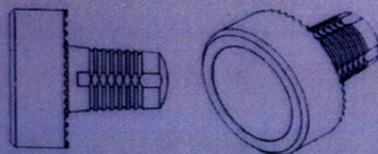


для использования
без цемента

REF 22-1035/10/0

LOT 1172001717/0002

Рег. уд. №



09.02.2022



10.02.2017



REF

22-1035/10/0



LOT

1172001717/0002

ООО "МОЙЕ Керамик-Имплантате"
634055, Россия, Томская область,
г. Томск, пр. Развития, 8
Тел.: (3822) 48-85-65
info@moje-keramik.ru
www.moje-keramik.ru



Эндопротезы керамические суставов и костей стопы по ТУ 32.50.22-001-88201166-2016. Дистальный компонент 22-1035/10.


СТЕРИЛЬНО • НЕТОКСИЧНО • АПИРОГЕННО



Эндопротезы керамические
суставов и костей стопы

ТУ 32.50.22-001-88201166-2016

Проксимальный компонент
плюснефалангового сустава

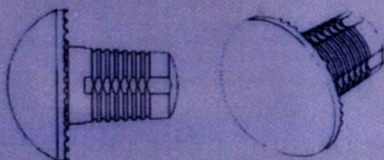


для использования
без цемента


REF 21-1580/10/0

LOT 1167001117/0002

Рег. уд. №



09.02.2022



10.02.2017



21-1580/10/0



1167001117/0002

ООО "МОЙЕ Керамик-Имплантате"
634055, Россия, Томская область,
г. Томск, пр. Развития, 8
Тел.: (3822) 48-85-65
info@moje-keramik.ru
www.moje-keramik.ru



Эндопротезы керамические суставов и костей стопы по ТУ 32.50.22-001-88201166-2016. Проксимальный компонент 21-1580/10/0.



Эндопротезы керамические суставов и костей стопы по ТУ 32.50.22-001-88201166-2016. Дистальный компонент 22-1035/10 сочетается с проксимальным компонентом 21-1580/10/0.



СТЕРИЛЬНО • НЕТОКСИЧНО • АПИРОГЕННО



Эндопротезы керамические
суставов и костей стопы

ТУ 32.50.22-001-88201166-2016

Дистальный компонент
плюснефалангового сустава




для использования
без цемента


REF 24 - 1780/10/0

LOT 1211001317/0002

Рег. уд. №



09 02 2022



10.02.2017



REF

24 - 1780/10/0



LOT

1211001317/0002

ООО "МОЙЕ Керамик-Имплантате"
634055, Россия, Томская область,
Томск, пр. Развития, 8
Тел.: (3822) 48-85-65
info@moje-keramik.ru
www.moje-keramik.ru



Эндопротезы керамические суставов и костей стопы по ТУ 32.50.22-001-88201166-2016. Дистальный компонент 24-1780/10/0.


СТЕРИЛЬНО • НЕТОКСИЧНО • АПИРОГЕННО



Эндопротезы керамические
суставов и костей стопы

ТУ 32.50.22-001-88201166-2016

Проксимальный компонент
плюснефалангового сустава

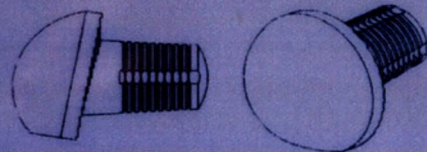

для использования
без цемента


REF 25-1780/12/0

LOT 1208001417/0002


Рег. уд. №



09 02 2022



10 02 2017




REF

25-1780/12/0


LOT

1208001417/0002

ООО "МОЙЕ Керамик-Имплантате"
634055, Россия, Томская область,
г. Томск, пр. Развития, 8
Тел.: (3822) 48-85-65
info@moje-keramik.ru
www.moje-keramik.ru

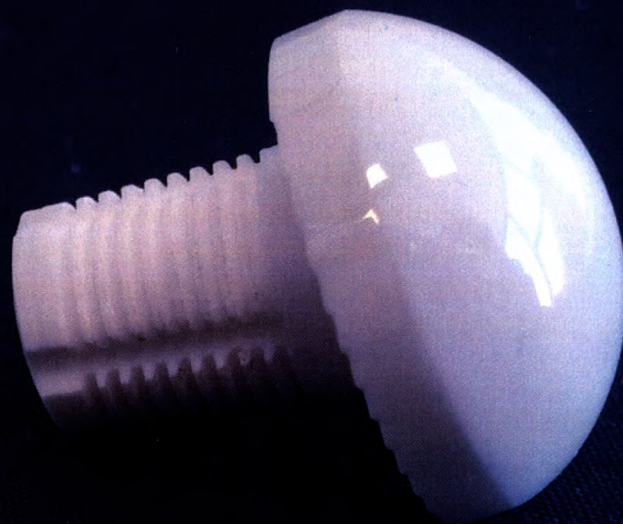

Эндопротезы керамические суставов и костей стопы по ТУ 32.50.22-001-88201166-2016. Проксимальный компонент 25-1780/12/0.

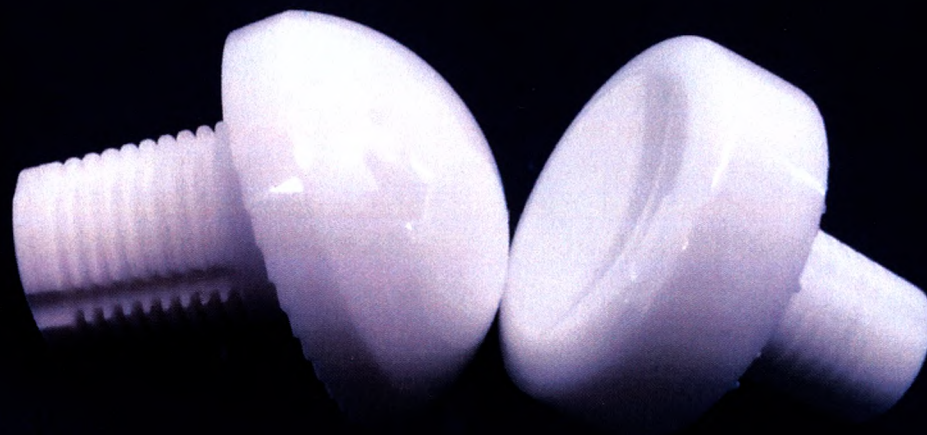

Эндопротезы керамические суставов и костей стопы по ТУ 32.50.22-001-88201166-2016. Дистальный компонент 24-1780/10/0 сочетается с проксимальным компонентом 25-1780/10/0

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


СТЕРИЛЬНО • НЕТОКСИЧНО • АПИРОГЕННО



Эндопротезы керамические
суставов и костей стопы

ТУ 32.50.22-011-88201166-2016

Проксимальный компонент
плюснефалангового сустава

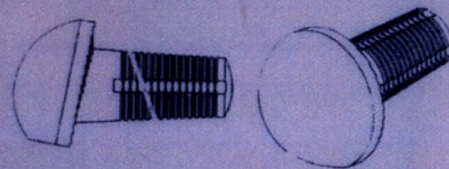


для использования
без цемента


REF 27-1980/22/0

LOT 1576001617/0002

Рег. уд. №



09 02 2022



10 02 2017




27-1980/22/0



1576001617/0002

ООО "МОЙЕ Керамик-Имплантат"
634055, Россия, Томская область,
г. Томск, пр. Развития 8
Тел.: (3822) 48-85-65
info@moje-keramik.ru
www.moje-keramik.ru

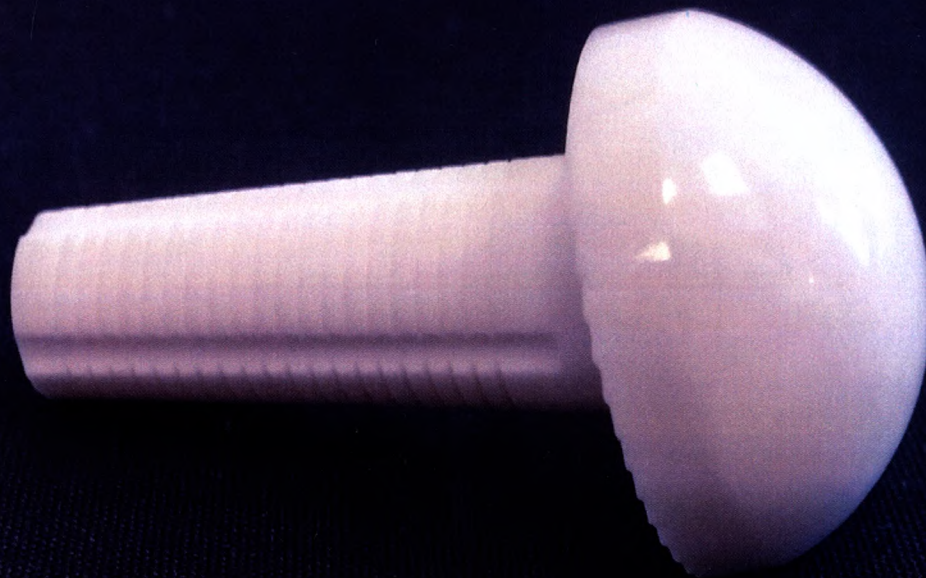

Эндопротезы керамические суставов и костей стопы по ТУ 32.50.22-001-88201166-2016. Проксимальный компонент 27-1980/22/0.

СТЕРИЛЬНО • НЕТОКСИЧНО • АПИРОГЕННО



Эндопротезы керамические
суставов и костей стопы

ТУ 32.50.22 001-88201166-2016

Дистальный компонент
плюснефалангового сустава




для использования
без цемента

REF 26-1980/17/0

LOT 1559001517/0002


Рег. уд. №



01



09.02.2022



10.02.2017



REF


26-1980/17/0



LOT

1559001517/0002

ООО "МОЙЕ" Керамик-Имплантате"
634055, Россия, Томская область,
пр. Развигия, 8
Тел.: (3822) 48-65-65
info@moje-keramik.ru
www.moje-keramik.ru

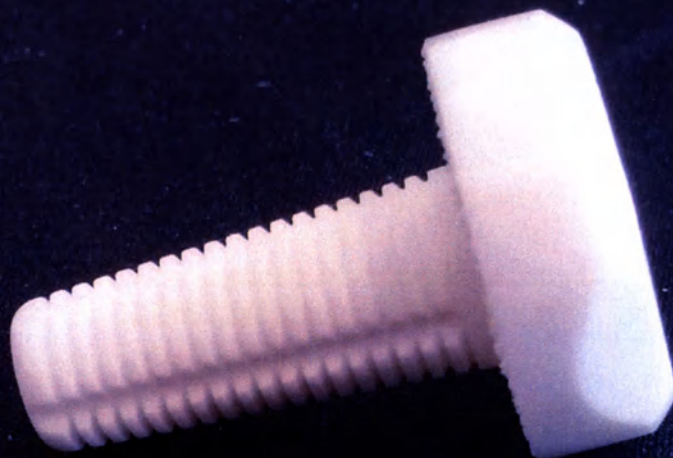

Эндопротезы керамические суставов и костей стопы по ТУ 32.50.22-001-88201166-2016. Дистальный компонент 26-1980/17/0.



Эндопротезы керамические суставов и костей стопы по ТУ 32.50.22-001-88201166-2016. Дистальный компонент 26-1980/17/0 сочетается с проксимальным компонентом 27-1980/22/0.

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


СТЕРИЛЬНО • НЕТОКСИЧНО • АПИРОГЕННО



Эндопротезы керамические
суставов и костей стопы

ТУ 32.50.22-001-88201166-2016

Дистальный компонент
плюснефалангового сустава

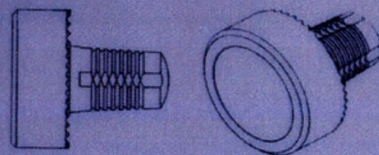


для использования
без цемента


REF 22-1580/10/0

LOT 1176001217/0002

Пер. уд. №



09 02 2022



10 02 2017



REF


22-1580/10/0



LOT

1176001217/0002

ООО "МОЙЕ Керамик-Имплантате"
634055, Россия, Томская область,
г. Томск, пр. Развития, 8
Тел. (3822) 48-85-65
info@moje-keramik.ru
www.moje-keramik.ru

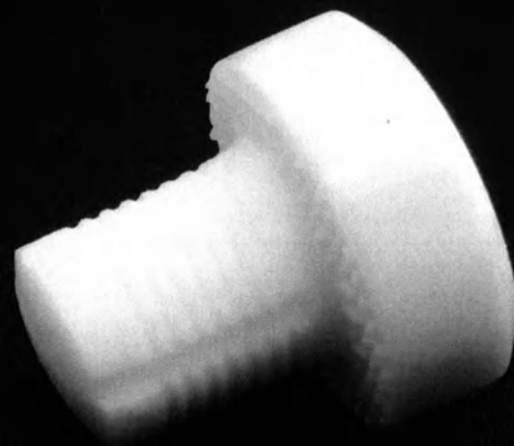

Эндопротезы керамические суставов и костей стопы по ТУ 32.50.22-001-88201166-2016. Дистальный компонент 22-1580/10/0.


СТЕРИЛЬНО • НЕТОКСИЧНО • АПИРОГЕННО



Эндопротезы керамические
суставов и костей стопы

ТУ 32.50.22-001-88201166-2016

Гемипротез головки
плюсневой кости

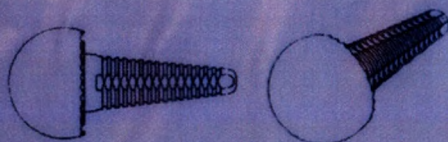

для использования
без цемента


REF 29-1340/17/0

LOT 1609001817/0002

Рег. уд. №



09 02 2022



10 02 2017



REF 29-1340/17/0



LOT 1609001817/0002



ООО "МОЙЕ Керамик-Имплантате"
634055, Россия, Томская область,
г. Томск пр. Развития, 8
Тел.: (3822) 48-85-65
info@moje-keramik.ru
www.moje-keramik.ru



Эндопротезы керамические суставов и костей стопы по ТУ 32.50.22-001-88201166-2016. Проксимальный компонент 29-1340/17/0.



Эндопротезы керамические суставов и костей стопы по ТУ 32.50.22-001-88201166-2016. Дистальный компонент 22-1580/10/0 сочетается с проксимальным компонентом 29-1340/17/0.

Прошито и пронумеровано 10

(фактически)
Директор ООО «МОЙЕ»

Карлов А.В.

