




Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

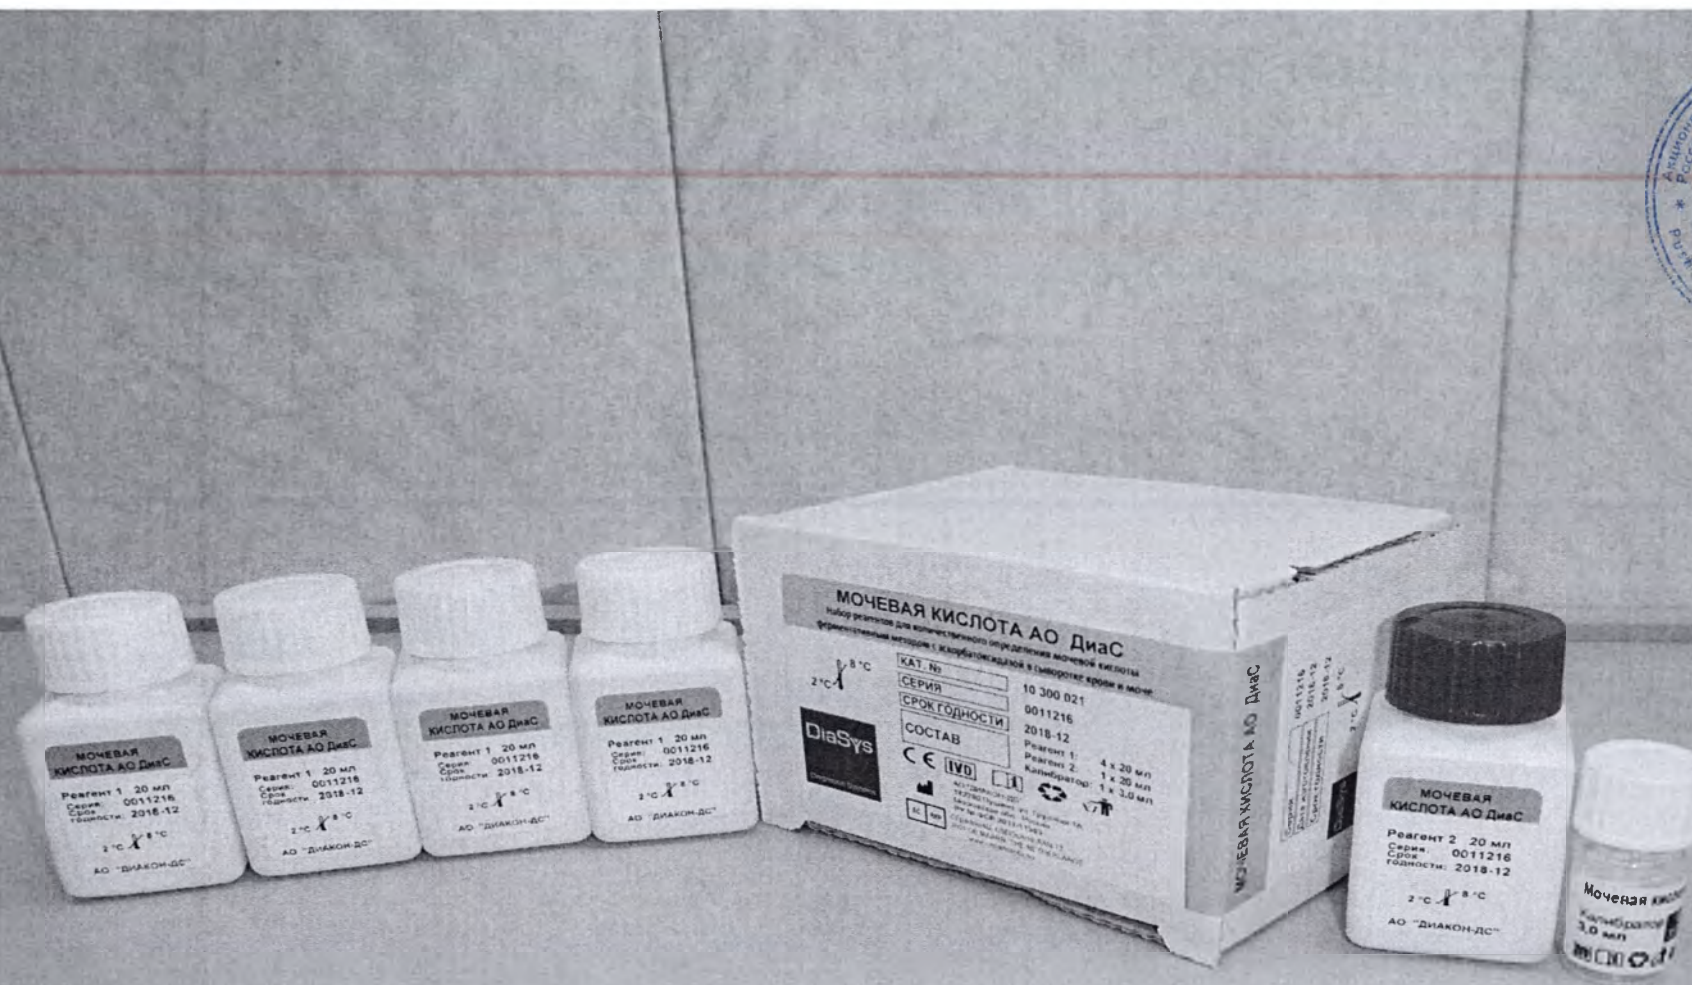


Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

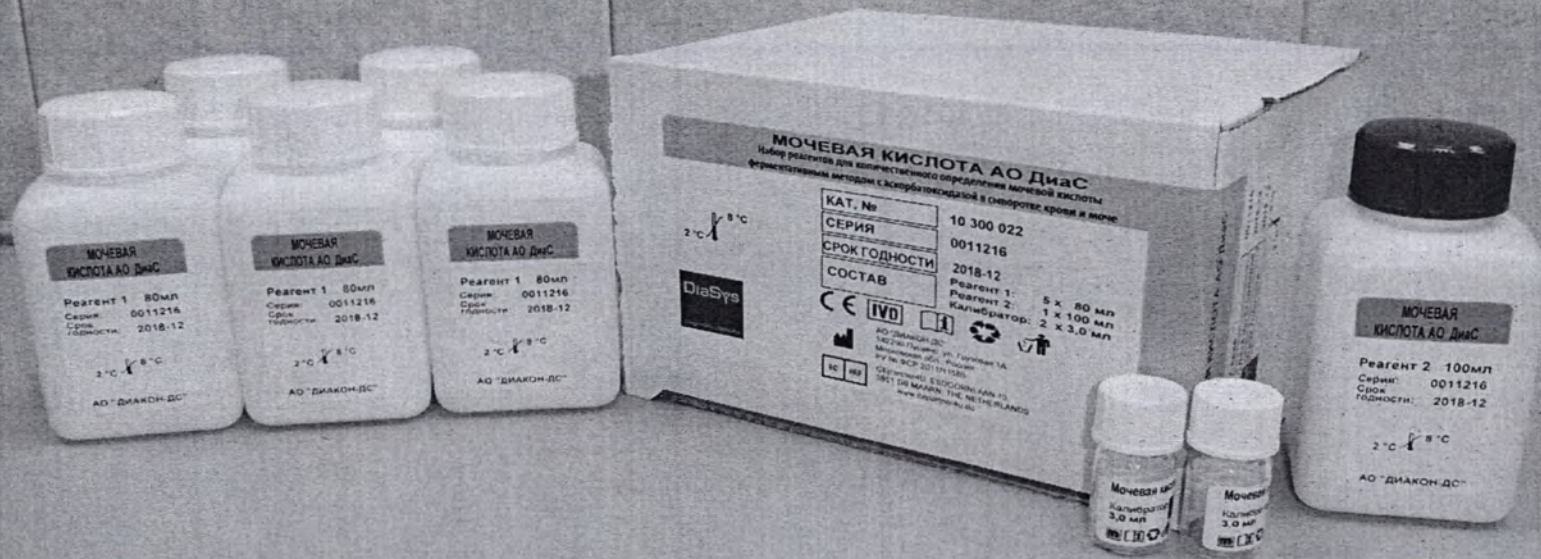

Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

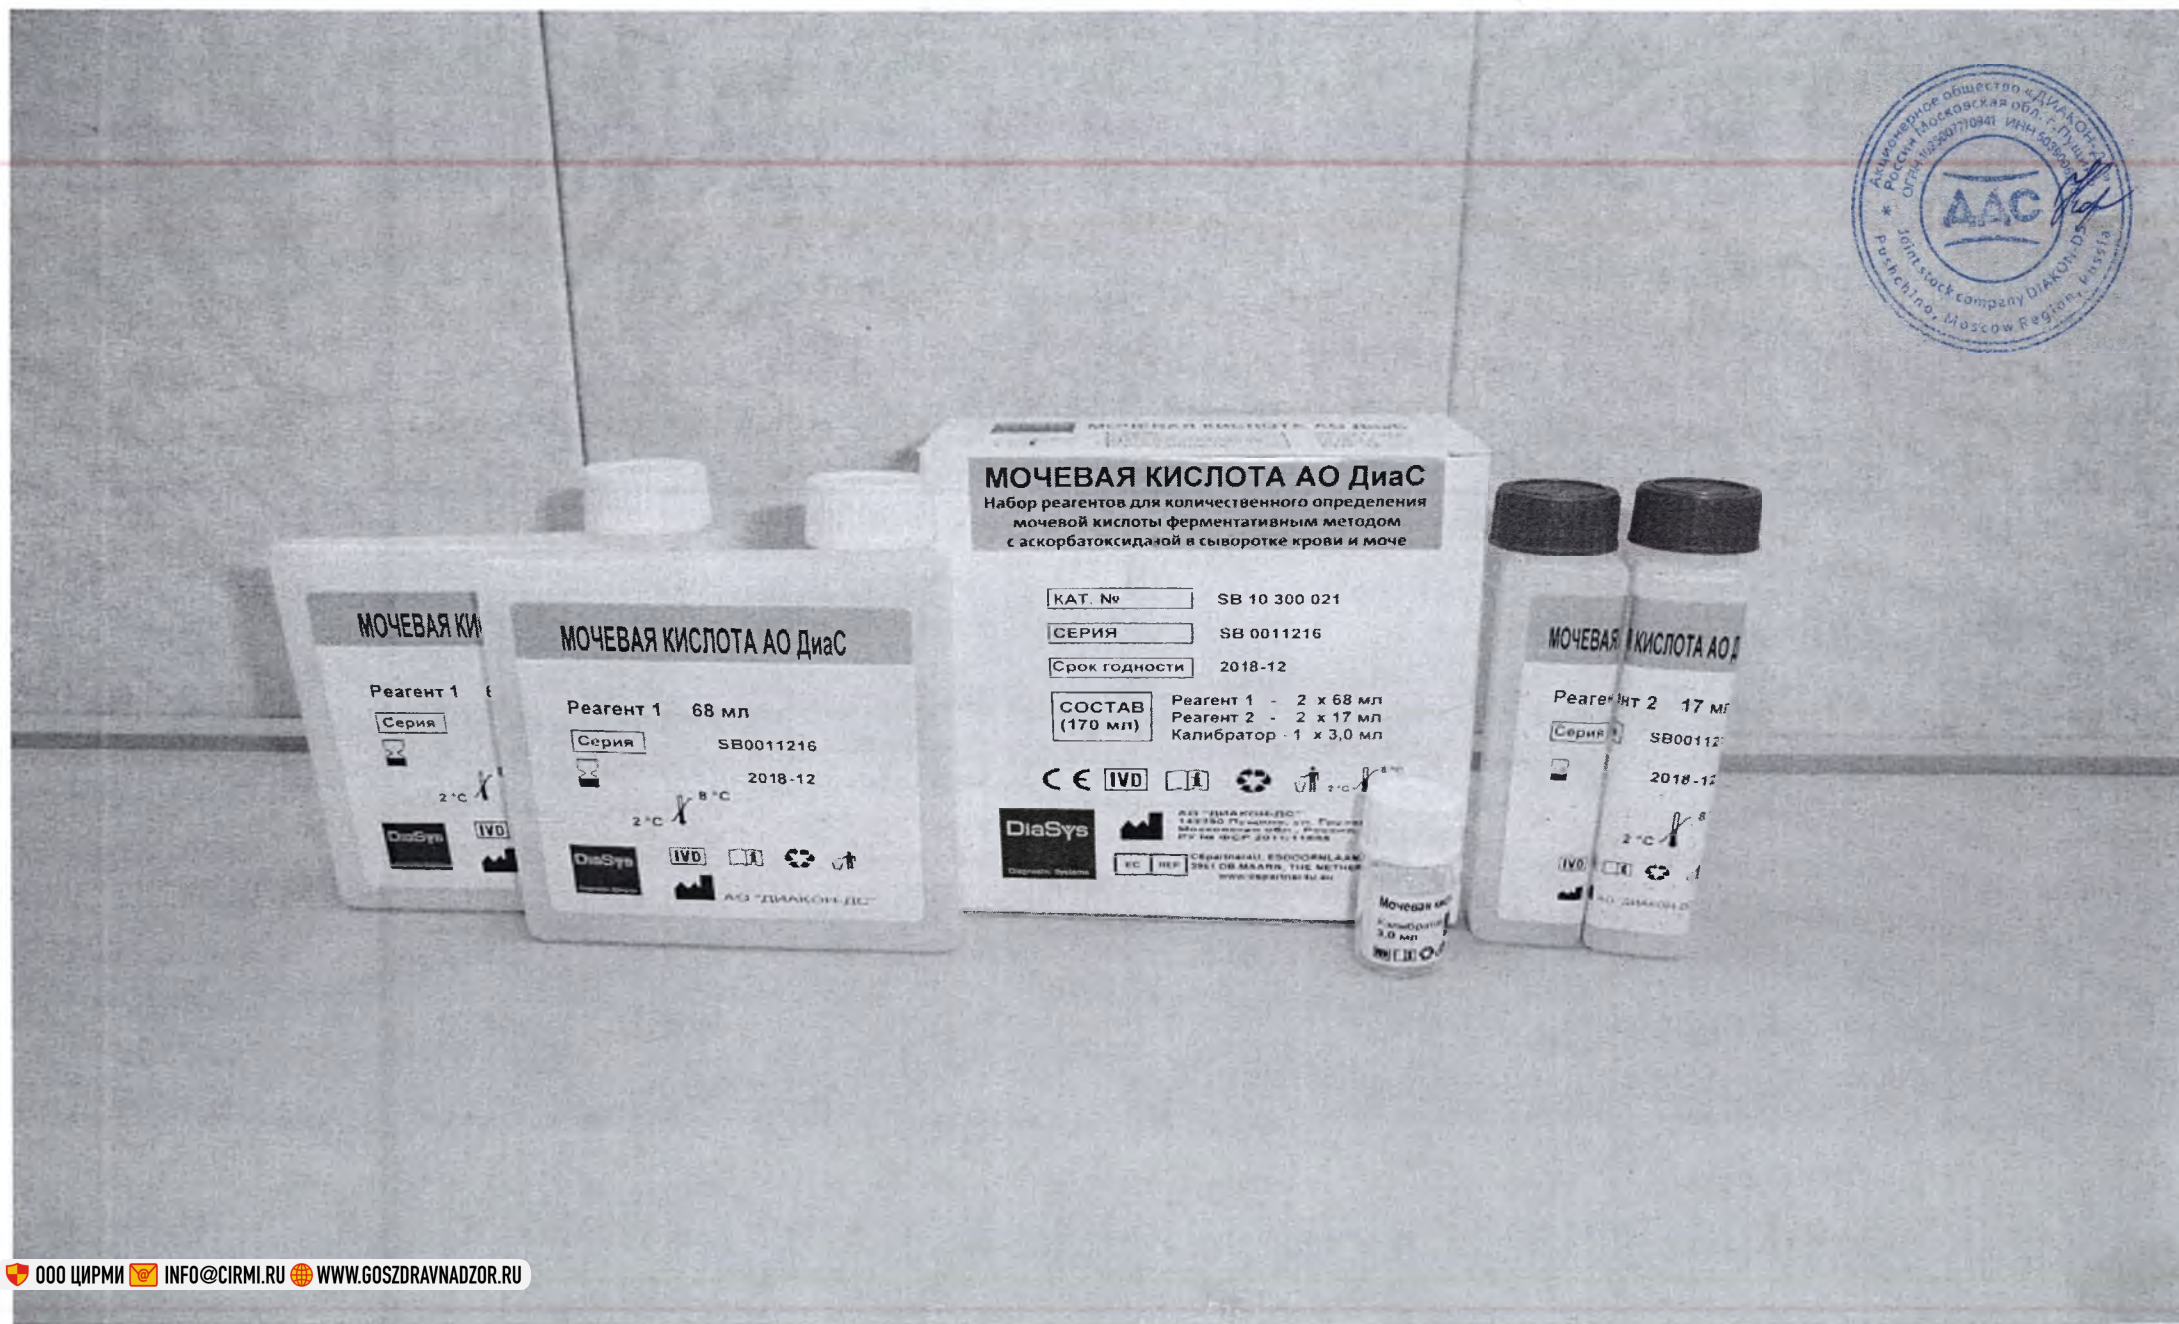


Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

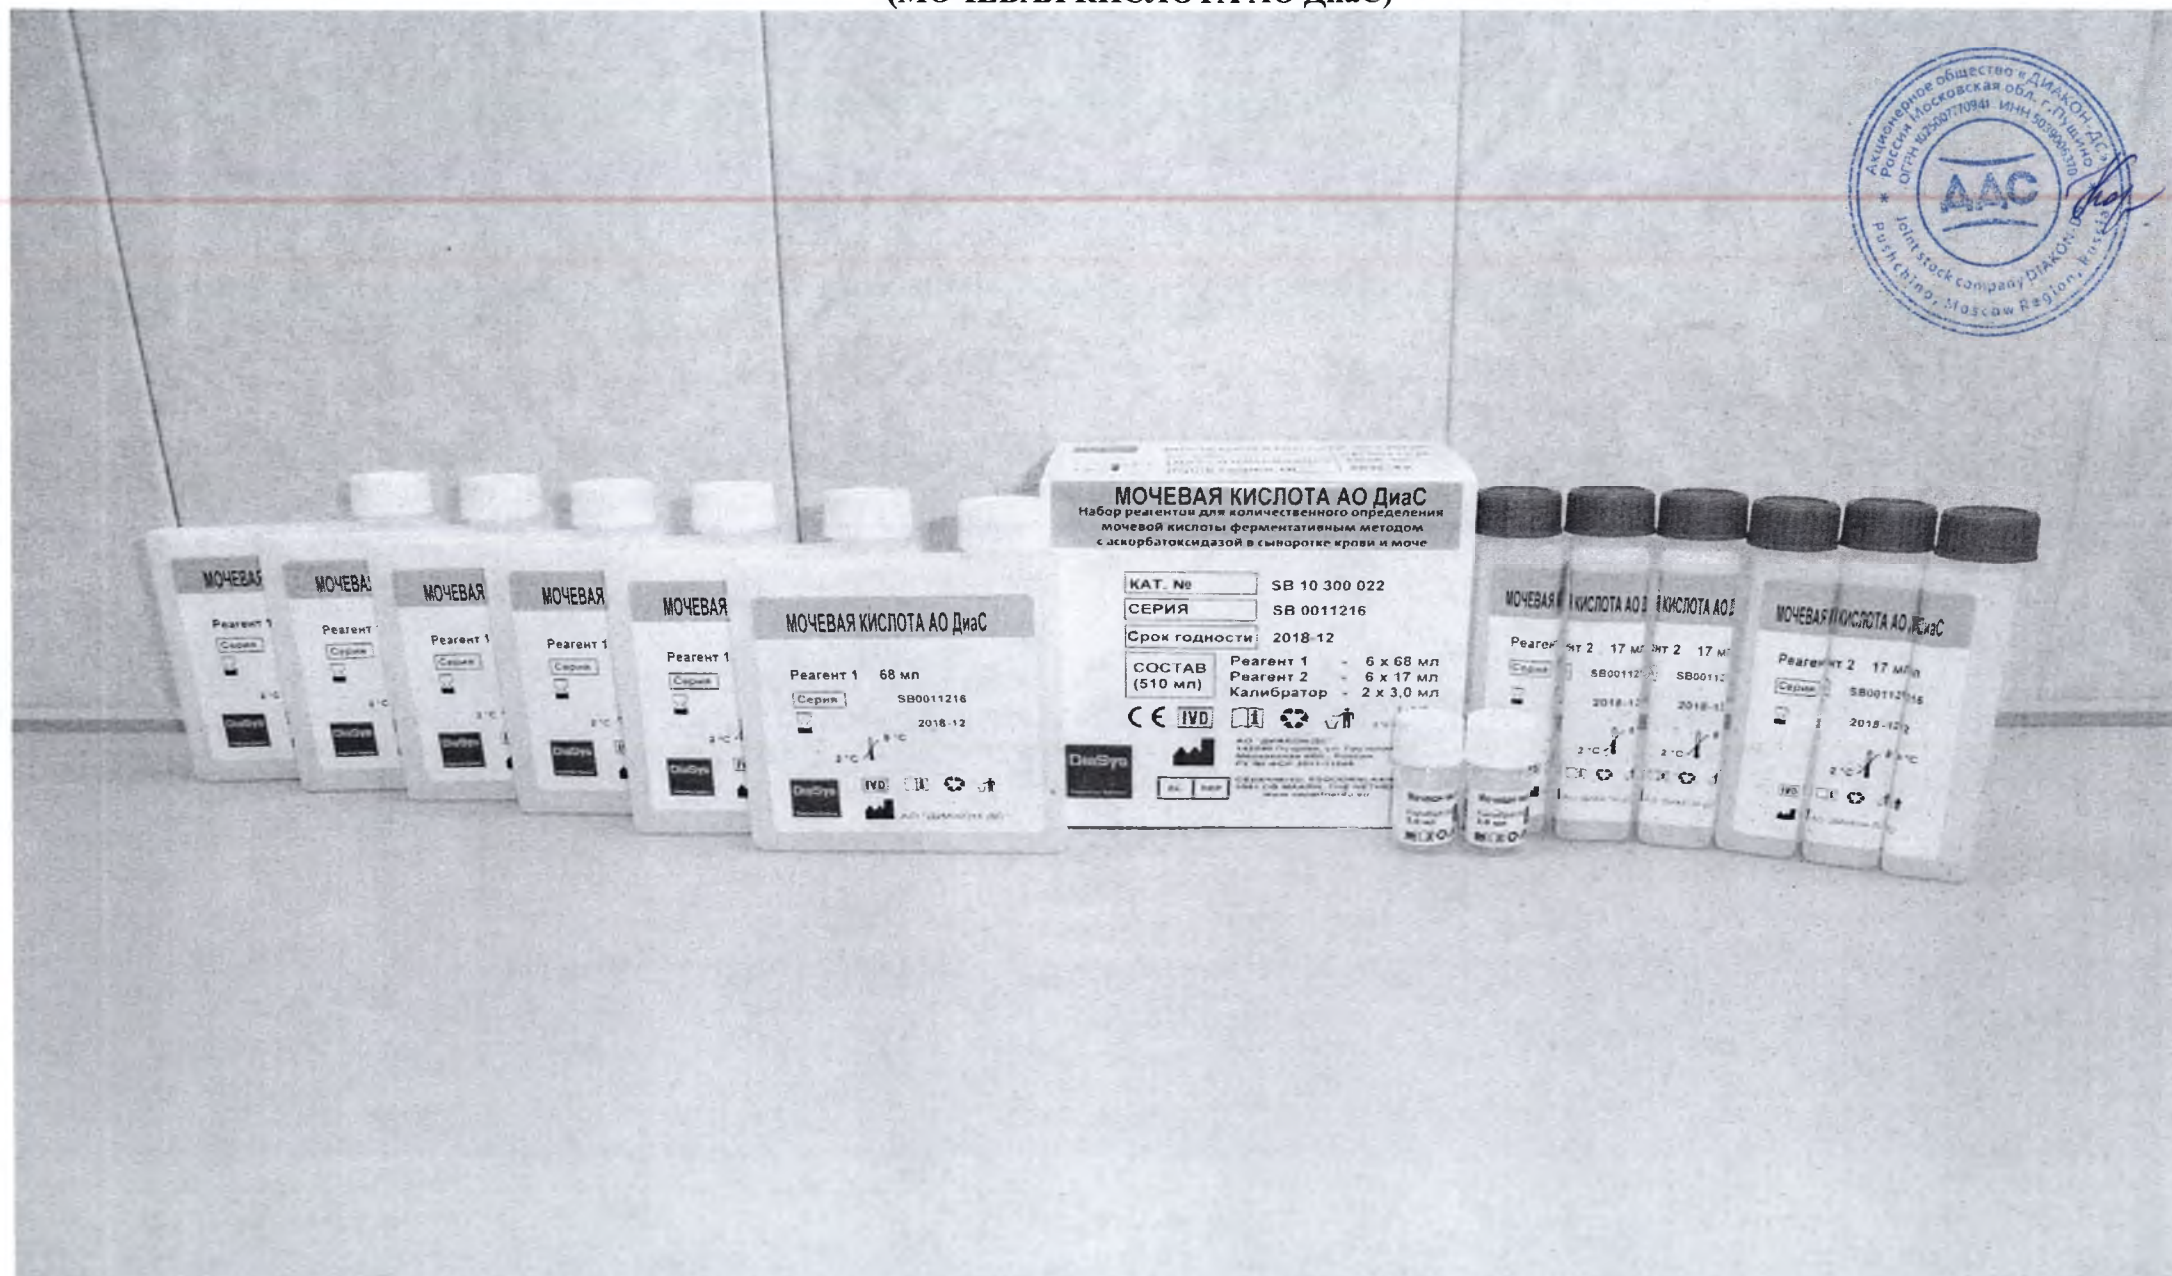





Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

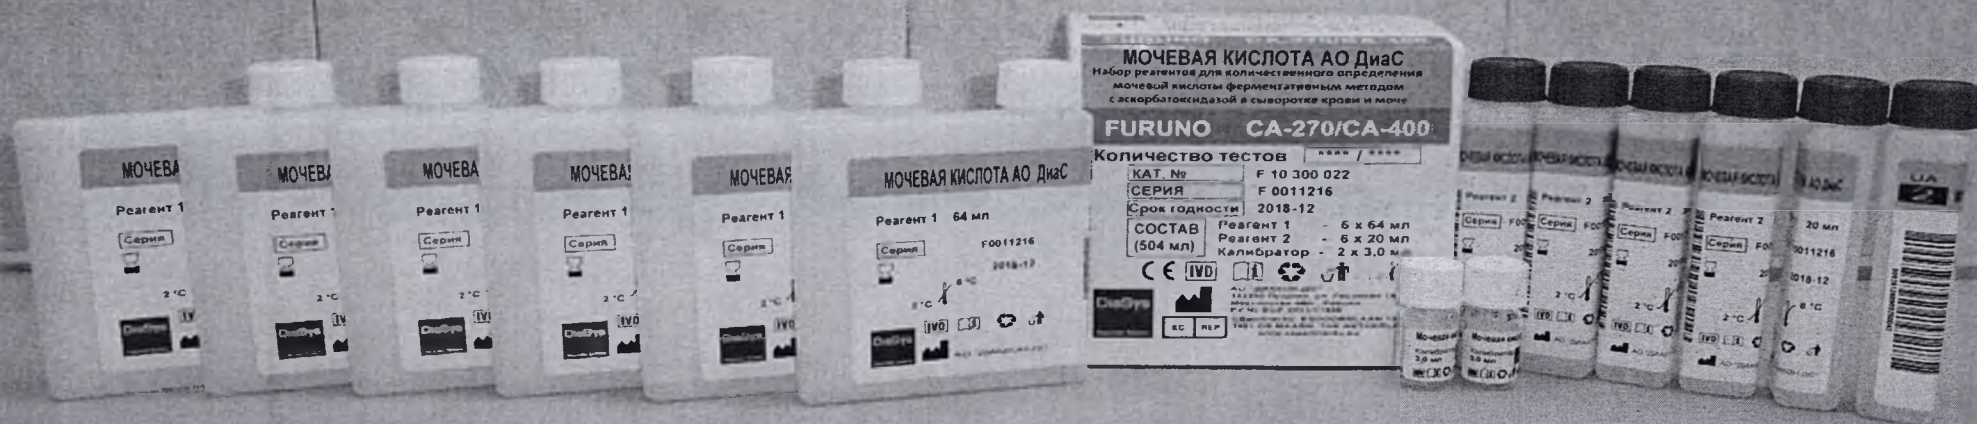


Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

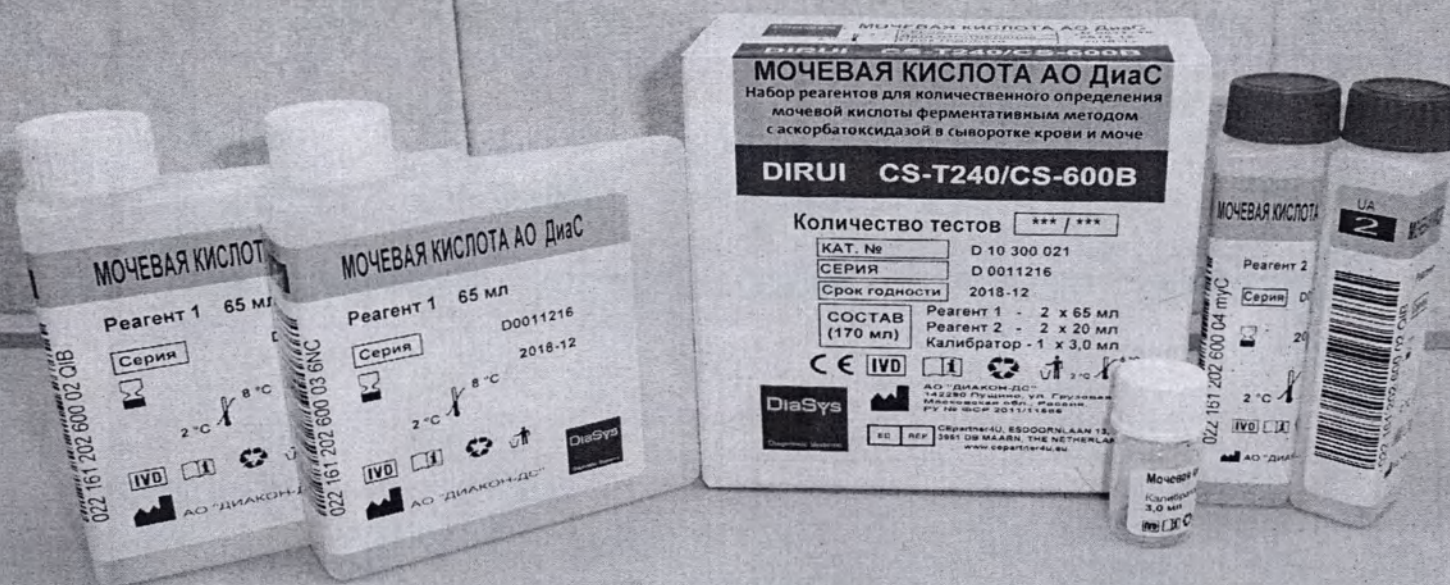


Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

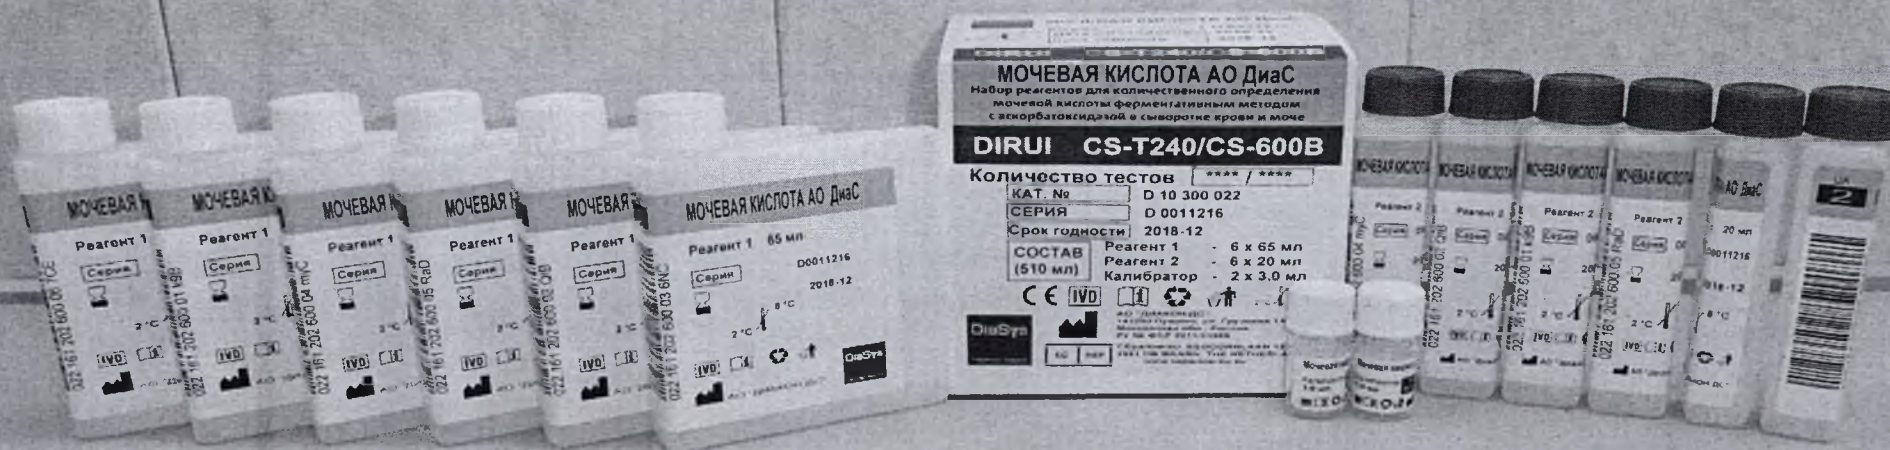


Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

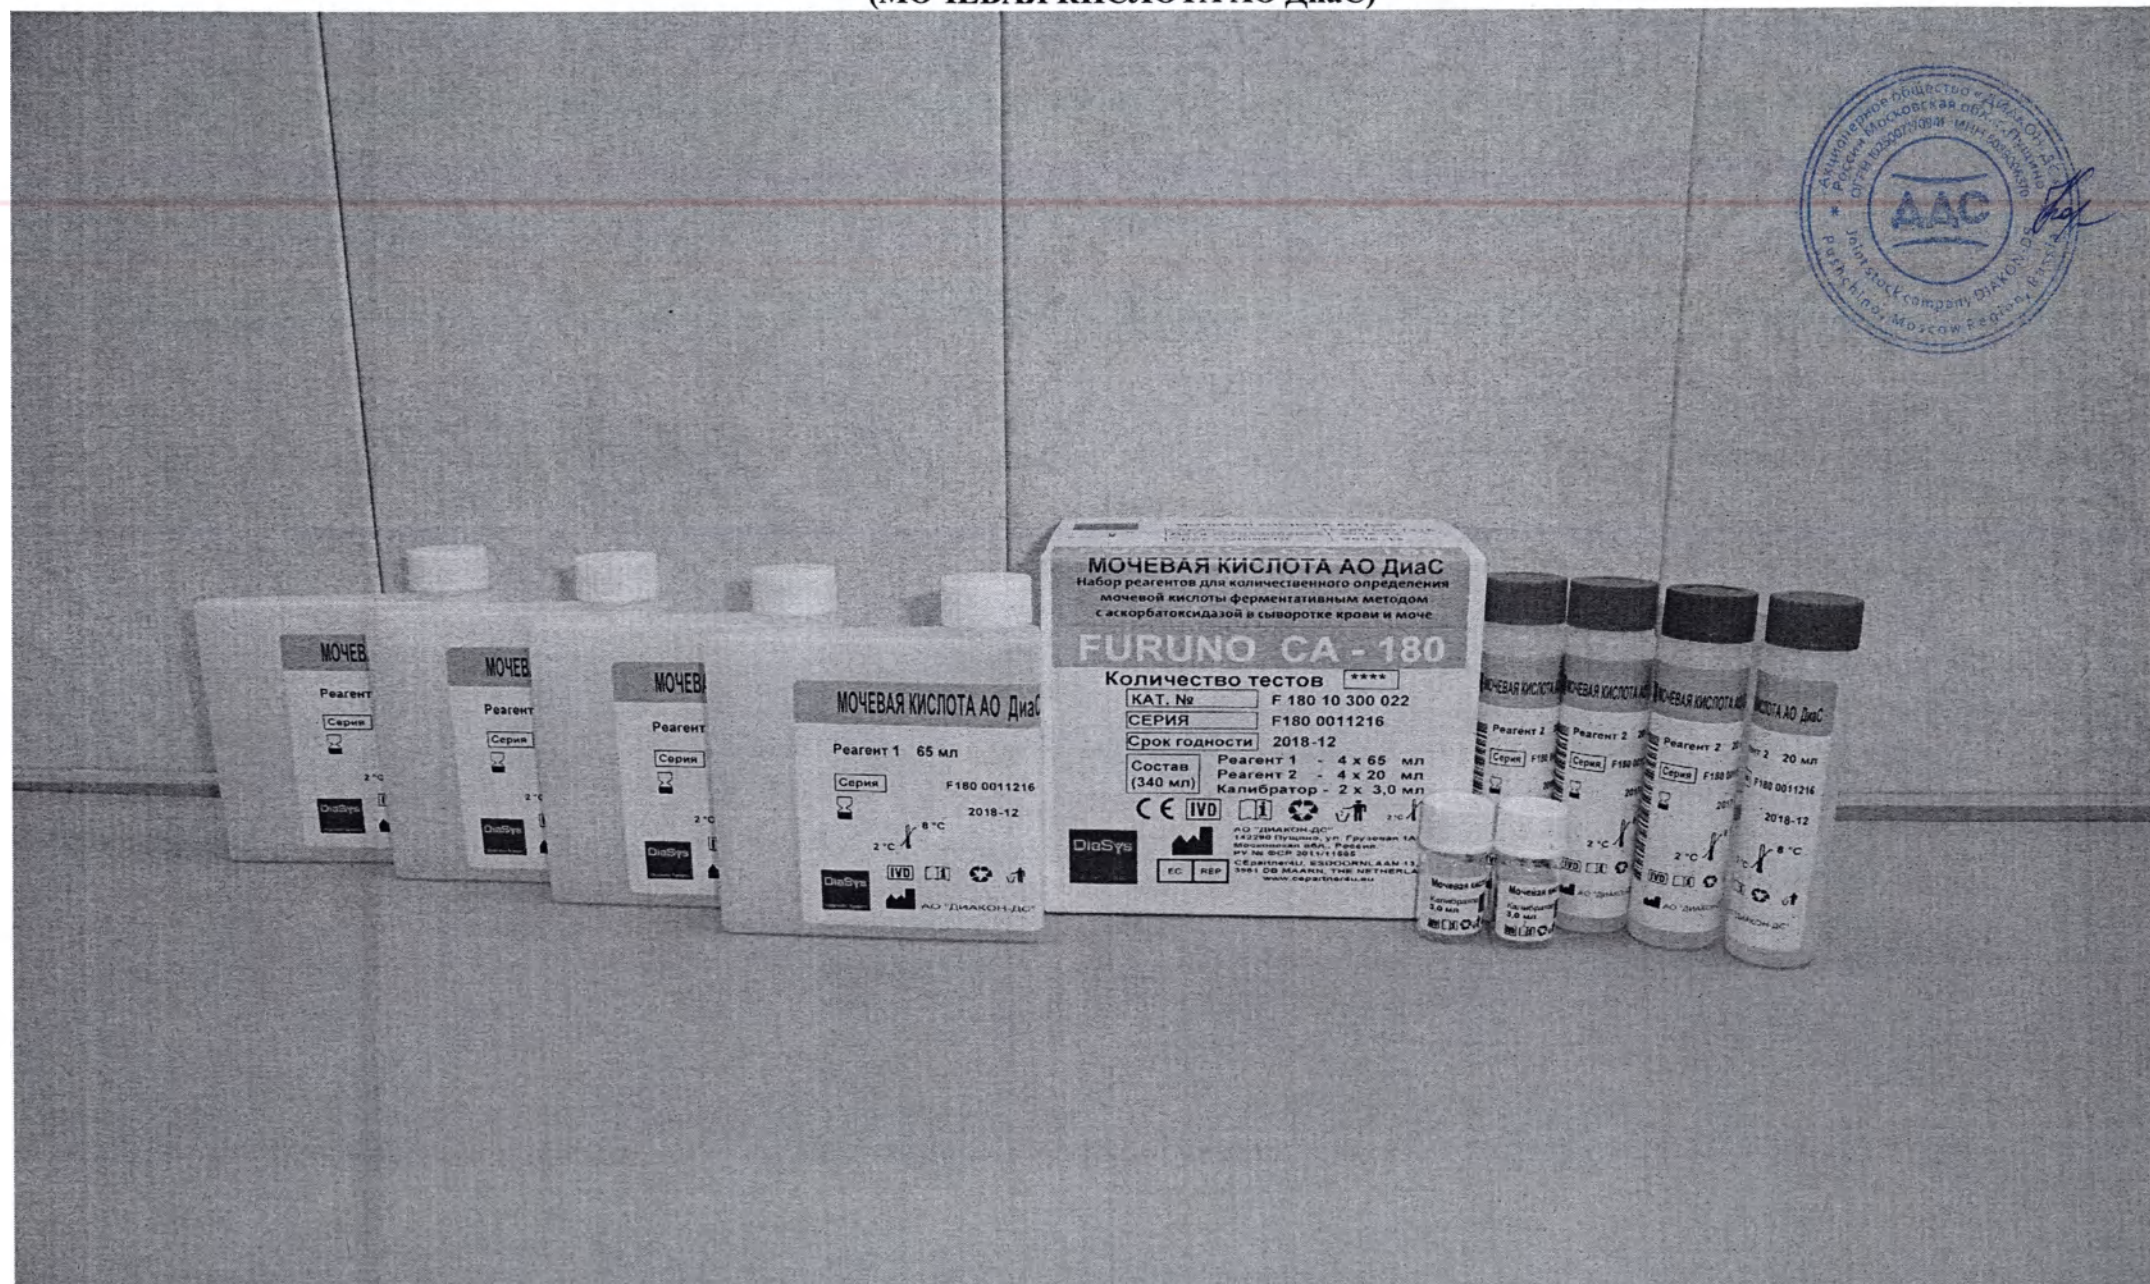




Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

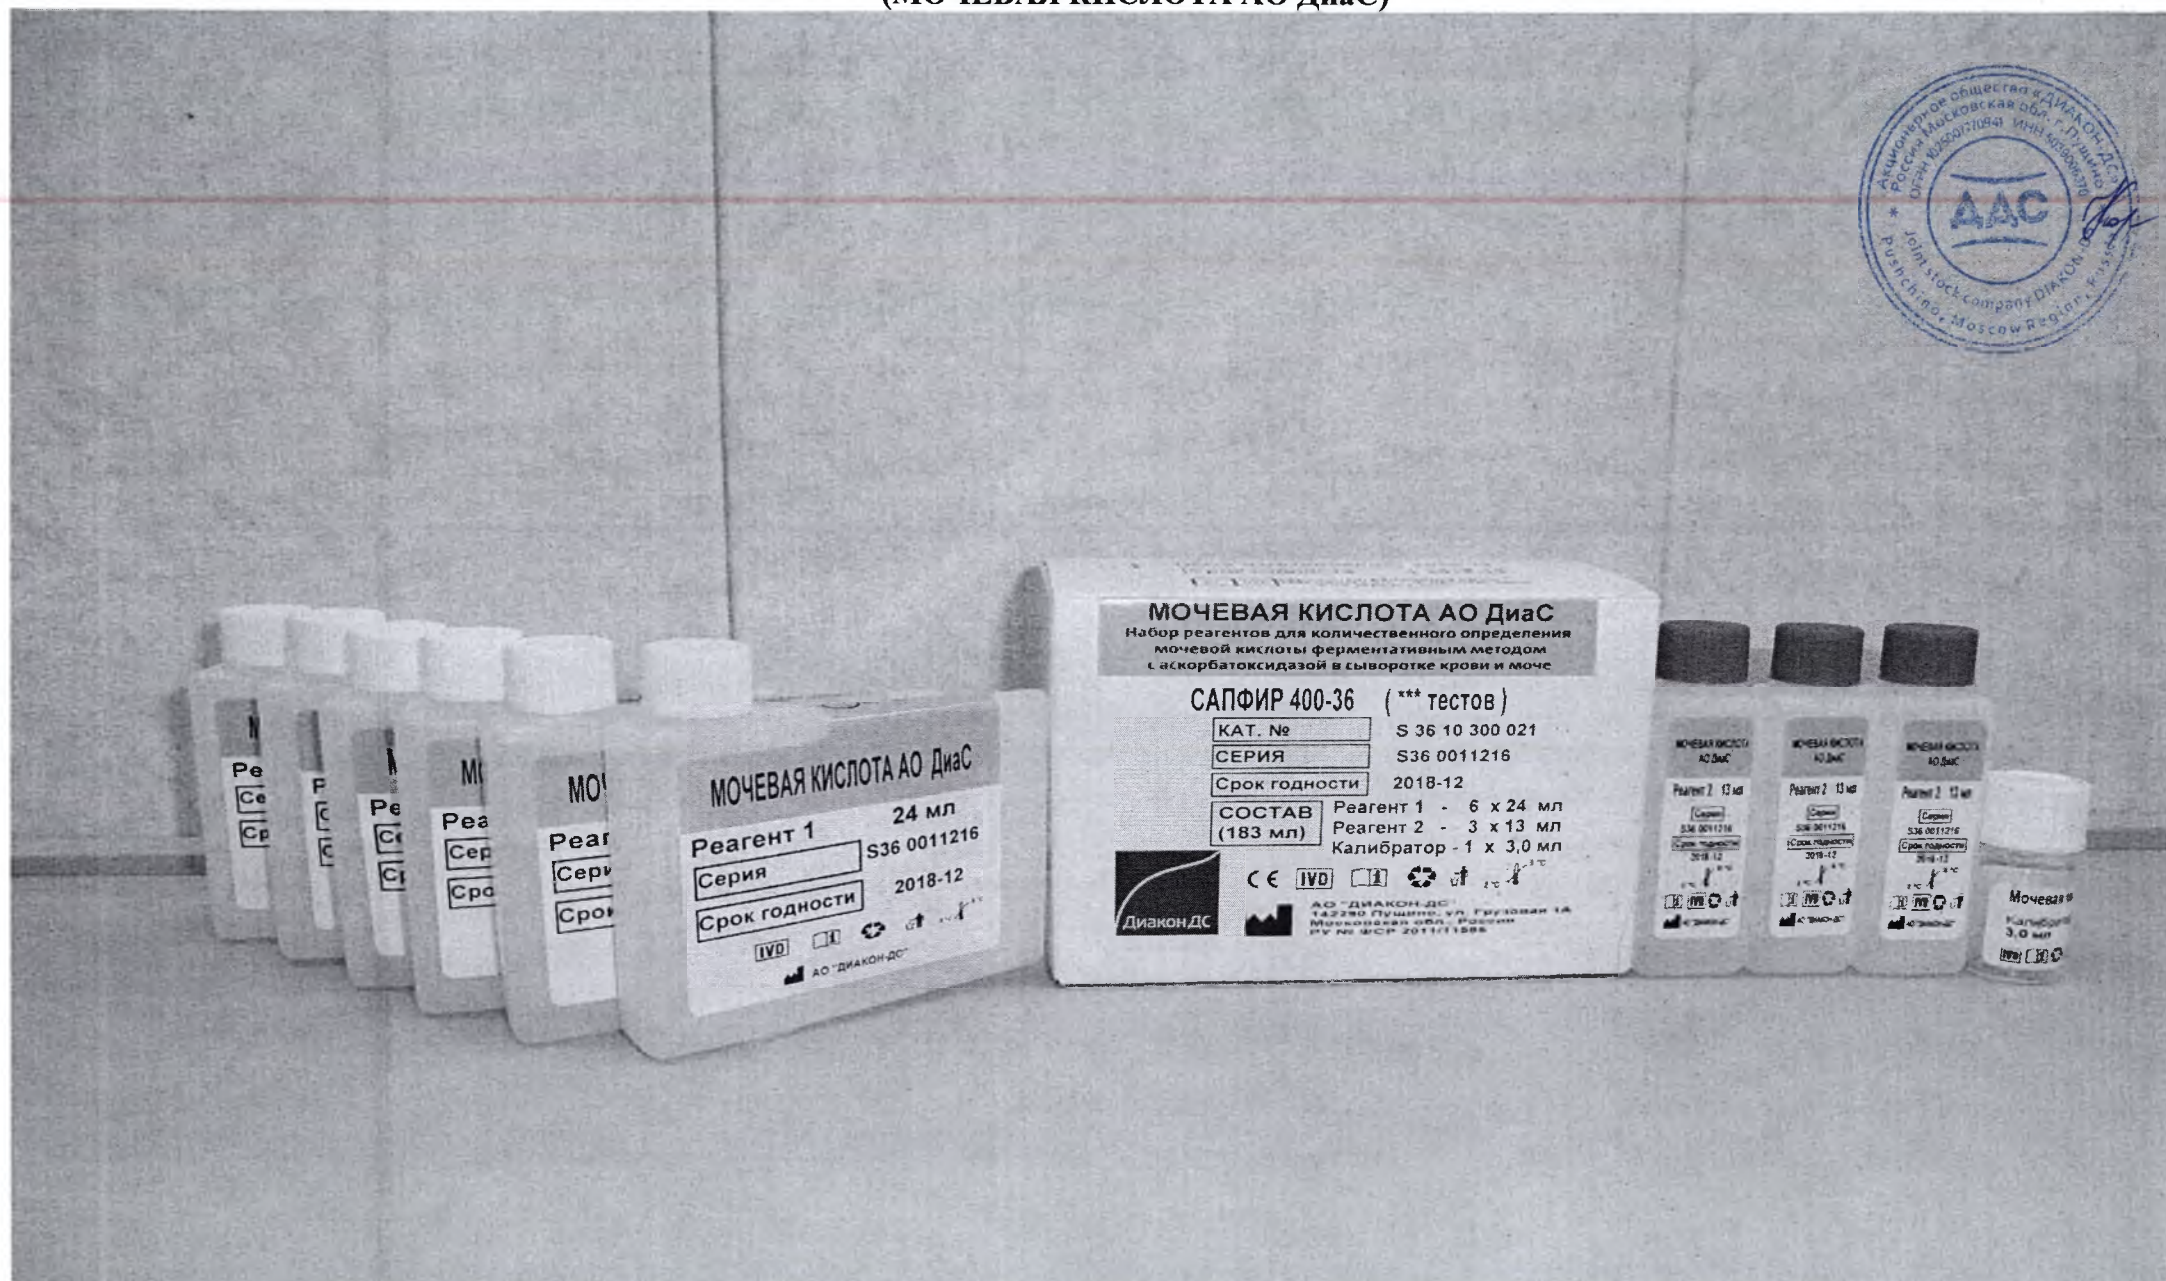

Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)







Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС
Набор реагентов для количественного определения
мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче


BioSystems A25/A15 (** тестов)**

КАТ. №	A 25 300 10
СЕРИЯ	A 0011216
Срок годности	2018-12
Состав (500 мл)	Реагент 1 - 10 x 40 мл Реагент 2 - 2 x 50 мл Калибратор - 1 x 3,0 мл


CE IVD REP

Сертификат соответствия
Заявитель: АО «ДИАКОН-ДС»
АО «ДИАКОН-ДС»
142230 Пушкино, АО, Россия 14
Московская обл., г. Пушкино
RU № ФСР 2017-185


Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

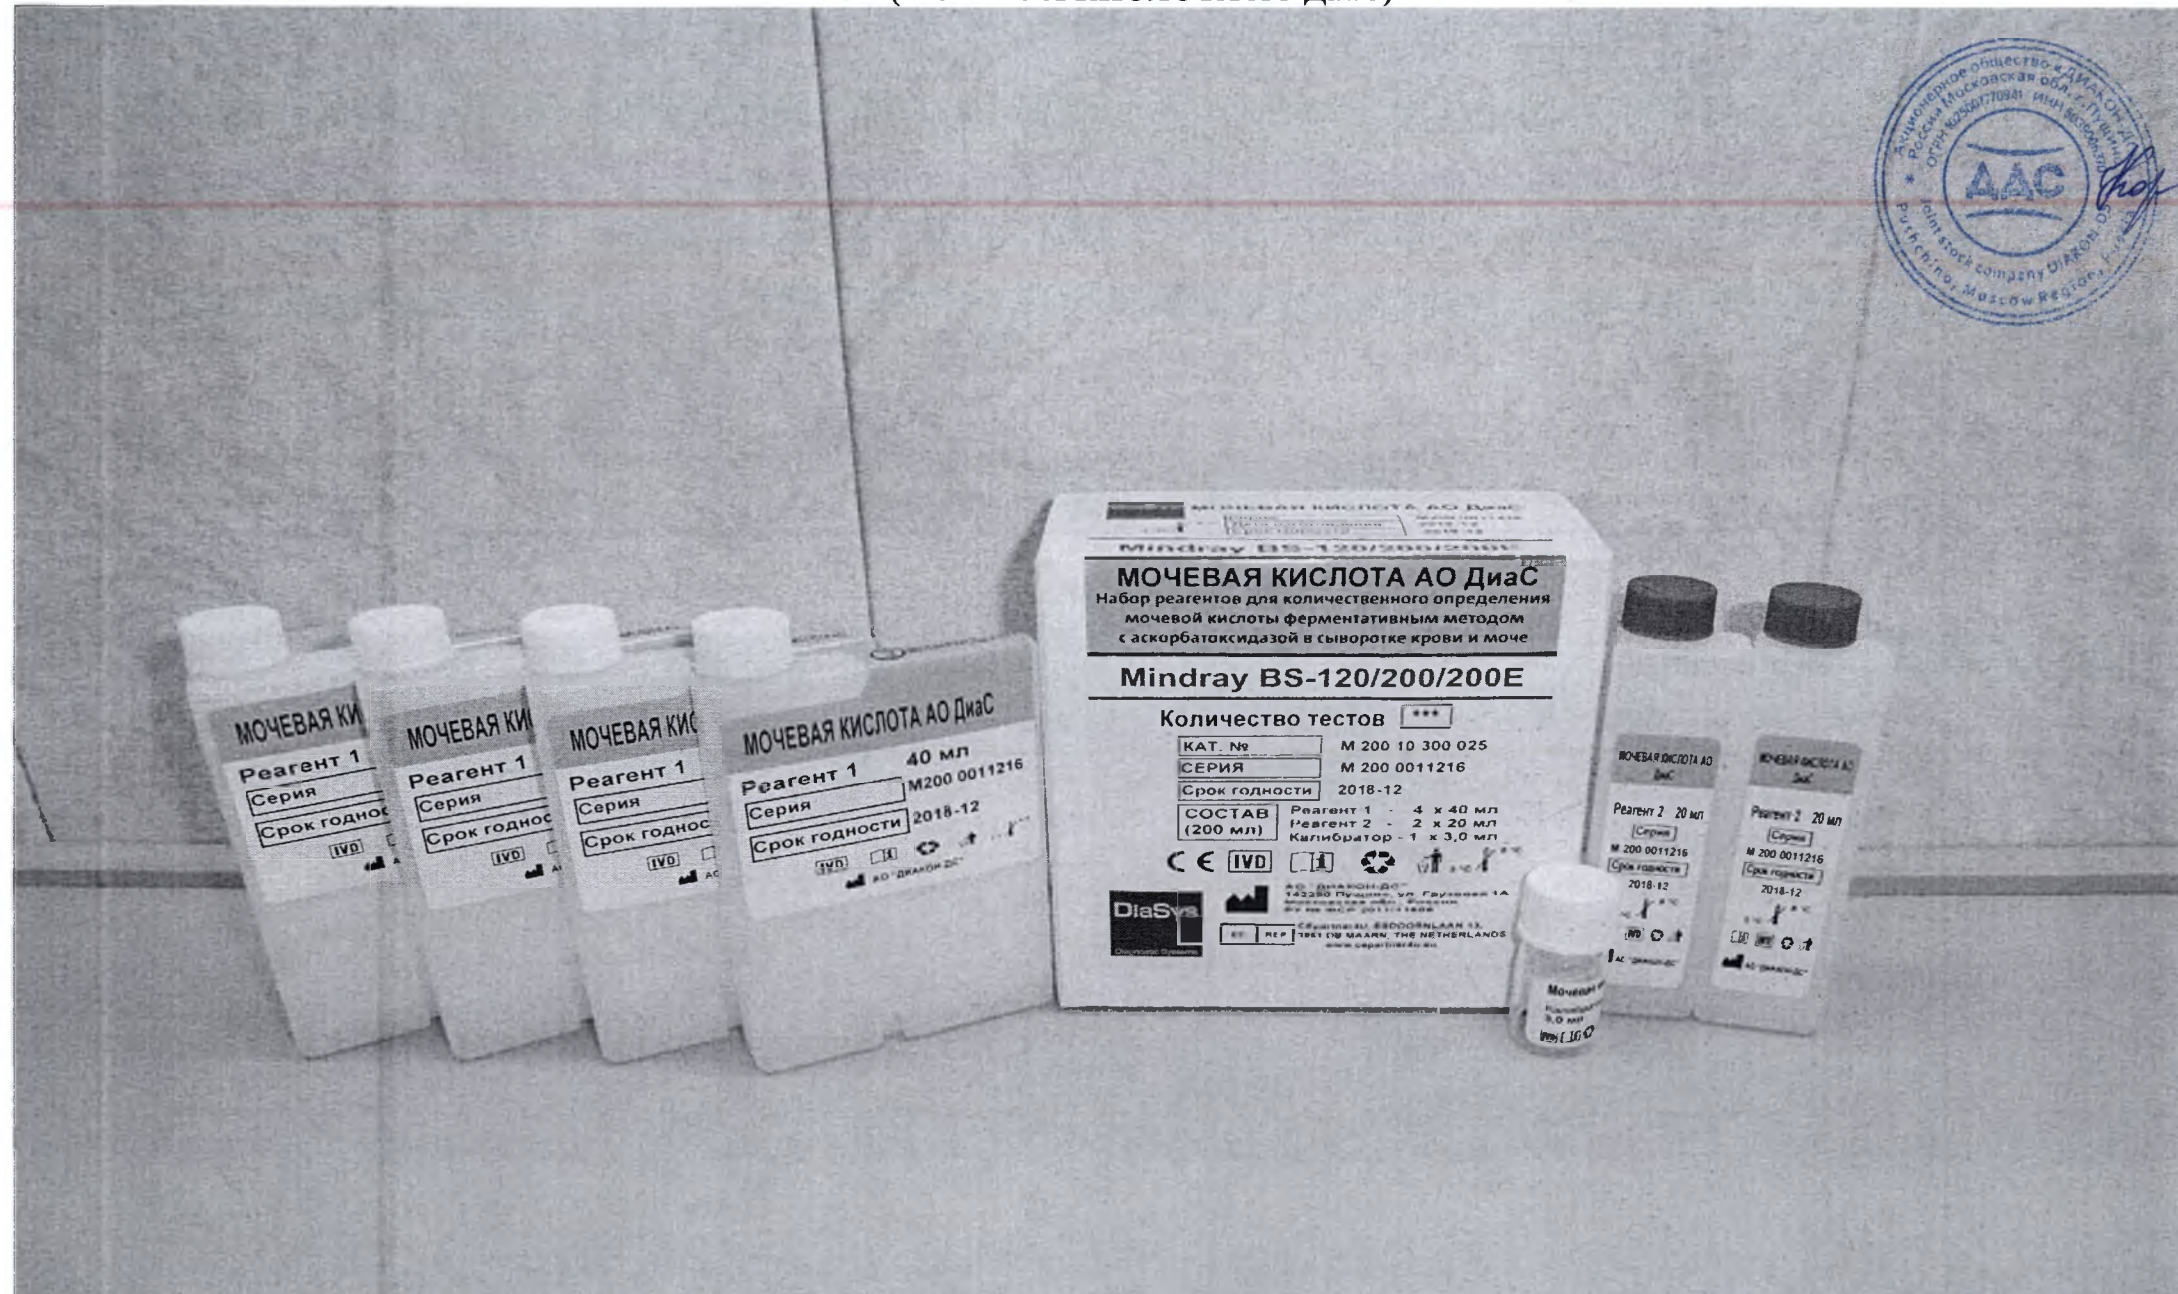


Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

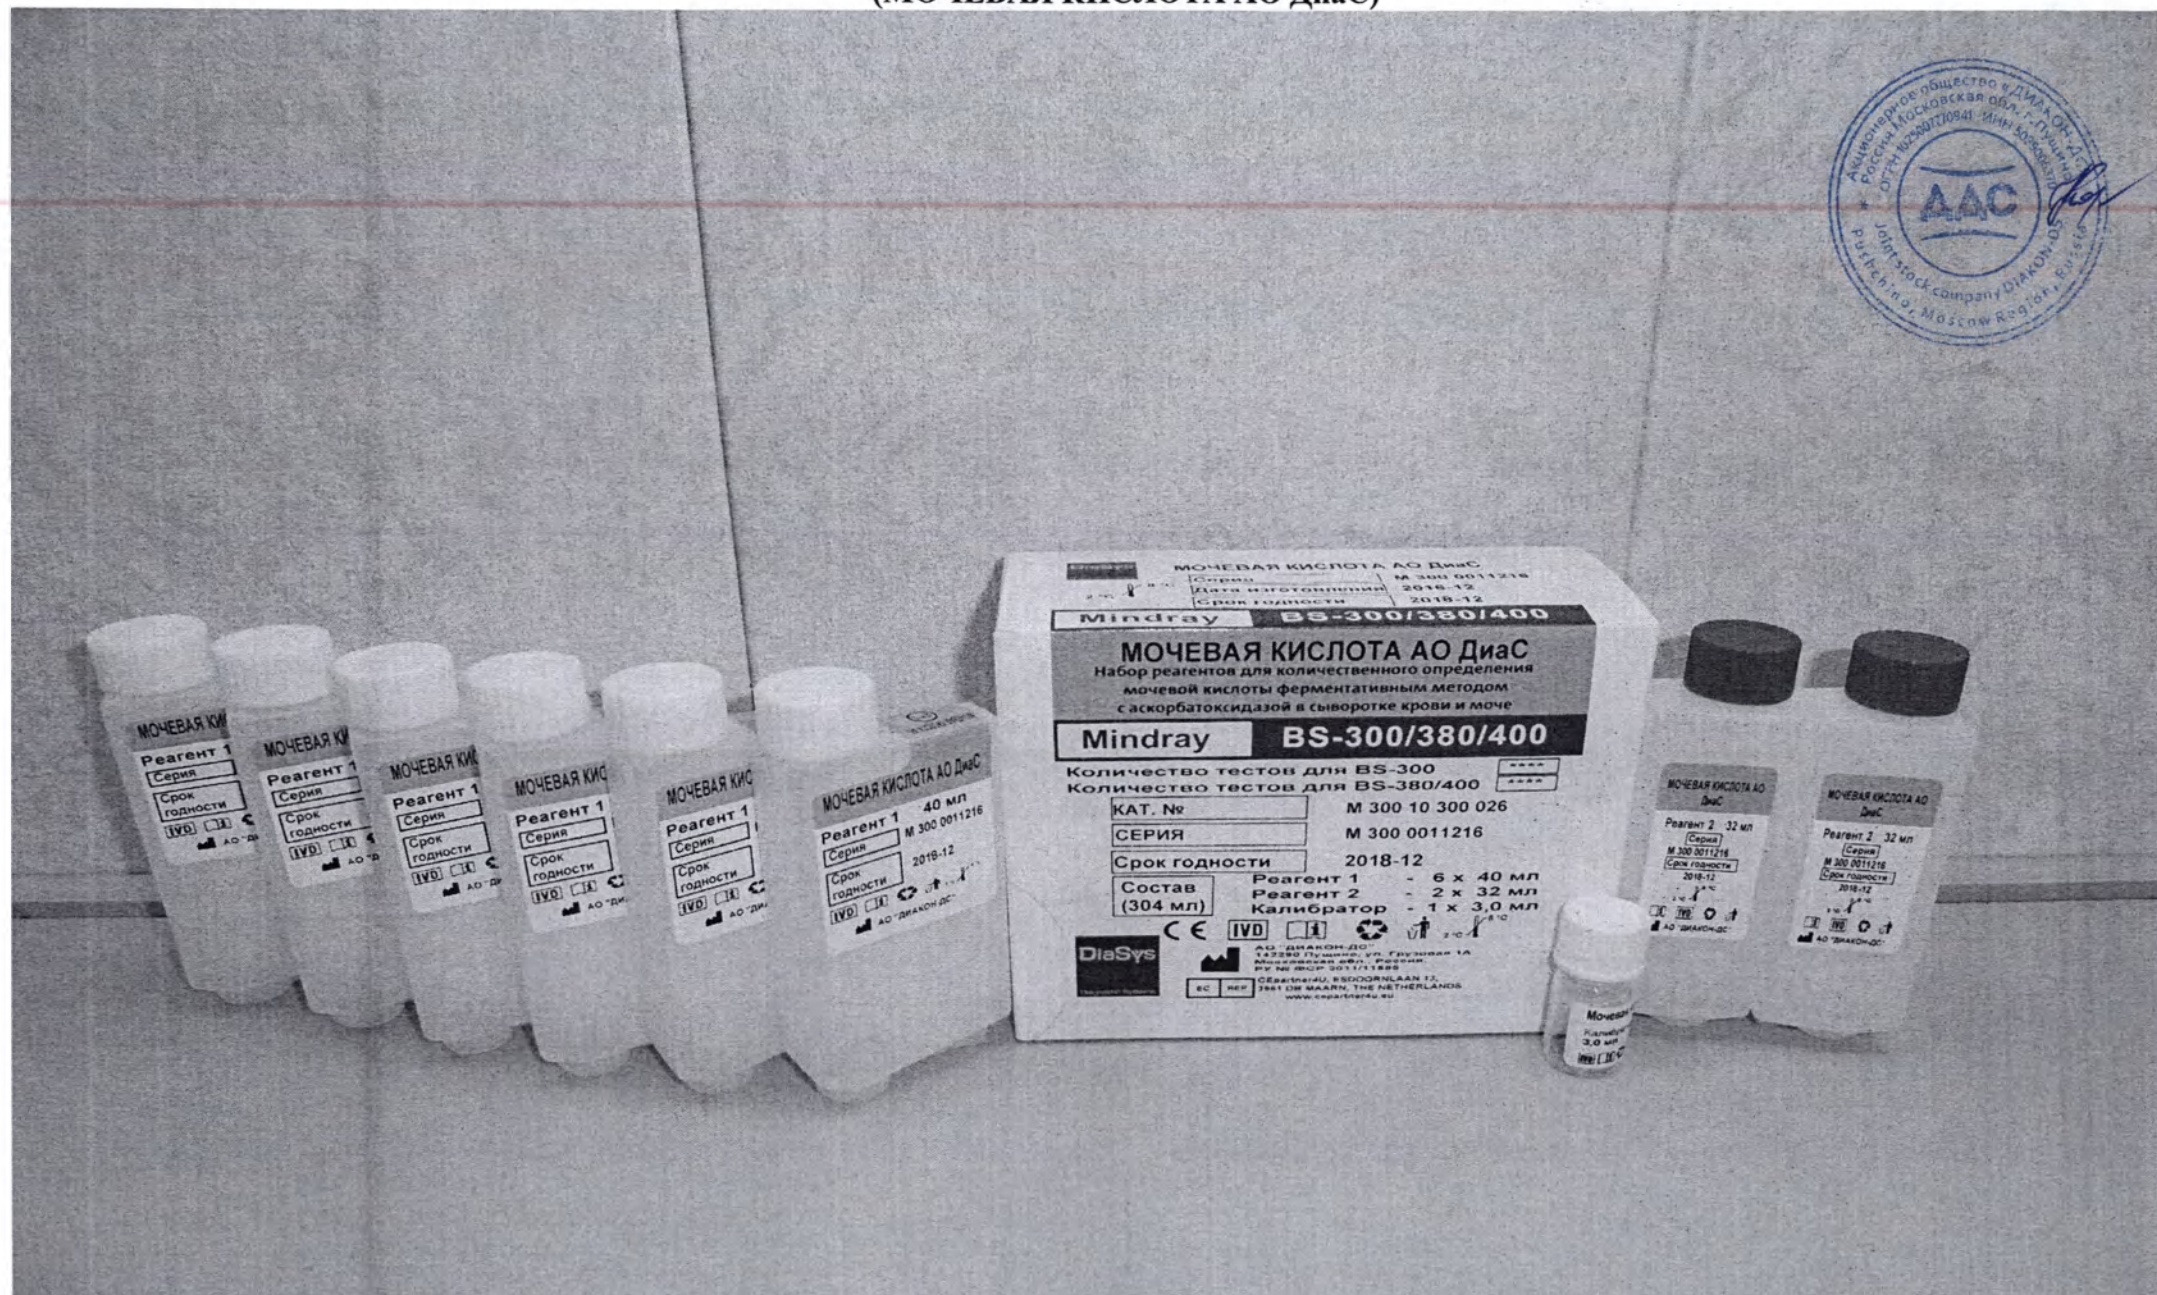


Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

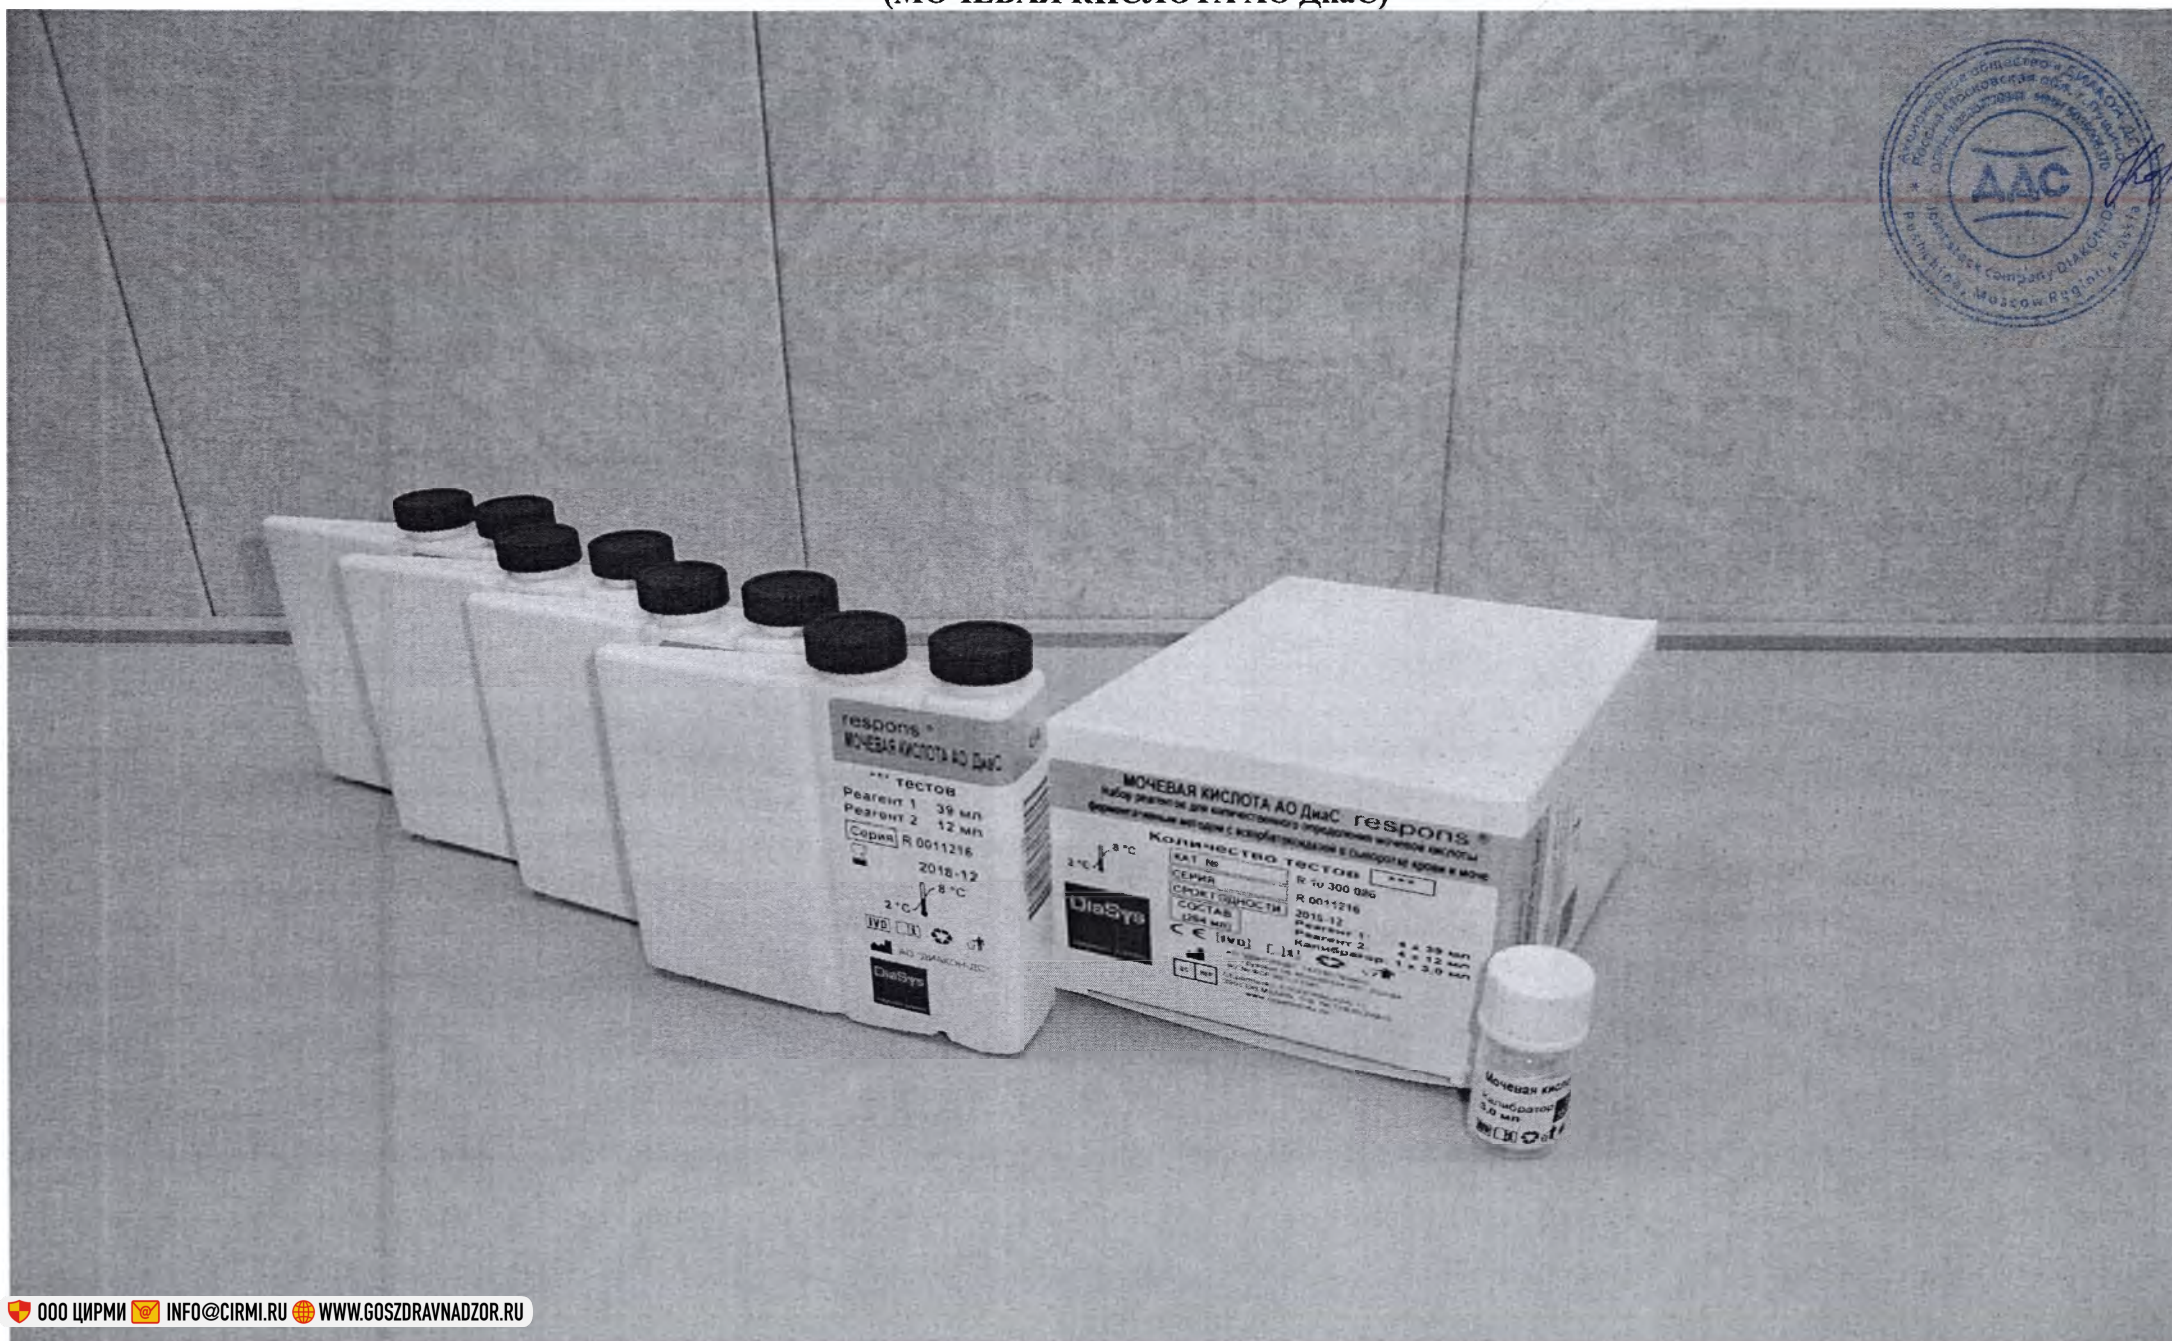

Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

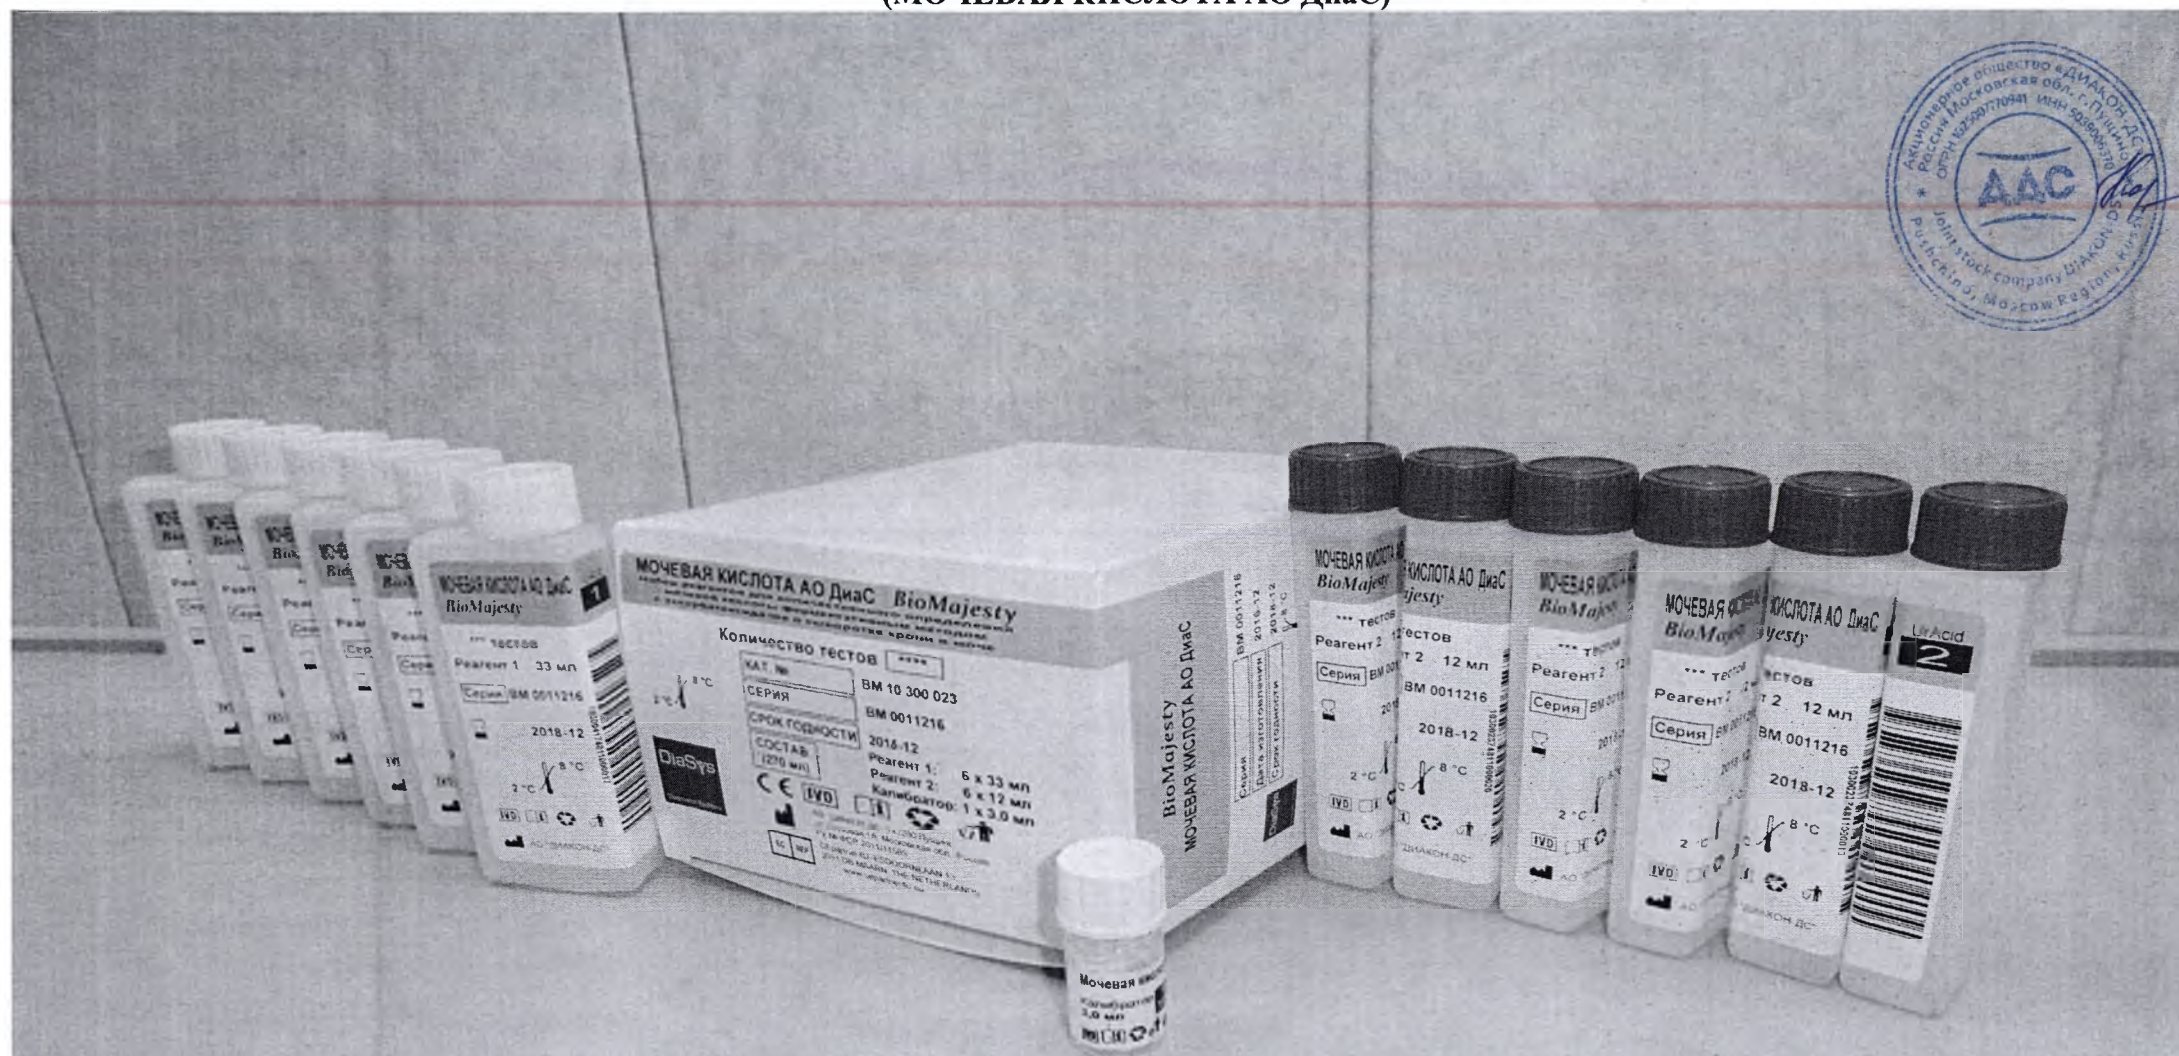


Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

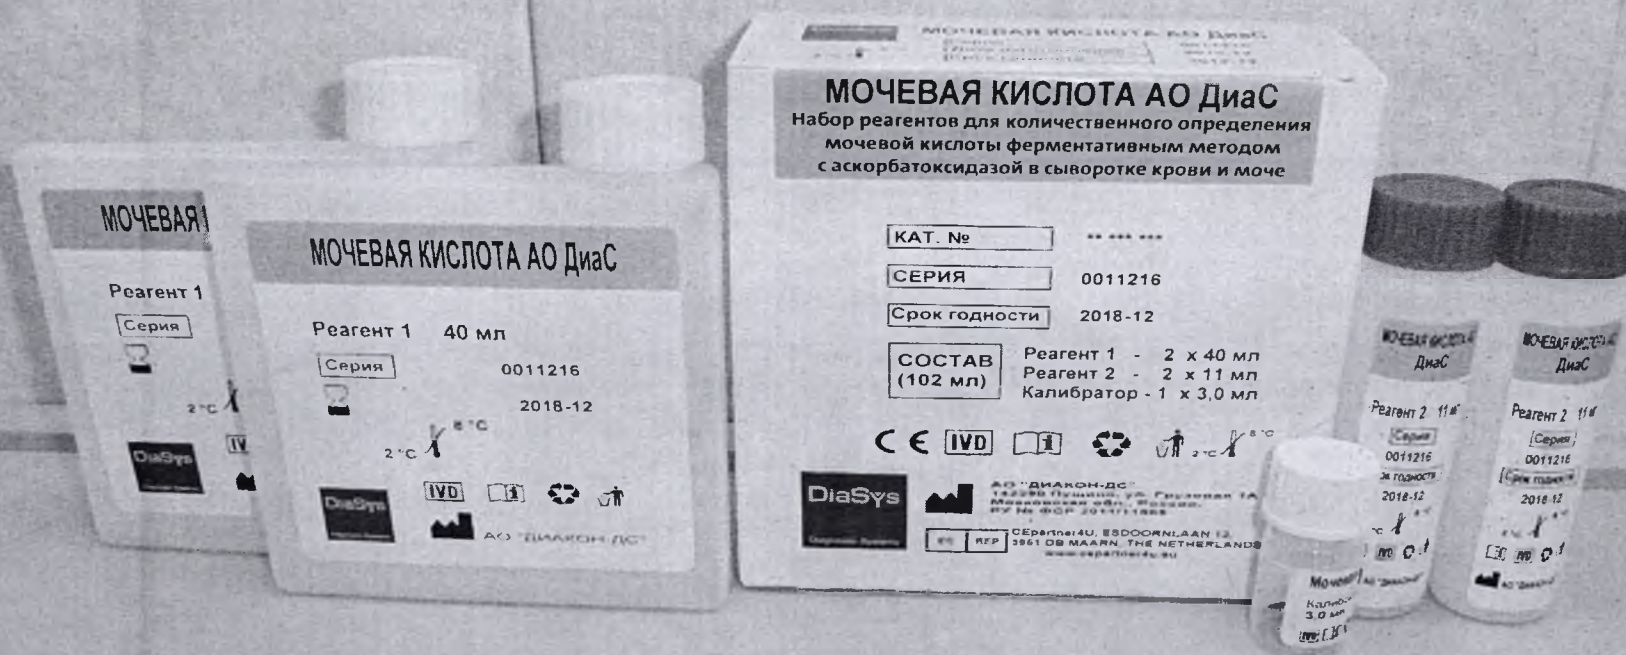

Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)



Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

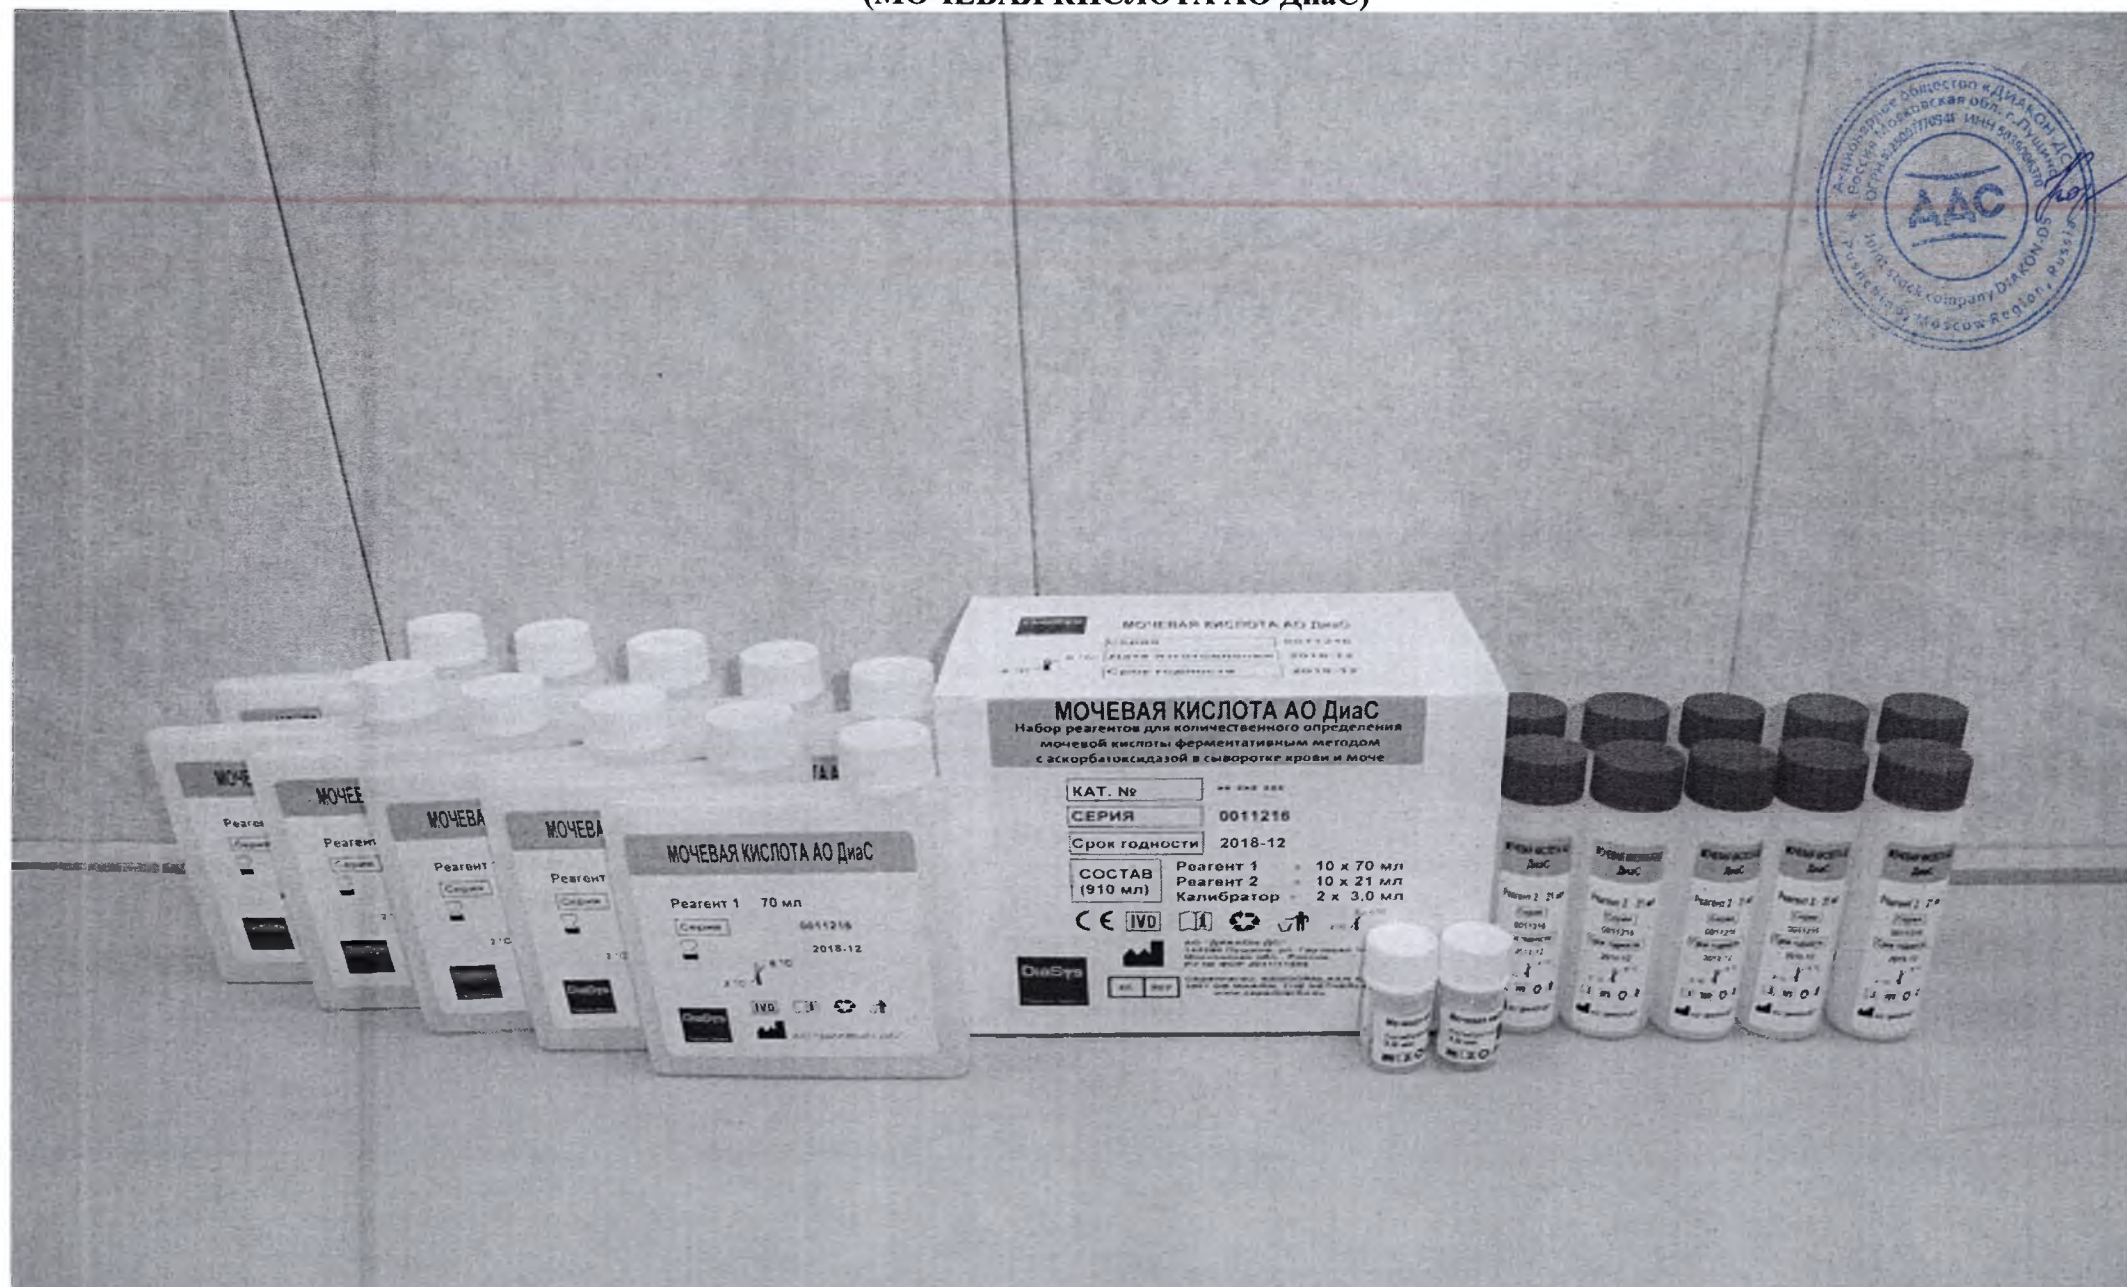

Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)



Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)



Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом
с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС)

