



ЗАО «ШАГ», 119002, г. Москва, Карманинский пер., д. 9  
«Арбат Бизнес Центр», оф. 501а  
т. +7 (495) 956-13-09, ф. +7 (495) 956-13-10  
[www.schag.ru](http://www.schag.ru)

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия  
«Система низкотемпературной стерилизации EOGas с принадлежностями»




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «ШАГ»

Курин С.Н.

« 26 » декабря 2016 г.

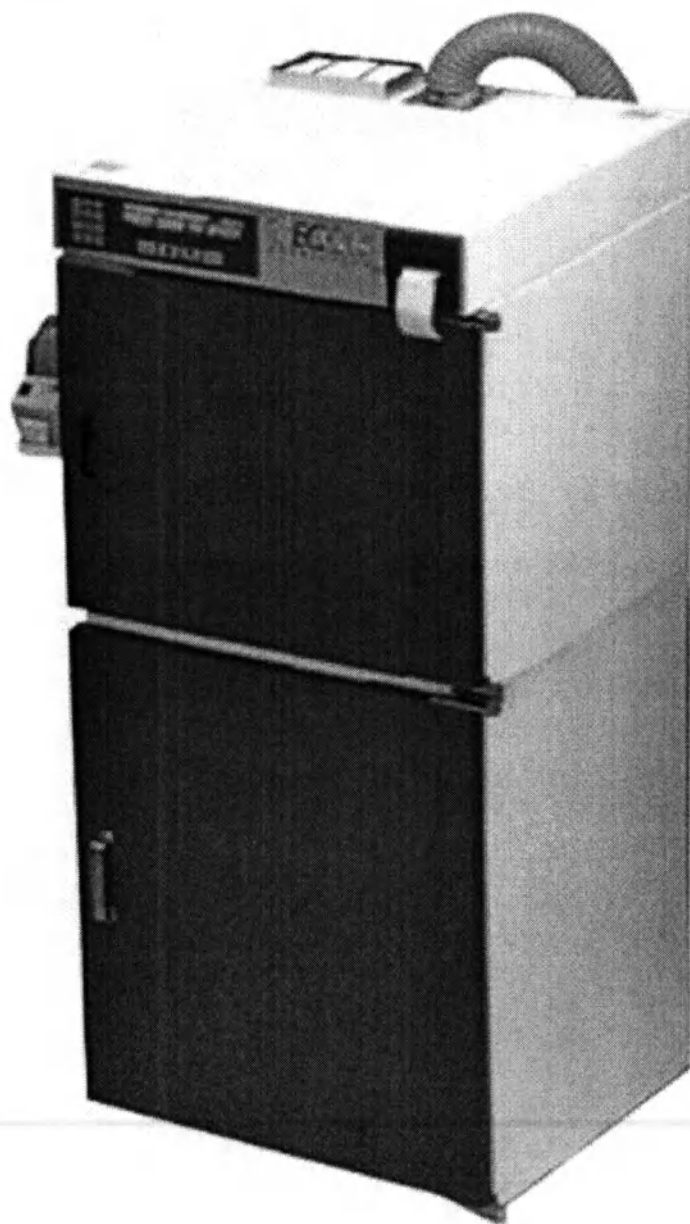

Система низкотемпературной стерилизации EOGas, вариант исполнения: AN-306. Блок системы основной.



Система низкотемпературной стерилизации EOGas, вариант исполнения: AN-310. Блок системы основной.



Система низкотемпературной стерилизации EOGas, вариант исполнения: AN-333. Блок системы основной.




Система низкотемпературной стерилизации EOGas, вариант исполнения: AN-4000. Блок системы основной.




Комплект для EOGas




Принадлежности: Картридж сменный с ОЭ

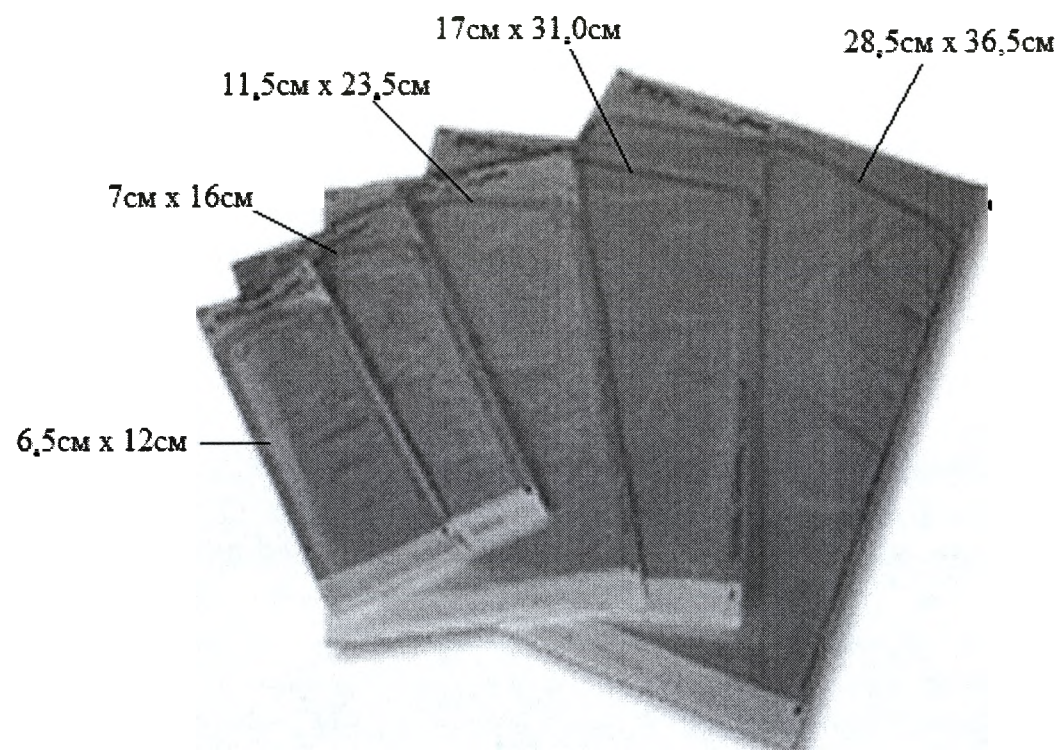


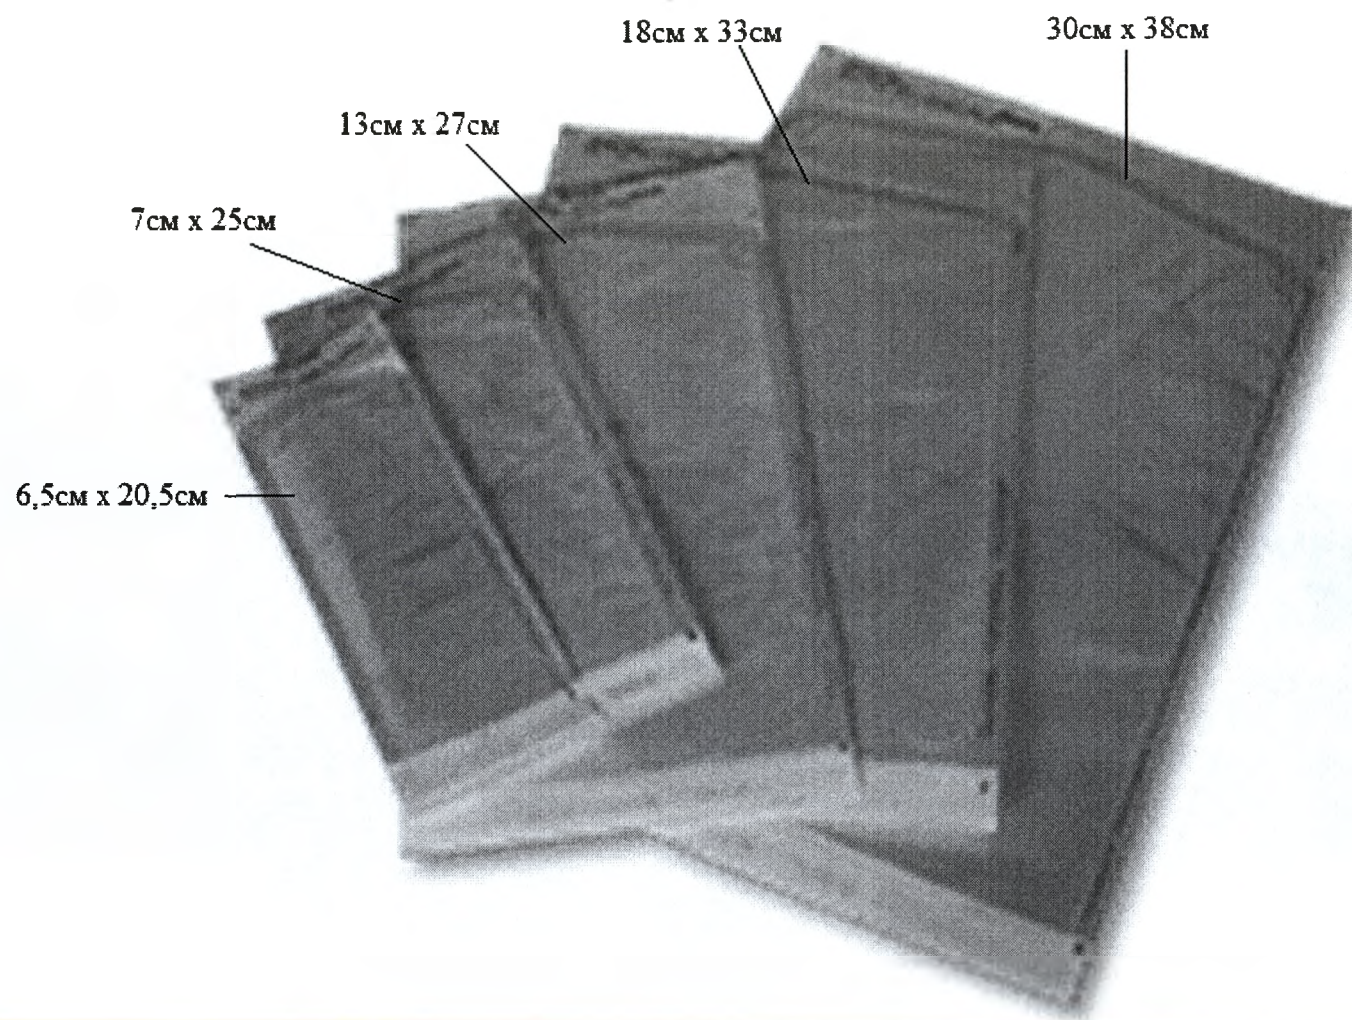

Пакеты для стерилизации


ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

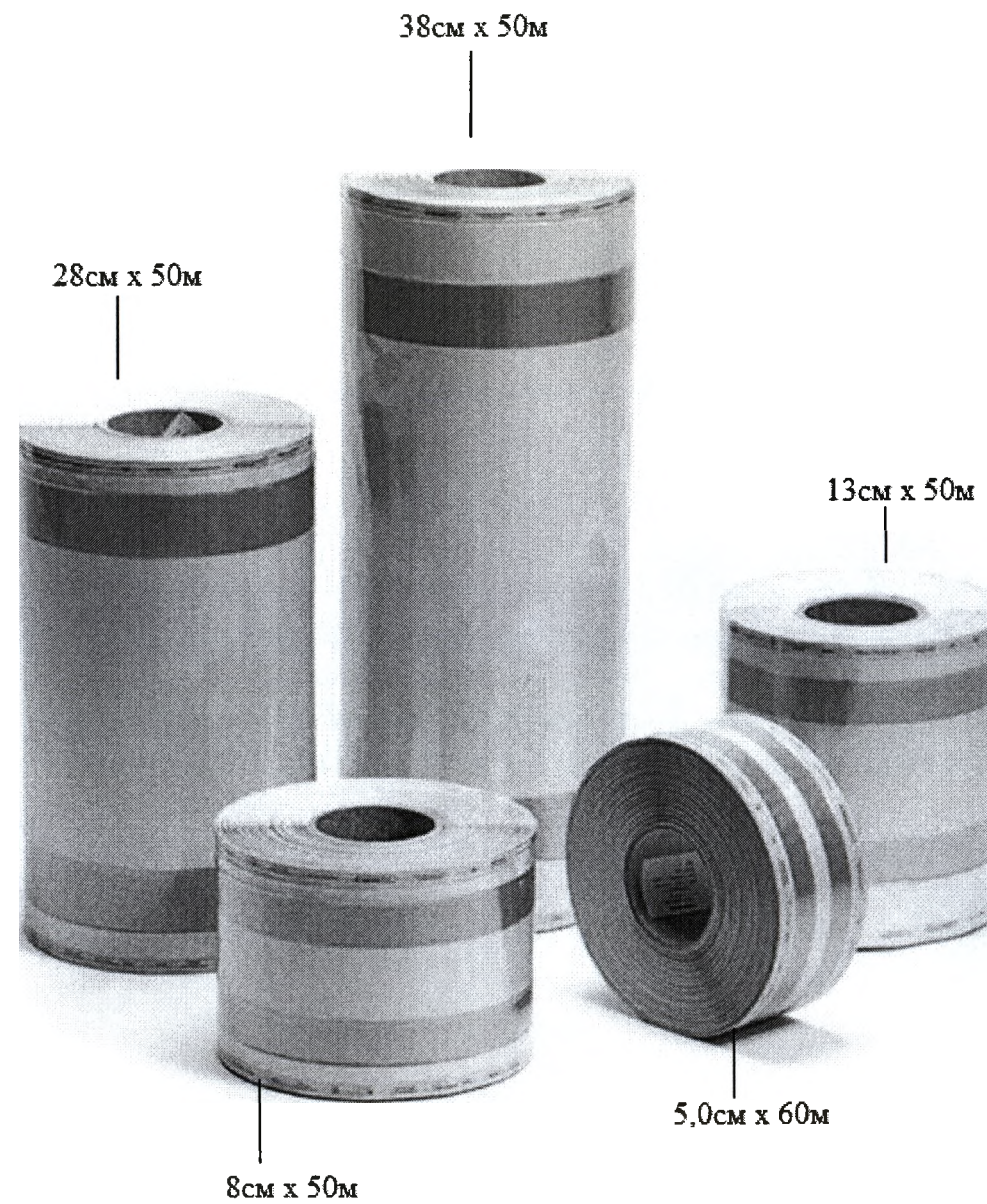


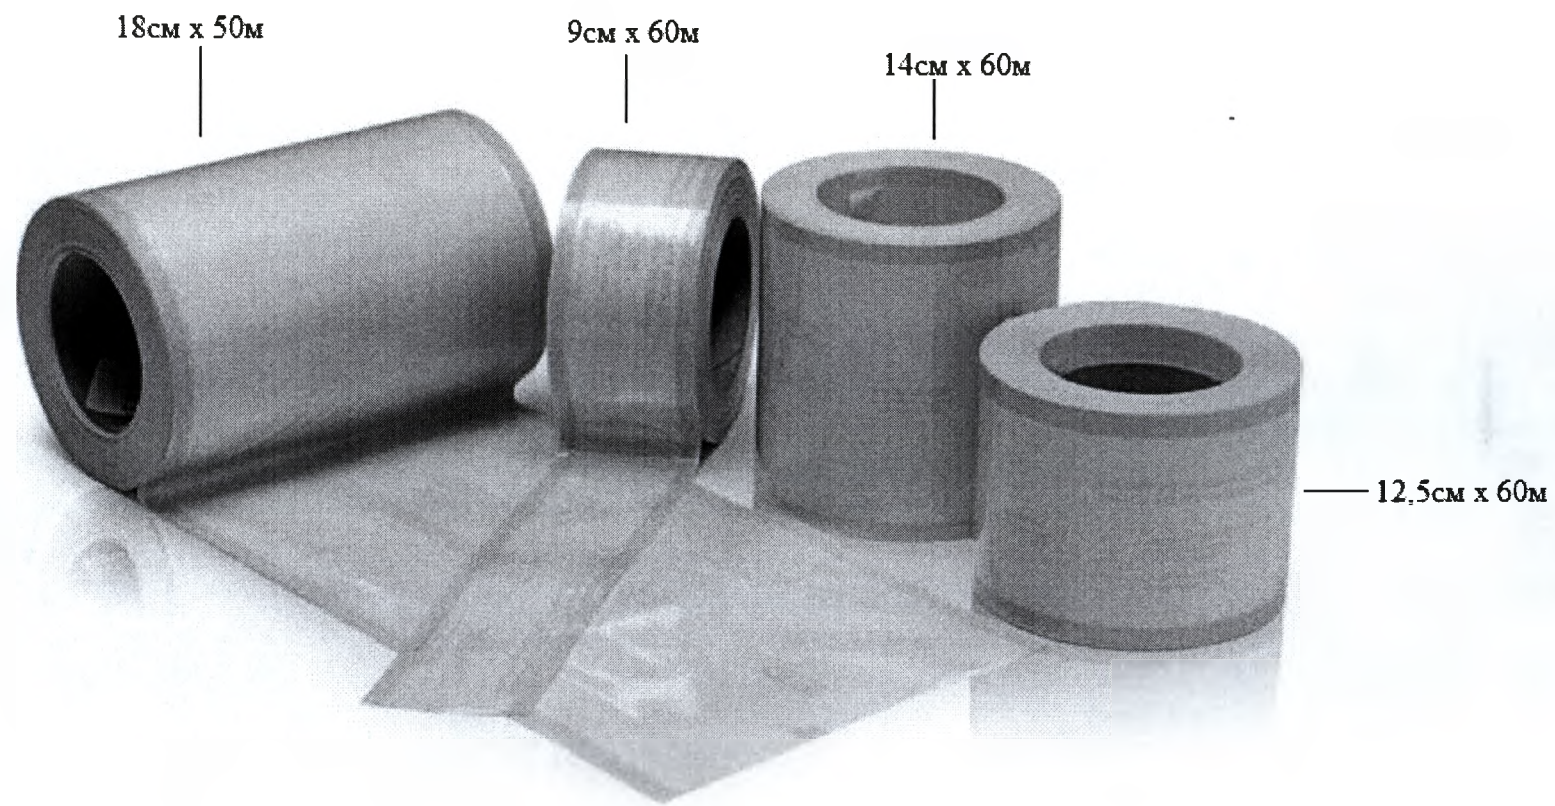


Рулоны для упаковки

ООО ЦИРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:INFO@CIRMI.RU)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU)

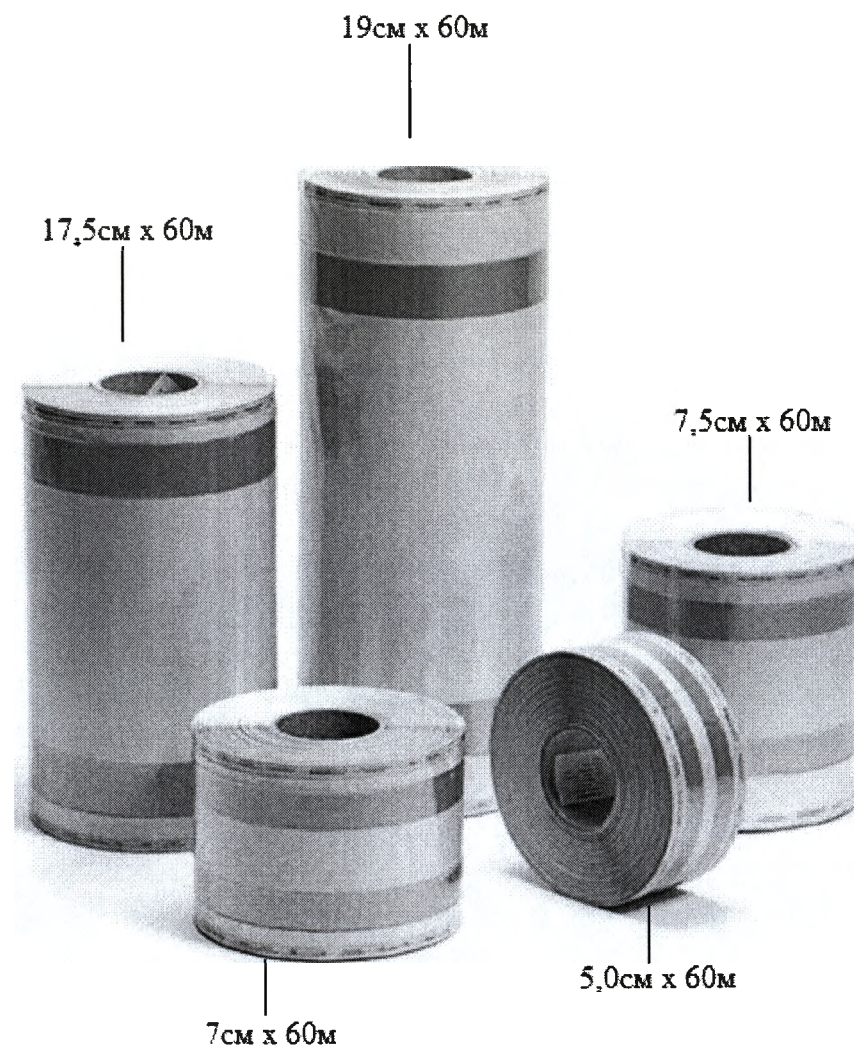

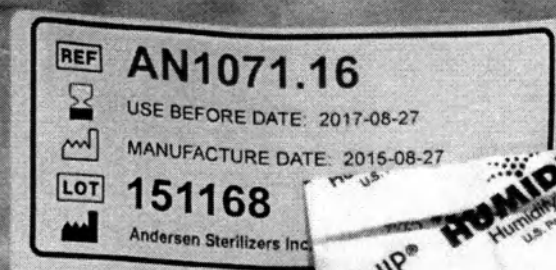



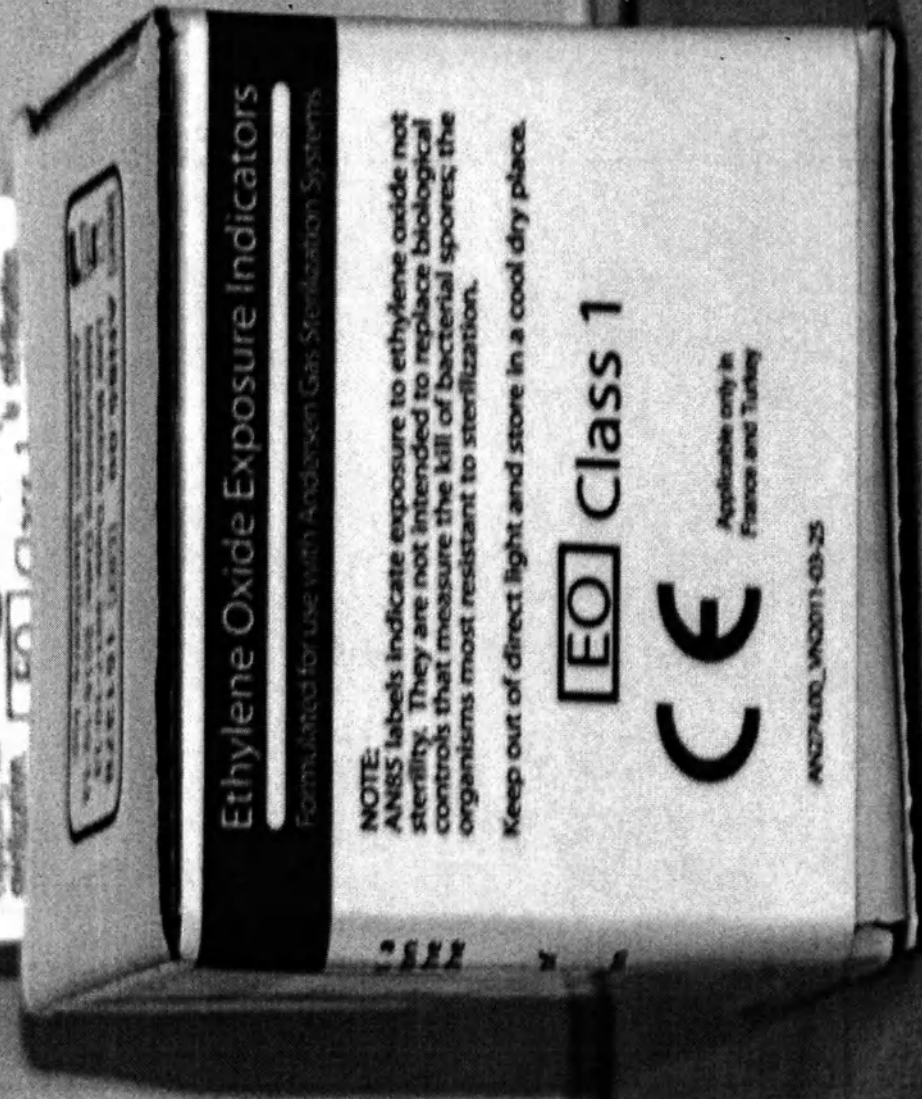

# Ethylene Oxide Exposure Indicators

Formulated for use with Andersen Gas Sterilization Systems

**NOTE:**  
ANBS labels indicate exposure to ethylene oxide not sterility. They are not intended to replace biological controls that measure the kill of bacterial spores; the organisms most resistant to sterilization.


Keep out of direct light and store in a cool dry place.

**EO** Class 1

**CE**

Applicable only in  
France and Turkey

ANG2400\_VN0011-03-25

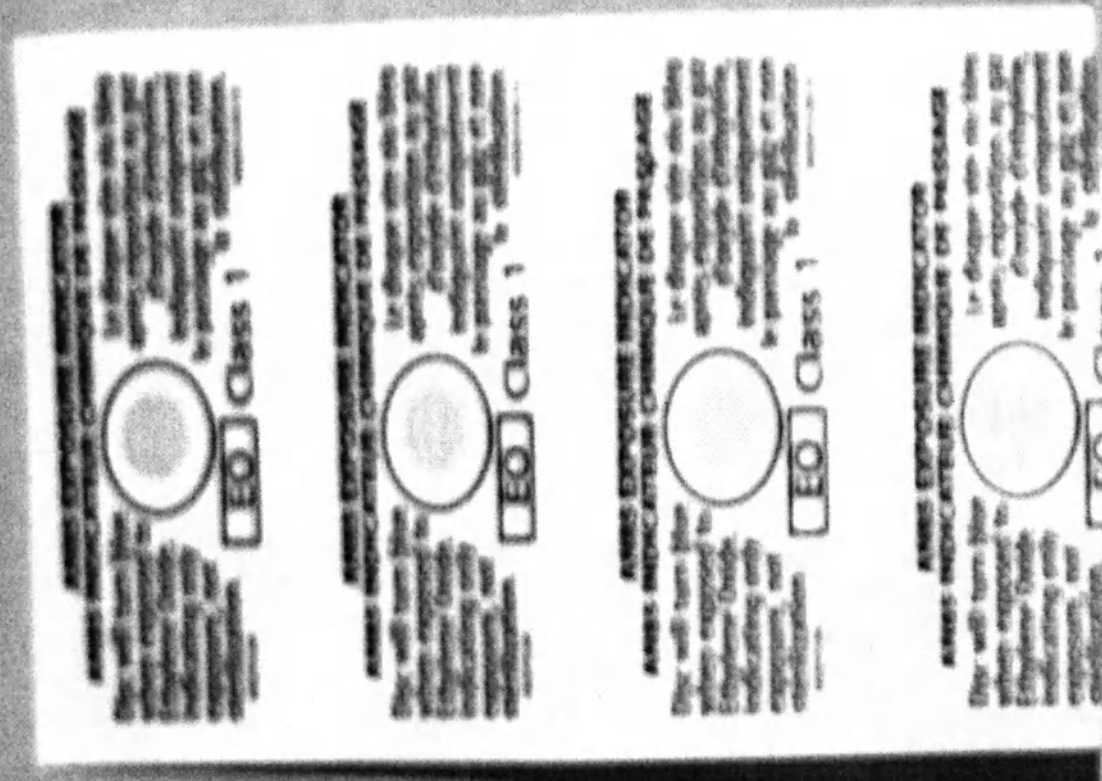


## Ethylene Oxide Exposure Indicator


This will turn blue when exposed to Ethylene Oxide. Indicating only exposure, not sterilization.


Этот индикатор станет синим при воздействии этиленоксида. Указывает только на воздействие, не стерилизацию.

Индикаторы контроля стерилизации: - полоски индикаторные (200 шт./упак.)

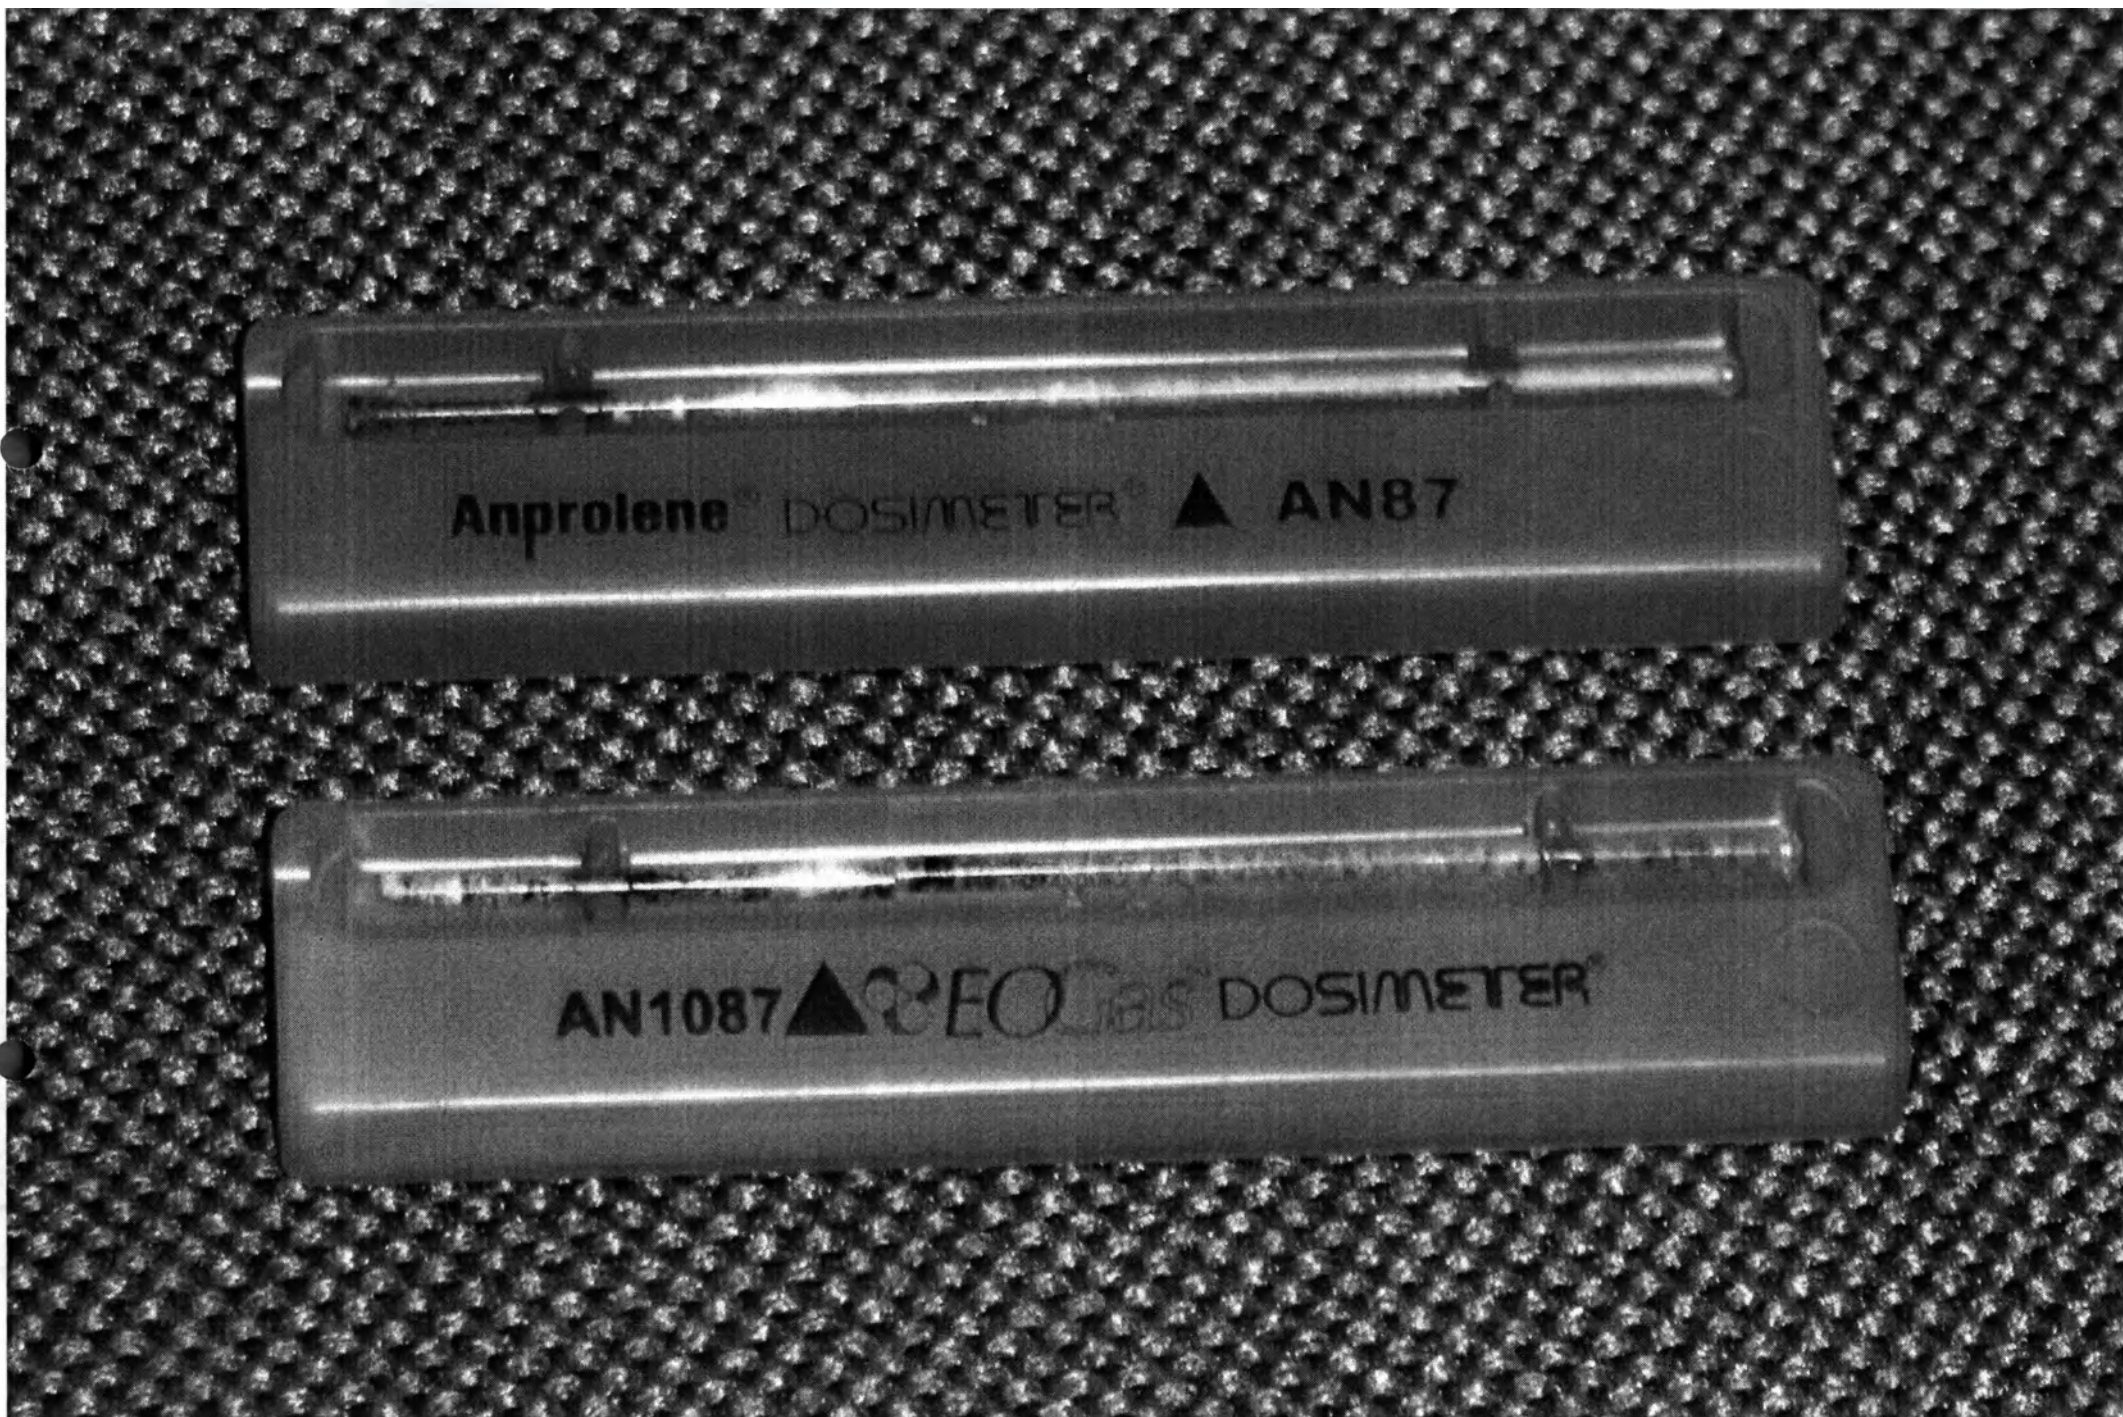


Индикаторы контроля стерилизации: - индикаторы ОЭ для системы EOGas

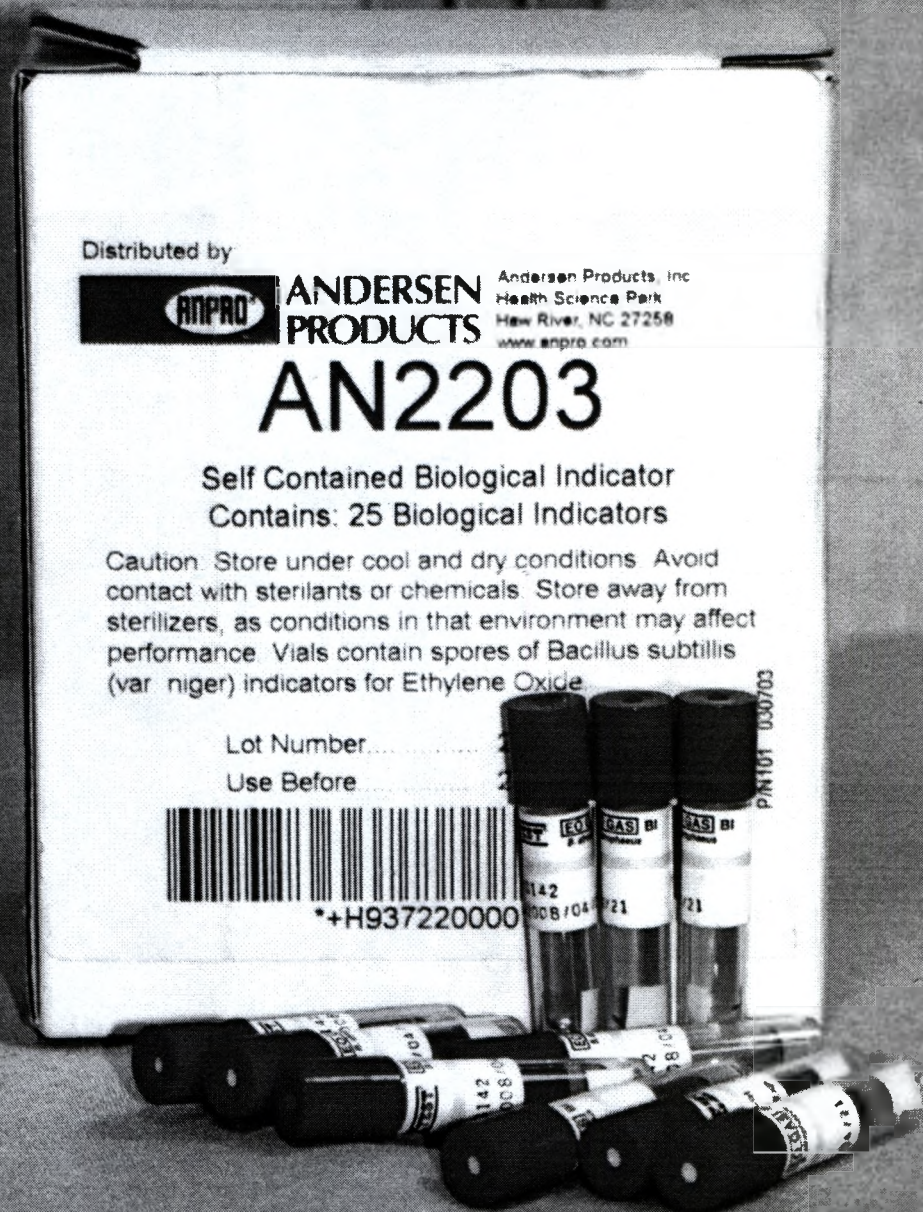

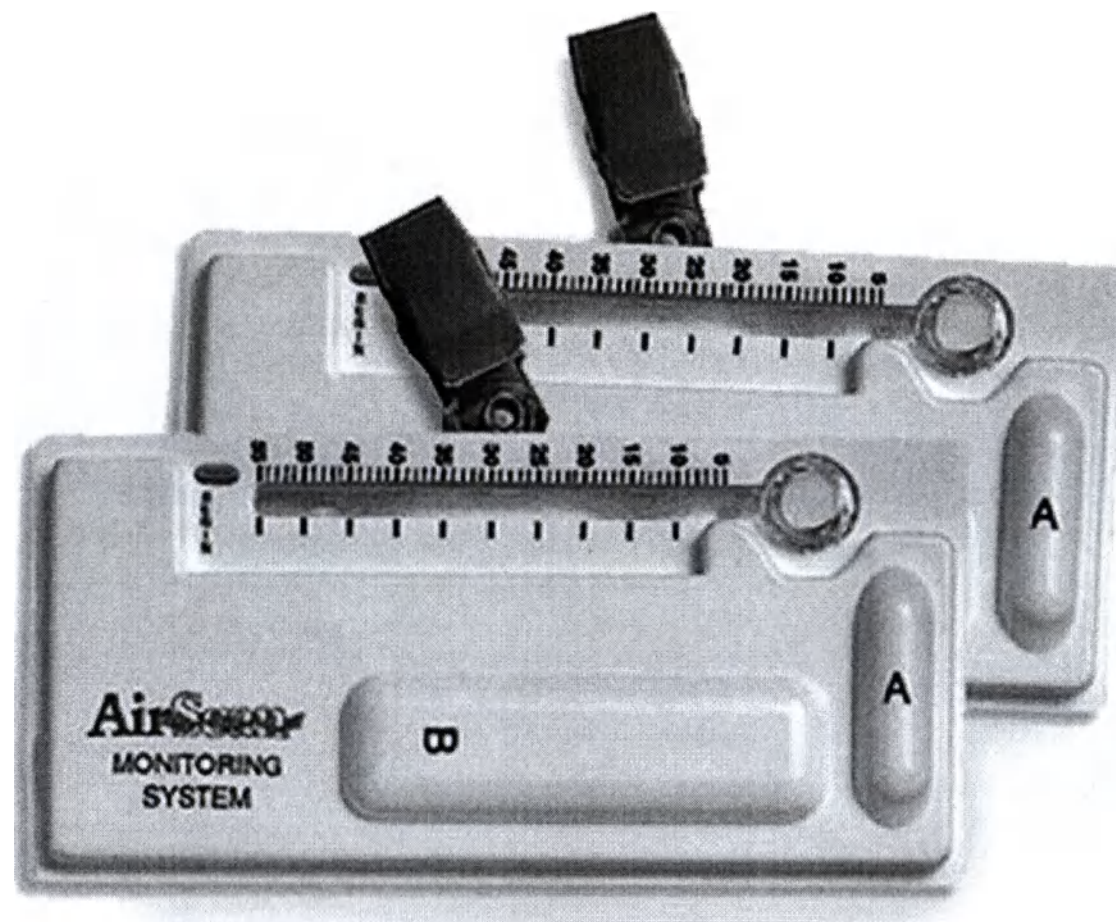

Индикаторы контроля стерилизации: - индикаторы ОЗ персональные AirScan универсальные

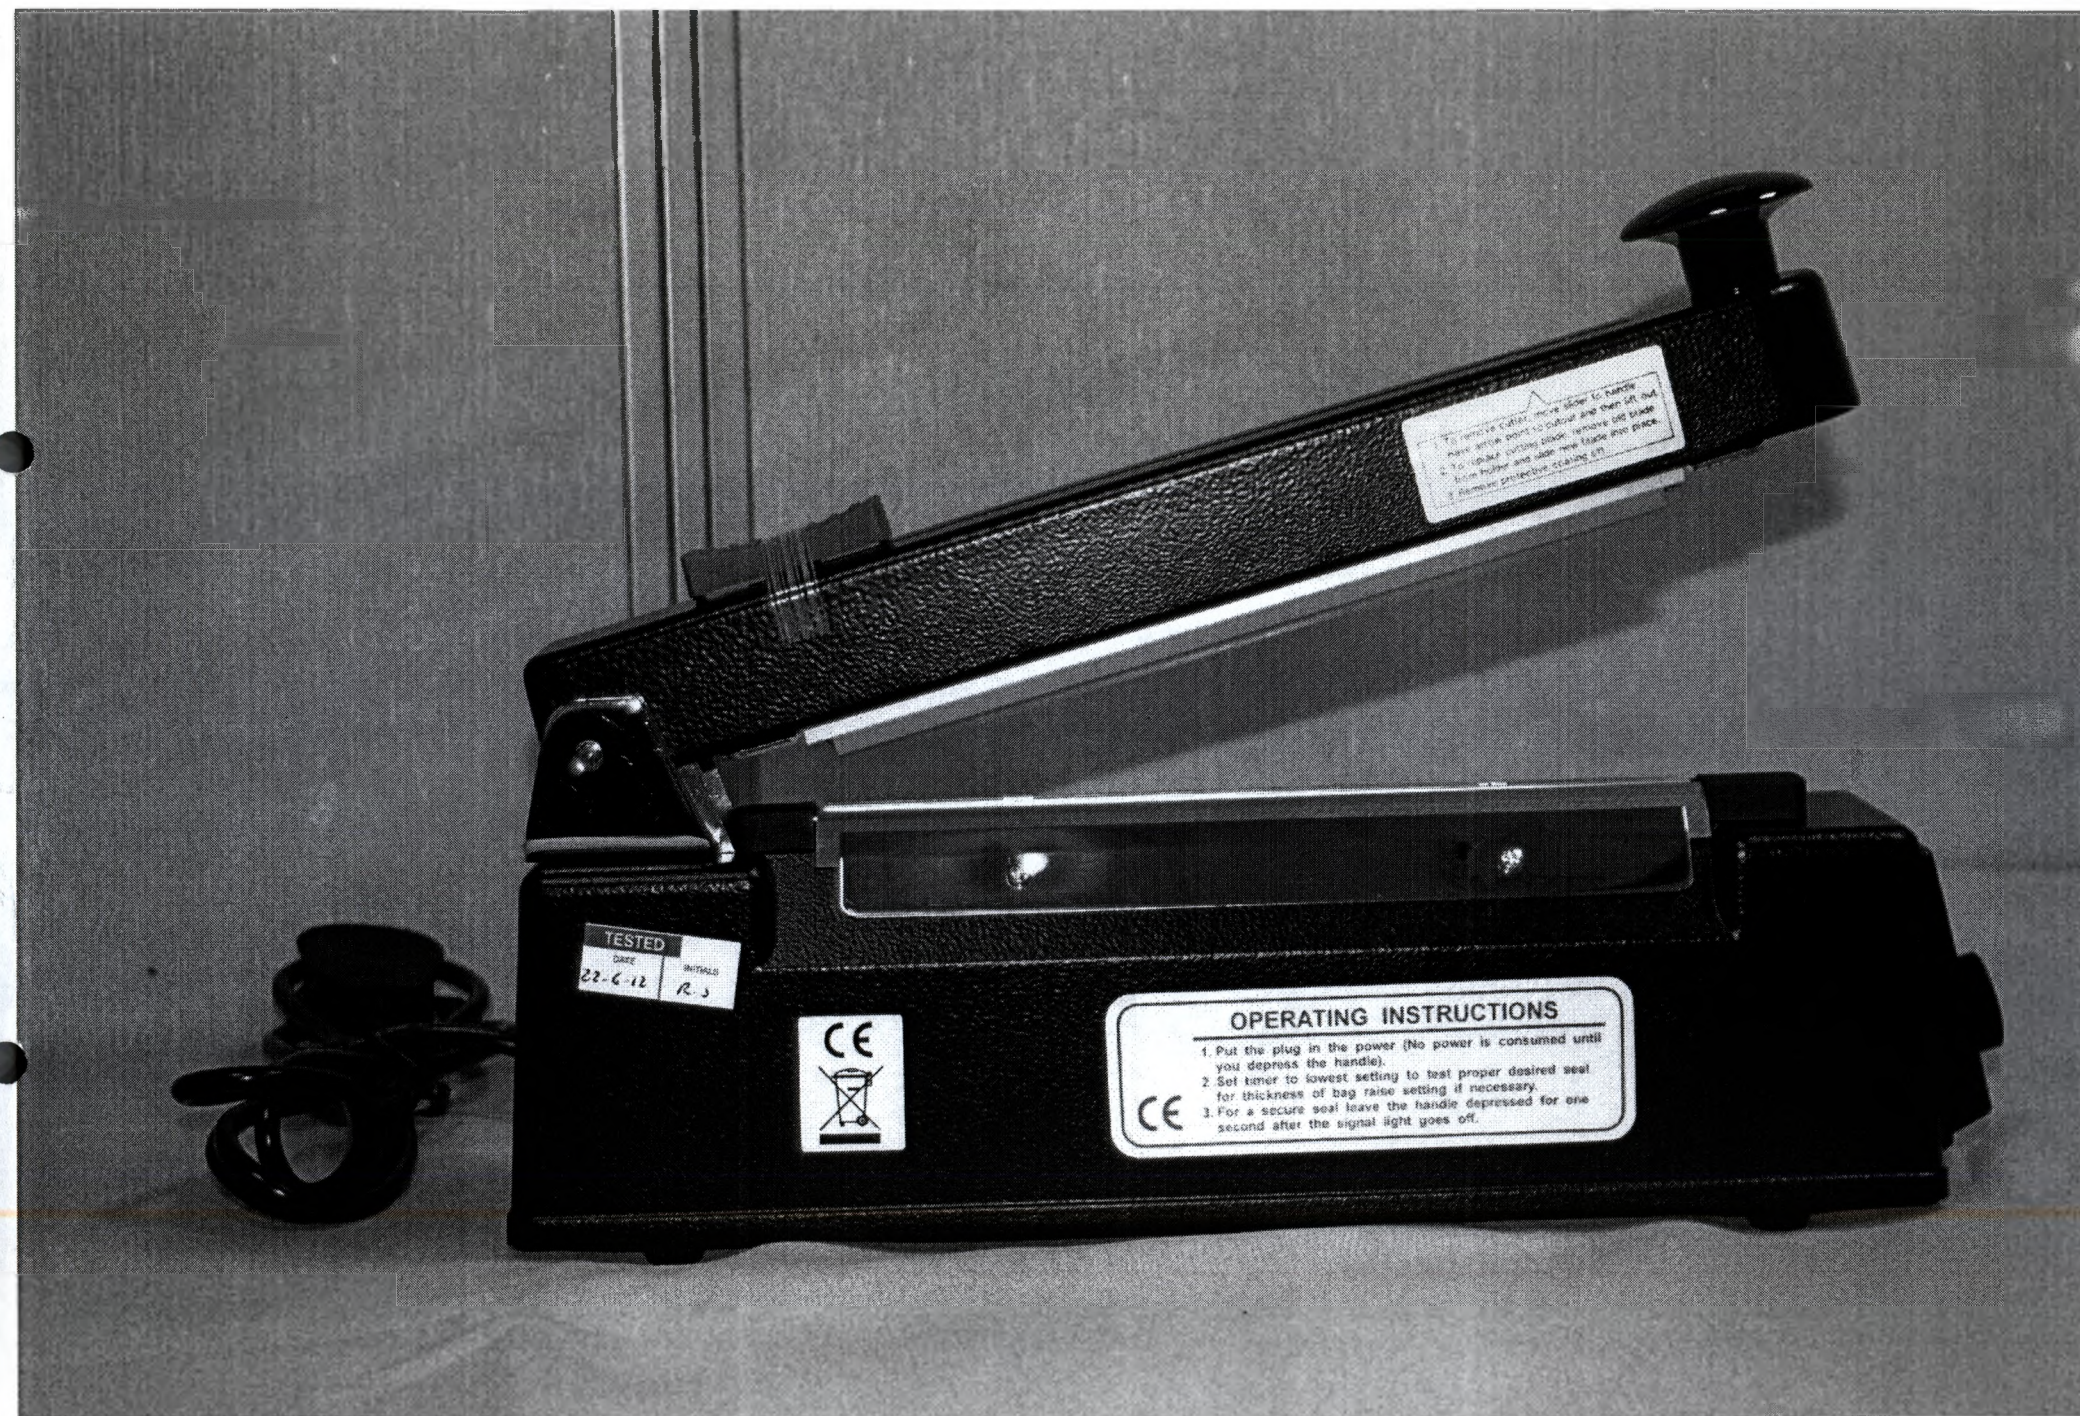

Устройство предстерилизационной упаковки



Проинуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 20 листов.

Генеральный директор

С.Н.Курий