

Руководитель направления по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
биохимия и портативные системы в

диагностике
Тышкунова Е.С.
«23» марта 2023 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Картридж с реагентом СНК (проверочный) для биохимических анализаторов серии
"Dimension" (Dimension CHK Flex reagent Cartridge (CHK))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикас Инк.» (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.), США

SIEMENS

Dimension® clinical chemistry system

Flex® reagent cartridge



siemens.com/eifu

IVD

CONTENTS 8



WARNING

H317
P280
P302+P352
P333+P313
P362+P364



**H505CHK2X*

CHK

2°C 8°C

For US

CHK Flex® reagent cartridge

Intended Use: For checking proper functioning of the fluid metering and photometric measuring system on the Dimension® clinical chemistry system. It is run daily as part of the System Check routine.
Reagents: Red dye with buffer and preservative.

Dimension® and Flex® (USA)

REF DF179

SMN 10481507

RxOnly

CE



(01)00042768039124 GTIN
110103133 BATCH/LOT
171230513 EXPIRY
(240)10481507 SMN
(422)040 ORIGIN US

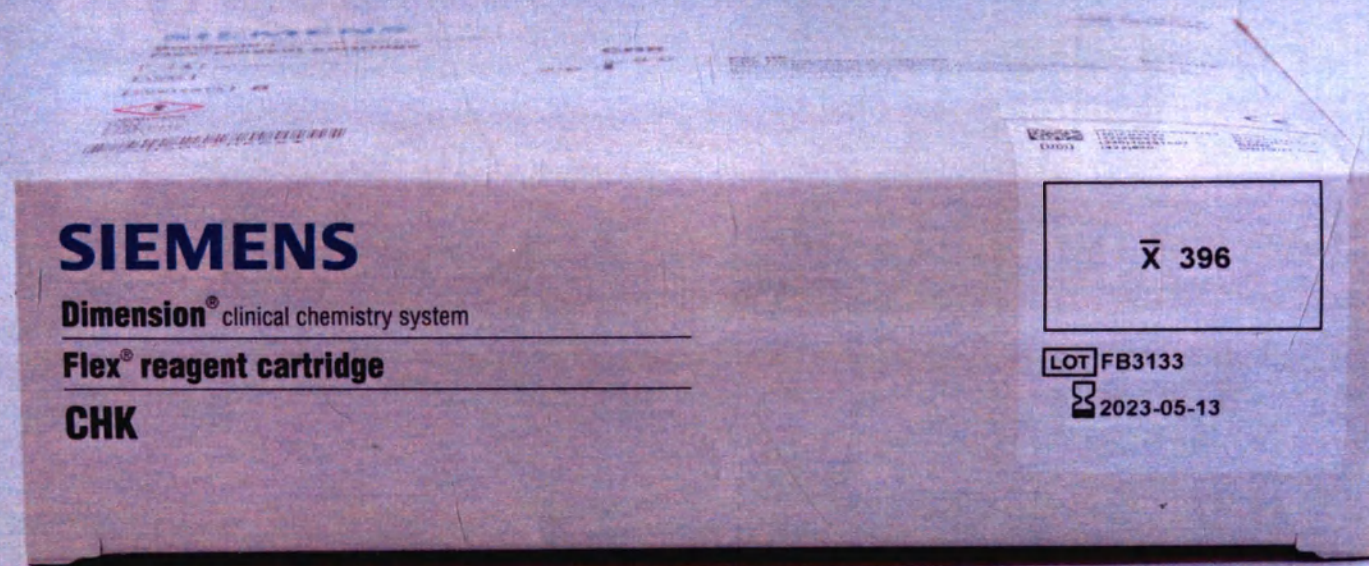


Рисунок 2. Картридж с реагентом CHK (проверочный) для биохимических анализаторов серии "Dimension" (Dimension CHK Flex reagent Cartridge (CHK)) – вид сбоку



Рисунок 3. Картридж с реагентом CHK (проверочный) для биохимических анализаторов серии "Dimension" (Dimension CHK Flex reagent Cartridge (CHK)) – общий вид медицинского изделия

10481507

Картридж с реагентом CHK (проверочный) для
биохимических анализаторов серии "Dimension"
(Dimension CHK Flex reagent Cartridge (CHK))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2018/7432 от 01.08.2018

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Тел.: 8(800) 550-50-22

Рисунок 4. Картридж с реагентом CHK (проверочный) для биохимических анализаторов серии "Dimension" (Dimension CHK Flex reagent Cartridge (CHK)) – русскоязычная маркировка
медицинского изделия

Всего прошито и пронумеровано
3 листа (ов).

ООО «Сиенс Здоровоохранение»

